

«УТВЕРЖДАЮ»

Управляющий - индивидуальный предприниматель  
ООО «БИ Плюс»



В.Ф. Потака

«19» апреля 2023г.

**МАКЕТ УПАКОВКИ**

медицинского изделия

**Перчатки медицинские диагностические нестерильные  
нитриловые Libry®**

ТУ 22.19.60-005-19812462-2020

г. Санкт-Петербург

## Содержание

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Макет упаковки медицинского изделия (горизонтальный) ..... | 3  |
| Макет упаковки медицинского изделия (вертикальный) .....   | 30 |

Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® одноразовые неопудренные с однократной хлоринацией, текстурированные на пальцах, стандартная манжета 240 мм с валиком; цвет: голубой, фиолетовый, зеленый, красный, розовый, черный, белый; размер: XS, S, M, L, XL. Цвет медицинского изделия – голубой.



**Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® по ТУ 22.19.60-005-19812462-2020: Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® одноразовые неопудренные с однократной хлоринацией, текстурированные на пальцах, стандартная манжета 240 мм с валиком; цвет: голубой; размер: XS, S, M, L, XL**

**НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Перчатки предназначены для одноразового использования при защите рук медицинского персонала и создания барьера от бактериальной и/или вирусной контаминации между медицинским работником и пациентом при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, при работе с зараженными медицинскими материалами, а также при возможной аллергии на латекс и опудривающее вещество.

**УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Транспортирование перчаток производится всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения. Перчатки должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей или яркого искусственного света, имеющего высокое содержание ультрафиолета, при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха – от 65% до 85% в течение всего срока годности. В помещениях для хранения не допускается размещать оборудование, генерирующее озон, такое как ртутные лампы или высоковольтное электрооборудование, являющееся источником повышенного искрообразования или бесшумных электрических разрядов. Изделия необходимо хранить вдали от источников возгорания. Горючие газы и органические пары должны быть исключены из складских помещений. Следует быть осторожными с изделиями, хранящимися при температуре ниже 15°C, так как при неосторожном обращении они могут быть жесткими и чувствительными к деформации. После хранения при низкой температуре перчатки перед использованием должны быть прогреты до 30°C по всему объему изделия.

Изделия, пришедшие в непригодность, в том числе в связи с истечением срока годности, а также при нарушении целостности упаковки, подлежат утилизации как отходы класса А в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21. Уничтожение изделий осуществляется организациями, имеющими соответствующую лицензию, на специально оборудованных площадках, полигонах и в помещениях в соответствии с требованиями, предусмотренными существующими Федеральным законам, и с соблюдением обязательных требований по охране окружающей среды.

Использованные изделия перед уничтожением дезинфицируют и складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21.

**МАТЕРИАЛ:** нитрил.

**ВНИМАНИЕ! ПЕРЧАТКИ НЕ ГАРАНТИРУЮТ 100% ЗАЩИТЫ РУК ОТ ПРОКОЛОВ, ПОРЕЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Надевание диагностических перчаток не требует применения чрезмерной силы во избежание нарушения их целостности. Перед применением перчаток медицинские работники проводят гигиеническую обработку рук в соответствии с режимом манипуляции. Достаньте перчатку из упаковки. Аккуратно наденьте первую перчатку на руку, осторожно расправьте манжету перчатки на руке до запястья. Возьмите вторую перчатку из упаковки. Повторите действия для второй руки, затем легкими движениями расправьте перчатки по форме рук, обеспечив их комфортное использование.

Снимать использованные перчатки следует осторожно, избегая разбрызгивания с поверхностей перчатки, при котором возможно микробное загрязнение рук и окружающей среды.

Чтобы снять перчатки, возьмитесь за первую перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Стяните перчатку и удерживайте ее другой рукой. Затем поместите пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и стяните ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, используйте ее в качестве мешка для другой перчатки. Поместите перчатки в предназначенную для них емкость для отходов. Затем проведите гигиеническую обработку рук.

**УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Перчатки должны применяться в соответствии с инструкцией на медицинское изделие. Применение изделия не требует специальной квалификации или специального образования. Изделие предназначено только для одноразового применения.

Перчатки применяются в лечебных или лечебно-профилактических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от 15°C до 25°C и относительной влажности от 65% до 85%. Необходимо подбирать перчатки нужного размера и в зависимости от характера выполняемых манипуляций – они должны легко надеваться и не должны затруднять движения или сдавливать кисти рук. Не применять при несоответствии размера. Только для индивидуального применения. Не использовать одну и ту же пару одноразовых перчаток при проведении медицинских манипуляций нескольким пациентам, а также при выполнении медицинских манипуляций у одного пациента, но в различных анатомических областях, отличающихся по составу микрофлоры. Перчатки во время выполнения манипуляций не рекомендуется обрабатывать антисептическими и дезинфицирующими средствами, так как это отрицательно влияет на их герметичность и может привести к усилению проницаемости.

ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62; [www.benovydent.ru](http://www.benovydent.ru), [beplus@beplus.spb.ru](mailto:beplus@beplus.spb.ru).

ТУ 22.19.60-005-19812462-2020.

Соответствует ГОСТ 32337-2013.


ПУ № РЗН 2022/17641 от 30.06.2022 г.

Не подлежит обязательной сертификации.

**СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:** 5 лет. Не использовать по истечении срока годности.

**ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.** Производитель гарантирует соответствие качества перчаток требованиям нормативной и технической документации при соблюдении правил использования, транспортирования и хранения. Безопасность и качество изделия гарантируется в течение всего срока годности.



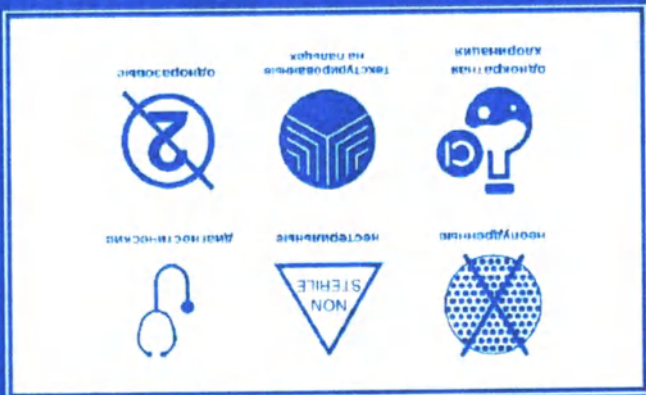

Цвет медицинского изделия – фиолетовый.



**Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® по ТУ 22.19.60-005-19812462-2020: Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® одноразовые неопудренные с однократной хлоринацией, текстурированные на пальцах, стандартная манжета 240 мм с валиком; цвет: фиолетовый; размер: XS, S, M, L, XL.**

**НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Перчатки предназначены для одноразового использования при защите рук медицинского персонала и создания барьера от бактериальной и/или вирусной контаминации между медицинским работником и пациентом при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, при работе с зараженными медицинскими материалами, а также при возможной аллергии на латекс и опудривающее вещество.

**УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Транспортирование перчаток производится всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения. Перчатки должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей или яркого искусственного света, имеющего высокое содержание ультрафиолета, при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха – от 65% до 85% в течение всего срока годности. В помещениях для хранения не допускается размещать оборудование, генерирующее озон, такое как ртутные лампы или высоковольтное электрооборудование, являющееся источником повышенного искрообразования или бесшумных электрических разрядов. Изделия необходимо хранить вдали от источников возгорания. Горючие газы и органические пары должны быть исключены из складских помещений. Следует быть осторожными с изделиями, хранящимися при температуре ниже 15°C, так как при неосторожном обращении они могут быть жесткими и чувствительными к деформации. После хранения при низкой температуре перчатки перед использованием должны быть прогреты до 30°C по всему объему изделия.

Изделия, пришедшие в непригодность, в том числе в связи с истечением срока годности, а также при нарушении целостности упаковки, подлежат утилизации как отходы класса А в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21. Уничтожение изделий осуществляется организациями, имеющими соответствующую лицензию, на специально оборудованных площадках, полигонах и в помещениях в соответствии с требованиями, предусмотренными существующими Федеральным законам, и с соблюдением обязательных требований по охране окружающей среды.

Использованные изделия перед уничтожением дезинфицируют и складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21.

**МАТЕРИАЛ:** нитрил.

**ВНИМАНИЕ! ПЕРЧАТКИ НЕ ГАРАНТИРУЮТ 100% ЗАЩИТЫ РУК ОТ ПРОКОЛОВ, ПОРЕЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Надевание диагностических перчаток не требует применения чрезмерной силы во избежание нарушения их целостности. Перед применением перчаток медицинские работники проводят гигиеническую обработку рук в соответствии с режимом манипуляции. Достаньте перчатку из упаковки. Аккуратно наденьте первую перчатку на руку, осторожно расправьте манжету перчатки на руке до запястья. Возьмите вторую перчатку из упаковки. Повторите действия для второй руки, затем легкими движениями расправьте перчатки по форме рук, обеспечив их комфортное использование.

Снимать использованные перчатки следует осторожно, избегая разбрызгивания с поверхностей перчатки, при котором возможно микробное загрязнение рук и окружающей среды.

Чтобы снять перчатки, возьмитесь за первую перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Стяните перчатку и удерживайте ее другой рукой. Затем поместите пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и стяните ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, используйте ее в качестве мешка для другой перчатки. Поместите перчатки в предназначенную для них емкость для отходов. Затем проведите гигиеническую обработку рук.

**УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Перчатки должны применяться в соответствии с инструкцией на медицинское изделие. Применение изделия не требует специальной квалификации или специального образования. Изделие предназначено только для одноразового применения.

Перчатки применяются в лечебных или лечебно-профилактических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от 15°C до 25°C и относительной влажности от 65% до 85%. Необходимо подбирать перчатки нужного размера и в зависимости от характера выполняемых манипуляций – они должны легко надеваться и не должны затруднять движения или сдавливать кисти рук. Не применять при несоответствии размера. Только для индивидуального применения. Не использовать одну и ту же пару одноразовых перчаток при проведении медицинских манипуляций нескольким пациентам, а также при выполнении медицинских манипуляций у одного пациента, но в различных анатомических областях, отличающихся по составу микрофлоры. Перчатки во время выполнения манипуляций не рекомендуется обрабатывать антисептическими и дезинфицирующими средствами, так как это отрицательно влияет на их герметичность и может привести к усилению проницаемости.

ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62; [www.benovy dental.ru](http://www.benovy dental.ru), [beplus@beplus.spb.ru](mailto:beplus@beplus.spb.ru).

ТУ 22.19.60-005-19812462-2020.

Соответствует ГОСТ 32337-2013.

РУ № РЗН 2022/17641 от 30.06.2022 г.

Не подлежат обязательной сертификации.

**СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:** 5 лет. Не использовать по истечении срока годности.

**ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.** Производитель гарантирует соответствие качества перчаток требованиям нормативной и технической документации при соблюдении правил использования, транспортирования и хранения. Безопасность и качество изделия гарантируется в течение всего срока годности.





**НИТРИЛ**  
**ФИОЛЕТОВЫЙ**  
XXX пар



непудренные



нестерильные



диагностические



однократная  
хлоринация



текстурированные  
на пальцах



одноразовые

Цвет медицинского изделия – красный.



**Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® по ТУ 22.19.60-005-19812462-2020: Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® одноразовые неопудренные с однократной хлоринацией, текстурированные на пальцах, стандартная манжета 240 мм с валиком; цвет: красный; размер: XS, S, M, L, XL.**

**НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Перчатки предназначены для одноразового использования при защите рук медицинского персонала и создания барьера от бактериальной и/или вирусной контаминации между медицинским работником и пациентом при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, при работе с зараженными медицинскими материалами, а также при возможной аллергии на латекс и опудривающее вещество.

**УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Транспортирование перчаток производится всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения. Перчатки должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей или яркого искусственного света, имеющего высокое содержание ультрафиолета, при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха – от 65% до 85% в течение всего срока годности. В помещениях для хранения не допускается размещать оборудование, генерирующее озон, такое как ртутные лампы или высоковольтное электрооборудование, являющееся источником повышенного искрообразования или бесшумных электрических разрядов. Изделия необходимо хранить вдали от источников возгорания. Горючие газы и органические пары должны быть исключены из складских помещений. Следует быть осторожными с изделиями, хранящимися при температуре ниже 15°C, так как при неосторожном обращении они могут быть жесткими и чувствительными к деформации. После хранения при низкой температуре перчатки перед использованием должны быть прогреты до 30°C по всему объему изделия.

Изделия, пришедшие в негодность, в том числе в связи с истечением срока годности, а также при нарушении целостности упаковки, подлежат утилизации как отходы класса А в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21. Уничтожение изделий осуществляется организациями, имеющими соответствующую лицензию, на специально оборудованных площадках, полигонах и в помещениях в соответствии с требованиями, предусмотренными существующими Федеральными законами, и с соблюдением обязательных требований по охране окружающей среды.

Использованные изделия перед уничтожением дезинфицируют и складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21.

**МАТЕРИАЛ:** нитрил.

**ВНИМАНИЕ! ПЕРЧАТКИ НЕ ГАРАНТИРУЮТ 100% ЗАЩИТЫ РУК ОТ ПРОКОЛОВ, ПОРЕЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Надевание диагностических перчаток не требует применения чрезмерной силы во избежание нарушения их целостности. Перед применением перчаток медицинские работники проводят гигиеническую обработку рук в соответствии с режимом манипуляции. Достаньте перчатку из упаковки. Аккуратно наденьте первую перчатку на руку, осторожно расправьте манжету перчатки на руке до запястья. Возьмите вторую перчатку из упаковки. Повторите действия для второй руки, затем легкими движениями расправьте перчатки по форме рук, обеспечив их комфортное использование.

Снимать использованные перчатки следует осторожно, избегая разбрызгивания с поверхностей перчатки, при котором возможно микробное загрязнение рук и окружающей среды.

Чтобы снять перчатки, возьмитесь за первую перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Стяните перчатку и удерживайте ее другой рукой. Затем поместите пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и стяните ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, используйте ее в качестве мешка для другой перчатки. Поместите перчатки в предназначенную для них емкость для отходов. Затем проведите гигиеническую обработку рук.

**УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Перчатки должны применяться в соответствии с инструкцией на медицинское изделие. Применение изделия не требует специальной квалификации или специального образования. Изделие предназначено только для одноразового применения.

Перчатки применяются в лечебных или лечебно-профилактических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от 15°C до 25°C и относительной влажности от 65% до 85%. Необходимо подбирать перчатки нужного размера и в зависимости от характера выполняемых манипуляций – они должны легко надеваться и не должны затруднять движения или сдавливать кисти рук. Не применять при несоответствии размера. Только для индивидуального применения. Не использовать одну и ту же пару одноразовых перчаток при проведении медицинских манипуляций нескольким пациентам, а также при выполнении медицинских манипуляций у одного пациента, но в различных анатомических областях, отличающихся по составу микрофлоры. Перчатки во время выполнения манипуляций не рекомендуется обрабатывать антисептическими и дезинфицирующими средствами, так как это отрицательно влияет на их герметичность и может привести к усилению проницаемости.

ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62; [www.benovydental.ru](mailto:berplus@berplus.spb.ru), [berplus@berplus.spb.ru](mailto:berplus@berplus.spb.ru).

ТУ 22.19.60-005-19812462-2020.

Соответствует ГОСТ 32337-2013.

РУ № РЗН 2022/17641 от 30.06.2022 г.

Не подлежит обязательной сертификации.


**СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:** 5 лет. Не использовать по истечении срока годности.

**ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.** Производитель гарантирует соответствие качества перчаток требованиям нормативной и технической документации при соблюдении правил использования, транспортирования и хранения. Безопасность и качество изделия гарантируется в течение всего срока годности.

XXXXXX

XXXXXX



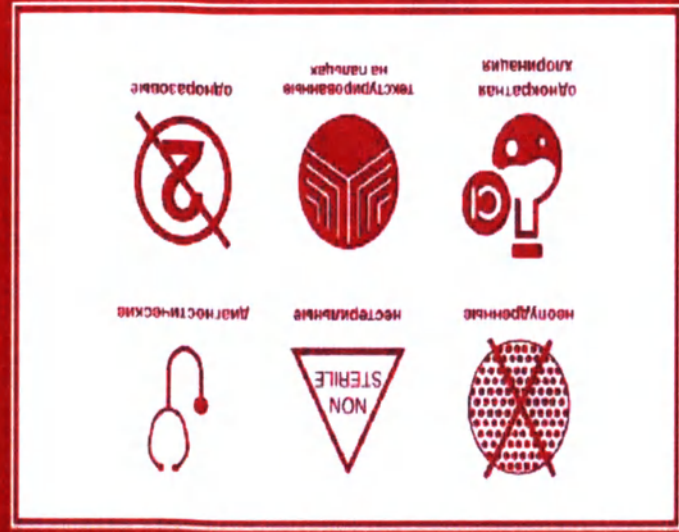

Цвет медицинского изделия – розовый.



**Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® по ТУ 22.19.60-005-19812462-2020: Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® одноразовые неопудренные с однократной хлоринацией, текстурированные на пальцах, стандартная манжета 240 мм с валиком; цвет: розовый; размер: XS, S, M, L, XL.**

**НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Перчатки предназначены для одноразового использования при защите рук медицинского персонала и создания барьера от бактериальной и/или вирусной контаминации между медицинским работником и пациентом при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, при работе с зараженными медицинскими материалами, а также при возможной аллергии на латекс и опудривающее вещество.

**УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Транспортирование перчаток производится всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения. Перчатки должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей или яркого искусственного света, имеющего высокое содержание ультрафиолета, при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха – от 65% до 85% в течение всего срока годности. В помещениях для хранения не допускается размещать оборудование, генерирующее озон, такое как ртутные лампы или высоковольтное электрооборудование, являющееся источником повышенного искрообразования или бесшумных электрических разрядов. Изделия необходимо хранить вдали от источников возгорания. Горючие газы и органические пары должны быть исключены из складских помещений. Следует быть осторожными с изделиями, хранящимися при температуре ниже 15°C, так как при неосторожном обращении они могут быть жесткими и чувствительными к деформации. После хранения при низкой температуре перчатки перед использованием должны быть прогреты до 30°C по всему объему изделия.

Изделия, пришедшие в непригодность, в том числе в связи с истечением срока годности, а также при нарушении целостности упаковки, подлежат утилизации как отходы класса А в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21. Уничтожение изделий осуществляется организациями, имеющими соответствующую лицензию, на специально оборудованных площадках, полигонах и в помещениях в соответствии с требованиями, предусмотренными существующими Федеральным законом, и с соблюдением обязательных требований по охране окружающей среды.

Использованные изделия перед уничтожением дезинфицируют и складируют в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21.

**МАТЕРИАЛ:** нитрил.

**ВНИМАНИЕ! ПЕРЧАТКИ НЕ ГАРАНТИРУЮТ 100% ЗАЩИТЫ РУК ОТ ПРОКОЛОВ, ПОРЕЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Надевание диагностических перчаток не требует применения чрезмерной силы во избежание нарушения их целостности. Перед применением перчаток медицинские работники проводят гигиеническую обработку рук в соответствии с режимом манипуляции. Достаньте перчатку из упаковки. Аккуратно наденьте первую перчатку на руку, осторожно расправьте манжету перчатки на руке до запястья. Возьмите вторую перчатку из упаковки. Повторите действия для второй руки, затем легкими движениями расправьте перчатки по форме рук, обеспечив их комфортное использование.

Снимать использованные перчатки следует осторожно, избегая разбрызгивания с поверхностей перчатки, при котором возможно микробное загрязнение рук и окружающей среды.

Чтобы снять перчатки, возьмитесь за первую перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Стяните перчатку и удерживайте ее другой рукой. Затем поместите пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и стяните ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, используйте ее в качестве мешка для другой перчатки. Поместите перчатки в предназначенную для них емкость для отходов. Затем проведите гигиеническую обработку рук.

**УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Перчатки должны применяться в соответствии с инструкцией на медицинское изделие. Применение изделия не требует специальной квалификации или специального образования. Изделие предназначено только для одноразового применения.

Перчатки применяются в лечебных или лечебно-профилактических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от 15°C до 25°C и относительной влажности от 65% до 85%. Необходимо подбирать перчатки нужного размера и в зависимости от характера выполняемых манипуляций – они должны легко надеваться и не должны затруднять движения или сдавливать кисти рук. Не применять при несоответствии размера. Только для индивидуального применения. Не использовать одну и ту же пару одноразовых перчаток при проведении медицинских манипуляций нескольким пациентам, а также при выполнении медицинских манипуляций у одного пациента, но в различных анатомических областях, отличающихся по составу микрофлоры. Перчатки во время выполнения манипуляций не рекомендуется обрабатывать антисептическими и дезинфицирующими средствами, так как это отрицательно влияет на их герметичность и может привести к усилению проницаемости.

■ ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62; [www.benovydenal.ru](http://www.benovydenal.ru), [beplus@beplus.spb.ru](mailto:beplus@beplus.spb.ru).

ТУ 22.19.60-005-19812462-2020.


Соответствует ГОСТ 32337-2013.

РУ № РЗН 2022/17641 от 30.06.2022 г.

Не подлежит обязательной сертификации.


**СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:** 5 лет. Не использовать по истечении срока годности.

**ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.** Производитель гарантирует соответствие качества перчаток требованиям нормативной и технической документации при соблюдении правил использования, транспортирования и хранения. Безопасность и качество изделия гарантируется в течение всего срока годности.

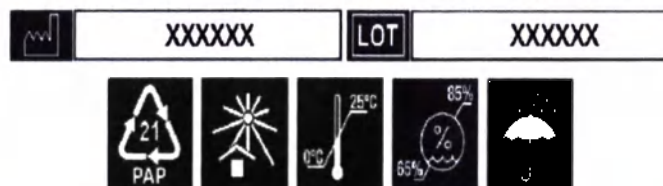

*Liberty*

НИТРИЛ  
 РОЗОВЫЙ  
 XXX пар

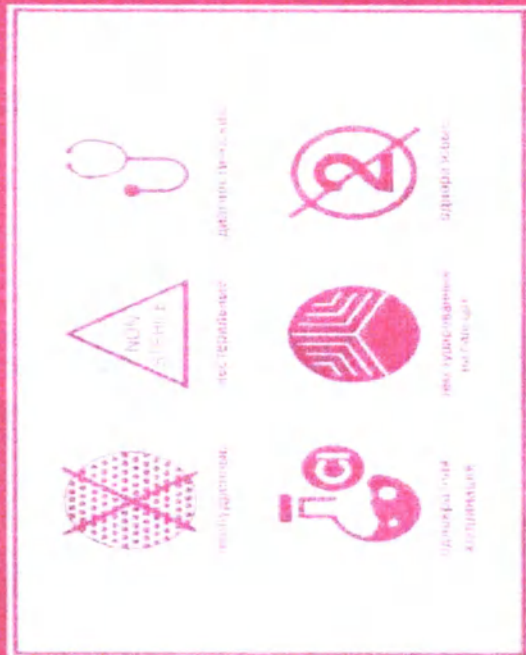

Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® одноразовые неопудренные с однократной хлоринацией, текстурированные по всей поверхности ладони, стандартная манжета 240 мм с валиком; цвет: голубой, фиолетовый, зеленый, красный, розовый, черный, белый; размер: XS, S, M, L, XL.

**Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® по ТУ 22.19.60-005-19812462-2020: Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® одноразовые неопудренные с однократной хлоринацией, текстурированные по всей поверхности ладони, стандартная манжета 240 мм с валиком; цвет: зеленый; размер: XS, S, M, L, XL.**

**НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Перчатки предназначены для одноразового использования при защите рук медицинского персонала и создания барьера от бактериальной и/или вирусной контаминации между медицинским работником и пациентом при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, при работе с зараженными медицинскими материалами, а также при возможной аллергии на латекс и опудривающее вещество.

**УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Транспортирование перчаток производится всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения. Перчатки должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей или яркого искусственного света, имеющего высокое содержание ультрафиолета, при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха – от 65% до 85% в течение всего срока годности. В помещениях для хранения не допускается размещать оборудование, генерирующее озон, такое как ртутные лампы или высоковольтное электрооборудование, являющееся источником повышенного искрообразования или бесшумных электрических разрядов. Изделия необходимо хранить вдали от источников возгорания. Горючие газы и органические пары должны быть исключены из складских помещений. Следует быть осторожными с изделиями, хранящимися при температуре ниже 15°C, так как при неосторожном обращении они могут быть жесткими и чувствительными к деформации. После хранения при низкой температуре перчатки перед использованием должны быть прогреты до 30°C по всему объему изделия.

Изделия, пришедшие в непригодность, в том числе в связи с истечением срока годности, а также при нарушении целостности упаковки, подлежат утилизации как отходы класса А в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21. Уничтожение изделий осуществляется организациями, имеющими соответствующую лицензию, на специально оборудованных площадках, полигонах и в помещениях в соответствии с требованиями, предусмотренными существующими Федеральным законами, и с соблюдением обязательных требований по охране окружающей среды.

Использованные изделия перед уничтожением дезинфицируют и складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21.

**МАТЕРИАЛ:** нитрил.

**ВНИМАНИЕ! ПЕРЧАТКИ НЕ ГАРАНТИРУЮТ 100% ЗАЩИТЫ РУК ОТ ПРОКОЛОВ, ПОРЕЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Надевание диагностических перчаток не требует применения чрезмерной силы во избежание нарушения их целостности. Перед применением перчаток медицинские работники проводят гигиеническую обработку рук в соответствии с режимом манипуляции. Достаньте перчатку из упаковки. Аккуратно наденьте первую перчатку на руку, осторожно расправьте манжету перчатки на руке до запястья. Возьмите вторую перчатку из упаковки. Повторите действия для второй руки, затем легкими движениями расправьте перчатки по форме рук, обеспечив их комфортное использование.

Снимать использованные перчатки следует осторожно, избегая разбрызгивания с поверхностей перчатки, при котором возможно микробное загрязнение рук и окружающей среды.

Чтобы снять перчатки, возьмитесь за первую перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Стяните перчатку и удерживайте ее другой рукой. Затем поместите пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и стяните ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, используйте ее в качестве мешка для другой перчатки. Поместите перчатки в предназначенную для них емкость для отходов. Затем проведите гигиеническую обработку рук.

**УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Перчатки должны применяться в соответствии с инструкцией на медицинское изделие. Применение изделия не требует специальной квалификации или специального образования. Изделие предназначено только для одноразового применения.

Перчатки применяются в лечебных или лечебно-профилактических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от 15°C до 25°C и относительной влажности от 65% до 85%. Необходимо подбирать перчатки нужного размера и в зависимости от характера выполняемых манипуляций – они должны легко надеваться и не должны затруднять движения или сдавливать кисти рук. Не применять при несоответствии размера. Только для индивидуального применения. Не использовать одну и ту же пару одноразовых перчаток при проведении медицинских манипуляций нескольким пациентам, а также при выполнении медицинских манипуляций у одного пациента, но в различных анатомических областях, отличающихся по составу микрофлоры. Перчатки во время выполнения манипуляций не рекомендуется обрабатывать антисептическими и дезинфицирующими средствами, так как это отрицательно влияет на их герметичность и может привести к усилению проницаемости.

■ ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62; [www.benovydent.ru](http://www.benovydent.ru), [beplus@beplus.spb.ru](mailto:beplus@beplus.spb.ru).

ТУ 22.19.60-005-19812462-2020.


Соответствует ГОСТ 32337-2013.


ПУ № РЗН 2022/17641 от 30.06.2022 г.

Не подлежит обязательной сертификации.

**СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:** 5 лет. Не использовать по истечении срока годности.

**ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.** Производитель гарантирует соответствие качества перчаток требованиям нормативной и технической документации при соблюдении правил использования, транспортирования и хранения. Безопасность и качество изделия гарантируется в течение всего срока годности.

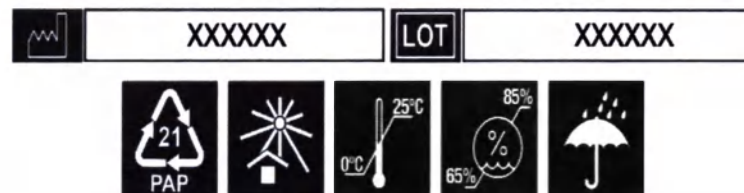

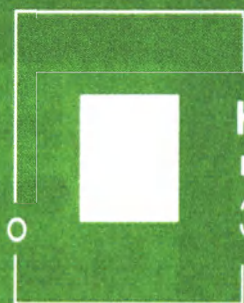

НИТРИЛ  
ЗЕЛЕНый

XXX пар



неопундренные



нестерильные



диагностические



однократная  
хлоринация



текстурированные по  
всей поверхности ладони



одноразовые

Цвет медицинского изделия – голубой.

[illegible]

**Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® по ТУ 22.19.60-005-19812462-2020: Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® одноразовые неопудренные с полимерным покрытием, текстурированные на пальцах, стандартная манжета 240 мм с валиком; цвет: голубой; размер: XS, S, M, L, XL.**

**НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Перчатки предназначены для одноразового использования при защите рук медицинского персонала и создания барьера от бактериальной и/или вирусной контаминации между медицинским работником и пациентом при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, при работе с зараженными медицинскими материалами, а также при возможной аллергии на латекс и опудривающее вещество.

**УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Транспортирование перчаток производится всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения. Перчатки должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей или яркого искусственного света, имеющего высокое содержание ультрафиолета, при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха – от 65% до 85% в течение всего срока годности. В помещениях для хранения не допускается размещать оборудование, генерирующее озон, такое как ртутные лампы или высоковольтное электрооборудование, являющееся источником повышенного искрообразования или бесшумных электрических разрядов. Изделия необходимо хранить вдали от источников возгорания. Горючие газы и органические пары должны быть исключены из складских помещений. Следует быть осторожными с изделиями, хранящимися при температуре ниже 15°C, так как при неосторожном обращении они могут быть жесткими и чувствительными к деформации. После хранения при низкой температуре перчатки перед использованием должны быть прогреты до 30°C по всему объему изделия.

Изделия, пришедшие в негодность, в том числе в связи с истечением срока годности, а также при нарушении целостности упаковки, подлежат утилизации как отходы класса А в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21. Уничтожение изделий осуществляется организациями, имеющими соответствующую лицензию, на специально оборудованных площадках, полигонах и в помещениях в соответствии с требованиями, предусмотренными существующими Федеральным законам, и с соблюдением обязательных требований по охране окружающей среды.

Использованные изделия перед уничтожением дезинфицируют и складируют в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21.

**МАТЕРИАЛ:** нитрил.

**ВНИМАНИЕ! ПЕРЧАТКИ НЕ ГАРАНТИРУЮТ 100% ЗАЩИТЫ РУК ОТ ПРОКОЛОВ, ПОРЕЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Надевание диагностических перчаток не требует применения чрезмерной силы во избежание нарушения их целостности. Перед применением перчаток медицинские работники проводят гигиеническую обработку рук в соответствии с режимом манипуляции. Достаньте перчатку из упаковки. Аккуратно наденьте первую перчатку на руку, осторожно расправьте манжету перчатки на руке до запястья. Возьмите вторую перчатку из упаковки. Повторите действия для второй руки, затем легкими движениями расправьте перчатки по форме рук, обеспечив их комфортное использование.

Снимать использованные перчатки следует осторожно, избегая разбрызгивания с поверхностей перчаток, при котором возможно микробное загрязнение рук и окружающей среды.

Чтобы снять перчатки, возьмитесь за первую перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Стяните перчатку и удерживайте ее другой рукой. Затем поместите пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и стяните ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, используйте ее в качестве мешка для другой перчатки. Поместите перчатки в предназначенную для них емкость для отходов. Затем проведите гигиеническую обработку рук.

**УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Перчатки должны применяться в соответствии с инструкцией на медицинское изделие. Применение изделия не требует специальной квалификации или специального образования. Изделие предназначено только для одноразового применения.

Перчатки применяются в лечебных или лечебно-профилактических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от 15°C до 25°C и относительной влажности от 65% до 85%. Необходимо подбирать перчатки нужного размера и в зависимости от характера выполняемых манипуляций – они должны легко надеваться и не должны затруднять движения или сдавливать кисти рук. Не применять при несоответствии размера. Только для индивидуального применения. Не использовать одну и ту же пару одноразовых перчаток при проведении медицинских манипуляций нескольким пациентам, а также при выполнении медицинских манипуляций у одного пациента, но в различных анатомических областях, отличающихся по составу микрофлоры. Перчатки во время выполнения манипуляций не рекомендуется обрабатывать антисептическими и дезинфицирующими средствами, так как это отрицательно влияет на их герметичность и может привести к усилению проницаемости.

ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62; [www.benovydent.ru](http://www.benovydent.ru), [beplus@beplus.spb.ru](mailto:beplus@beplus.spb.ru).

ТУ 22.19.60-005-19812462-2020.


Соответствует ГОСТ 32337-2013.


РУ № РЗН 2022/17641 от 30.06.2022 г.

Не подлежит обязательной сертификации.

**СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:** 5 лет. Не использовать по истечении срока годности.

**ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.** Производитель гарантирует соответствие качества перчаток требованиям нормативной и технической документации при соблюдении правил использования, транспортирования и хранения. Безопасность и качество изделия гарантируется в течение всего срока годности.

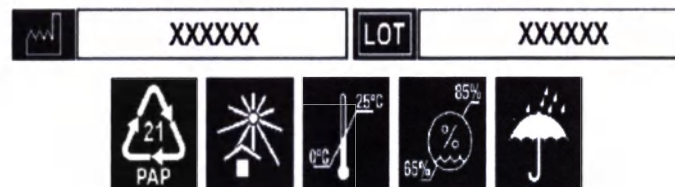

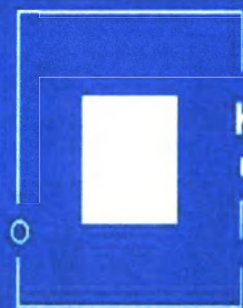

НИТРИЛ  
ГОЛУБОЙ  
XXX пар




непудренные



нестерильные



диагностические



полимерное  
покрытие



текстурированные  
на пальцах



одноразовые

Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® одноразовые неопудренные с однократной хлоринацией, текстурированные по всей поверхности ладони, удлиненная манжета 300 мм с валиком; цвет: голубой, фиолетовый, зеленый, красный, розовый, черный, белый; размер: XS, S, M, L, XL.

[illegible]

**Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® по ТУ 22.19.60-005-19812462-2020: Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® одноразовые неопудренные с однократной хлоринацией, текстурированные по всей поверхности ладони, удлиненная манжета 300 мм с валиком; цвет: голубой; размер: XS, S, M, L, XL.**

**НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Перчатки предназначены для одноразового использования при защите рук медицинского персонала и создания барьера от бактериальной и/или вирусной контаминации между медицинским работником и пациентом при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, при работе с зараженными медицинскими материалами, а также при возможной аллергии на латекс и опудривающее вещество.

**УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Транспортирование перчаток производится всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Перчатки должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей или яркого искусственного света, имеющего высокое содержание ультрафиолета, при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха – от 65% до 85% в течение всего срока годности.

В помещениях для хранения не допускается размещать оборудование, генерирующее озон, такое как ртутные лампы или высоковольтное электрооборудование, являющееся источником повышенного искробразования или бесшумных электрических разрядов. Изделия необходимо хранить вдали от источников возгорания. Горючие газы и органические пары должны быть исключены из складских помещений.

Следует быть осторожными с изделиями, хранящимися при температуре ниже 15°C, так как при неосторожном обращении они могут быть жесткими и чувствительными к деформации. После хранения при низкой температуре перчатки перед использованием должны быть прогреты до 30°C по всему объему изделия.

Изделия, пришедшие в непригодность, в том числе в связи с истечением срока годности, а также при нарушении целостности упаковки, подлежат утилизации как отходы класса А в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21.

Уничтожение изделий осуществляется организациями, имеющими соответствующую лицензию, на специально оборудованных площадках, полигонах и в помещениях в соответствии с требованиями, предусмотренными существующими Федеральным законам, и с соблюдением обязательных требований по охране окружающей среды.

Использованные изделия перед уничтожением дезинфицируют и складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21.

**МАТЕРИАЛ:** нитрил.

**ВНИМАНИЕ! ПЕРЧАТКИ НЕ ГАРАНТИРУЮТ 100% ЗАЩИТЫ РУК ОТ ПРОКОЛОВ, ПОРЕЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Надевание диагностических перчаток не требует применения чрезмерной силы во избежание нарушения их целостности. Перед применением перчаток медицинские работники проводят гигиеническую обработку рук в соответствии с режимом манипуляции.

Достаньте перчатку из упаковки. Аккуратно наденьте первую перчатку на руку, осторожно расправьте манжету перчатки на руке до запястья. Возьмите вторую перчатку из упаковки. Повторите действия для второй руки, затем легкими движениями расправьте перчатки по форме рук, обеспечив их комфортное использование.

Снимать использованные перчатки следует осторожно, избегая разбрызгивания с поверхностей перчатки, при котором возможно микробное загрязнение рук и окружающей среды.

Чтобы снять перчатки, возьмитесь за первую перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Сняв перчатку и удерживайте ее другой рукой. Затем поместите пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и снимите ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, используйте ее в качестве мешка для другой перчатки. Поместите перчатки в предназначенную для них емкость для отходов. Затем проведите гигиеническую обработку рук.

**УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Перчатки должны применяться в соответствии с инструкцией на медицинское изделие. Применение изделия не требует специальной квалификации или специального образования. Изделие предназначено только для одноразового применения.

Перчатки применяются в лечебных или лечебно-профилактических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от 15°C до 25°C и относительной влажности от 65% до 85%.

Необходимо подбирать перчатки нужного размера и в зависимости от характера выполняемых манипуляций – они должны легко надеваться и не должны затруднять движения или сдавливать кисти рук. Не применять при несоответствии размера. Только для индивидуального применения. Не использовать одну и ту же пару одноразовых перчаток при проведении медицинских манипуляций нескольким пациентам, а также при выполнении медицинских манипуляций у одного пациента, но в различных анатомических областях, отличающихся по составу микрофлоры.

Перчатки во время выполнения манипуляций не рекомендуется обрабатывать антисептическими и дезинфицирующими средствами, так как это отрицательно влияет на их герметичность и может привести к усилению проницаемости.

ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62; [www.benovydental.ru](http://www.benovydental.ru), [beplus@beplus.spb.ru](mailto:beplus@beplus.spb.ru).

ТУ 22.19.60-005-19812462-2020.

Соответствует ГОСТ 32337-2013.



РУ № РЗН 2022/17641 от 30.06.2022 г.

Не подлежит обязательной сертификации.

**СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:** 5 лет. Не использовать по истечении срока годности.

**ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.** Производитель гарантирует соответствие качества перчаток требованиям нормативной и технической документации при соблюдении правил использования, транспортирования и хранения. Безопасность и качество изделия гарантируется в течение всего срока годности.



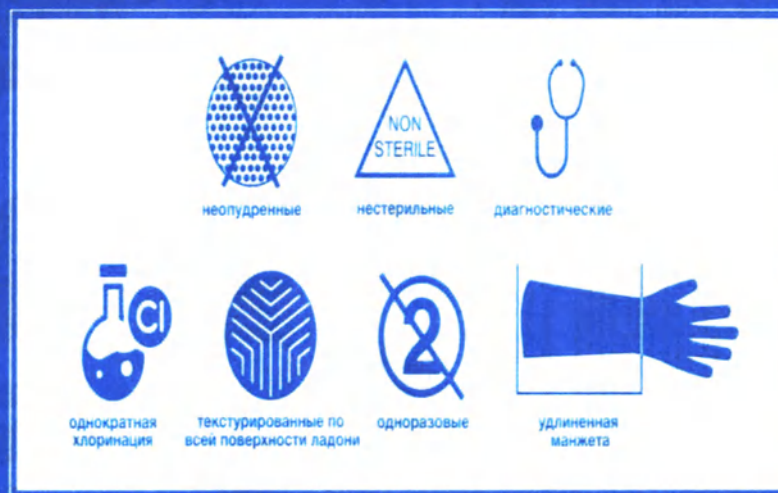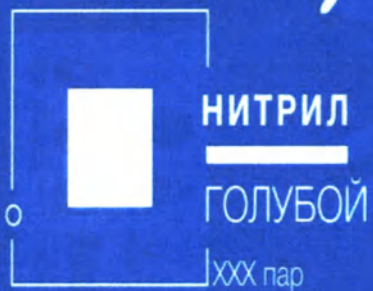

Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® одноразовые неопудренные с однократной хлоринацией, текстурированные по всей поверхности ладони, удлиненная манжета 300 мм с валиком; цвет: голубой, фиолетовый, зеленый, красный, розовый, черный, белый; размер: XS, S, M, L, XL.

|                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>manuale<br/>antiscivolo</p>  | <p>antiscivolo</p>              | <p>analisi acustica: tipo<br/>di prevenzione/uso</p>  | <p>antiscivolo<br/>antiscivolo</p>  |
| <p>antiscivolo/antiscivolo</p>  | <p>antiscivolo/antiscivolo</p>  | <p>antiscivolo/antiscivolo</p>                        |                                                                                                                      |



# Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® по ТУ 22.19.60-005-19812462-2020: Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® одноразовые неопудренные с однократной хлоринацией, текстурированные по всей поверхности ладони, удлиненная манжета 300 мм с валиком; цвет: черный; размер: XS, S, M, L, XL.

**НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Перчатки предназначены для одноразового использования при защите рук медицинского персонала и создания барьера от бактериальной и/или вирусной контаминации между медицинским работником и пациентом при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, при работе с зараженными медицинскими материалами, а также при возможной аллергии на латекс и опудривающее вещество.

**УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Транспортирование перчаток производится всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Перчатки должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей или яркого искусственного света, имеющего высокое содержание ультрафиолета, при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха – от 65% до 85% в течение всего срока годности.

В помещениях для хранения не допускается размещать оборудование, генерирующее озон, такое как ртутные лампы или высоковольтное электрооборудование, являющееся источником повышенного искробразования или бесшумных электрических разрядов. Изделия необходимо хранить вдали от источников возгорания. Горючие газы и органические пары должны быть исключены из складских помещений.

Следует быть осторожными с изделиями, хранящимися при температуре ниже 15°C, так как при неосторожном обращении они могут быть жесткими и чувствительными к деформации. После хранения при низкой температуре перчатки перед использованием должны быть прогреты до 30°C по всему объему изделия.

Изделия, пришедшие в непригодность, в том числе в связи с истечением срока годности, а также при нарушении целостности упаковки, подлежат утилизации как отходы класса А в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21.

Уничтожение изделий осуществляется организациями, имеющими соответствующую лицензию, на специально оборудованных площадках, полигонах и в помещениях в соответствии с требованиями, предусмотренными существующими Федеральным законам, и с соблюдением обязательных требований по охране окружающей среды.

Использованные изделия перед уничтожением дезинфицируют и складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21.

**МАТЕРИАЛ:** нитрил.

**ВНИМАНИЕ! ПЕРЧАТКИ НЕ ГАРАНТИРУЮТ 100% ЗАЩИТЫ РУК ОТ ПРОКОЛОВ, ПОРЕЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Надевание диагностических перчаток не требует применения чрезмерной силы во избежание нарушения их целостности. Перед применением перчаток медицинские работники проводят гигиеническую обработку рук в соответствии с режимом манипуляции.

Достаньте перчатку из упаковки. Аккуратно наденьте первую перчатку на руку, осторожно расправьте манжету перчатки на руке до запястья. Возьмите вторую перчатку из упаковки. Повторите действия для второй руки, затем легкими движениями расправьте перчатки по форме рук, обеспечив их комфортное использование.

Снимать использованные перчатки следует осторожно, избегая разбрызгивания с поверхностей перчатки, при котором возможно микробное загрязнение рук и окружающей среды.

Чтобы снять перчатки, возьмитесь за первую перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Стяните перчатку и удерживайте ее другой рукой. Затем поместите пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и стяните ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, используйте ее в качестве мешка для другой перчатки. Поместите перчатки в предназначенную для них емкость для отходов. Затем проведите гигиеническую обработку рук.

**УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Перчатки должны применяться в соответствии с инструкцией на медицинское изделие. Применение изделия не требует специальной квалификации или специального образования. Изделие предназначено только для одноразового применения.

Перчатки применяются в лечебных или лечебно-профилактических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от 15°C до 25°C и относительной влажности от 65% до 85%.

Необходимо подбирать перчатки нужного размера и в зависимости от характера выполняемых манипуляций – они должны легко надеваться и не должны затруднять движения или сдавливать кисти рук. Не применять при несоответствии размера. Только для индивидуального применения. Не использовать одну и ту же пару одноразовых перчаток при проведении медицинских манипуляций нескольким пациентам, а также при выполнении медицинских манипуляций у одного пациента, но в различных анатомических областях, отличающихся по составу микрофлоры.

Перчатки во время выполнения манипуляций не рекомендуется обрабатывать антисептическими и дезинфицирующими средствами, так как это отрицательно влияет на их герметичность и может привести к усилению проницаемости.

ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62; [www.benovydent.ru](http://www.benovydent.ru), [beplus@beplus.spb.ru](mailto:beplus@beplus.spb.ru).

ТУ 22.19.60-005-19812462-2020.


Соответствует ГОСТ 32337-2013.


РУ № РЗН 2022/17641 от 30.06.2022 г.

Не подлежит обязательной сертификации.

**СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:** 5 лет. Не использовать по истечении срока годности.

**ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.** Производитель гарантирует соответствие качества перчаток требованиям нормативной и технической документации при соблюдении правил использования, транспортирования и хранения. Безопасность и качество изделия гарантируется в течение всего срока годности.

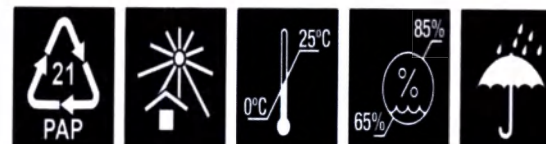




НИТРИЛ

ЧЕРНЫЙ


XXX пар

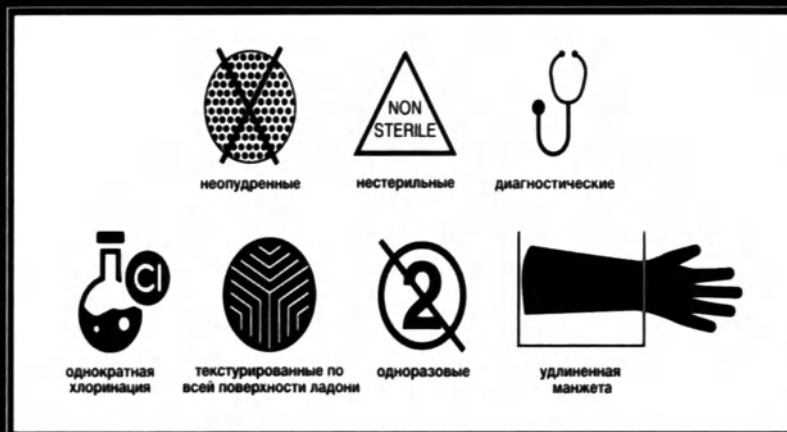

# Макет упаковки медицинского изделия (горизонтальный) Вариант исполнения №4:

Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® одноразовые неопудренные с однократной хлоринацией, текстурированные по всей поверхности ладони, удлиненная манжета 300 мм с валиком; цвет: голубой, фиолетовый, зеленый, красный, розовый, черный, белый; размер: XS, S, M, L, XL.

Цвет медицинского изделия – белый.

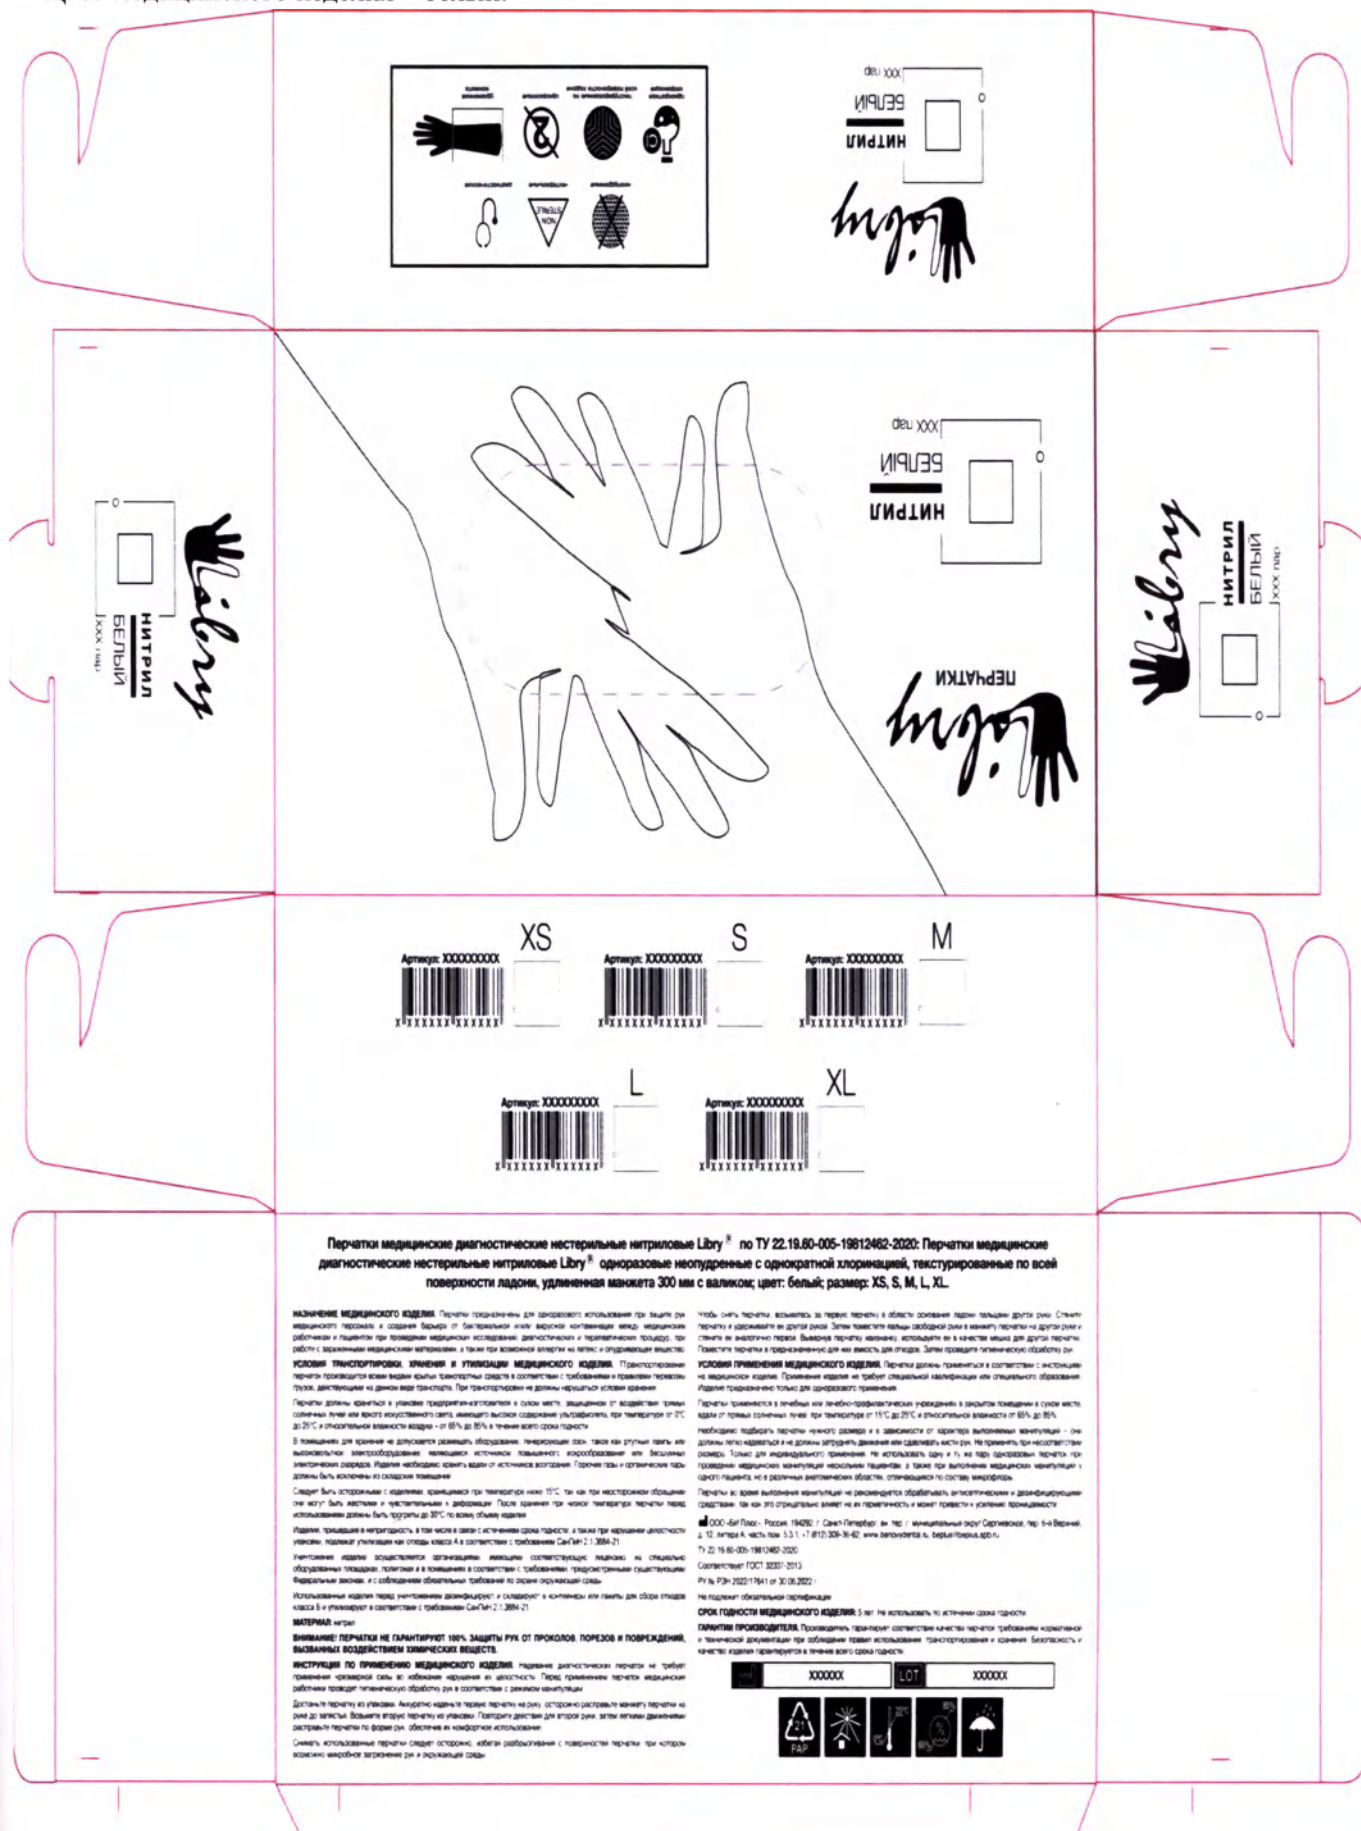

# Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® по ТУ 22.19.60-005-19812462-2020: Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® одноразовые неопудренные с однократной хлоринацией, текстурированные по всей поверхности ладони, удлиненная манжета 300 мм с валиком; цвет: белый; размер: XS, S, M, L, XL.

**НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Перчатки предназначены для одноразового использования при защите рук медицинского персонала и создания барьера от бактериальной и/или вирусной контаминации между медицинским работником и пациентом при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, при работе с зараженными медицинскими материалами, а также при возможной аллергии на латекс и опудривающее вещество.

**УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Транспортирование перчаток производится всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Перчатки должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей или яркого искусственного света, имеющего высокое содержание ультрафиолета, при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха – от 65% до 85% в течение всего срока годности.

В помещениях для хранения не допускается размещать оборудование, генерирующее озон, такое как ртутные лампы или высоковольтное электрооборудование, являющееся источником повышенного искрообразования или бесшумных электрических разрядов. Изделия необходимо хранить вдали от источников возгорания. Горючие газы и органические пары должны быть исключены из складских помещений.

Следует быть осторожными с изделиями, хранящимися при температуре ниже 15°C, так как при неосторожном обращении они могут быть жесткими и чувствительными к деформации. После хранения при низкой температуре перчатки перед использованием должны быть прогреты до 30°C по всему объему изделия.

Изделия, пришедшие в непригодность, в том числе в связи с истечением срока годности, а также при нарушении целостности упаковки, подлежат утилизации как отходы класса А в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21.

Уничтожение изделий осуществляется организациями, имеющими соответствующую лицензию, на специально оборудованных площадках, полигонах и в помещениях в соответствии с требованиями, предусмотренными существующими Федеральным законам, и с соблюдением обязательных требований по охране окружающей среды.

Использованные изделия перед уничтожением дезинфицируют и складируют в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21.

**МАТЕРИАЛ:** нитрил.

**ВНИМАНИЕ! ПЕРЧАТКИ НЕ ГАРАНТИРУЮТ 100% ЗАЩИТЫ РУК ОТ ПРОКОЛОВ, ПОРЕЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Надевание диагностических перчаток не требует применения чрезмерной силы во избежание нарушения их целостности. Перед применением перчаток медицинские работники проводят гигиеническую обработку рук в соответствии с режимом манипуляции.

Достаньте перчатку из упаковки. Аккуратно наденьте первую перчатку на руку, осторожно расправьте манжету перчатки на руке до запястья. Возьмите вторую перчатку из упаковки. Повторите действия для второй руки, затем легкими движениями расправьте перчатки по форме рук, обеспечив их комфортное использование.

Снимать использованные перчатки следует осторожно, избегая разбрызгивания с поверхностей перчатки, при котором возможно микробное загрязнение рук и окружающей среды.

Чтобы снять перчатки, возьмитесь за первую перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Сняв перчатку и удерживайте ее другой рукой. Затем поместите пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и снимите ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, используйте ее в качестве мешка для другой перчатки. Поместите перчатки в предназначенную для них емкость для отходов. Затем проведите гигиеническую обработку рук.

**УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Перчатки должны применяться в соответствии с инструкцией на медицинское изделие. Применение изделия не требует специальной квалификации или специального образования. Изделие предназначено только для одноразового применения.

Перчатки применяются в лечебных или лечебно-профилактических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от 15°C до 25°C и относительной влажности от 65% до 85%.

Необходимо подбирать перчатки нужного размера и в зависимости от характера выполняемых манипуляций – они должны легко надеваться и не должны затруднять движения или сдавливать кисти рук. Не применять при несоответствии размера. Только для индивидуального применения. Не использовать одну и ту же пару одноразовых перчаток при проведении медицинских манипуляций нескольким пациентам, а также при выполнении медицинских манипуляций у одного пациента, но в различных анатомических областях, отличающихся по составу микрофлоры.

Перчатки во время выполнения манипуляций не рекомендуется обрабатывать антисептическими и дезинфицирующими средствами, так как это отрицательно влияет на их герметичность и может привести к усилению проницаемости.

ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62; [www.benovydent.ru](http://www.benovydent.ru), [bepus@bepus.spb.ru](mailto:bepus@bepus.spb.ru).

ТУ 22.19.60-005-19812462-2020.

Соответствует ГОСТ 32337-2013.

РУ № РЗН 2022/17641 от 30.06.2022 г.


Не подлежит обязательной сертификации.

**СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:** 5 лет. Не использовать по истечении срока годности.

**ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.** Производитель гарантирует соответствие качества перчаток требованиям нормативной и технической документации при соблюдении правил использования, транспортирования и хранения. Безопасность и качество изделия гарантируется в течение всего срока годности.



**Libru**



**НИТРИЛ**  
**БЕЛЫЙ**  
XXX пар





**Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® по ТУ 22.19.60-005-19812462-2020: Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® одноразовые неопудренные с однократной хлоринацией, текстурированные на пальцах, стандартная манжета 240 мм с валиком; цвет: голубой; размер: XS, S, M, L, XL.**

**НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Перчатки предназначены для одноразового использования при защите рук медицинского персонала и создания барьера от бактериальной и/или вирусной контаминации между медицинским работником и пациентом при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, при работе с зараженными медицинскими материалами, а также при возможной аллергии на латекс и опудривающее вещество.

**УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Транспортирование перчаток производится всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения. Перчатки должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей или яркого искусственного света, имеющего высокое содержание ультрафиолета, при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха – от 65% до 85% в течение всего срока годности. В помещениях для хранения не допускается размещать оборудование, генерирующее озон, такое как ртутные лампы или высоковольтное электрооборудование, являющееся источником повышенного искрообразования или бесшумных электрических разрядов. Изделия необходимо хранить вдали от источников возгорания. Горючие газы и органические пары должны быть исключены из складских помещений. Следует быть осторожными с изделиями, хранящимися при температуре ниже 15°C, так как при неосторожном обращении они могут быть жесткими и чувствительными к деформации. После хранения при низкой температуре перчатки перед использованием должны быть прогреты до 30°C по всему объему изделия.

Изделия, пришедшие в непригодность, в том числе в связи с истечением срока годности, а также при нарушении целостности упаковки, подлежат утилизации как отходы класса А в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21. Уничтожение изделий осуществляется организациями, имеющими соответствующую лицензию, на специально оборудованных площадках, полигонах и в помещениях в соответствии с требованиями, предусмотренными существующими Федеральным законом, и с соблюдением обязательных требований по охране окружающей среды. Использованные изделия перед уничтожением дезинфицируют и складировать в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21.

**МАТЕРИАЛ:** нитрил.

**ВНИМАНИЕ! ПЕРЧАТКИ НЕ ГАРАНТИРУЮТ 100% ЗАЩИТЫ РУК ОТ ПРОКОЛОВ, ПОРЕЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Надевание диагностических перчаток не требует применения чрезмерной силы во избежание нарушения их целостности. Перед применением перчаток медицинские работники проводят гигиеническую обработку рук в соответствии с режимом манипуляции. Достаньте перчатку из упаковки. Аккуратно наденьте первую перчатку на руку, осторожно расправьте манжету перчатки на руке до запястья. Возьмите вторую перчатку из упаковки. Повторите действия для второй руки, затем легкими движениями расправьте перчатки по форме рук, обеспечив их комфортное использование.

Снимать использованные перчатки следует осторожно, избегая разбрызгивания с поверхностей перчатки, при котором возможно микробное загрязнение рук и окружающей среды.

Чтобы снять перчатки, возьмитесь за первую перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Стяните перчатку и удерживайте ее другой рукой. Затем поместите пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и стяните ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, используйте ее в качестве мешка для другой перчатки. Поместите перчатки в предназначенную для них емкость для отходов. Затем проведите гигиеническую обработку рук.

**УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Перчатки должны применяться в соответствии с инструкцией на медицинское изделие. Применение изделия не требует специальной квалификации или специального образования. Изделие предназначено только для одноразового применения.

Перчатки применяются в лечебных или лечебно-профилактических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от 15°C до 25°C и относительной влажности от 65% до 85%. Необходимо подбирать перчатки нужного размера и в зависимости от характера выполняемых манипуляций – они должны легко надеваться и не должны затруднять движения или сдавливать кисти рук. Не применять при несоответствии размера. Только для индивидуального применения. Не использовать одну и ту же пару одноразовых перчаток при проведении медицинских манипуляций нескольким пациентам, а также при выполнении медицинских манипуляций у одного пациента, но в различных анатомических областях, отличающихся по составу микрофлоры. Перчатки во время выполнения манипуляций не рекомендуется обрабатывать антисептическими и дезинфицирующими средствами, так как это отрицательно влияет на их герметичность и может привести к усилению проницаемости.

ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сергиевское, пер 6-й Верхний, д. 12 литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, [www.benovydent.ru](http://www.benovydent.ru), [beplus@beplus.spb.ru](mailto:beplus@beplus.spb.ru)  
ТУ 22.19.60-005-19812462-2020.

Соответствует ГОСТ 32337-2013.

РУ № РЗН 2022/17641 от 30.06.2022 г.

Не подлежит обязательной сертификации.

**СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:** 5 лет. Не использовать по истечении срока годности.

**ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.** Производитель гарантирует соответствие качества перчаток требованиям нормативной и технической документации при соблюдении правил использования, транспортирования и хранения. Безопасность и качество изделия гарантируется в течение всего срока годности.





неопудренные



нестерильные



диагностические

однократная  
хлоринациятекстурированные  
на пальцах

одноразовые

Цвет медицинского изделия – фиолетовый.



**Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® по ТУ 22.19.60-005-19812462-2020: Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® одноразовые неопудренные с однократной хлоринацией, текстурированные на пальцах, стандартная манжета 240 мм с валиком; цвет: фиолетовый; размер: XS, S, M, L, XL.**

**НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Перчатки предназначены для одноразового использования при защите рук медицинского персонала и создания барьера от бактериальной и/или вирусной контаминации между медицинским работником и пациентом при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, при работе с зараженными медицинскими материалами, а также при возможной аллергии на латекс и опудривающее вещество.

**УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Транспортирование перчаток производится всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения. Перчатки должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей или яркого искусственного света, имеющего высокое содержание ультрафиолета, при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха – от 65% до 85% в течение всего срока годности. В помещениях для хранения не допускается размещать оборудование, генерирующее озон, такое как ртутные лампы или высоковольтное электрооборудование, являющееся источником повышенного искрообразования или бесшумных электрических разрядов. Изделия необходимо хранить вдали от источников возгорания. Горючие газы и органические пары должны быть исключены из складских помещений. Следует быть осторожными с изделиями, хранящимися при температуре ниже 15°C, так как при неосторожном обращении они могут быть жесткими и чувствительными к деформации. После хранения при низкой температуре перчатки перед использованием должны быть прогреты до 30°C по всему объему изделия.

Изделия, пришедшие в непригодность, в том числе в связи с истечением срока годности, а также при нарушении целостности упаковки, подлежат утилизации как отходы класса А в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21. Уничтожение изделий осуществляется организациями, имеющими соответствующую лицензию, на специально оборудованных площадках, полигонах и в помещениях в соответствии с требованиями, предусмотренными существующими Федеральным законам, и с соблюдением обязательных требований по охране окружающей среды. Использованные изделия перед уничтожением дезинфицируют и складируют в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21.

**МАТЕРИАЛ:** нитрил.

**ВНИМАНИЕ! ПЕРЧАТКИ НЕ ГАРАНТИРУЮТ 100% ЗАЩИТЫ РУК ОТ ПРОКОЛОВ, ПОРЕЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Надевание диагностических перчаток не требует применения чрезмерной силы во избежание нарушения их целостности. Перед применением перчаток медицинские работники проводят гигиеническую обработку рук в соответствии с режимом манипуляции. Достаньте перчатку из упаковки. Аккуратно наденьте первую перчатку на руку, осторожно расправьте манжету перчатки на руке до запястья. Возьмите вторую перчатку из упаковки. Повторите действия для второй руки, затем легкими движениями расправьте перчатки по форме рук, обеспечив их комфортное использование.

Снимать использованные перчатки следует осторожно, избегая разбрызгивания с поверхностей перчатки, при котором возможно микробное загрязнение рук и окружающей среды.

Чтобы снять перчатки, возьмитесь за первую перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Стяните перчатку и удерживайте ее другой рукой. Затем поместите пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и стяните ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, используйте ее в качестве мешка для другой перчатки. Поместите перчатки в предназначенную для них емкость для отходов. Затем проведите гигиеническую обработку рук.

**УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Перчатки должны применяться в соответствии с инструкцией на медицинское изделие. Применение изделия не требует специальной квалификации или специального образования. Изделие предназначено только для одноразового применения.

Перчатки применяются в лечебных или лечебно-профилактических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от 15°C до 25°C и относительной влажности от 65% до 85%. Необходимо подбирать перчатки нужного размера и в зависимости от характера выполняемых манипуляций – они должны легко надеваться и не должны затруднять движения или сдавливать кисти рук. Не применять при несоответствии размера. Только для индивидуального применения. Не использовать одну и ту же пару одноразовых перчаток при проведении медицинских манипуляций нескольким пациентам, а также при выполнении медицинских манипуляций у одного пациента, но в различных анатомических областях, отличающихся по составу микрофлоры. Перчатки во время выполнения манипуляций не рекомендуется обрабатывать антисептическими и дезинфицирующими средствами, так как это отрицательно влияет на их герметичность и может привести к усилению проницаемости.

ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сергиевское, пер 6-й Верхний, д. 12 литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, [www.benovydentall.ru](http://www.benovydentall.ru), [beplus@beplus.spb.ru](mailto:beplus@beplus.spb.ru)  
ТУ 22.19.60-005-19812462-2020.

Соответствует ГОСТ 32337-2013.

РУ № РЗН 2022/17641 от 30.06.2022 г.

Не подлежит обязательной сертификации.

**СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:** 5 лет. Не использовать по истечении срока годности.

**ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.** Производитель гарантирует соответствие качества перчаток требованиям нормативной и технической документации при соблюдении правил использования, транспортирования и хранения. Безопасность и качество изделия гарантируется в течение всего срока годности.





**НИТРИЛ**  
**ФИОЛЕТОВЫЙ**  
XXX пар



# Макет упаковки медицинского изделия (вертикальный) Вариант исполнения №1:

Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® одноразовые неопудренные с однократной хлоринацией, текстурированные на пальцах, стандартная манжета 240 мм с валиком; цвет: голубой, фиолетовый, зеленый, красный, розовый, черный, белый; размер: XS, S, M, L, XL.

Цвет медицинского изделия – красный.



**Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® по ТУ 22.19.60-005-19812462-2020: Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® одноразовые неопудренные с однократной хлоринацией, текстурированные на пальцах, стандартная манжета 240 мм с валиком; цвет: красный; размер: XS, S, M, L, XL.**

**НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Перчатки предназначены для одноразового использования при защите рук медицинского персонала и создания барьера от бактериальной и/или вирусной контаминации между медицинским работником и пациентом при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, при работе с зараженными медицинскими материалами, а также при возможной аллергии на латекс и опудривающее вещество.

**УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Транспортирование перчаток производится всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения. Перчатки должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей или яркого искусственного света, имеющего высокое содержание ультрафиолета, при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха – от 65% до 85% в течение всего срока годности. В помещениях для хранения не допускается размещать оборудование, генерирующее озон, такое как ртутные лампы или высоковольтное электрооборудование, являющееся источником повышенного искрообразования или бесшумных электрических разрядов. Изделия необходимо хранить вдали от источников возгорания. Горючие газы и органические пары должны быть исключены из складских помещений. Следует быть осторожными с изделиями, хранящимися при температуре ниже 15°C, так как при неосторожном обращении они могут быть жесткими и чувствительными к деформации. После хранения при низкой температуре перчатки перед использованием должны быть прогреты до 30°C по всему объему изделия.

Изделия, прошедшие в непригодность, в том числе в связи с истечением срока годности, а также при нарушении целостности упаковки, подлежат утилизации как отходы класса А в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21. Уничтожение изделий осуществляется организациями, имеющими соответствующую лицензию, на специально оборудованных площадках, полигонах и в помещениях в соответствии с требованиями, предусмотренными существующими Федеральным законом, и с соблюдением обязательных требований по охране окружающей среды. Использованные изделия перед уничтожением дезинфицируют и складируют в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21.

**МАТЕРИАЛ:** нитрил.

**ВНИМАНИЕ! ПЕРЧАТКИ НЕ ГАРАНТИРУЮТ 100% ЗАЩИТЫ РУК ОТ ПРОКОЛОВ, ПОРЕЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Надевание диагностических перчаток не требует применения чрезмерной силы во избежание нарушения их целостности. Перед применением перчаток медицинские работники проводят гигиеническую обработку рук в соответствии с режимом манипуляции.

Достаньте перчатку из упаковки. Аккуратно наденьте первую перчатку на руку, осторожно расправьте манжету перчатки на руке до запястья. Возьмите вторую перчатку из упаковки. Повторите действия для второй руки, затем легкими движениями расправьте перчатки по форме рук, обеспечив их комфортное использование.

Снимать использованные перчатки следует осторожно, избегая разбрызгивания с поверхностей перчатки, при котором возможно микробное загрязнение рук и окружающей среды.

Чтобы снять перчатки, возьмитесь за первую перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Стяните перчатку и удерживайте ее другой рукой. Затем поместите пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и стяните ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, используйте ее в качестве мешка для другой перчатки. Поместите перчатки в предназначенную для них емкость для отходов. Затем проведите гигиеническую обработку рук.

**УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Перчатки должны применяться в соответствии с инструкцией на медицинское изделие. Применение изделия не требует специальной квалификации или специального образования. Изделие предназначено только для одноразового применения.

Перчатки применяются в лечебных или лечебно-профилактических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от 15°C до 25°C и относительной влажности от 65% до 85%. Необходимо подбирать перчатки нужного размера и в зависимости от характера выполняемых манипуляций – они должны легко надеваться и не должны затруднять движения или сдавливать кисти рук. Не применять при несоответствии размера. Только для индивидуального применения. Не использовать одну и ту же пару одноразовых перчаток при проведении медицинских манипуляций нескольким пациентам, а также при выполнении медицинских манипуляций у одного пациента, но в различных анатомических областях, отличающихся по составу микрофлоры. Перчатки во время выполнения манипуляций не рекомендуется обрабатывать антисептическими и дезинфицирующими средствами, так как это отрицательно влияет на их герметичность и может привести к усилению проницаемости.

ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сергиевское, пер 6-й Верхний, д. 12 литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, [www.benovydental.ru](http://www.benovydental.ru), [beplus@beplus.spb.ru](mailto:beplus@beplus.spb.ru)  
ТУ 22.19.60-005-19812462-2020.

Соответствует ГОСТ 32337-2013.

РУ № РЗН 2022/17641 от 30.06.2022 г.

Не подлежит обязательной сертификации.

**СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:** 5 лет. Не использовать по истечении срока годности.

**ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.** Производитель гарантирует соответствие качества перчаток требованиям нормативной и технической документации при соблюдении правил использования, транспортирования и хранения. Безопасность и качество изделия гарантируется в течение всего срока годности.





НИТРИЛ  
КРАСНЫЙ  
XXX пар



неопудренные



нестерильные



диагностические



однократная  
хлоринация



текстурированные  
на пальцах




одноразовые

# Макет упаковки медицинского изделия (горизонтальный) Вариант исполнения №1:

Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® одноразовые неопудренные с однократной хлоринацией, текстурированные на пальцах, стандартная манжета 240 мм с валиком; цвет: голубой, фиолетовый, зеленый, красный, розовый, черный, белый; размер: XS, S, M, L, XL.

Цвет медицинского изделия – розовый.

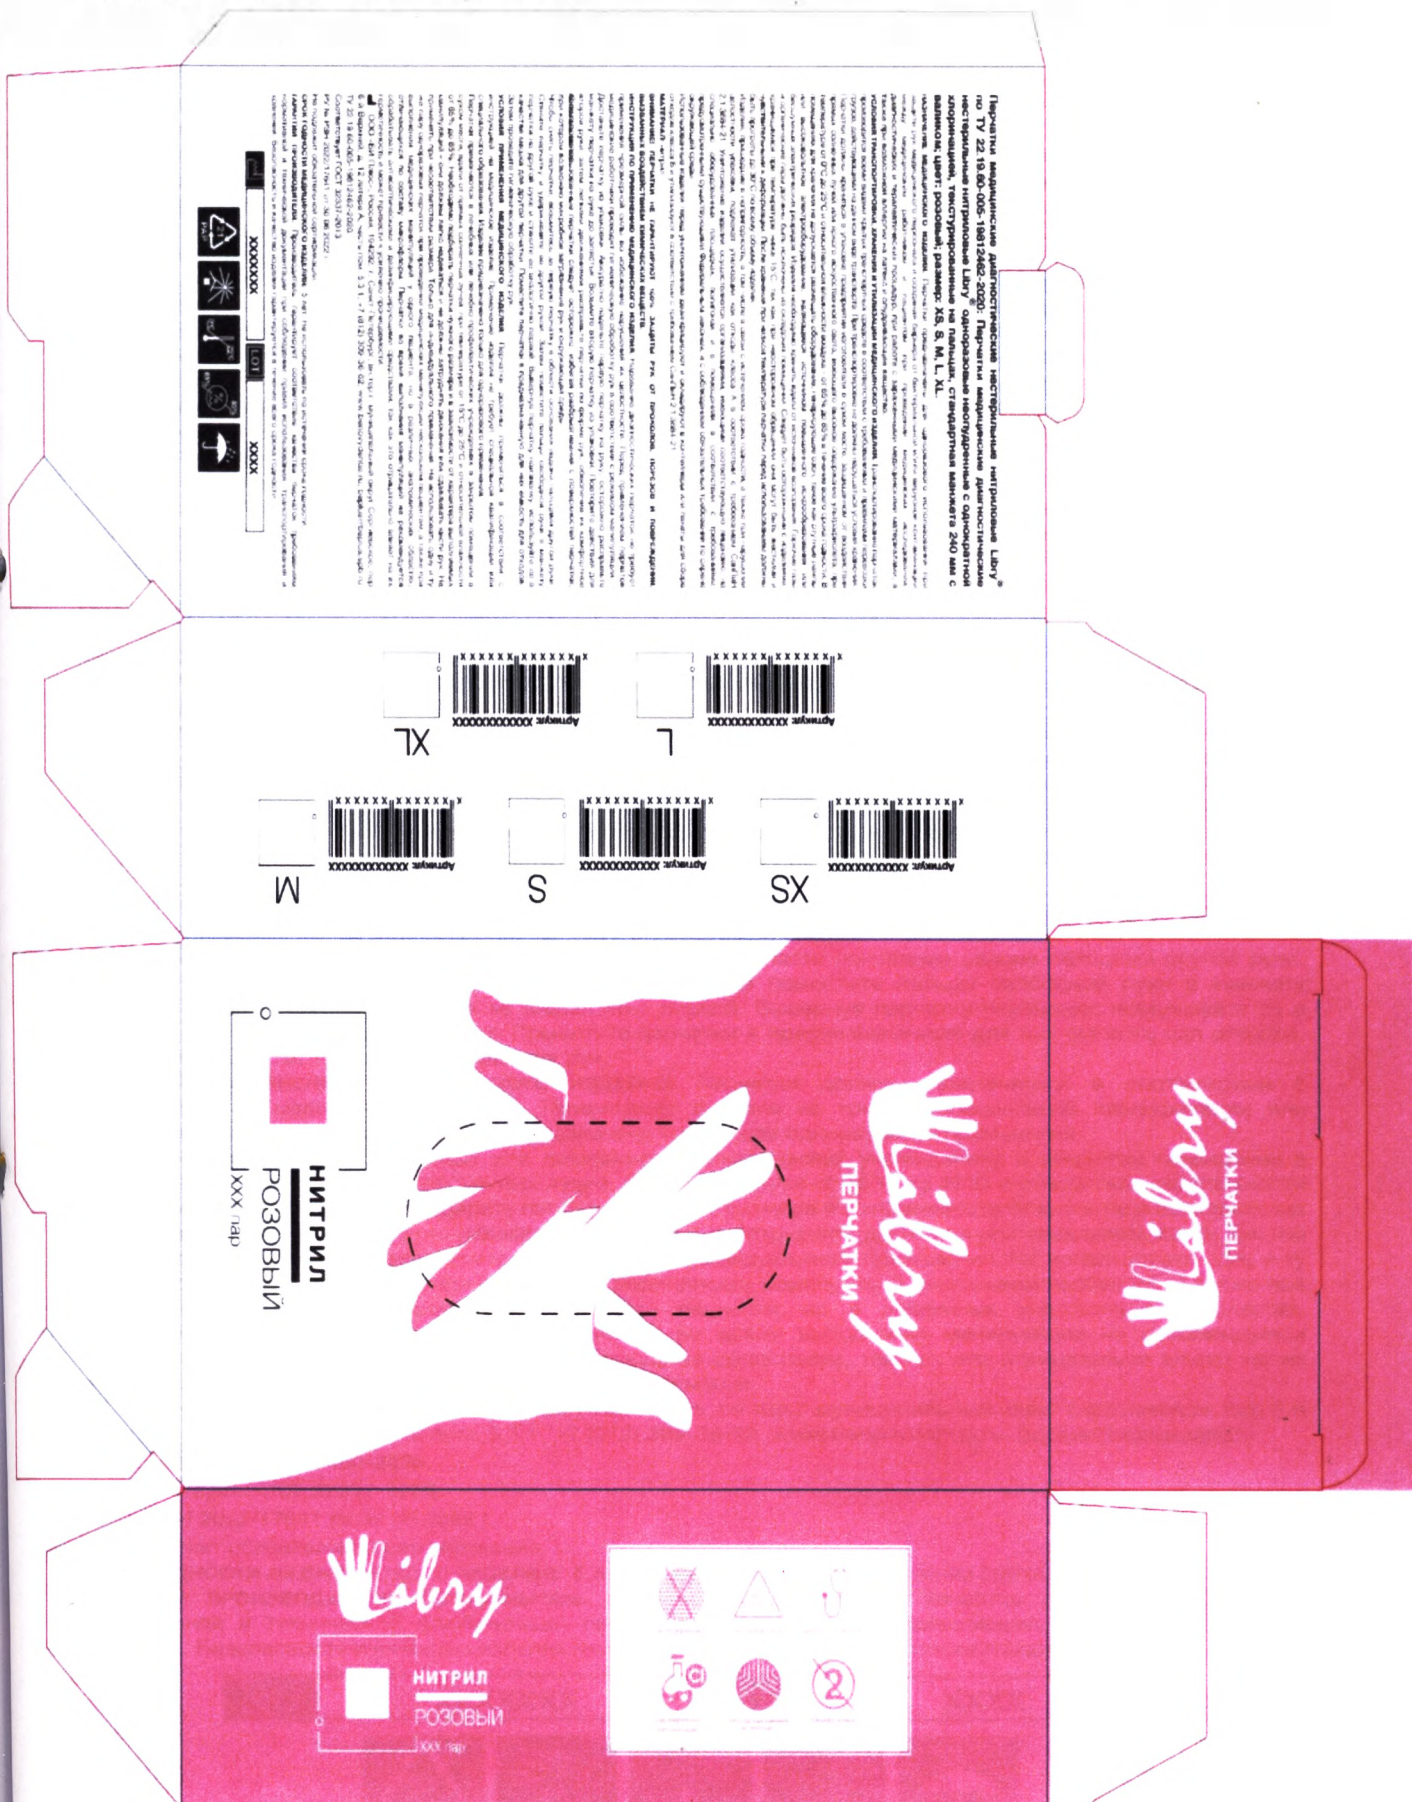

**Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® по ТУ 22.19.60-005-19812462-2020: Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® одноразовые неопудренные с однократной хлоринацией, текстурированные на пальцах, стандартная манжета 240 мм с валиком; цвет: розовый; размер: XS, S, M, L, XL.**

**НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Перчатки предназначены для одноразового использования при защите рук медицинского персонала и создания барьера от бактериальной и/или вирусной контаминации между медицинским работником и пациентом при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, при работе с зараженными медицинскими материалами, а также при возможной аллергии на латекс и опудривающее вещество.

**УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Транспортирование перчаток производится всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения. Перчатки должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей или яркого искусственного света, имеющего высокое содержание ультрафиолета, при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха – от 65% до 85% в течение всего срока годности. В помещениях для хранения не допускается размещать оборудование, генерирующее озон, такое как ртутные лампы или высоковольтное электрооборудование, являющееся источником повышенного искрообразования или бесшумных электрических разрядов. Изделия необходимо хранить вдали от источников возгорания. Горючие газы и органические пары должны быть исключены из складских помещений. Следует быть осторожными с изделиями, хранящимися при температуре ниже 15°C, так как при неосторожном обращении они могут быть жесткими и чувствительными к деформации. После хранения при низкой температуре перчатки перед использованием должны быть прогреты до 30°C по всему объему изделия.

Изделия, пришедшие в непригодность, в том числе в связи с истечением срока годности, а также при нарушении целостности упаковки, подлежат утилизации как отходы класса А в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21. Уничтожение изделий осуществляется организациями, имеющими соответствующую лицензию, на специально оборудованных площадках, полигонах и в помещениях в соответствии с требованиями, предусмотренными существующими Федеральным законом, и с соблюдением обязательных требований по охране окружающей среды. Использованные изделия перед уничтожением дезинфицируют и складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21.

**МАТЕРИАЛ:** нитрил.

**ВНИМАНИЕ! ПЕРЧАТКИ НЕ ГАРАНТИРУЮТ 100% ЗАЩИТЫ РУК ОТ ПРОКОЛОВ, ПОРЕЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Надевание диагностических перчаток не требует применения чрезмерной силы во избежание нарушения их целостности. Перед применением перчаток медицинские работники проводят гигиеническую обработку рук в соответствии с режимом манипуляции. Достаньте перчатку из упаковки. Аккуратно наденьте первую перчатку на руку, осторожно расправьте манжету перчатки на руке до запястья. Возьмите вторую перчатку из упаковки. Повторите действия для второй руки, затем легкими движениями расправьте перчатки по форме рук, обеспечив их комфортное использование.

Снимать использованные перчатки следует осторожно, избегая разбрызгивания с поверхностей перчатки, при котором возможно микробное загрязнение рук и окружающей среды.

Чтобы снять перчатки, возьмитесь за первую перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Стяните перчатку и удерживайте ее другой рукой. Затем поместите пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и стяните ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, используйте ее в качестве мешка для другой перчатки. Поместите перчатки в предназначенную для них емкость для отходов. Затем проведите гигиеническую обработку рук.

**УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Перчатки должны применяться в соответствии с инструкцией на медицинское изделие. Применение изделия не требует специальной квалификации или специального образования. Изделие предназначено только для одноразового применения.

Перчатки применяются в лечебных или лечебно-профилактических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от 15°C до 25°C и относительной влажности от 65% до 85%. Необходимо подбирать перчатки нужного размера и в зависимости от характера выполняемых манипуляций – они должны легко надеваться и не должны затруднять движения или сдавливать кисти рук. Не применять при несоответствии размера. Только для индивидуального применения. Не использовать одну и ту же пару одноразовых перчаток при проведении медицинских манипуляций нескольким пациентам, а также при выполнении медицинских манипуляций у одного пациента, но в различных анатомических областях, отличающихся по составу микрофлоры. Перчатки во время выполнения манипуляций не рекомендуется обрабатывать антисептическими и дезинфицирующими средствами, так как это отрицательно влияет на их герметичность и может привести к усилению проницаемости.

ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сергиевское, пер 6-й Верхний, д. 12 литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, [www.benovydental.ru](http://www.benovydental.ru), [beplus@beplus.spb.ru](mailto:beplus@beplus.spb.ru)  
ТУ 22.19.60-005-19812462-2020.


Соответствует ГОСТ 32337-2013.


РУ № РЗН 2022/17641 от 30.06.2022 г.

Не подлежит обязательной сертификации.

**СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:** 5 лет. Не использовать по истечении срока годности.

**ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.** Производитель гарантирует соответствие качества перчаток требованиям нормативной и технической документации при соблюдении правил использования, транспортирования и хранения. Безопасность и качество изделия гарантируется в течение всего срока годности.



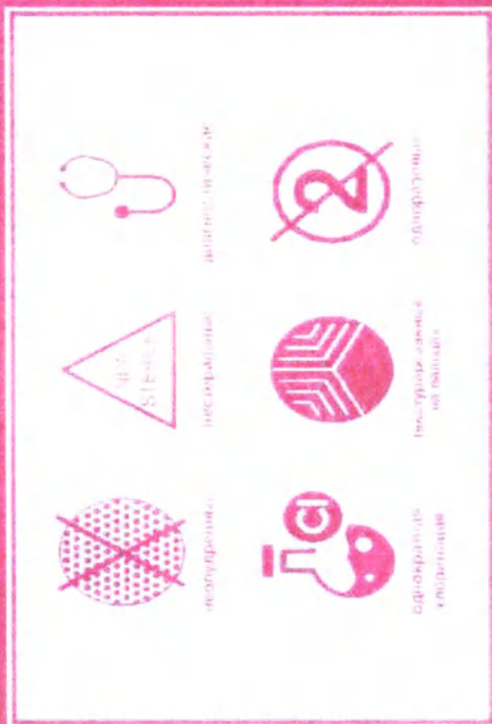

Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® одноразовые неопудренные с однократной хлоринацией, текстурированные по всей поверхности ладони, стандартная манжета 240 мм с валиком; цвет: голубой, фиолетовый, зеленый, красный, розовый, черный, белый; размер: XS, S, M, L, XL.

**Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® по ТУ 22.19.60-005-19812462-2020: Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® одноразовые неопудренные с однократной хлоринацией, текстурированные по всей поверхности ладони, стандартная манжета 240 мм с валиком; цвет: зеленый; размер: XS, S, M, L, XL.**

**НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Перчатки предназначены для одноразового использования при защите рук медицинского персонала и создания барьера от бактериальной и/или вирусной контаминации между медицинским работником и пациентом при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, при работе с зараженными медицинскими материалами, а также при возможной аллергии на латекс и опудривающее вещество.

**УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Транспортирование перчаток производится всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения. Перчатки должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей или яркого искусственного света, имеющего высокое содержание ультрафиолета, при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха – от 65% до 85% в течение всего срока годности. В помещениях для хранения не допускается размещать оборудование, генерирующее озон, такое как ртутные лампы или высоковольтное электрооборудование, являющееся источником повышенного искрообразования или бесшумных электрических разрядов. Изделия необходимо хранить вдали от источников возгорания. Горючие газы и органические пары должны быть исключены из складских помещений. Следует быть осторожными с изделиями, хранящимися при температуре ниже 15°C, так как при неосторожном обращении они могут быть жесткими и чувствительными к деформации. После хранения при низкой температуре перчатки перед использованием должны быть прогреты до 30°C по всему объему изделия.

Изделия, пришедшие в непригодность, в том числе в связи с истечением срока годности, а также при нарушении целостности упаковки, подлежат утилизации как отходы класса А в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21. Уничтожение изделий осуществляется организациями, имеющими соответствующую лицензию, на специально оборудованных площадках, полигонах и в помещениях в соответствии с требованиями, предусмотренными существующими Федеральным законом, и с соблюдением обязательных требований по охране окружающей среды.

Использованные изделия перед уничтожением дезинфицируют и складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21.

**МАТЕРИАЛ:** нитрил.

**ВНИМАНИЕ! ПЕРЧАТКИ НЕ ГАРАНТИРУЮТ 100% ЗАЩИТЫ РУК ОТ ПРОКОЛОВ, ПОРЕЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Надевание диагностических перчаток не требует применения чрезмерной силы во избежание нарушения их целостности. Перед применением перчаток медицинские работники проводят гигиеническую обработку рук в соответствии с режимом манипуляции.

Достаньте перчатку из упаковки. Аккуратно наденьте первую перчатку на руку, осторожно расправьте манжету перчатки на руке до запястья. Возьмите вторую перчатку из упаковки. Повторите действия для второй руки, затем легкими движениями расправьте перчатки по форме рук, обеспечив их комфортное использование.

Снимать использованные перчатки следует осторожно, избегая разбрызгивания с поверхностей перчатки, при котором возможно микробное загрязнение рук и окружающей среды.

Чтобы снять перчатки, возьмитесь за первую перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Стяните перчатку и удерживайте ее другой рукой. Затем поместите пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и стяните ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, используйте ее в качестве мешка для другой перчатки. Поместите перчатки в предназначенную для них емкость для отходов. Затем проведите гигиеническую обработку рук.

**УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Перчатки должны применяться в соответствии с инструкцией на медицинское изделие. Применение изделия не требует специальной квалификации или специального образования. Изделие предназначено только для одноразового применения.

Перчатки применяются в лечебных или лечебно-профилактических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от 15°C до 25°C и относительной влажности от 65% до 85%. Необходимо подбирать перчатки нужного размера и в зависимости от характера выполняемых манипуляций – они должны легко надеваться и не должны затруднять движения или сдавливать кисти рук. Не применять при несоответствии размера. Только для индивидуального применения. Не использовать одну и ту же пару одноразовых перчаток при проведении медицинских манипуляций нескольким пациентам, а также при выполнении медицинских манипуляций у одного пациента, но в различных анатомических областях, отличающихся по составу микрофлоры. Перчатки во время выполнения манипуляций не рекомендуется обрабатывать антисептическими и дезинфицирующими средствами, так как это отрицательно влияет на их герметичность и может привести к усилению проницаемости.

ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12 литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, [www.benovy dental.ru](http://www.benovy dental.ru), [beplus@beplus.spb.ru](mailto:beplus@beplus.spb.ru)  
ТУ 22.19.60-005-19812462-2020.


Соответствует ГОСТ 32337-2013.


РУ № РЗН 2022/17641 от 30.06.2022 г.

Не подлежит обязательной сертификации.

**СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:** 5 лет. Не использовать по истечении срока годности.

**ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.** Производитель гарантирует соответствие качества перчаток требованиям нормативной и технической документации при соблюдении правил использования, транспортирования и хранения. Безопасность и качество изделия гарантируются в течение всего срока годности.

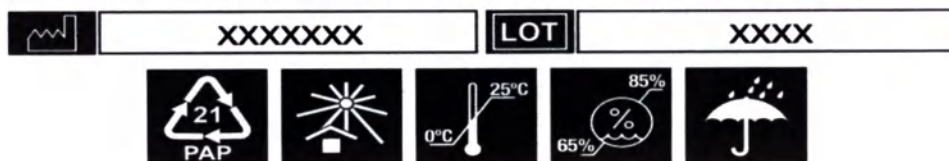

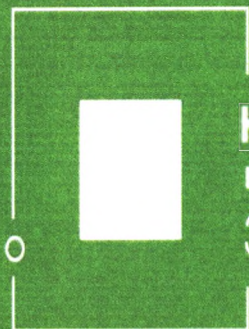

НИТРИЛ  
ЗЕЛЕНый  
XXX пар



неопудренные



нестерильные



диагностические



однократная  
хлоринация



текстурированные по  
всей поверхности ладони




одноразовые

### Макет упаковки медицинского изделия (вертикальный) Вариант исполнения №3:

Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® одноразовые неопудренные с полимерным покрытием, текстурированные на пальцах, стандартная манжета 240 мм с валиком; цвет: голубой, фиолетовый, зеленый, красный, розовый, черный, белый; размер: XS, S, M, L, XL.

Цвет медицинского изделия – голубой.

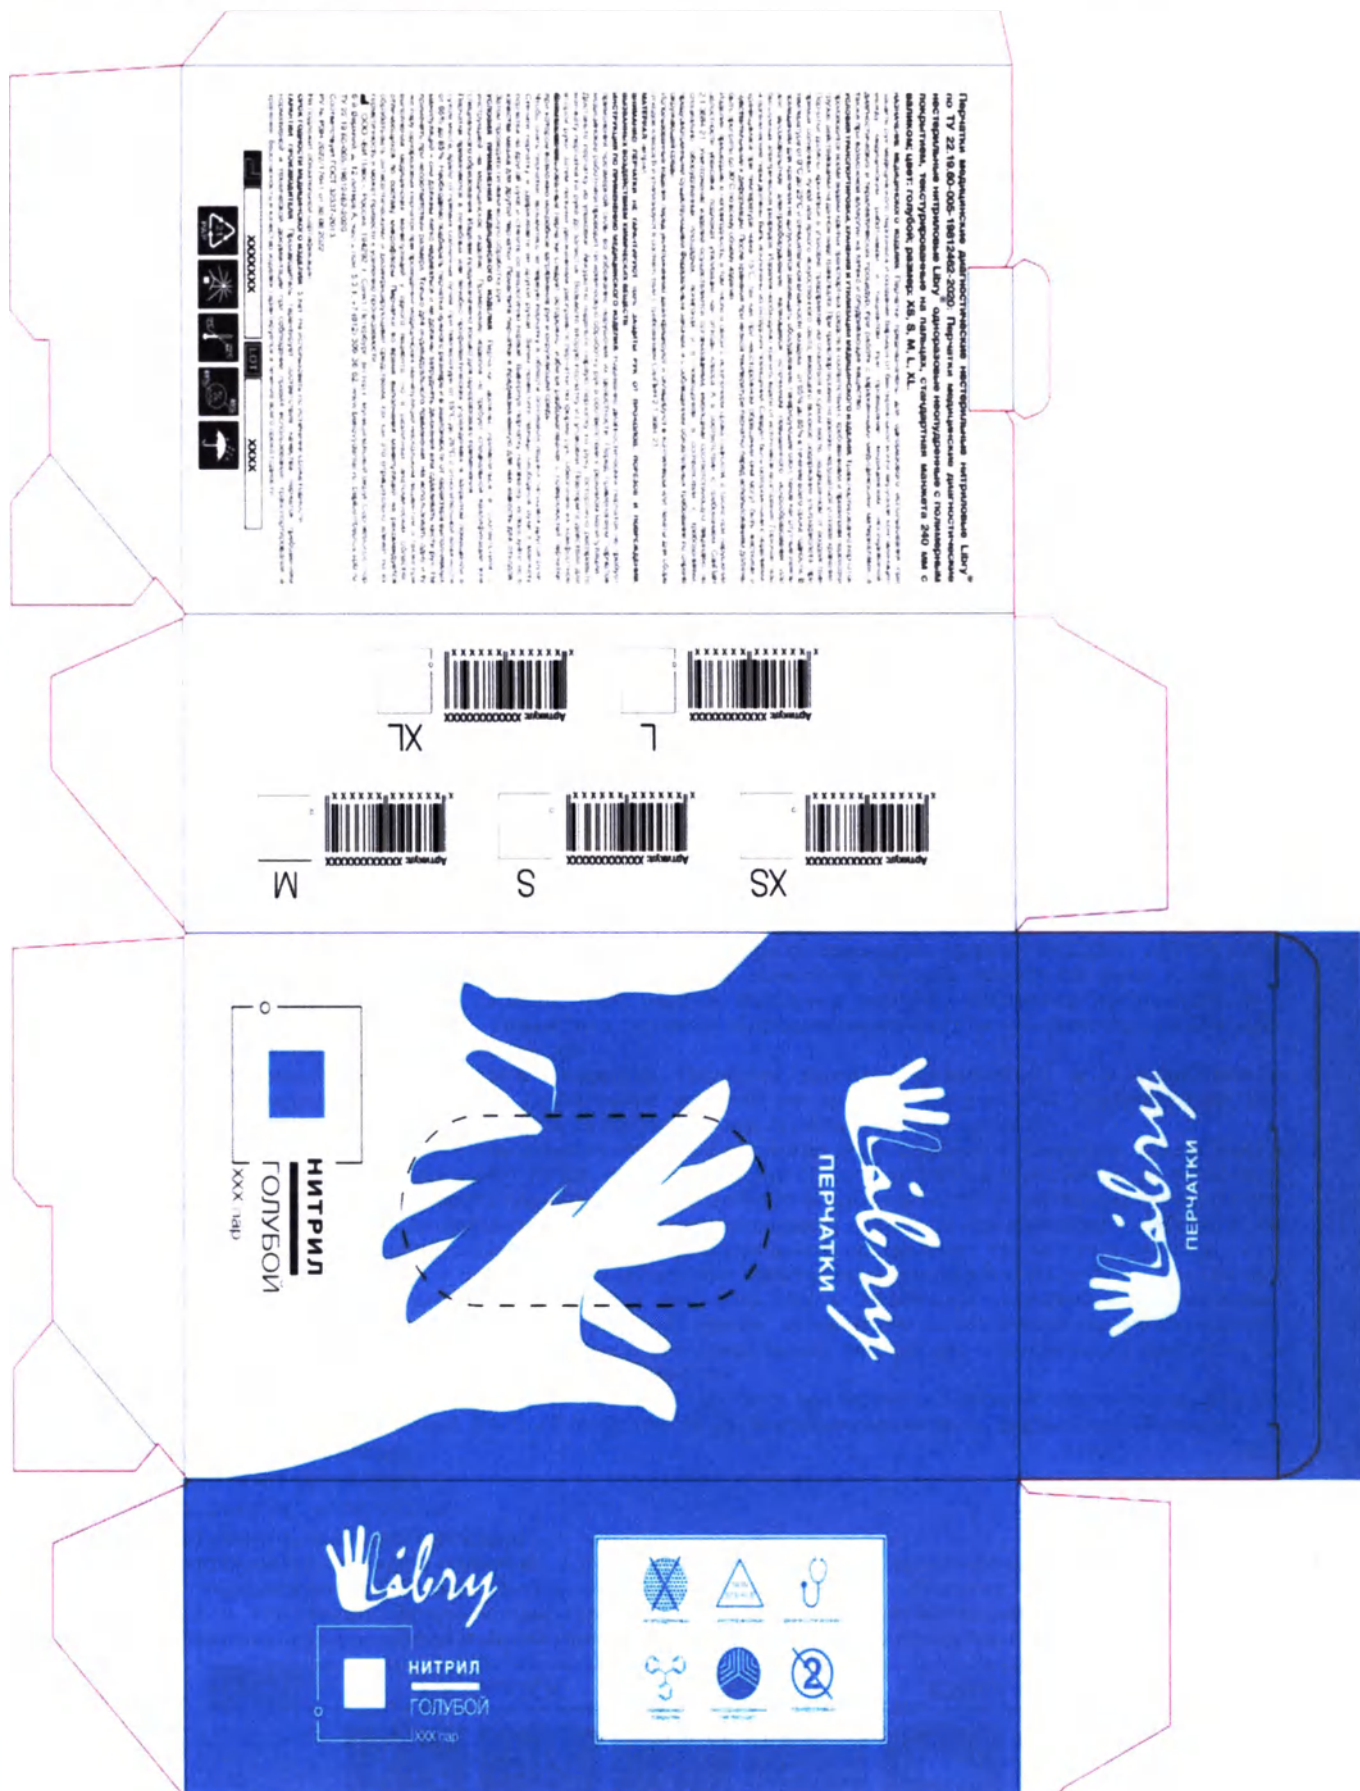

**Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® по ТУ 22.19.60-005-19812462-2020: Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® одноразовые неопудренные с полимерным покрытием, текстурированные на пальцах, стандартная манжета 240 мм с валиком; цвет: голубой; размер: XS, S, M, L, XL.**

**НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Перчатки предназначены для одноразового использования при защите рук медицинского персонала и создания барьера от бактериальной и/или вирусной контаминации между медицинским работником и пациентом при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, при работе с зараженными медицинскими материалами, а также при возможной аллергии на латекс и опудривающее вещество.

**УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Транспортирование перчаток производится всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения. Перчатки должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей или яркого искусственного света, имеющего высокое содержание ультрафиолета, при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха – от 65% до 85% в течение всего срока годности. В помещениях для хранения не допускается размещать оборудование, генерирующее озон, такое как ртутные лампы или высоковольтное электрооборудование, являющееся источником повышенного искрообразования или бесшумных электрических разрядов. Изделия необходимо хранить вдали от источников возгорания. Горючие газы и органические пары должны быть исключены из складских помещений. Следует быть осторожными с изделиями, хранящимися при температуре ниже 15°C, так как при неосторожном обращении они могут быть жесткими и чувствительными к деформации. После хранения при низкой температуре перчатки перед использованием должны быть прогреты до 30°C по всему объему изделия.

Изделия, пришедшие в непригодность, в том числе в связи с истечением срока годности, а также при нарушении целостности упаковки, подлежат утилизации как отходы класса А в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21. Уничтожение изделий осуществляется организациями, имеющими соответствующую лицензию, на специально оборудованных площадках, полигонах и в помещениях в соответствии с требованиями, предусмотренными существующими Федеральным законам, и с соблюдением обязательных требований по охране окружающей среды. Использованные изделия перед уничтожением дезинфицируют и складируют в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21.

**МАТЕРИАЛ:** нитрил.

**ВНИМАНИЕ! ПЕРЧАТКИ НЕ ГАРАНТИРУЮТ 100% ЗАЩИТЫ РУК ОТ ПРОКОЛОВ, ПОРЕЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Надевание диагностических перчаток не требует применения чрезмерной силы во избежание нарушения их целостности. Перед применением перчаток медицинские работники проводят гигиеническую обработку рук в соответствии с режимом манипуляции.

Достаньте перчатку из упаковки. Аккуратно наденьте первую перчатку на руку, осторожно расправьте манжету перчатки на руке до запястья. Возьмите вторую перчатку из упаковки. Повторите действия для второй руки, затем легкими движениями расправьте перчатки по форме рук, обеспечив их комфортное использование.

Снимать использованные перчатки следует осторожно, избегая разбрызгивания с поверхностей перчатки, при котором возможно микробное загрязнение рук и окружающей среды.

Чтобы снять перчатки, возьмитесь за первую перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Стяните перчатку и удерживайте ее другой рукой. Затем поместите пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и стяните ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, используйте ее в качестве мешка для другой перчатки. Поместите перчатки в предназначенную для них емкость для отходов. Затем проведите гигиеническую обработку рук.

**УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Перчатки должны применяться в соответствии с инструкцией на медицинское изделие. Применение изделия не требует специальной квалификации или специального образования. Изделие предназначено только для одноразового применения.

Перчатки применяются в лечебных или лечебно-профилактических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от 15°C до 25°C и относительной влажности от 65% до 85%. Необходимо подбирать перчатки нужного размера и в зависимости от характера выполняемых манипуляций – они должны легко надеваться и не должны затруднять движения или сдавливать кисти рук. Не применять при несоответствии размера. Только для индивидуального применения. Не использовать одну и ту же пару одноразовых перчаток при проведении медицинских манипуляций нескольким пациентам, а также при выполнении медицинских манипуляций у одного пациента, но в различных анатомических областях, отличающихся по составу микрофлоры. Перчатки во время выполнения манипуляций не рекомендуется обрабатывать антисептическими и дезинфицирующими средствами, так как это отрицательно влияет на их герметичность и может привести к усилению проницаемости.

ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сергиевское, пер 6-й Верхний, д. 12 литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, [www.benovydental.ru](http://www.benovydental.ru), [beplus@beplus.spb.ru](mailto:beplus@beplus.spb.ru)

ТУ 22.19.60-005-19812462-2020.

Соответствует ГОСТ 32337-2013.


РУ № РЗН 2022/17641 от 30.06.2022 г.

Не подлежит обязательной сертификации.

**СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:** 5 лет. Не использовать по истечении срока годности.

**ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.** Производитель гарантирует соответствие качества перчаток требованиям нормативной и технической документации при соблюдении правил использования, транспортирования и хранения. Безопасность и качество изделия гарантируется в течение всего срока годности.





НИТРИЛ  
ГОЛУБОЙ  
XXX пар




неопудренные



нестерильные



диагностические



полимерное  
покрытие



текстурированные  
на пальцах



одноразовые

# Макет упаковки медицинского изделия (вертикальный) Вариант исполнения №4:

Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® одноразовые неопудренные с однократной хлоринацией, текстурированные по всей поверхности ладони, удлиненная манжета 300 мм с валиком; цвет: голубой, фиолетовый, зеленый, красный, розовый, черный, белый; размер: XS, S, M, L, XL.

Цвет медицинского изделия – голубой.



**Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® по ТУ 22.19.60-005-19812462-2020: Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® одноразовые неопудренные с однократной хлоринацией, текстурированные по всей поверхности ладони, удлиненная манжета 300 мм с валиком; цвет: голубой; размер: XS, S, M, L, XL.**

**НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Перчатки предназначены для одноразового использования при защите рук медицинского персонала и создания барьера от бактериальной и/или вирусной контаминации между медицинским работником и пациентом при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, при работе с зараженными медицинскими материалами, а также при возможной аллергии на латекс и опудривающее вещество.

**УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Транспортирование перчаток производится всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения. Перчатки должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей или яркого искусственного света, имеющего высокое содержание ультрафиолета, при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха – от 65% до 85% в течение всего срока годности. В помещениях для хранения не допускается размещать оборудование, генерирующее озон, такое как ртутные лампы или высоковольтное электрооборудование, являющееся источником повышенного искрообразования или бесшумных электрических разрядов. Изделия необходимо хранить вдали от источников возгорания. Горючие газы и органические пары должны быть исключены из складских помещений. Следует быть осторожными с изделиями, хранящимися при температуре ниже 15°C, так как при неосторожном обращении они могут быть жесткими и чувствительными к деформации. После хранения при низкой температуре перчатки перед использованием должны быть прогреты до 30°C по всему объему изделия.

Изделия, пришедшие в непригодность, в том числе в связи с истечением срока годности, а также при нарушении целостности упаковки, подлежат утилизации как отходы класса А в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21. Уничтожение изделий осуществляется организациями, имеющими соответствующую лицензию, на специально оборудованных площадках, полигонах и в помещениях в соответствии с требованиями, предусмотренными существующими Федеральным законом, и с соблюдением обязательных требований по охране окружающей среды.

Использованные изделия перед уничтожением дезинфицируют и складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21.

**МАТЕРИАЛ:** нитрил.

**ВНИМАНИЕ! ПЕРЧАТКИ НЕ ГАРАНТИРУЮТ 100% ЗАЩИТЫ РУК ОТ ПРОКОЛОВ, ПОРЕЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Надевание диагностических перчаток не требует применения чрезмерной силы во избежание нарушения их целостности. Перед применением перчаток медицинские работники проводят гигиеническую обработку рук в соответствии с режимом манипуляции.

Достаньте перчатку из упаковки. Аккуратно наденьте первую перчатку на руку, осторожно расправьте манжету перчатки на руке до запястья. Возьмите вторую перчатку из упаковки. Повторите действия для второй руки, затем легкими движениями расправьте перчатки по форме рук, обеспечив их комфортное использование. Снимать использованные перчатки следует осторожно, избегая разбрызгивания с поверхностей перчатки, при котором возможно микробное загрязнение рук и окружающей среды.

Чтобы снять перчатки, возьмитесь за первую перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Снятые перчатку и удерживайте ее другой рукой. Затем поместите пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и снимите ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, используйте ее в качестве мешка для другой перчатки. Поместите перчатки в предназначенную для них емкость для отходов. Затем проведите гигиеническую обработку рук.

**УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Перчатки должны применяться в соответствии с инструкцией на медицинское изделие. Применение изделия не требует специальной квалификации или специального образования. Изделие предназначено только для одноразового применения.

Перчатки применяются в лечебных или лечебно-профилактических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от 15°C до 25°C и относительной влажности от 65% до 85%. Необходимо подбирать перчатки нужного размера и в зависимости от характера выполняемых манипуляций – они должны легко надеваться и не должны затруднять движения или сдавливать кисти рук. Не применять при несоответствии размера. Только для индивидуального применения. Не использовать одну и ту же пару одноразовых перчаток при проведении медицинских манипуляций нескольким пациентам, а также при выполнении медицинских манипуляций у одного пациента, но в различных анатомических областях, отличающихся по составу микрофлоры. Перчатки во время выполнения манипуляций не рекомендуется обрабатывать антисептическими и дезинфицирующими средствами, так как это отрицательно влияет на их герметичность и может привести к усилению проницаемости.

ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сергиевское, пер 6-й Верхний, д. 12 литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, [www.benovydentall.ru](http://www.benovydentall.ru), [beplus@beplus.spb.ru](mailto:beplus@beplus.spb.ru)  
ТУ 22.19.60-005-19812462-2020.

Соответствует ГОСТ 32337-2013.



ПУ № РЗН 2022/17641 от 30.06.2022 г.

Не подлежит обязательной сертификации.

**СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:** 5 лет. Не использовать по истечении срока годности.

**ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.** Производитель гарантирует соответствие качества перчаток требованиям нормативной и технической документации при соблюдении правил использования, транспортирования и хранения. Безопасность и качество изделия гарантируется в течение всего срока годности.




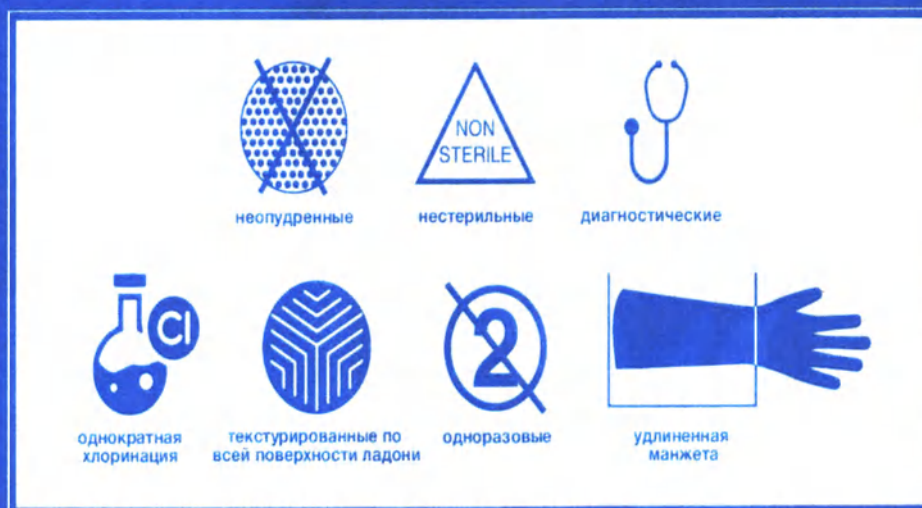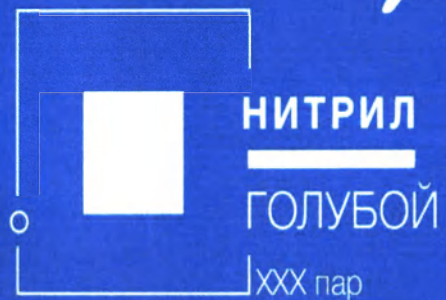

# Макет упаковки медицинского изделия (вертикальный) Вариант исполнения №4:

Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® одноразовые неопудренные с однократной хлоринацией, текстурированные по всей поверхности ладони, удлиненная манжета 300 мм с валиком; цвет: голубой, фиолетовый, зеленый, красный, розовый, черный, белый; размер: XS, S, M, L, XL.

Цвет медицинского изделия – черный.

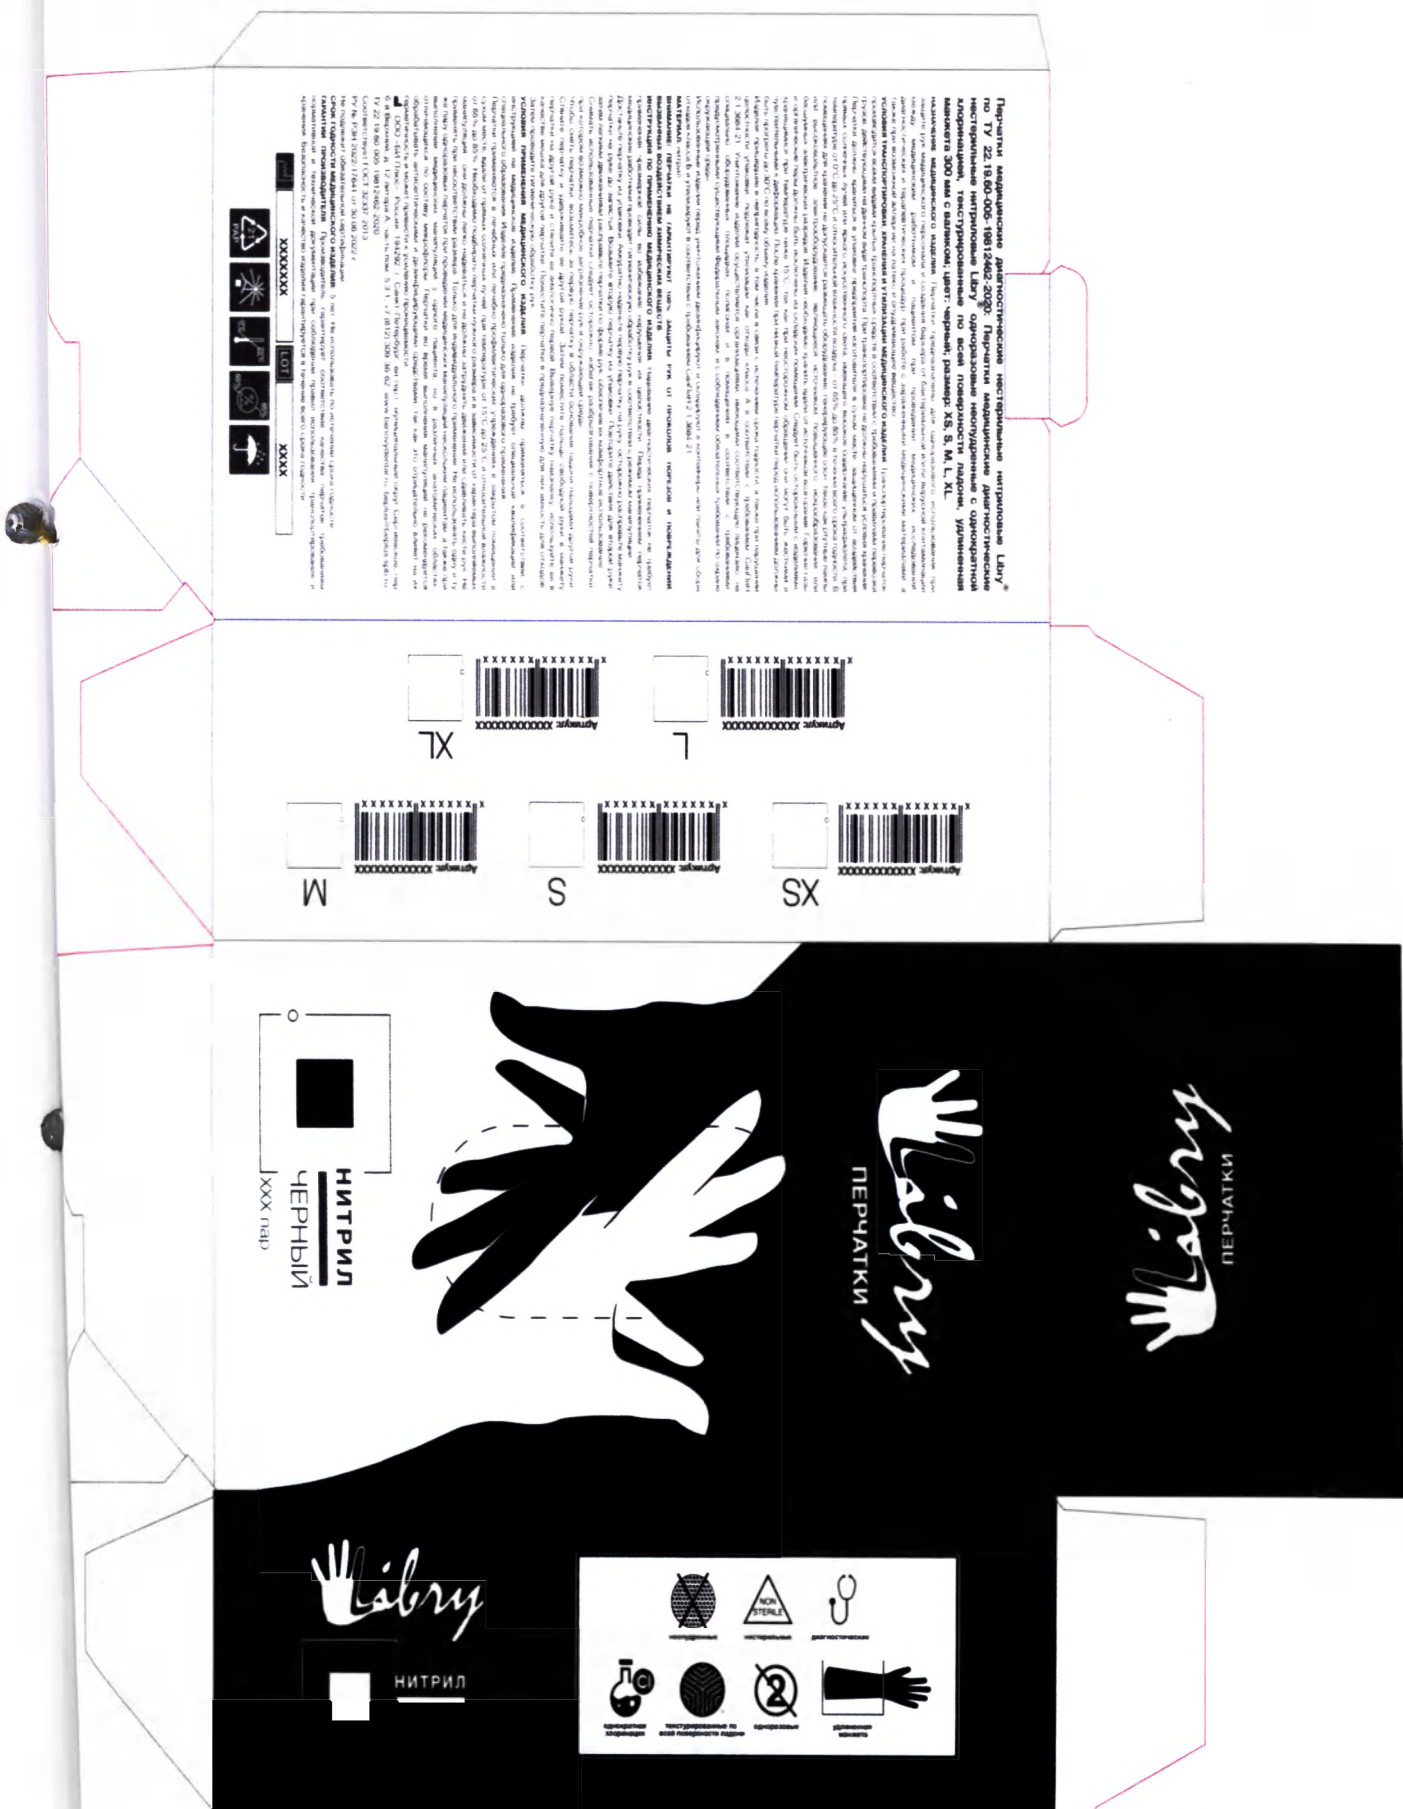

**Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® по ТУ 22.19.60-005-19812462-2020: Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® одноразовые неопудренные с однократной хлоринацией, текстурированные по всей поверхности ладони, удлиненная манжета 300 мм с валиком; цвет: черный; размер: XS, S, M, L, XL.**

**НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Перчатки предназначены для одноразового использования при защите рук медицинского персонала и создания барьера от бактериальной и/или вирусной контаминации между медицинским работником и пациентом при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, при работе с зараженными медицинскими материалами, а также при возможной аллергии на латекс и опудривающее вещество.

**УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Транспортирование перчаток производится всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения. Перчатки должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей или яркого искусственного света, имеющего высокое содержание ультрафиолета, при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха – от 65% до 85% в течение всего срока годности. В помещениях для хранения не допускается размещать оборудование, генерирующее озон, такое как ртутные лампы или высоковольтное электрооборудование, являющееся источником повышенного искрообразования или бесшумных электрических разрядов. Изделия необходимо хранить вдали от источников возгорания. Горючие газы и органические пары должны быть исключены из складских помещений. Следует быть осторожными с изделиями, хранящимися при температуре ниже 15°C, так как при неосторожном обращении они могут быть жесткими и чувствительными к деформации. После хранения при низкой температуре перчатки перед использованием должны быть прогреты до 30°C по всему объему изделия.

Изделия, пришедшие в непригодность, в том числе в связи с истечением срока годности, а также при нарушении целостности упаковки, подлежат утилизации как отходы класса А в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21. Уничтожение изделий осуществляется организациями, имеющими соответствующую лицензию, на специально оборудованных площадках, полигонах и в помещениях в соответствии с требованиями, предусмотренными существующими Федеральным законам, и с соблюдением обязательных требований по охране окружающей среды.

Использованные изделия перед уничтожением дезинфицируют и складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21.

**МАТЕРИАЛ:** нитрил.

**ВНИМАНИЕ! ПЕРЧАТКИ НЕ ГАРАНТИРУЮТ 100% ЗАЩИТЫ РУК ОТ ПРОКОЛОВ, ПОРЕЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Надевание диагностических перчаток не требует применения чрезмерной силы во избежание нарушения их целостности. Перед применением перчаток медицинские работники проводят гигиеническую обработку рук в соответствии с режимом манипуляции.

Достаньте перчатку из упаковки. Аккуратно наденьте первую перчатку на руку, осторожно расправьте манжету перчатки на руке до запястья. Возьмите вторую перчатку из упаковки. Повторите действия для второй руки, затем легкими движениями расправьте перчатки по форме рук, обеспечив их комфортное использование.

Снимать использованные перчатки следует осторожно, избегая разбрызгивания с поверхностей перчатки, при котором возможно микробное загрязнение рук и окружающей среды.

Чтобы снять перчатки, возьмитесь за первую перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Стяните перчатку и удерживайте ее другой рукой. Затем поместите пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и стяните ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, используйте ее в качестве мешка для другой перчатки. Поместите перчатки в предназначенную для них емкость для отходов. Затем проведите гигиеническую обработку рук.

**УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Перчатки должны применяться в соответствии с инструкцией на медицинское изделие. Применение изделия не требует специальной квалификации или специального образования. Изделие предназначено только для одноразового применения.

Перчатки применяются в лечебных или лечебно-профилактических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от 15°C до 25°C и относительной влажности от 65% до 85%. Необходимо подбирать перчатки нужного размера и в зависимости от характера выполняемых манипуляций – они должны легко надеваться и не должны затруднять движения или сдавливать кисти рук. Не применять при несоответствии размера. Только для индивидуального применения. Не использовать одну и ту же пару одноразовых перчаток при проведении медицинских манипуляций нескольким пациентам, а также при выполнении медицинских манипуляций у одного пациента, но в различных анатомических областях, отличающихся по составу микрофлоры. Перчатки во время выполнения манипуляций не рекомендуется обрабатывать антисептическими и дезинфицирующими средствами, так как это отрицательно влияет на их герметичность и может привести к усилению проницаемости.

ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12 литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, [www.benovydental.ru](http://www.benovydental.ru), [beplus@beplus.spb.ru](mailto:beplus@beplus.spb.ru)  
ТУ 22.19.60-005-19812462-2020.

Соответствует ГОСТ 32337-2013.

РУ № РЗН 2022/17641 от 30.06.2022 г.

Не подлежит обязательной сертификации.

**СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:** 5 лет. Не использовать по истечении срока годности.

**ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.** Производитель гарантирует соответствие качества перчаток требованиям нормативной и технической документации при соблюдении правил использования, транспортирования и хранения. Безопасность и качество изделия гарантируется в течение всего срока годности.





НИТРИЛ

одноразовые



неопудренные



нестерильные



диагностические



однократная  
хлоринация



текстурированные по  
всей поверхности ладони



одноразовые




удлиненная  
манжета

# Макет упаковки медицинского изделия (вертикальный) Вариант исполнения №4:

Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® одноразовые неопудренные с однократной хлоринацией, текстурированные по всей поверхности ладони, удлиненная манжета 300 мм с валиком; цвет: голубой, фиолетовый, зеленый, красный, розовый, черный, белый; размер: XS, S, M, L, XL.

Цвет медицинского изделия – белый.

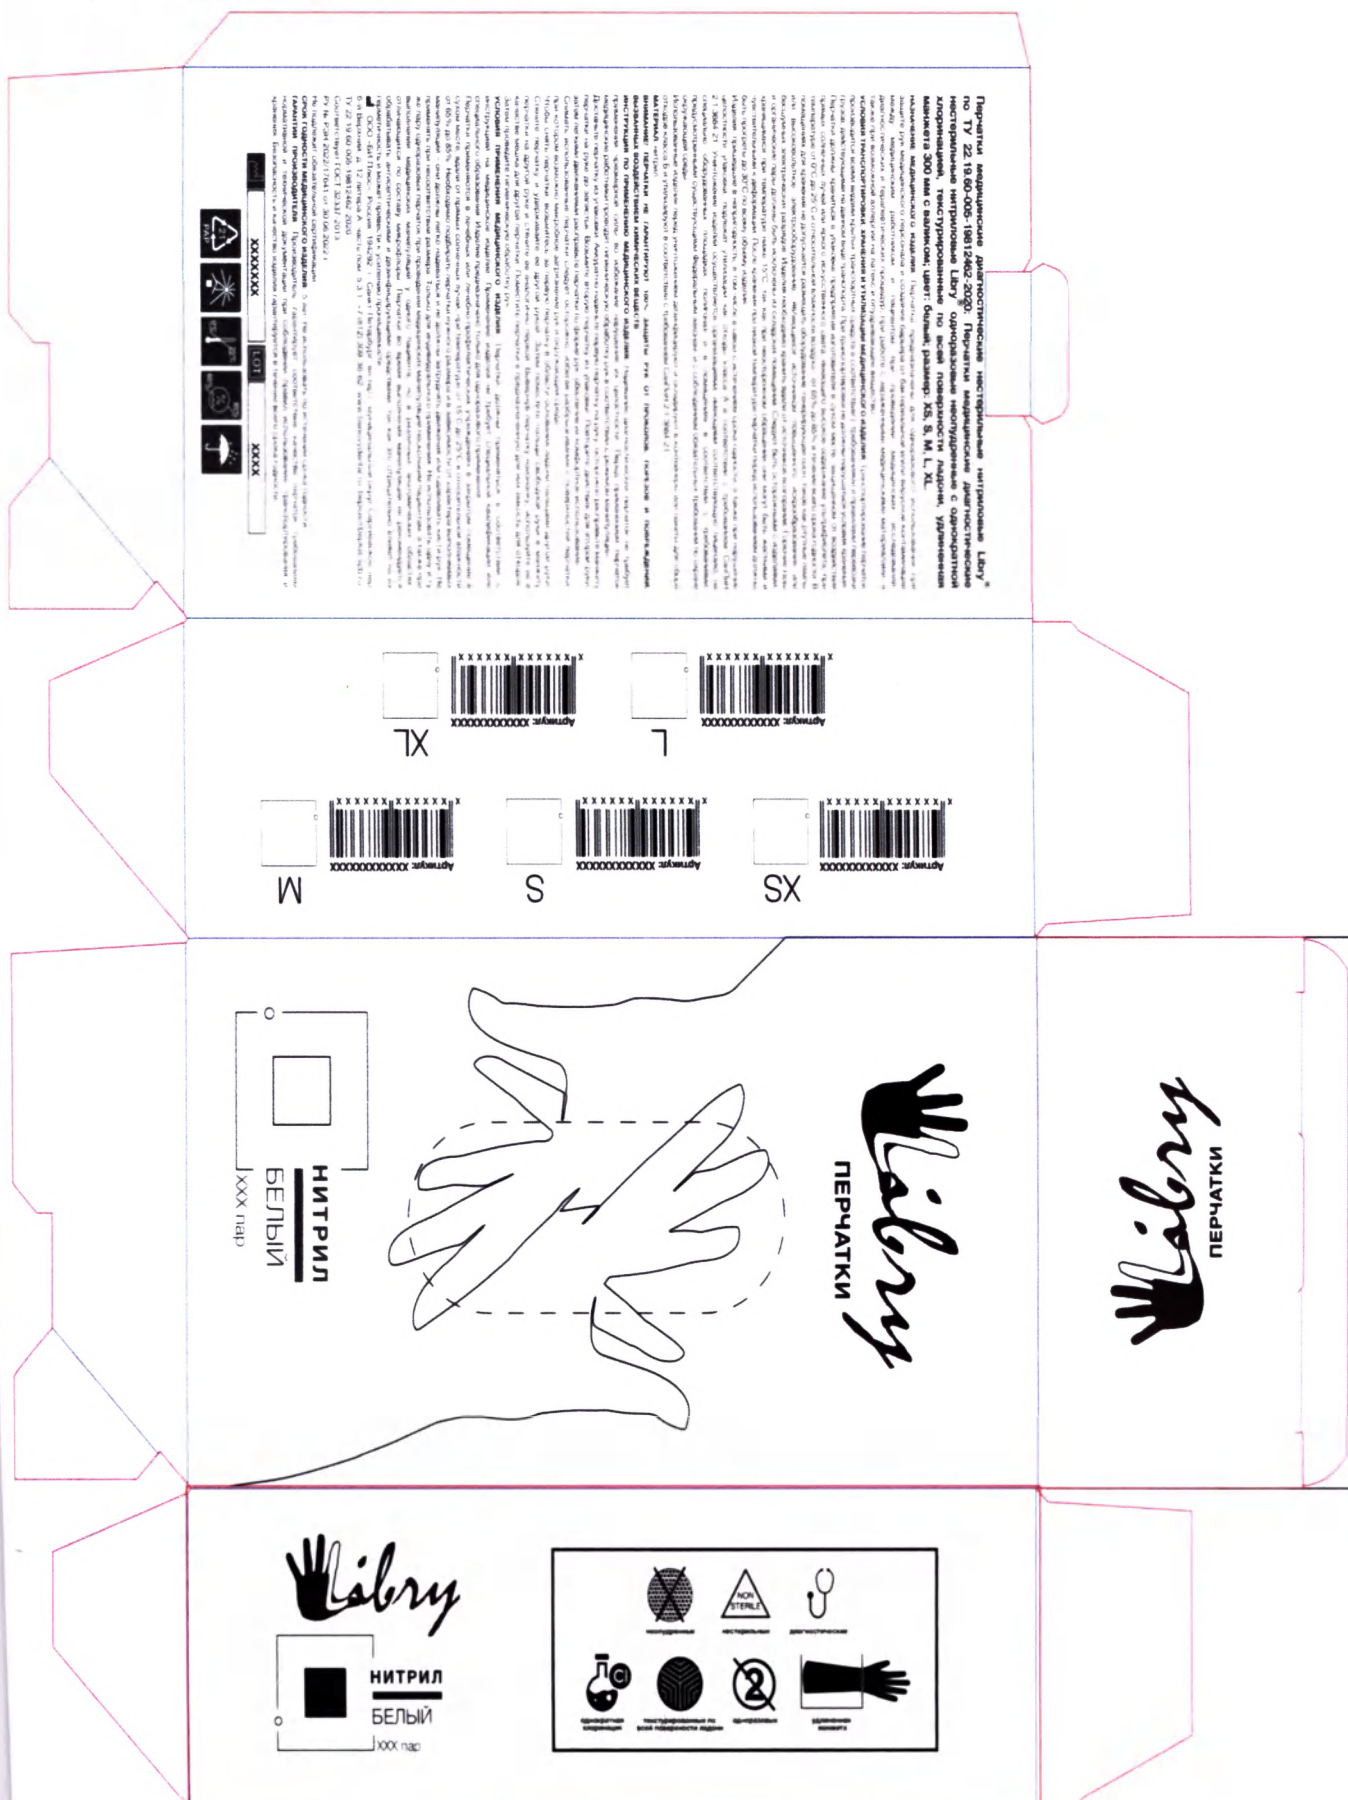

**Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® по ТУ 22.19.60-005-19812462-2020: Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® одноразовые неопудренные с однократной хлоринацией, текстурированные по всей поверхности ладони, удлиненная манжета 300 мм с валиком; цвет: белый; размер: XS, S, M, L, XL.**

**НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Перчатки предназначены для одноразового использования при защите рук медицинского персонала и создания барьера от бактериальной и/или вирусной контаминации между медицинским работником и пациентом при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, при работе с зараженными медицинскими материалами, а также при возможной аллергии на латекс и опудривающее вещество.

**УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Транспортирование перчаток производится всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения. Перчатки должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей или яркого искусственного света, имеющего высокое содержание ультрафиолета, при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха – от 65% до 85% в течение всего срока годности. В помещениях для хранения не допускается размещать оборудование, генерирующее озон, такое как ртутные лампы или высокочастотное электрооборудование, являющееся источником повышенного искрообразования или бесшумных электрических разрядов. Изделия необходимо хранить вдали от источников возгорания. Горючие газы и органические пары должны быть исключены из складских помещений. Следует быть осторожными с изделиями, хранящимися при температуре ниже 15°C, так как при неосторожном обращении они могут быть жесткими и чувствительными к деформации. После хранения при низкой температуре перчатки перед использованием должны быть прогреты до 30°C по всему объему изделия.

Изделия, пришедшие в непригодность, в том числе в связи с истечением срока годности, а также при нарушении целостности упаковки, подлежат утилизации как отходы класса А в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21. Уничтожение изделий осуществляется организациями, имеющими соответствующую лицензию, на специально оборудованных площадках, полигонах и в помещениях в соответствии с требованиями, предусмотренными существующими Федеральным законам, и с соблюдением обязательных требований по охране окружающей среды.

Использованные изделия перед уничтожением дезинфицируют и складировать в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21.

**МАТЕРИАЛ:** нитрил.

**ВНИМАНИЕ! ПЕРЧАТКИ НЕ ГАРАНТИРУЮТ 100% ЗАЩИТЫ РУК ОТ ПРОКОЛОВ, ПОРЕЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Надевание диагностических перчаток не требует применения чрезмерной силы во избежание нарушения их целостности. Перед применением перчаток медицинские работники проводят гигиеническую обработку рук в соответствии с режимом манипуляции.

Достаньте перчатку из упаковки. Аккуратно наденьте первую перчатку на руку, осторожно расправьте манжету перчатки на руке до запястья. Возьмите вторую перчатку из упаковки. Повторите действия для второй руки, затем легкими движениями расправьте перчатки по форме рук, обеспечив их комфортное использование.

Снимать использованные перчатки следует осторожно, избегая разбрызгивания с поверхностей перчатки, при котором возможно микробное загрязнение рук и окружающей среды.

Чтобы снять перчатки, возьмитесь за первую перчатку в области основания ладони пальцами другой руки.

Стяните перчатку и удерживайте ее другой рукой. Затем поместите пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и стяните ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, используйте ее в качестве мешка для другой перчатки. Поместите перчатки в предназначенную для них емкость для отходов. Затем проведите гигиеническую обработку рук.

**УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.** Перчатки должны применяться в соответствии с инструкцией на медицинское изделие. Применение изделия не требует специальной квалификации или специального образования. Изделие предназначено только для одноразового применения.

Перчатки применяются в лечебных или лечебно-профилактических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от 15°C до 25°C и относительной влажности от 65% до 85%. Необходимо подбирать перчатки нужного размера и в зависимости от характера выполняемых манипуляций – они должны легко надеваться и не должны затруднять движения или сдавливать кисти рук. Не применять при несоответствии размера. Только для индивидуального применения. Не использовать одну и ту же пару одноразовых перчаток при проведении медицинских манипуляций нескольким пациентам, а также при выполнении медицинских манипуляций у одного пациента, но в различных анатомических областях, отличающихся по составу микрофлоры. Перчатки во время выполнения манипуляций не рекомендуется обрабатывать антисептическими и дезинфицирующими средствами, так как это отрицательно влияет на их герметичность и может привести к усилению проницаемости.

ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сергиевское, пер 6-й Верхний, д. 12 литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, [www.benovydental.ru](http://www.benovydental.ru), [beplus@beplus.spb.ru](mailto:beplus@beplus.spb.ru)  
ТУ 22.19.60-005-19812462-2020.

Соответствует ГОСТ 32337-2013.

РУ № РЗН 2022/17641 от 30.06.2022 г.

Не подлежит обязательной сертификации.

**СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:** 5 лет. Не использовать по истечении срока годности.

**ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.** Производитель гарантирует соответствие качества перчаток требованиям нормативной и технической документации при соблюдении правил использования, транспортирования и хранения. Безопасность и качество изделия гарантируется в течение всего срока годности.





Всего прошито и скреплено  
печатью 56 листа/ов!  
Управляющий-ИП  
ПОТАКА В.Ф.



**ООО «БИ Плюс»**

Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й  
Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1.  
Тел.: +7 (812) 309-36-62. e-mail: beplus@beplus.spb.ru.

«УТВЕРЖДАЮ»

Управляющий - индивидуальный предприниматель  
ООО «БИ Плюс»

В.Ф. Потака

«24» мая 2023 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА**  
медицинского изделия

**Перчатки медицинские диагностические нестерильные**  
**нитриловые Libry®**

ТУ 22.19.60-005-19812462-2020

г. Санкт-Петербург

**Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия Вариант исполнения №1:**

Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® одноразовые неопудренные с однократной хлоринацией, текстурированные на пальцах, стандартная манжета 240 мм с валиком; цвет: голубой.



**Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия Вариант исполнения №1:**

Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® одноразовые неопудренные с однократной хлоринацией, текстурированные на пальцах, стандартная манжета 240 мм с валиком; цвет: фиолетовый.



**Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия Вариант исполнения №1:**

Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® одноразовые неопудренные с однократной хлоринацией, текстурированные на пальцах, стандартная манжета 240 мм с валиком; цвет: красный.



**Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия Вариант исполнения №1:**

Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® одноразовые неопудренные с однократной хлоринацией, текстурированные на пальцах, стандартная манжета 240 мм с валиком; цвет: розовый.



**Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия Вариант исполнения №2:**

Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® одноразовые неопудренные с однократной хлоринацией, текстурированные по всей поверхности ладони, стандартная манжета 240 мм с валиком; цвет: голубой.



**Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия Вариант исполнения №2:**

Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® одноразовые неопудренные с однократной хлоринацией, текстурированные по всей поверхности ладони, стандартная манжета 240 мм с валиком; цвет: зеленый.



**Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия Вариант исполнения №3:**

Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® одноразовые неопудренные с полимерным покрытием, текстурированные на пальцах, стандартная манжета 240 мм с валиком; цвет: голубой.



**Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия Вариант исполнения №4:**

Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® одноразовые неопудренные с однократной хлоринацией, текстурированные по всей поверхности ладони, удлиненная манжета 300 мм с валиком; цвет: голубой.




**Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия Вариант исполнения №4:**

Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® одноразовые неопудренные с однократной хлоринацией, текстурированные по всей поверхности ладони, удлиненная манжета 300 мм с валиком; цвет: черный.



**Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия Вариант исполнения №4:**

Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые Libry® одноразовые неопудренные с однократной хлоринацией, текстурированные по всей поверхности ладони, удлиненная манжета 300 мм с валиком; цвет: белый.

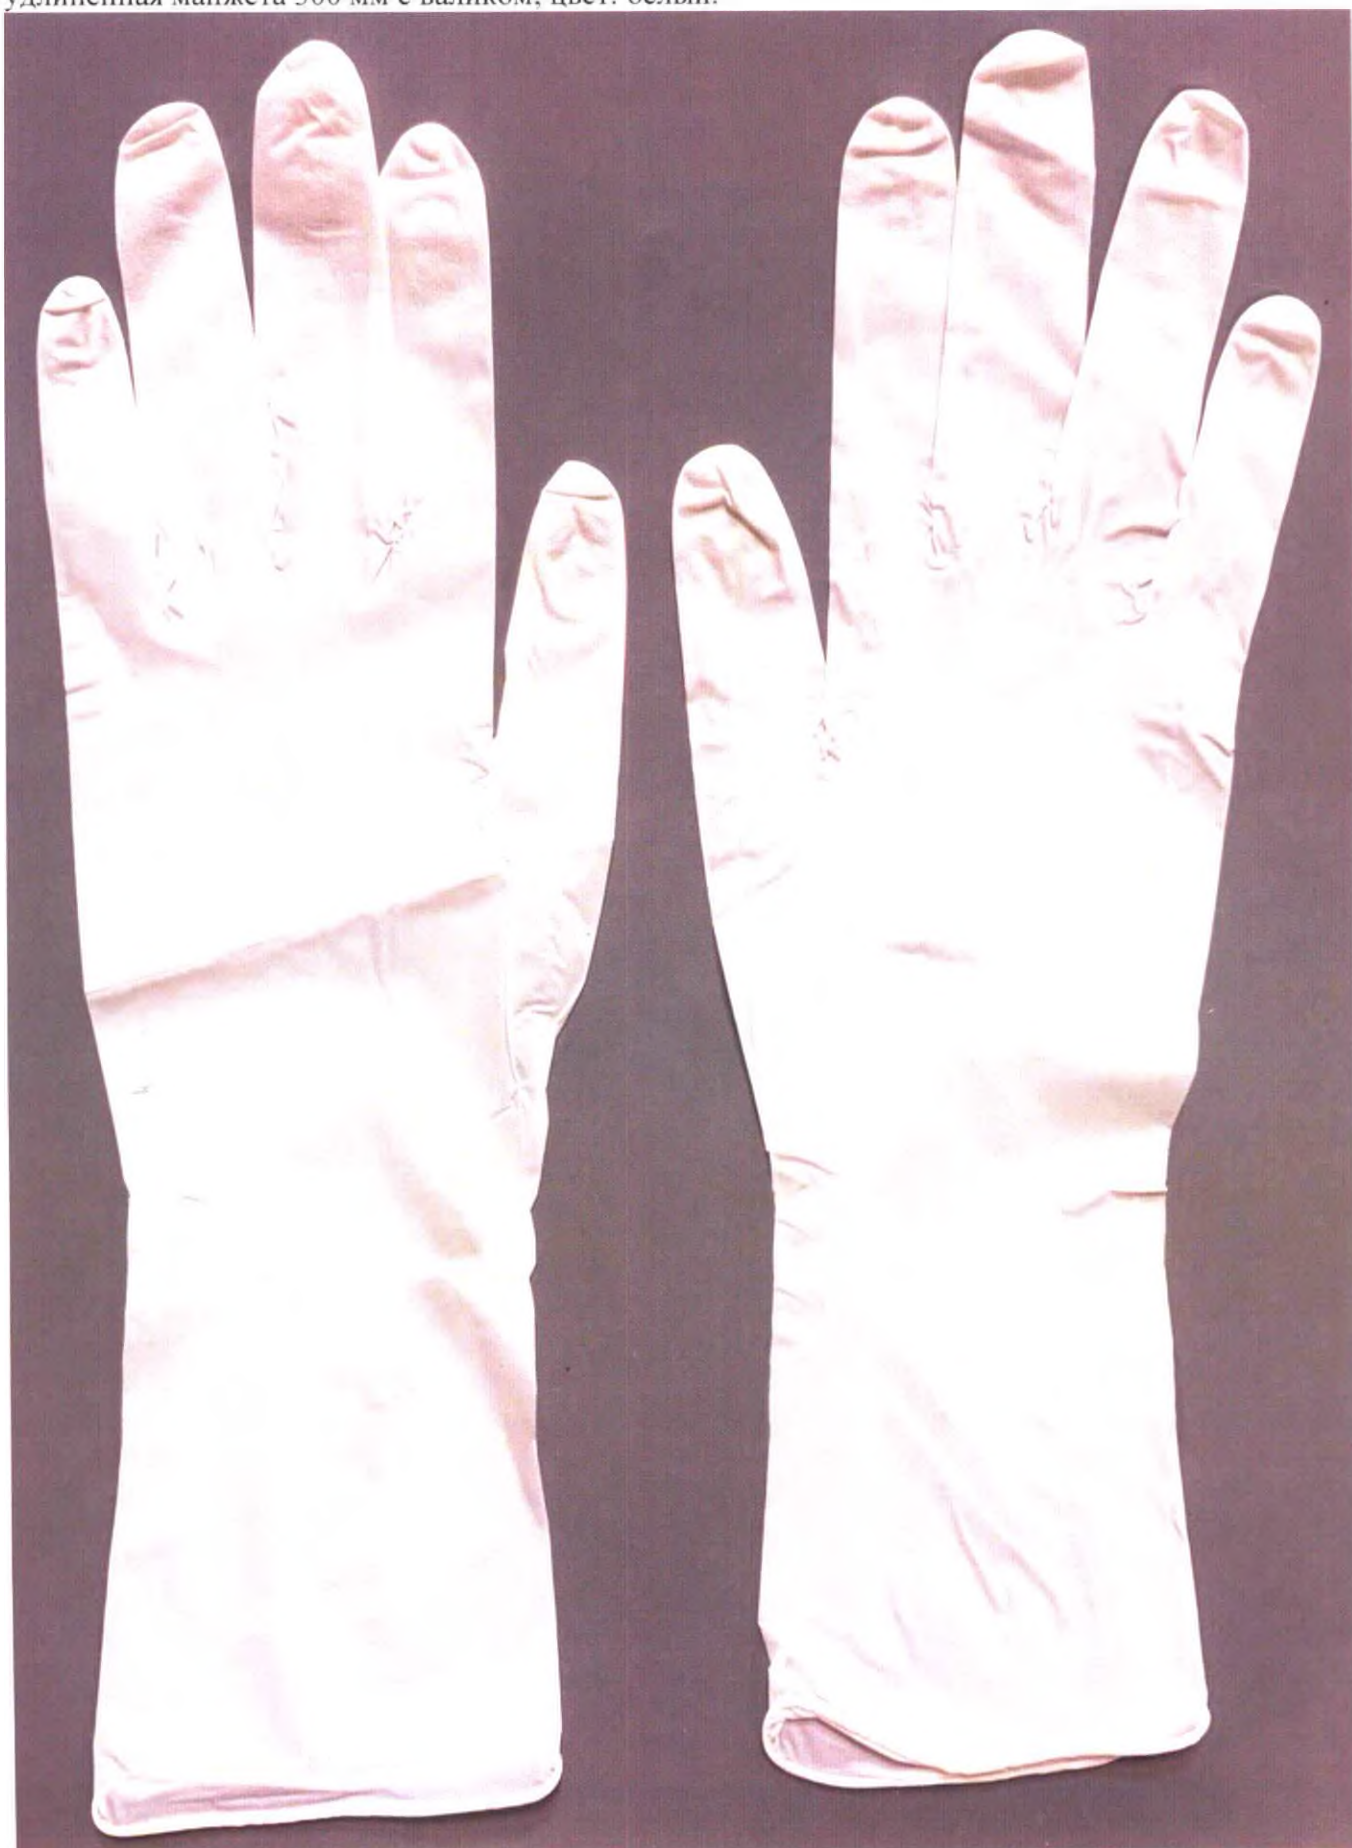

Всего прошито и скреплено  
печатью 11 листов  
Управляющий-Исполнитель  
Потака В.Ф.

