



Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Альфа Медикал»

В.В. Черный


«07» июня 2022 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


КОРЗИНКА-ЭКСТРАКТОР УРОЛОГИЧЕСКАЯ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КАМНЕЙ

Производитель: «МАРФЛОУ АГ (MARFLOW AG), Швейцария
Soodstrasse 57, 8134 Adliswil, Zurich, Switzerland


1) Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная с кончиком из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 2.5 СН (0,83 мм), длина интродьюсера: 70 см, количество струн: 4, диаметр раскрытия: 9 мм, покрытие интродьюсера: ПТФЭ, тип рукоятки «Scissor».

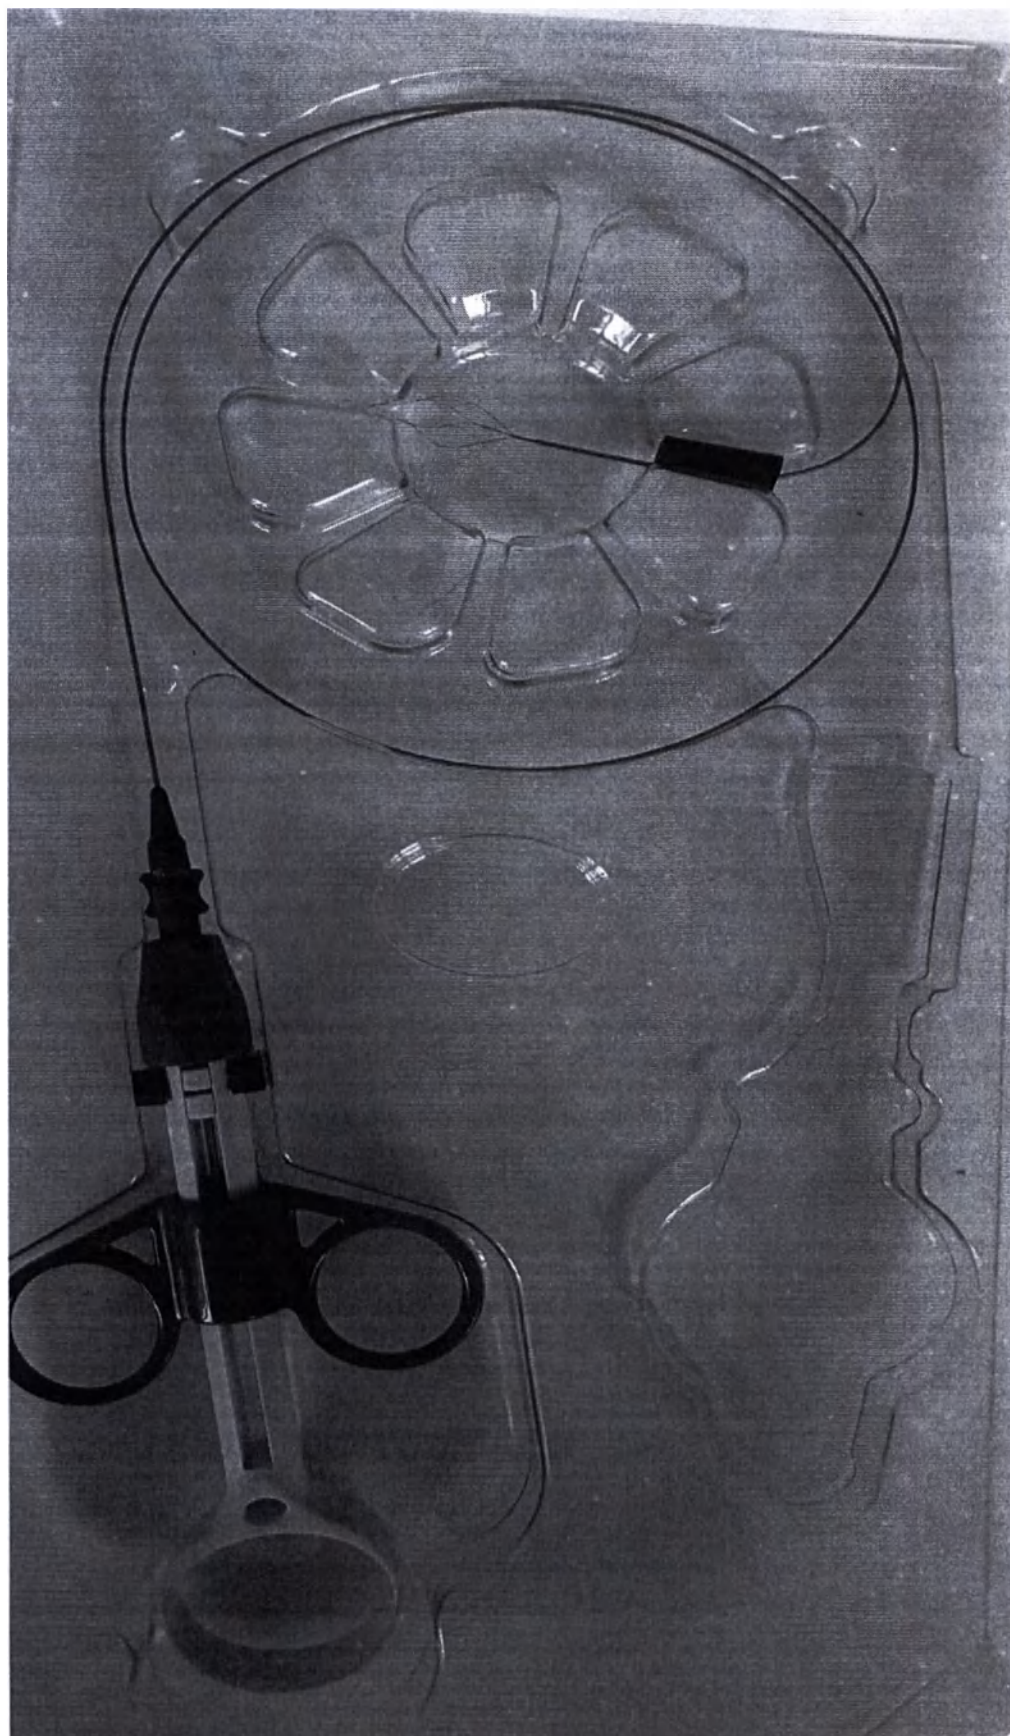


2) Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная с кончиком из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 3.0 СН (1,00 мм), длина интродьюсера: 100 см, количество струн: 5, диаметр раскрытия: 12 мм, покрытие интродьюсера: ПЭЭК, тип рукоятки «Scissor».

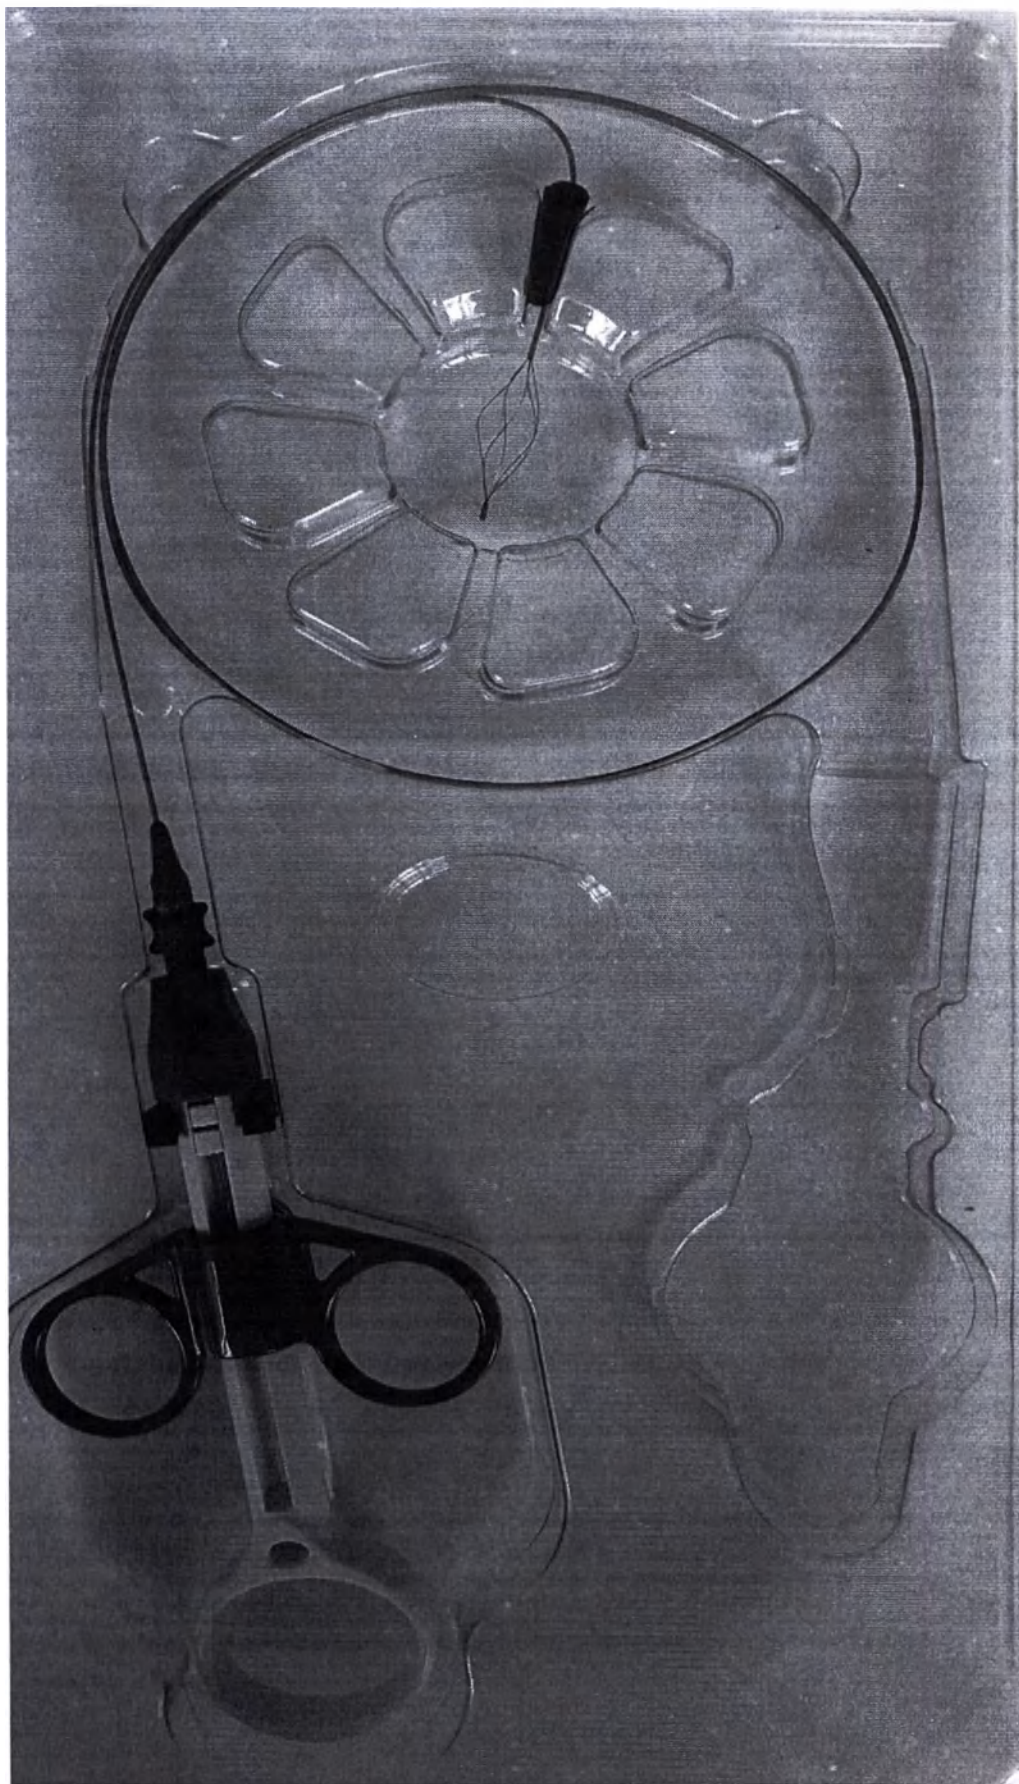


3) Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная с кончиком из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 4.0 СН (1,30 мм), длина интродьюсера: 90 см, количество струн: 5, диаметр раскрытия: 12 мм, покрытие интродьюсера: полиимид плетеный, тип рукоятки «Scissor».

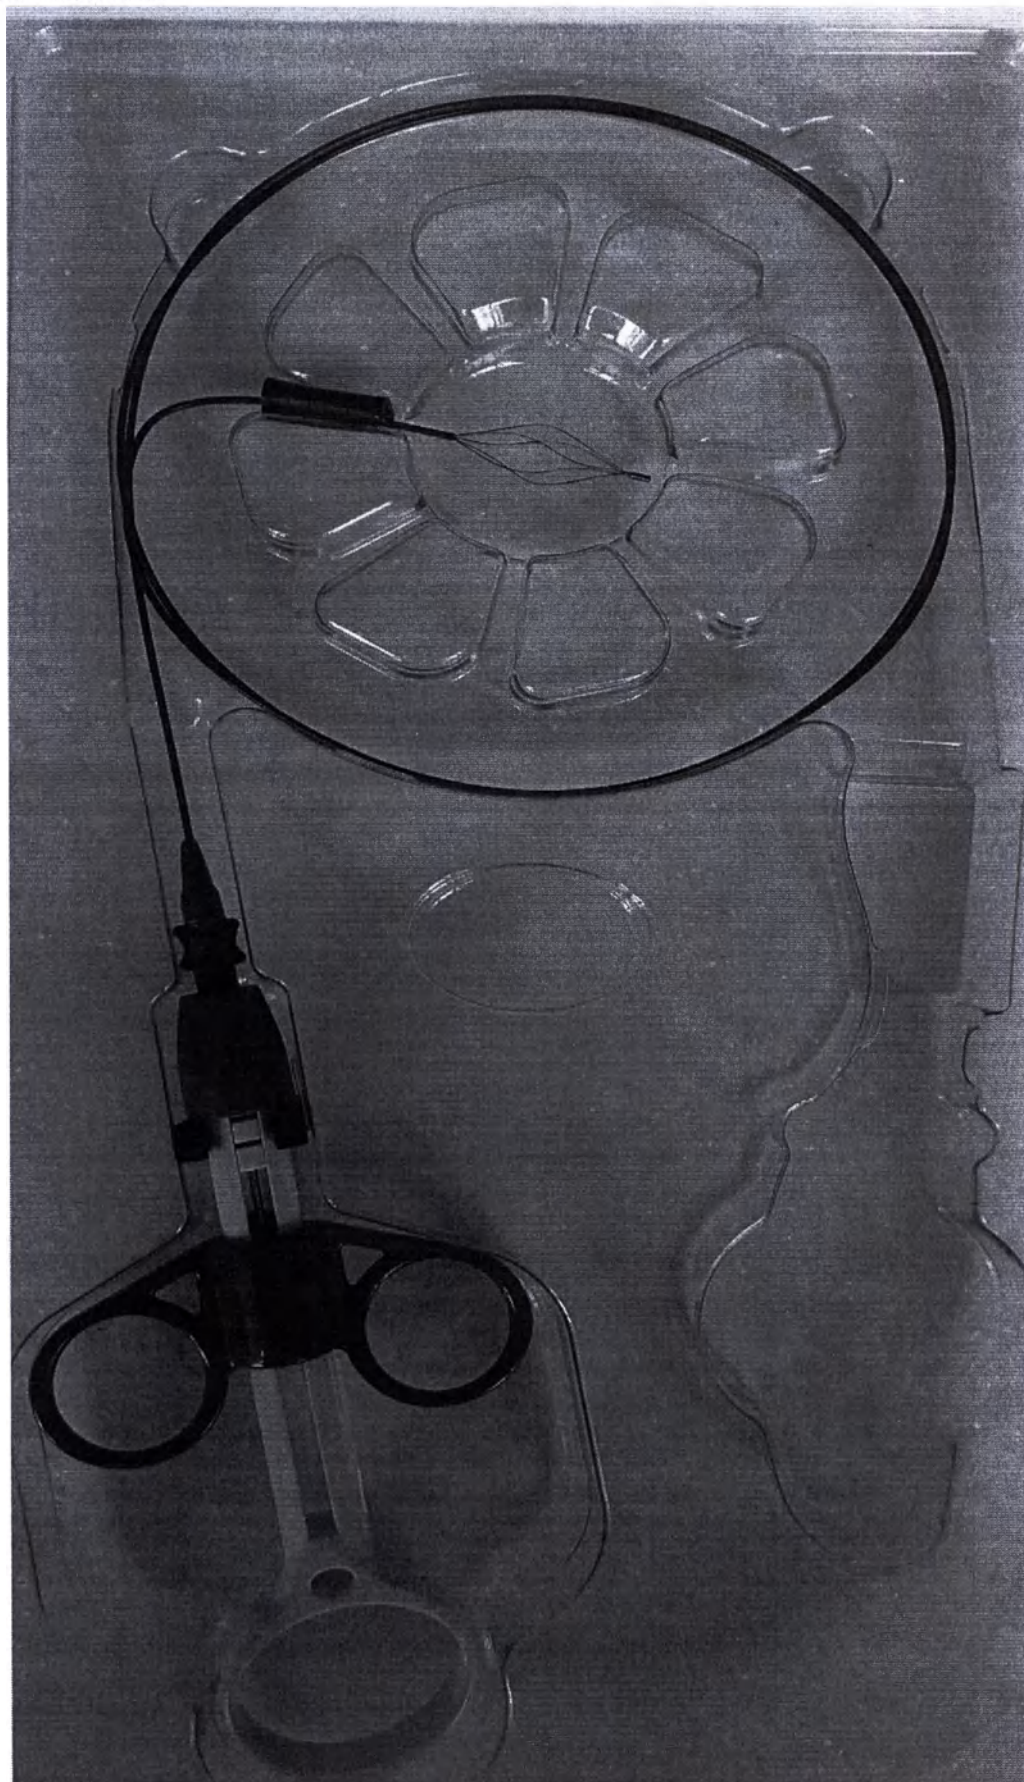


4) Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная с кончиком из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 5.0 СН (1,67 мм), длина интродьюсера: 110 см, количество струн: 5, диаметр раскрытия: 12 мм, покрытие интродьюсера: ПЭЭК, тип рукоятки «Scissor».

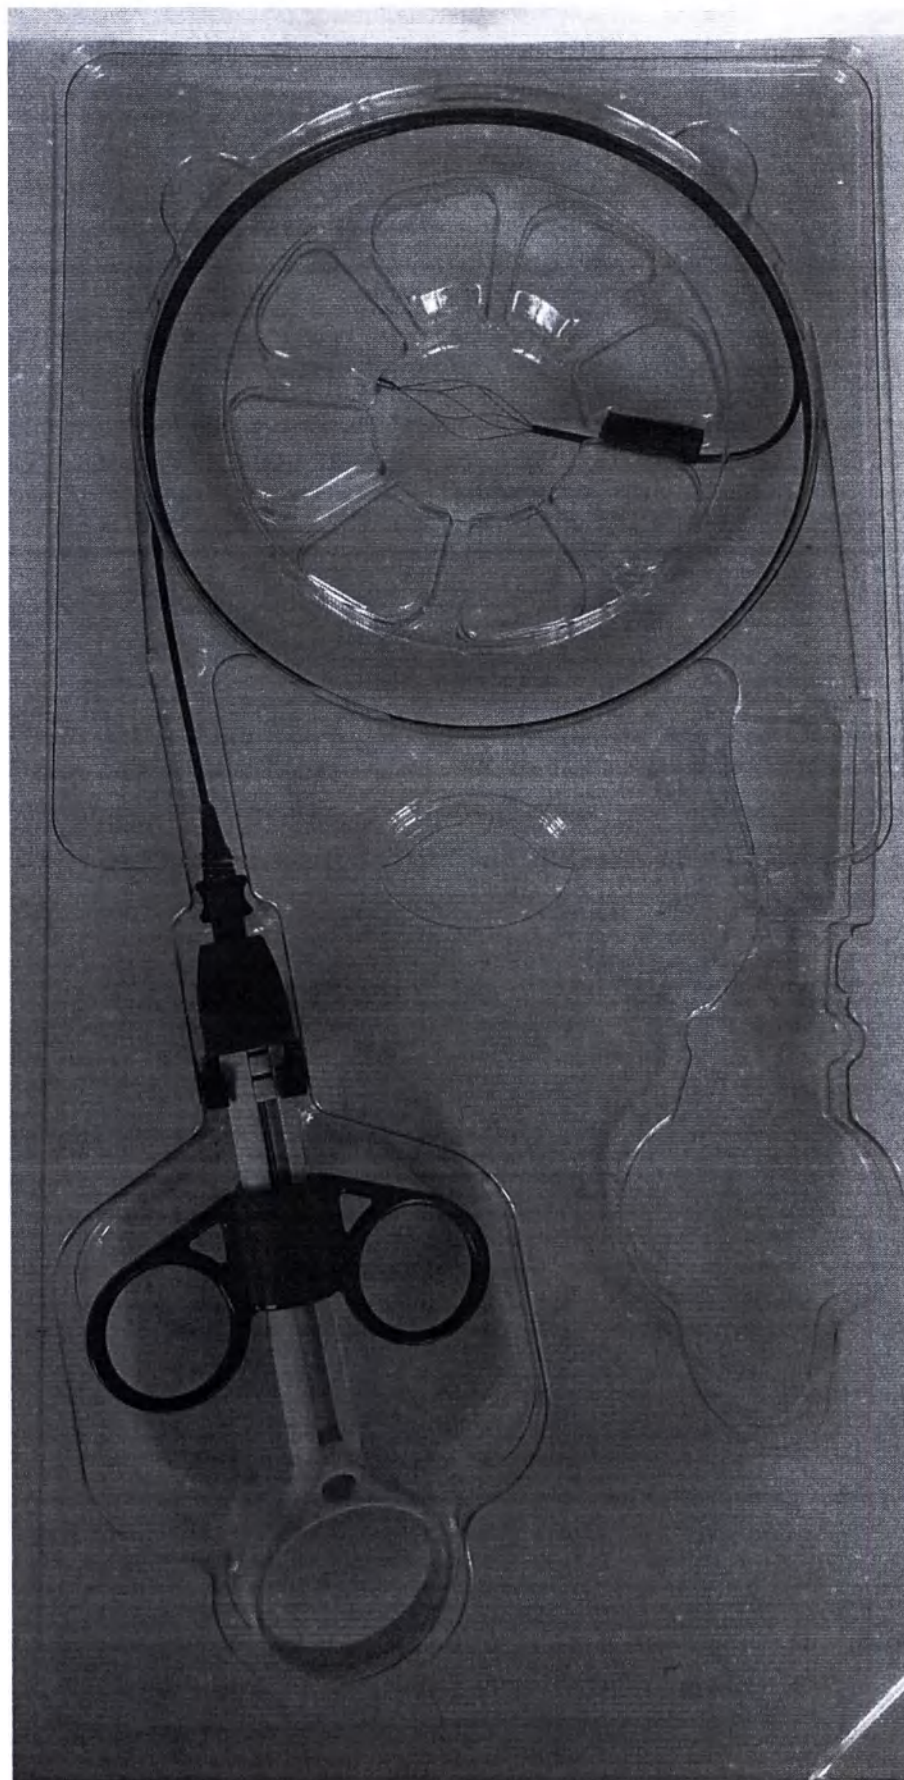


5) Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная с кончиком из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 90 см, количество струн: 6, диаметр раскрытия: 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид, тип рукоятки «Scissor».

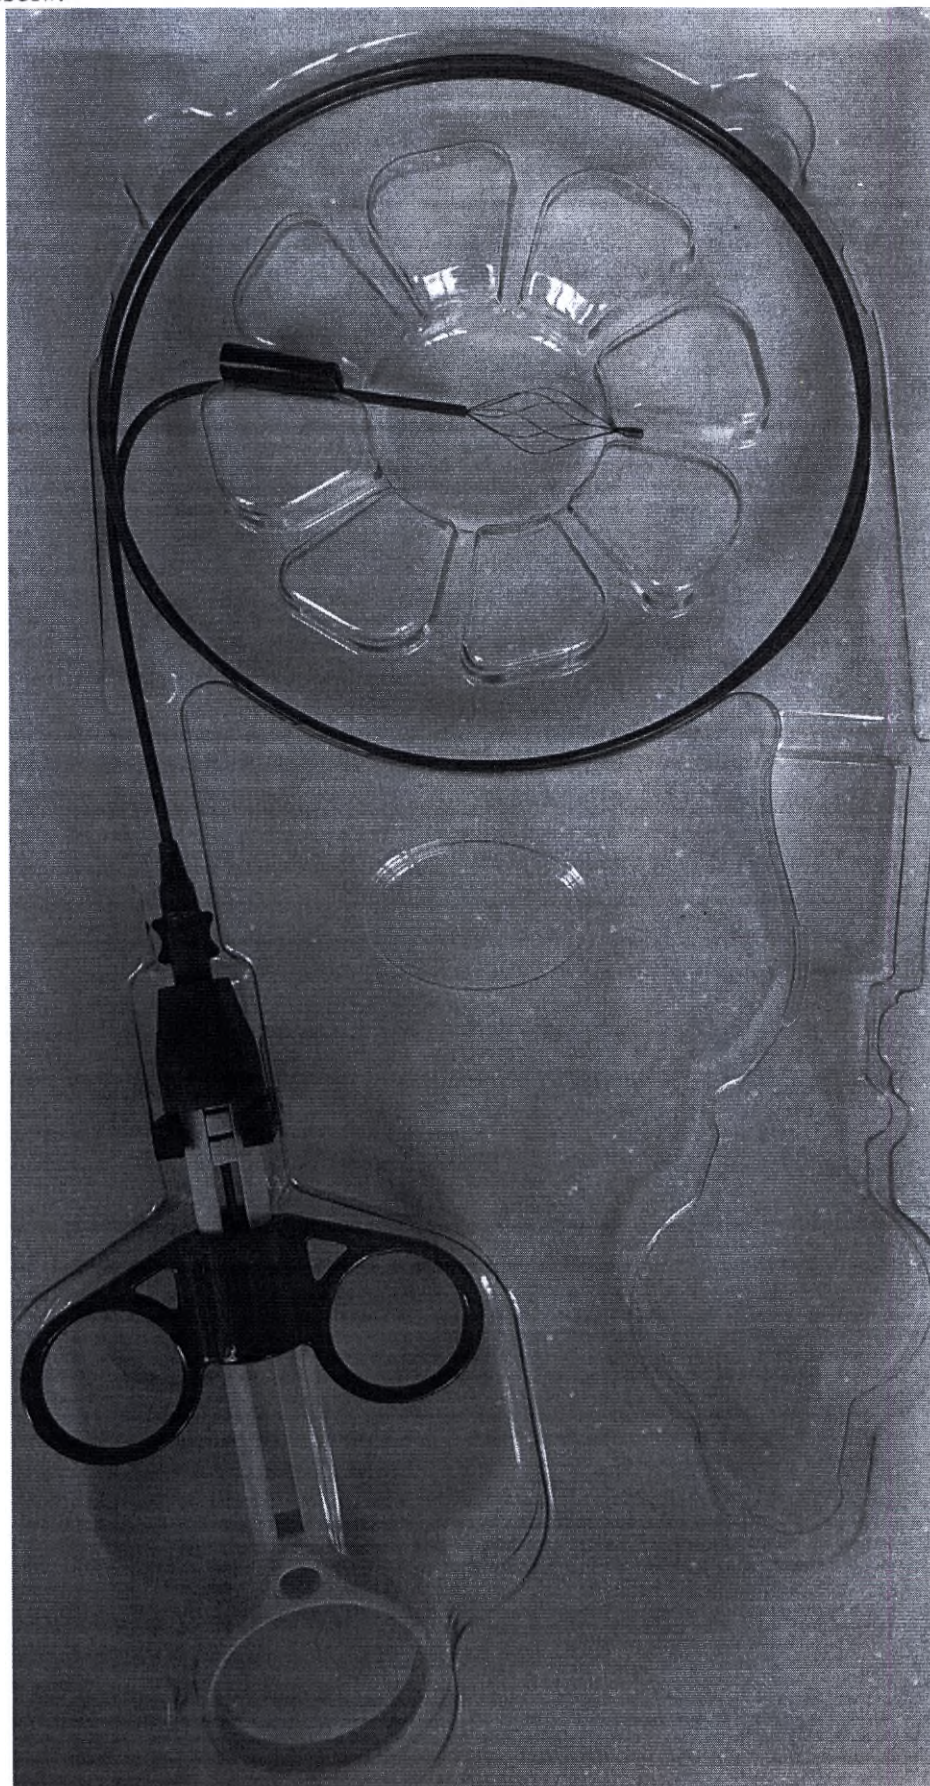


6) Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная с кончиком из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), длина интродьюсера: 70 см, количество струн: 4, диаметр раскрытия: 9 мм, покрытие интродьюсера: ПТФЭ, тип рукоятки «D-shape».

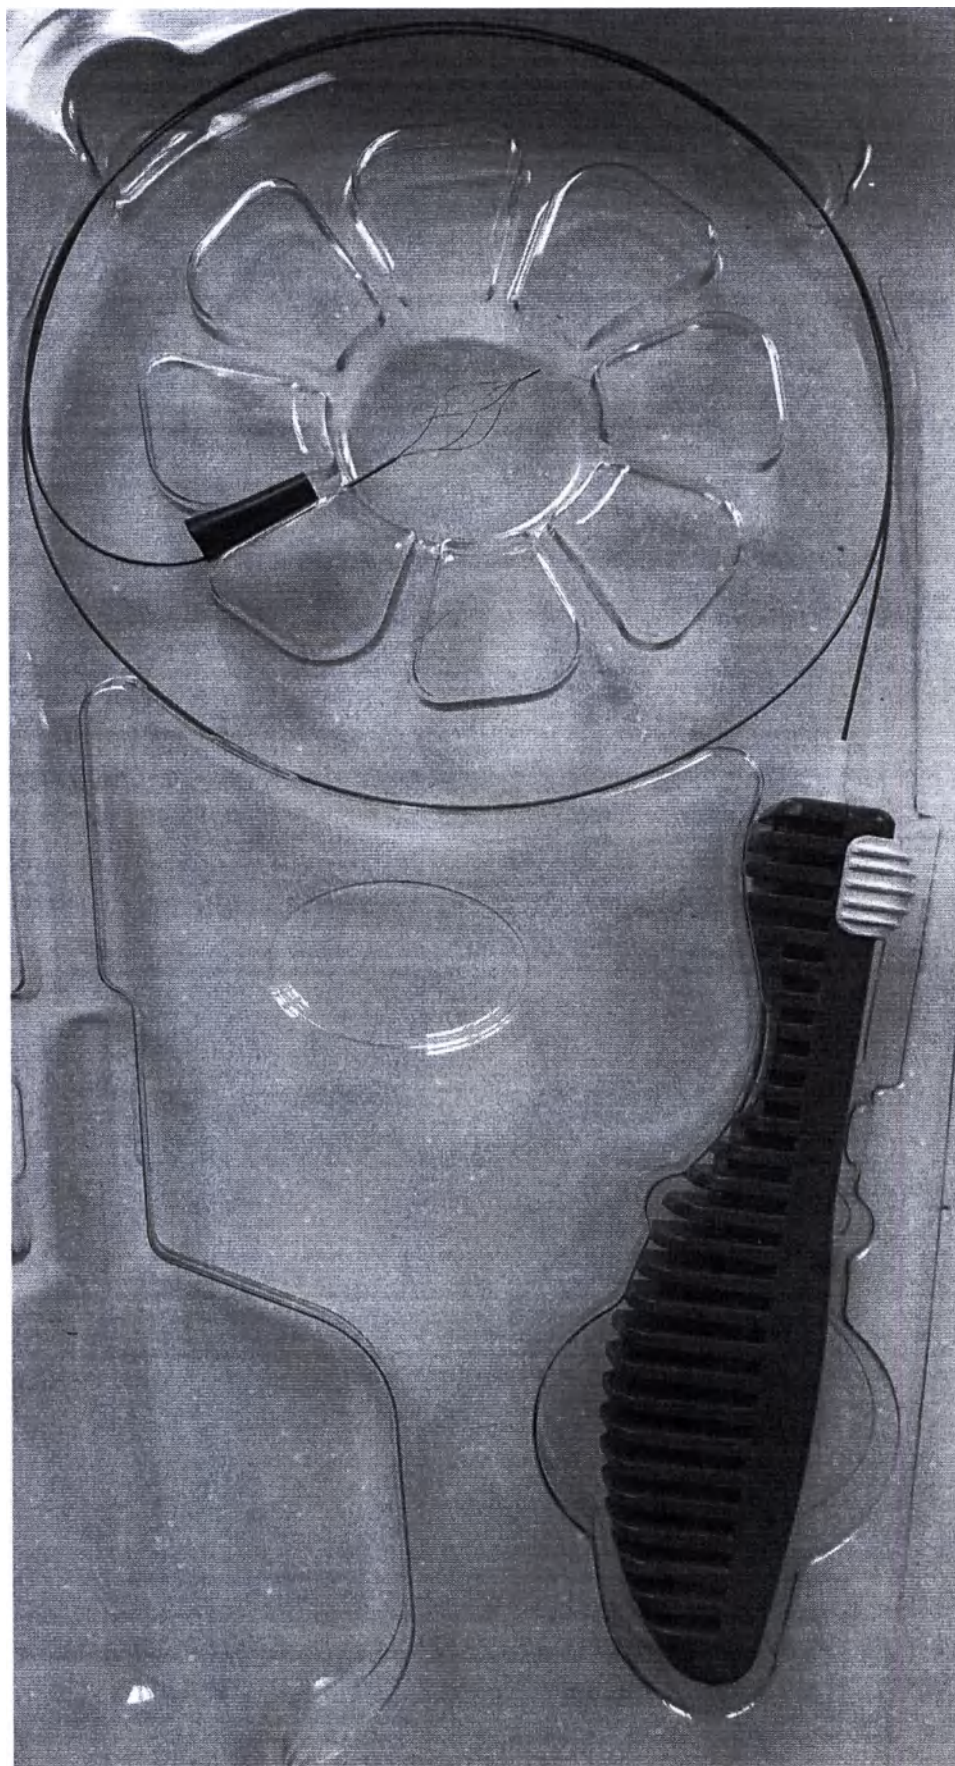


7) Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная с кончиком из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 4.0 СН (1,30 мм), длина интродьюсера: 90 см, количество струн: 4, диаметр раскрытия: 12 мм, покрытие интродьюсера: полиимид плетеный, тип рукоятки «D-shape».

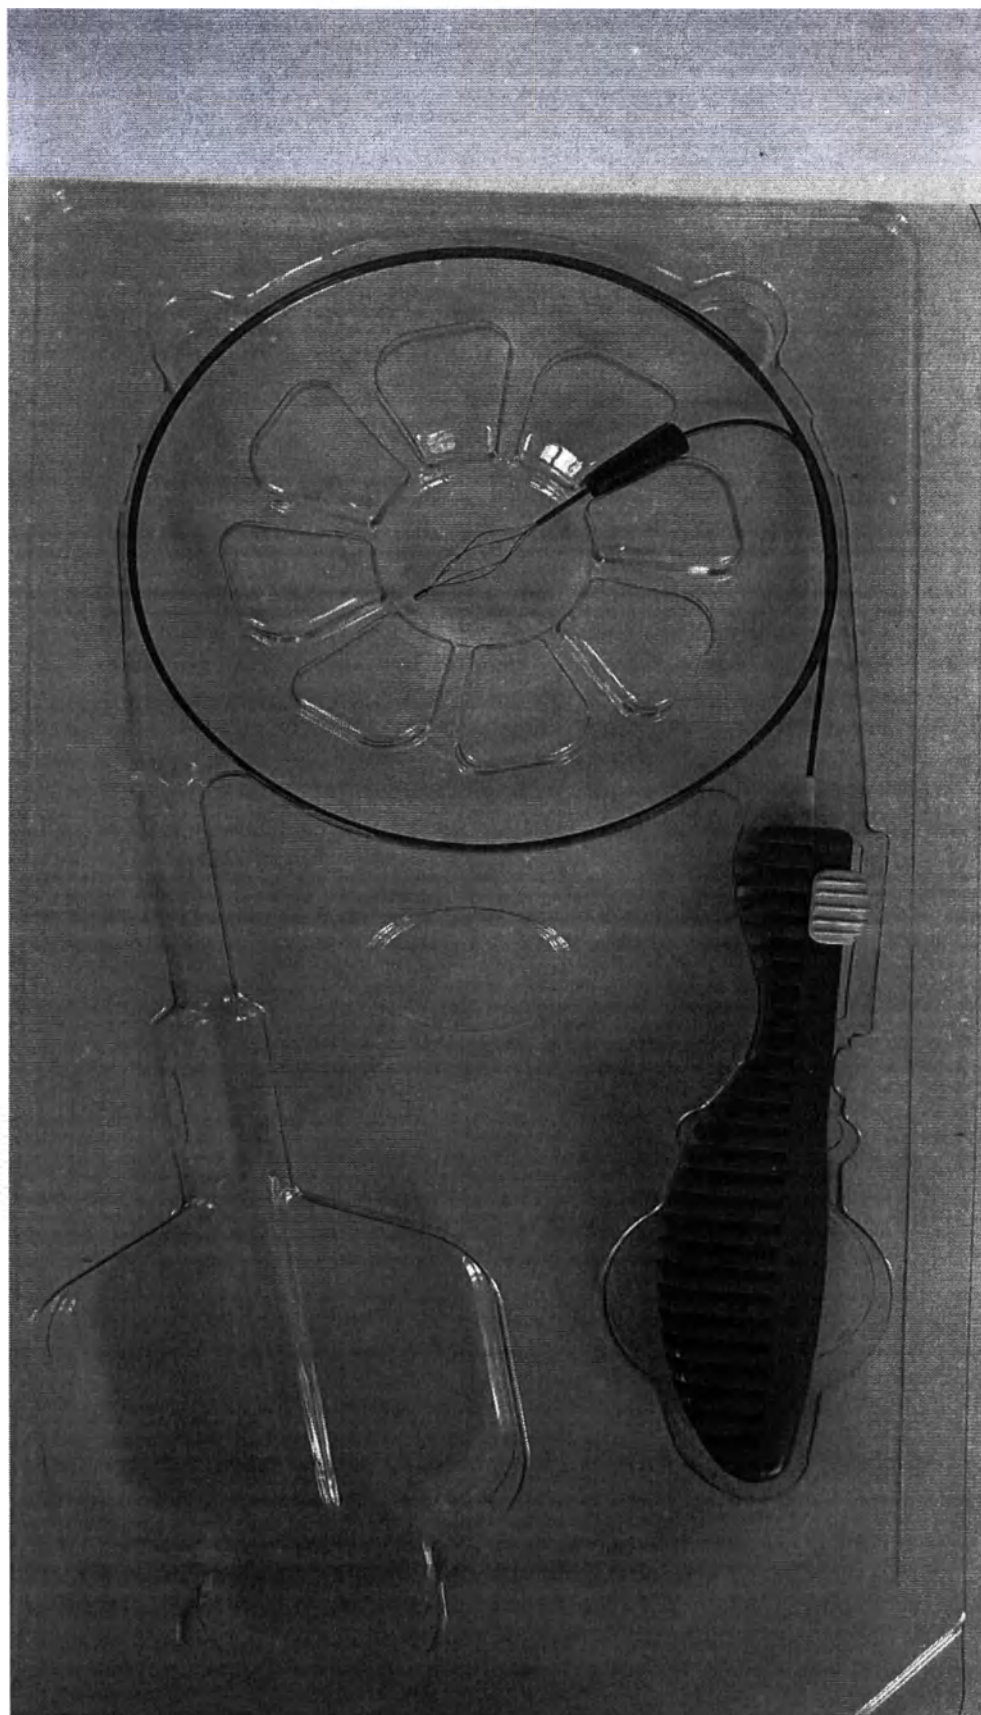


8) Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная с кончиком из нитинола, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), длина интродьюсера: 65 см, количество струн: 4, диаметр раскрытия: 9 мм, покрытие интродьюсера: ПТФЭ, тип рукоятки «Scissor».

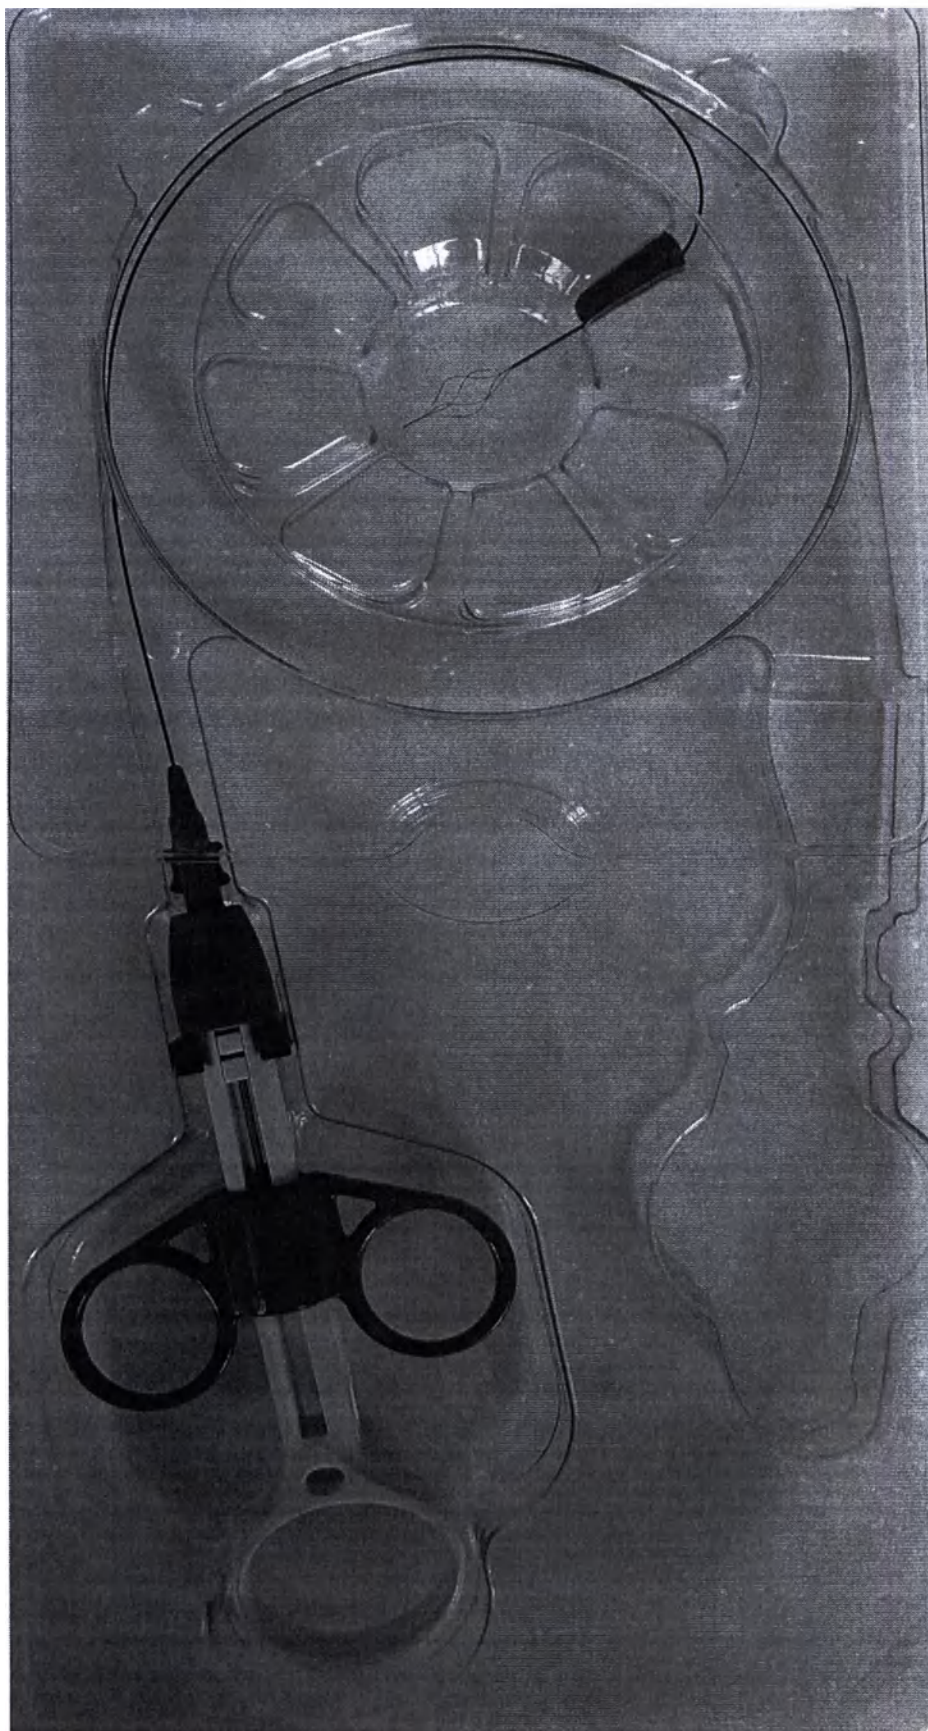


9) Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная с кончиком из нитинола, диаметр интродьюсера: 4.0 СН (1,30 мм), длина интродьюсера: 110 см, количество струн: 5, диаметр раскрытия: 12 мм, покрытие интродьюсера: полиимид плетеный, тип рукоятки «Scissor».

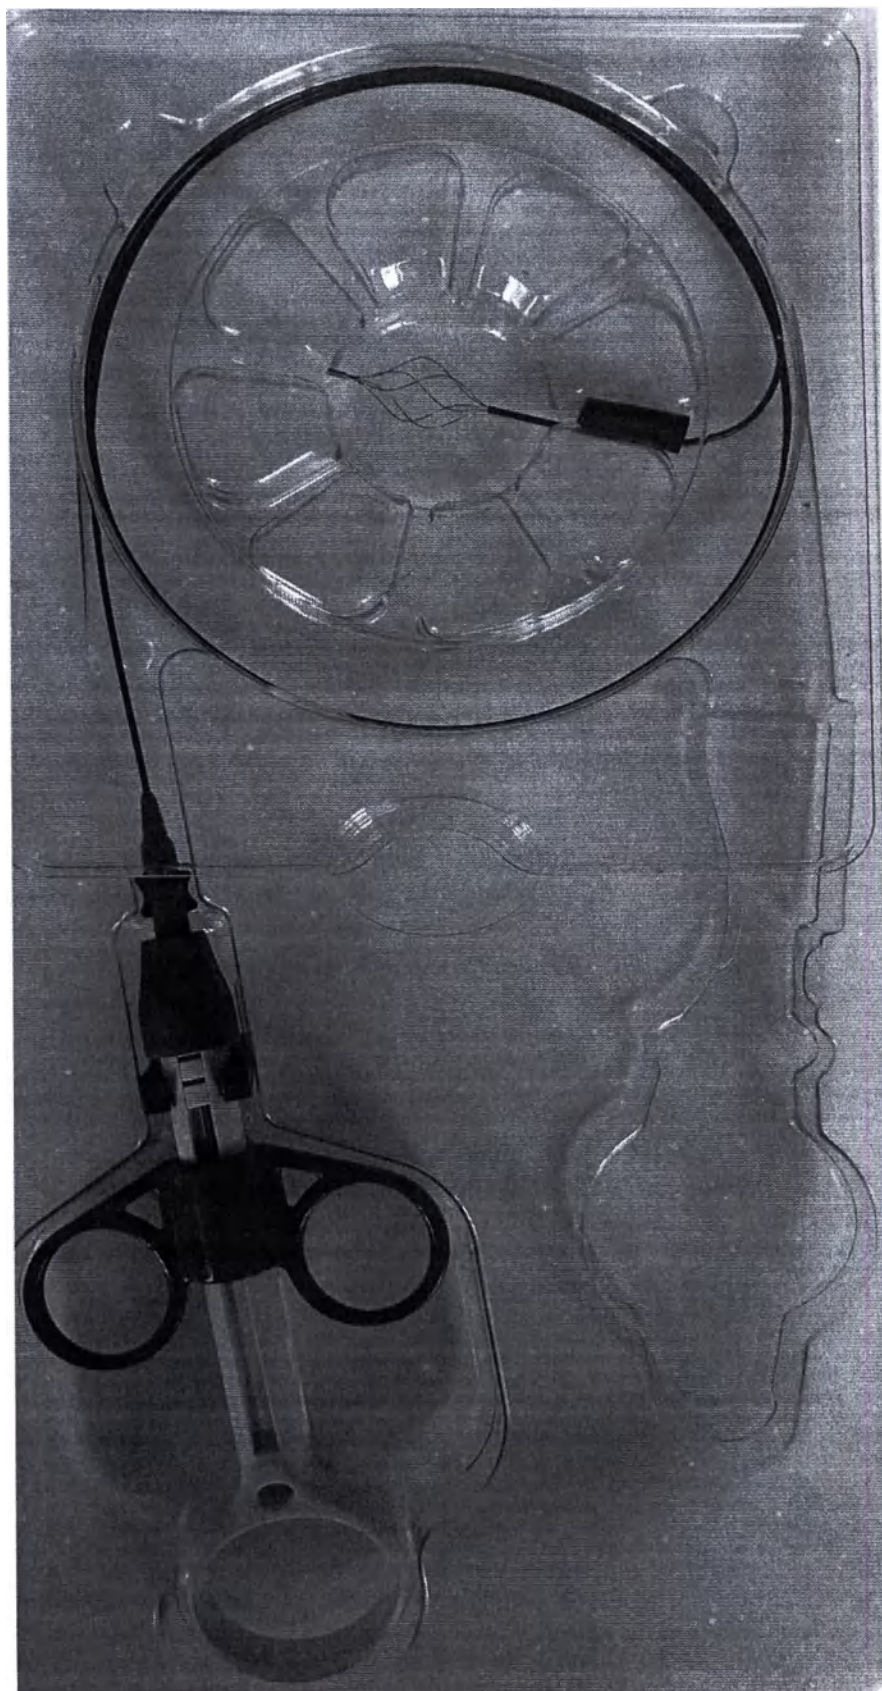


10) Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная с кончиком из нитинола, диаметр интродьюсера: 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 90 см, количество струн: 6, диаметр раскрытия: 15 мм, покрытие интродьюсера: ПЭЭК, тип рукоятки «Scissor».

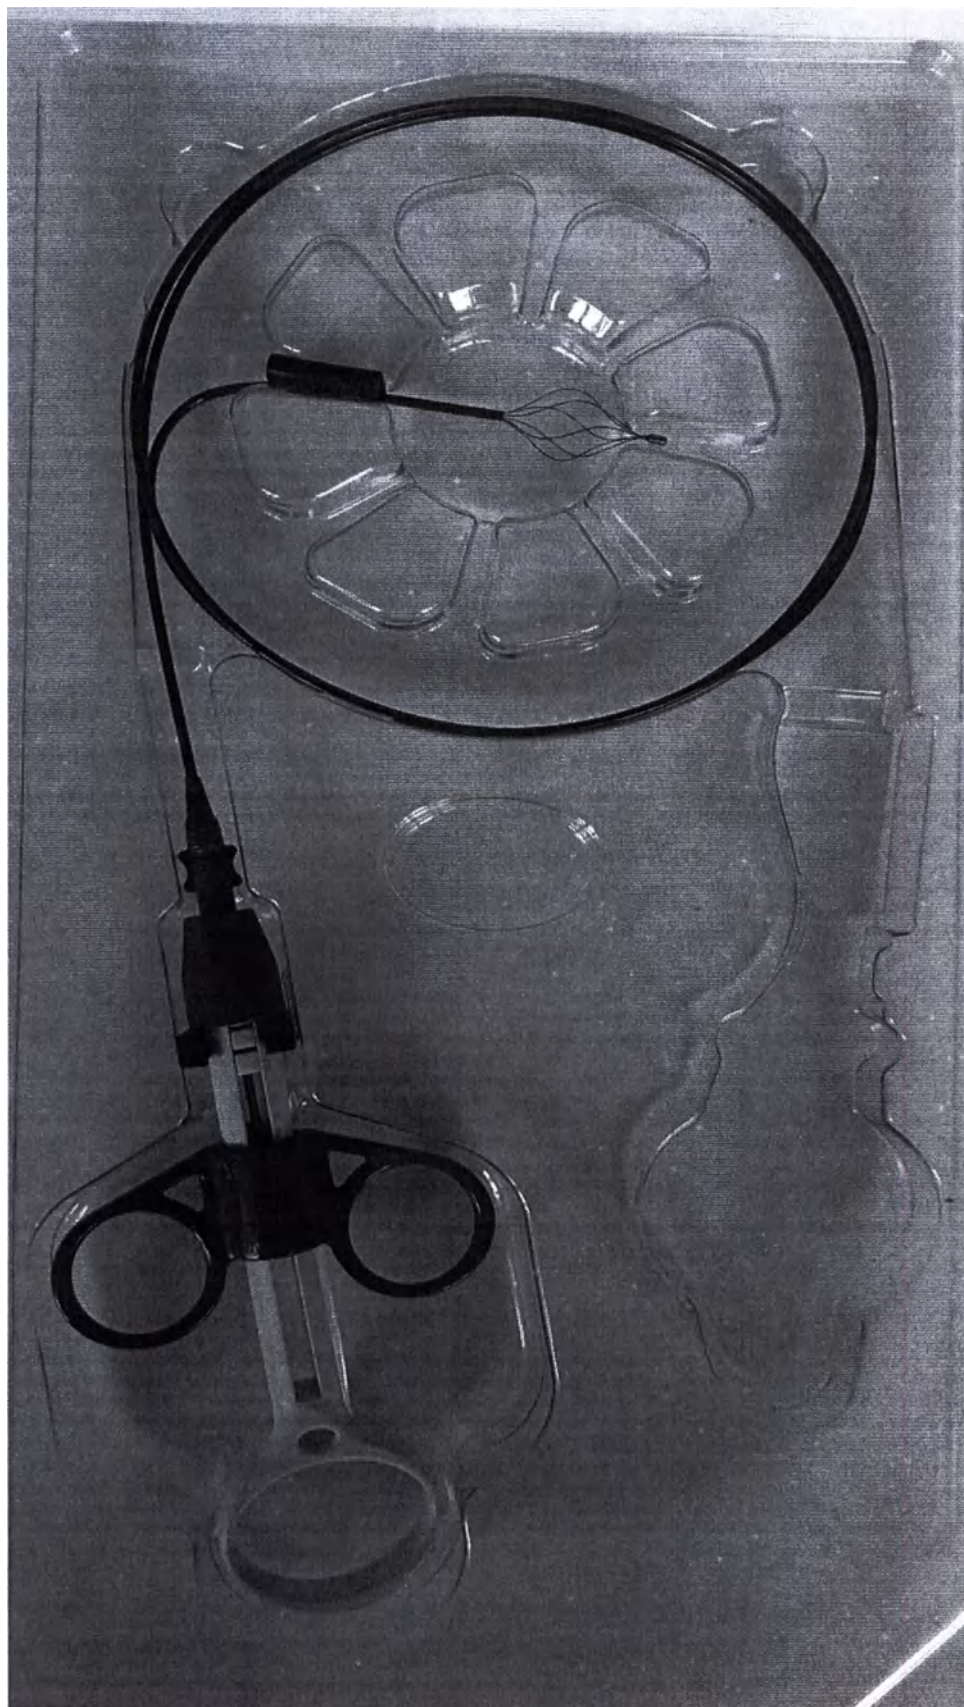


11) Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная с кончиком из нитинола, диаметр интродьюсера: 3,5 (1,17 мм), длина интродьюсера: 70 см, количество струн: 5, диаметр раскрытия: 12 мм, покрытие интродьюсера: полиимид, тип рукоятки «D-shape».

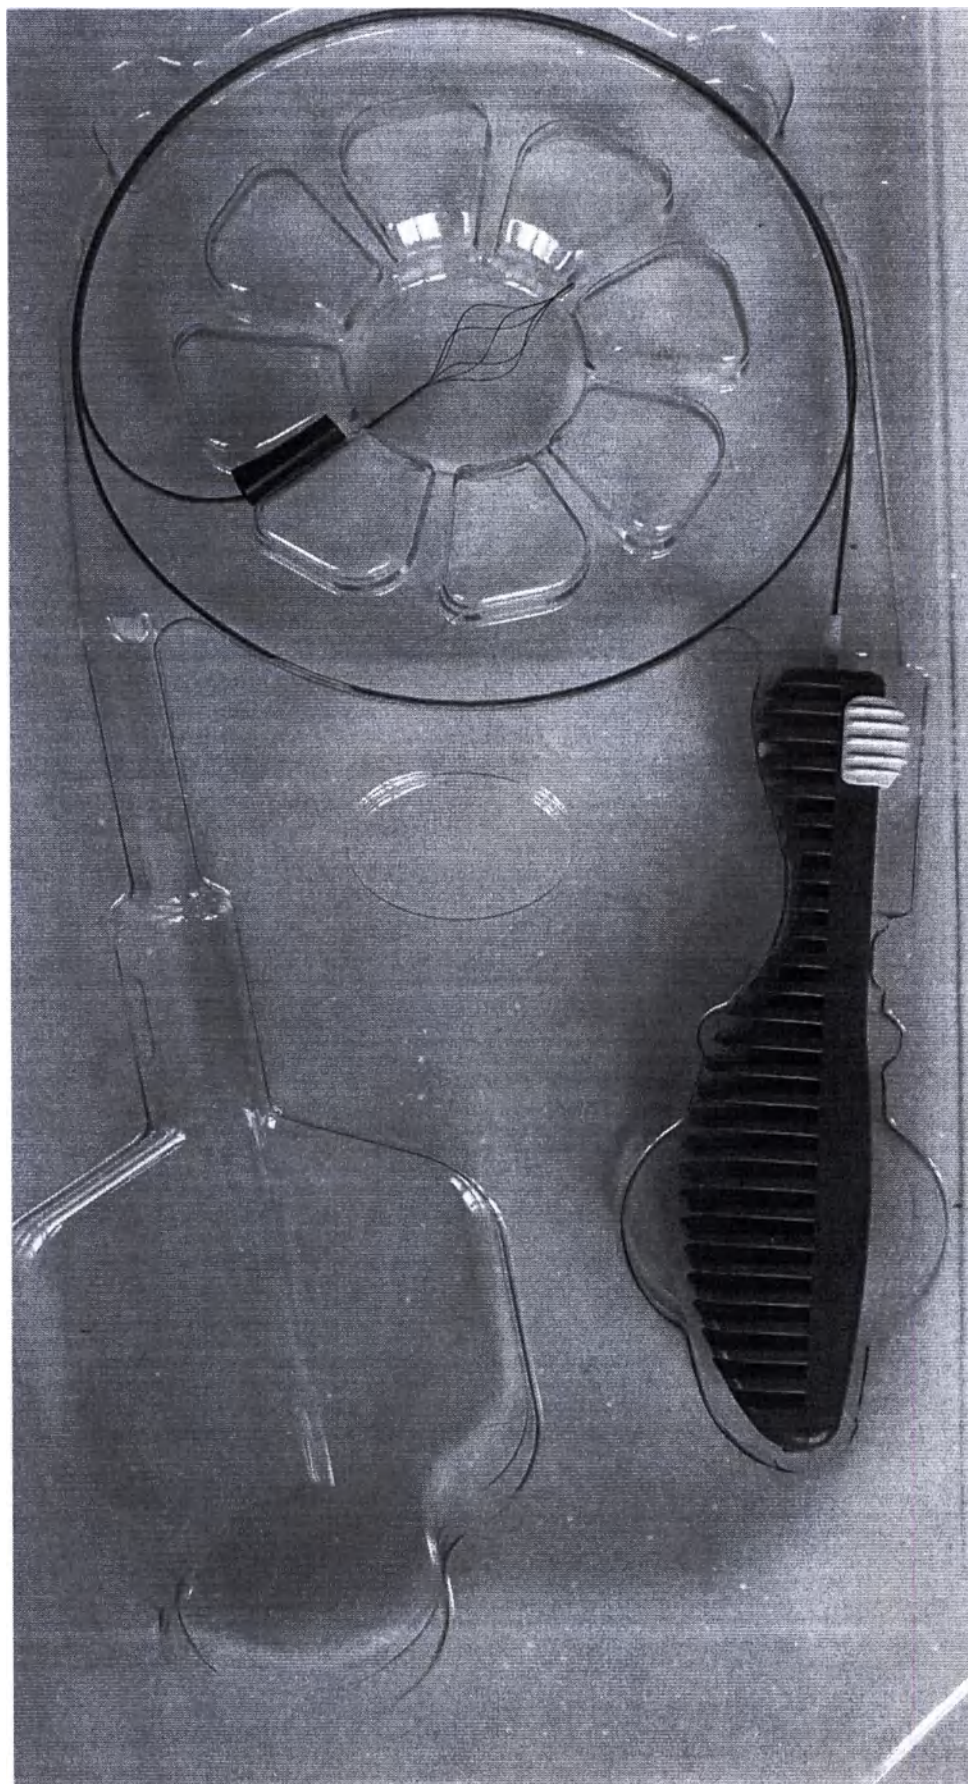


12) Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая с кончиком из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), длина интродьюсера: 70 см, количество струн: 4, диаметр раскрытия: 9 мм, покрытие интродьюсера: ПТФЭ, тип рукоятки «Scissor».

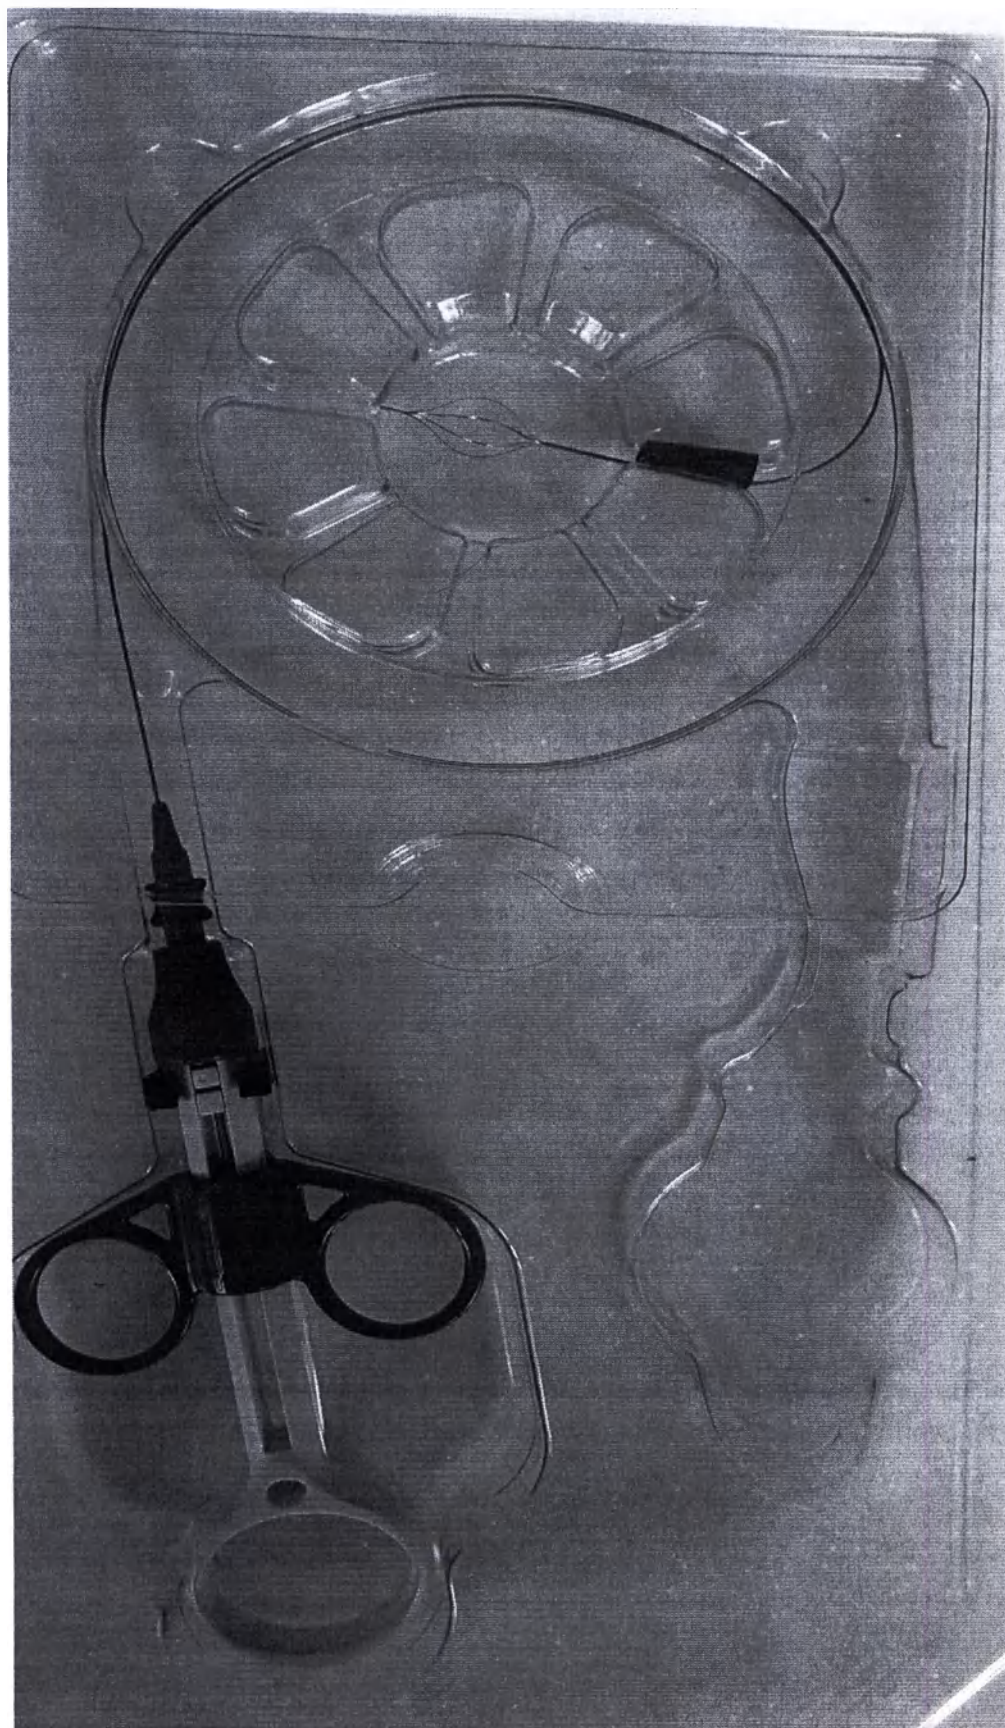


13) Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая с кончиком из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 90 см, количество струн: 6, диаметр раскрытия: 15 мм, покрытие интродьюсера: ПЭЭК, тип рукоятки «Scissor».

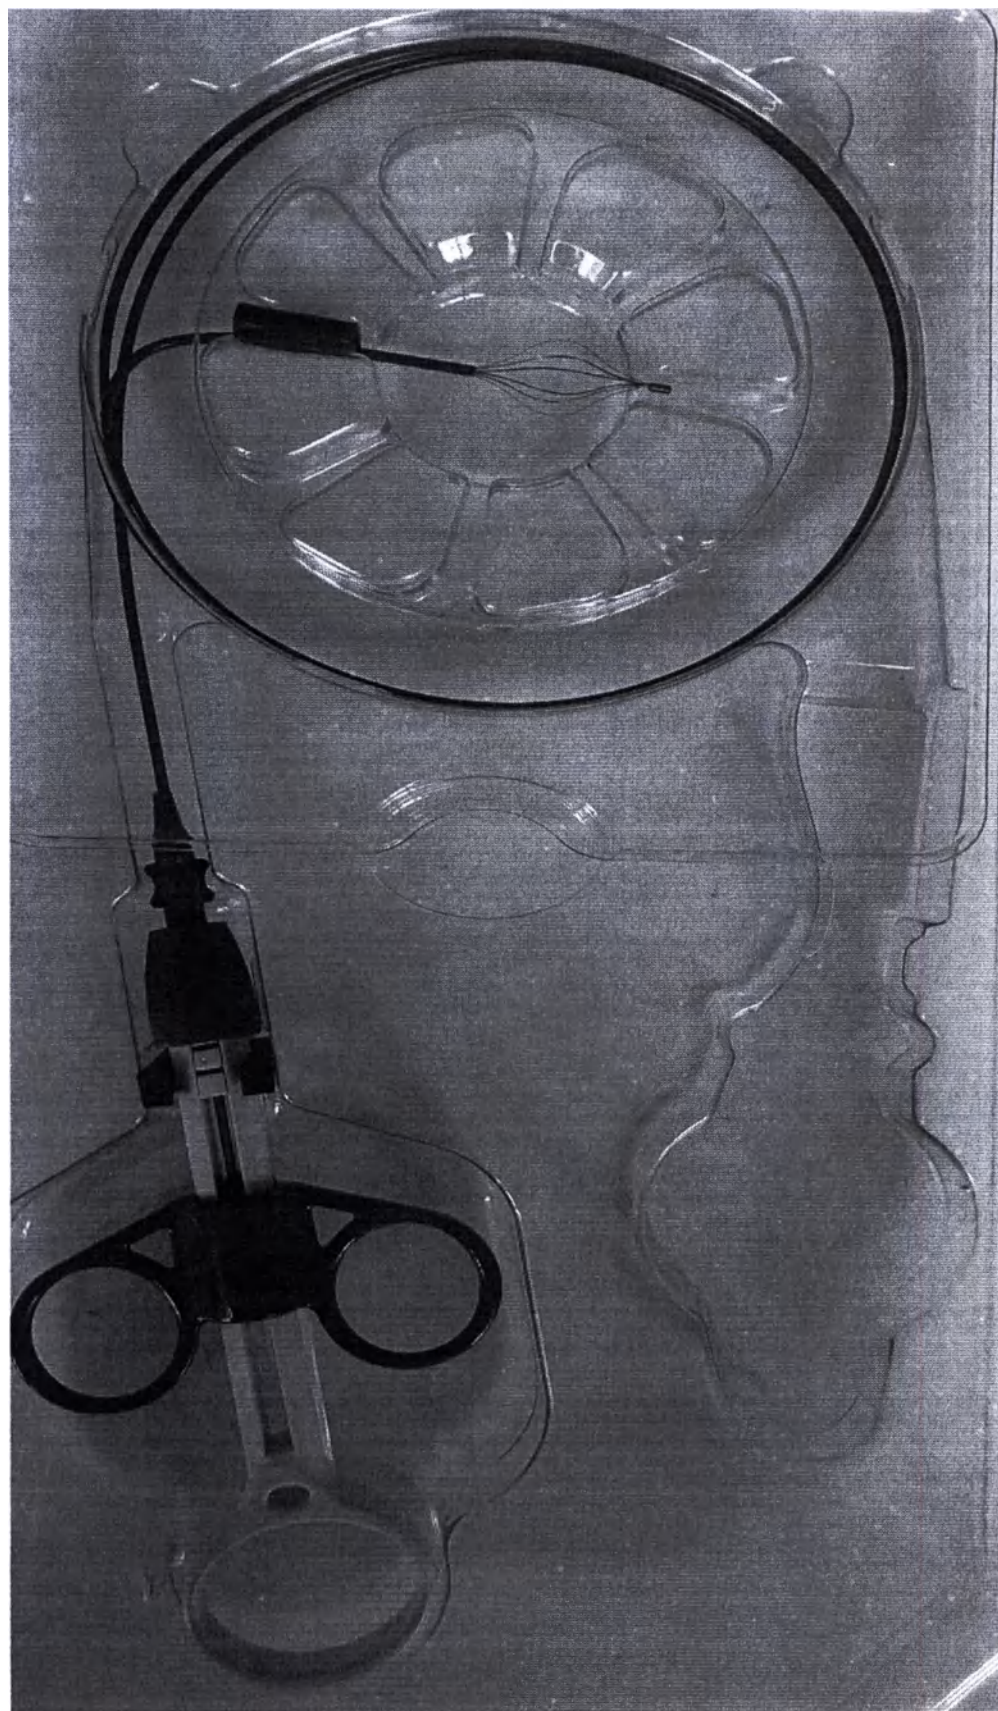


14) Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая с кончиком из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 3.0 СН (1,00 мм), длина интродьюсера: 110 см, количество струн: 5, диаметр раскрытия: 12 мм, покрытие интродьюсера: полиимид, тип рукоятки «D-shape».

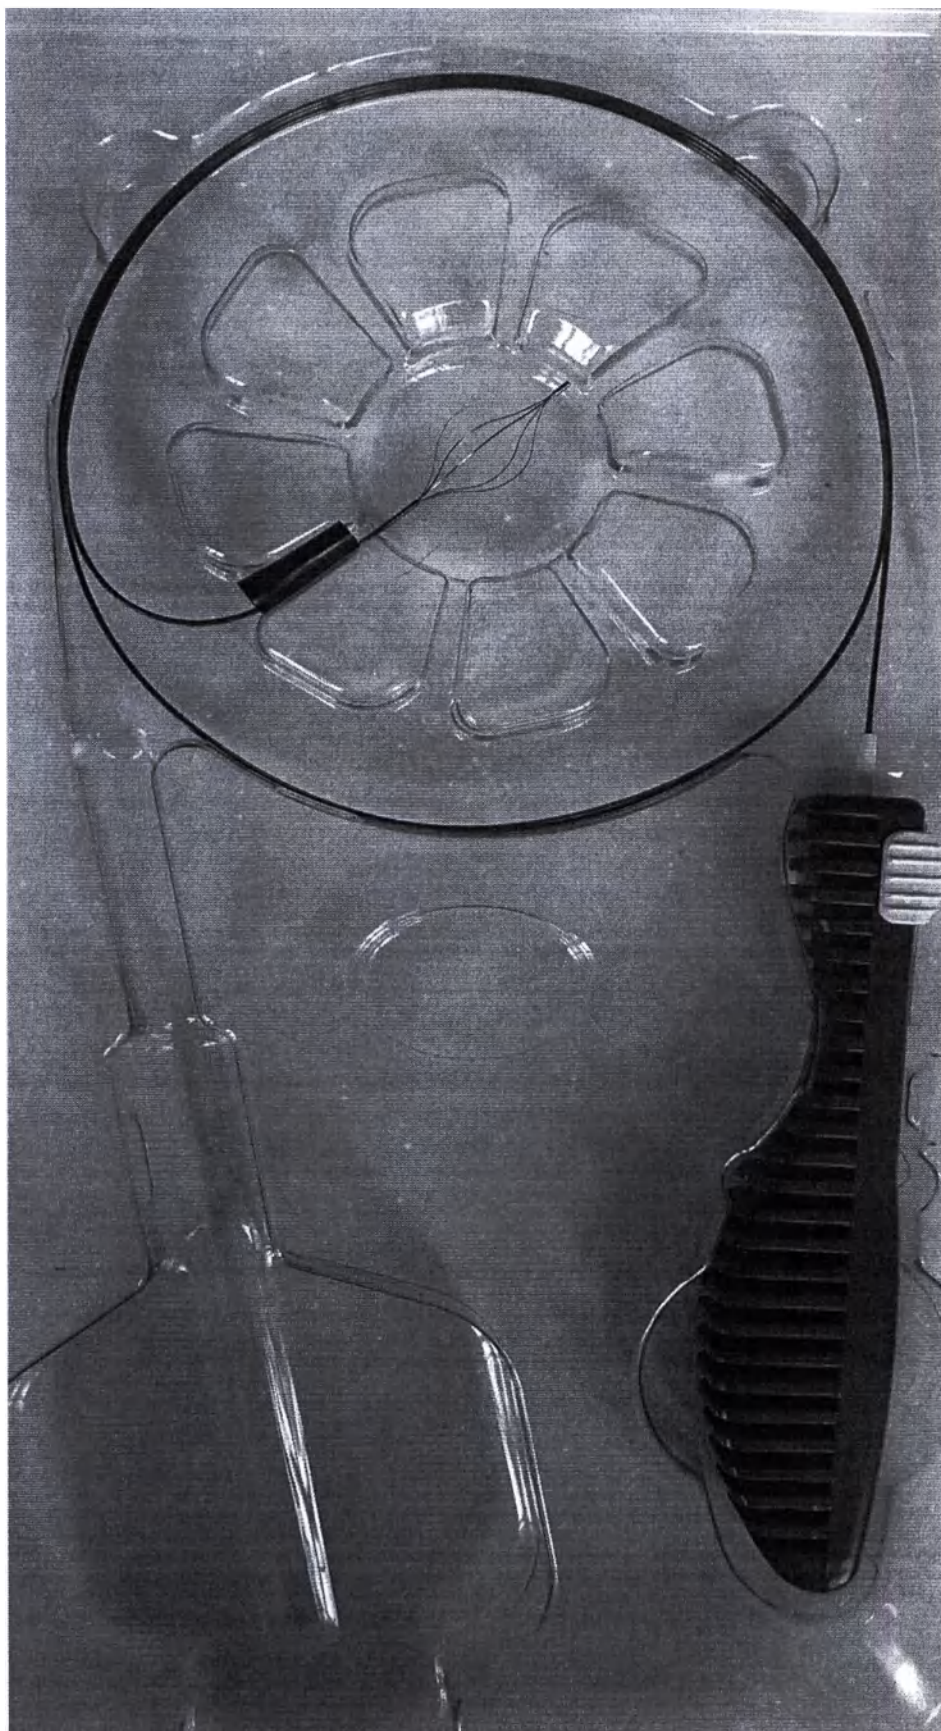


15) Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая с кончиком из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 3,5 (1,17 мм), длина интродьюсера: 120 см, количество струн: 5, диаметр раскрытия: 12 мм, покрытие интродьюсера: полиимид плетеный, тип рукоятки «D-shape».

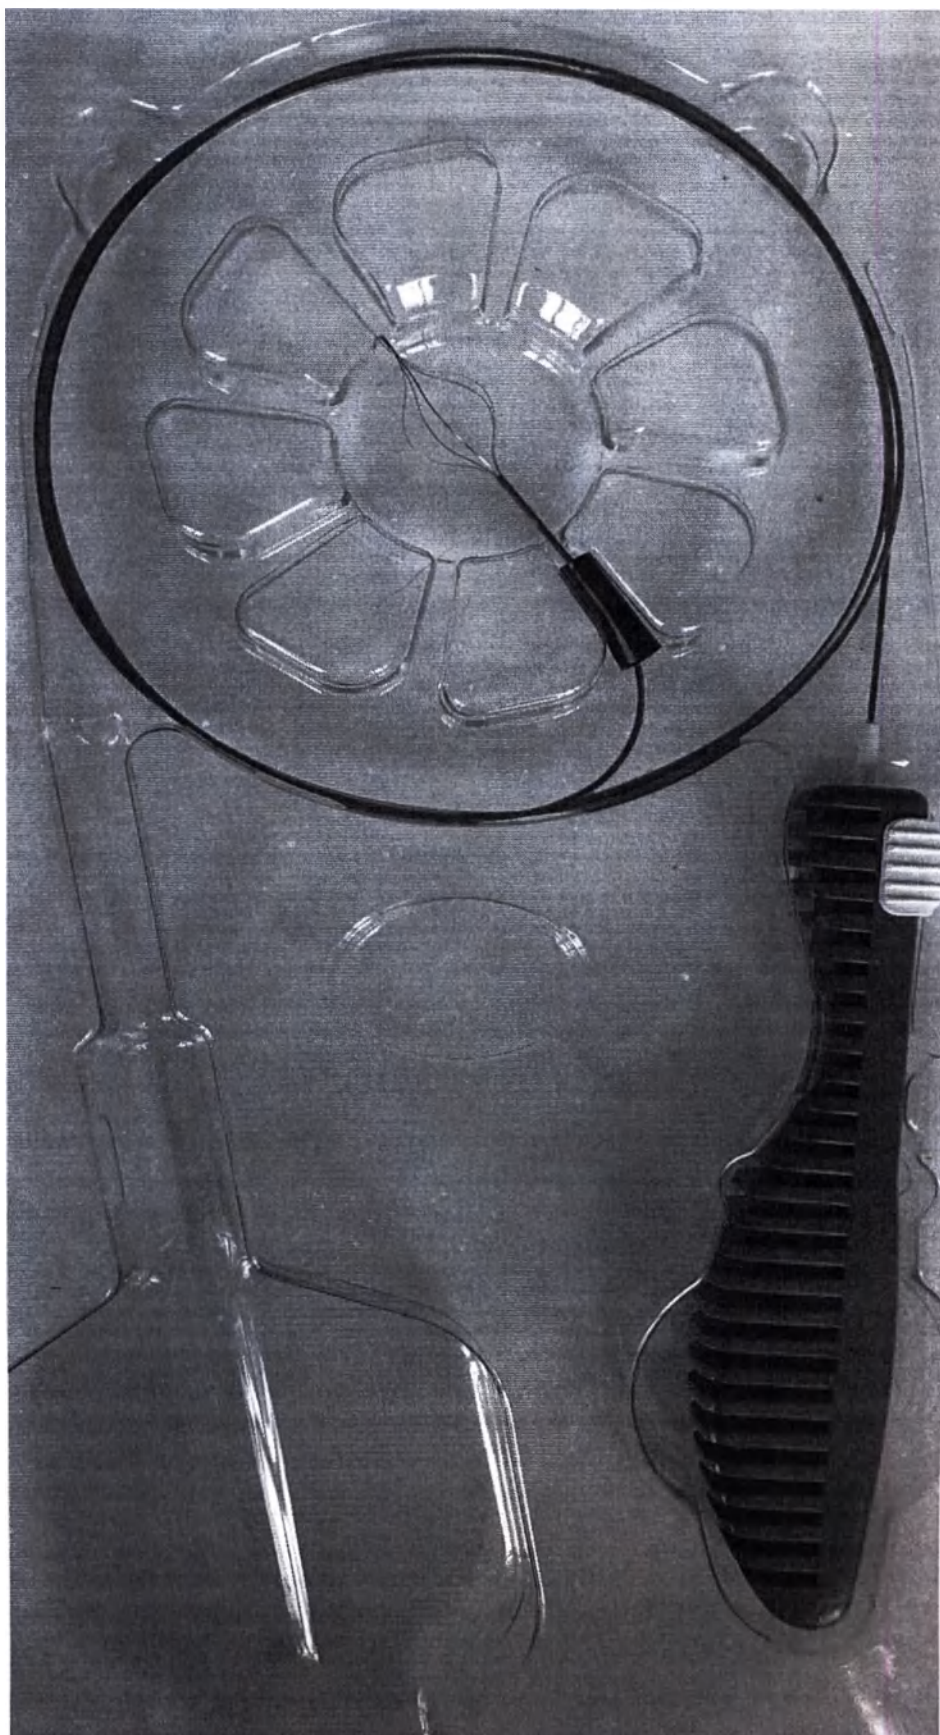


16) Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая с кончиком из нитинола, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), длина интродьюсера: 65 см, количество струн: 4, диаметр раскрытия: 9 мм, покрытие интродьюсера: ПЭЭК, тип рукоятки «Scissor».

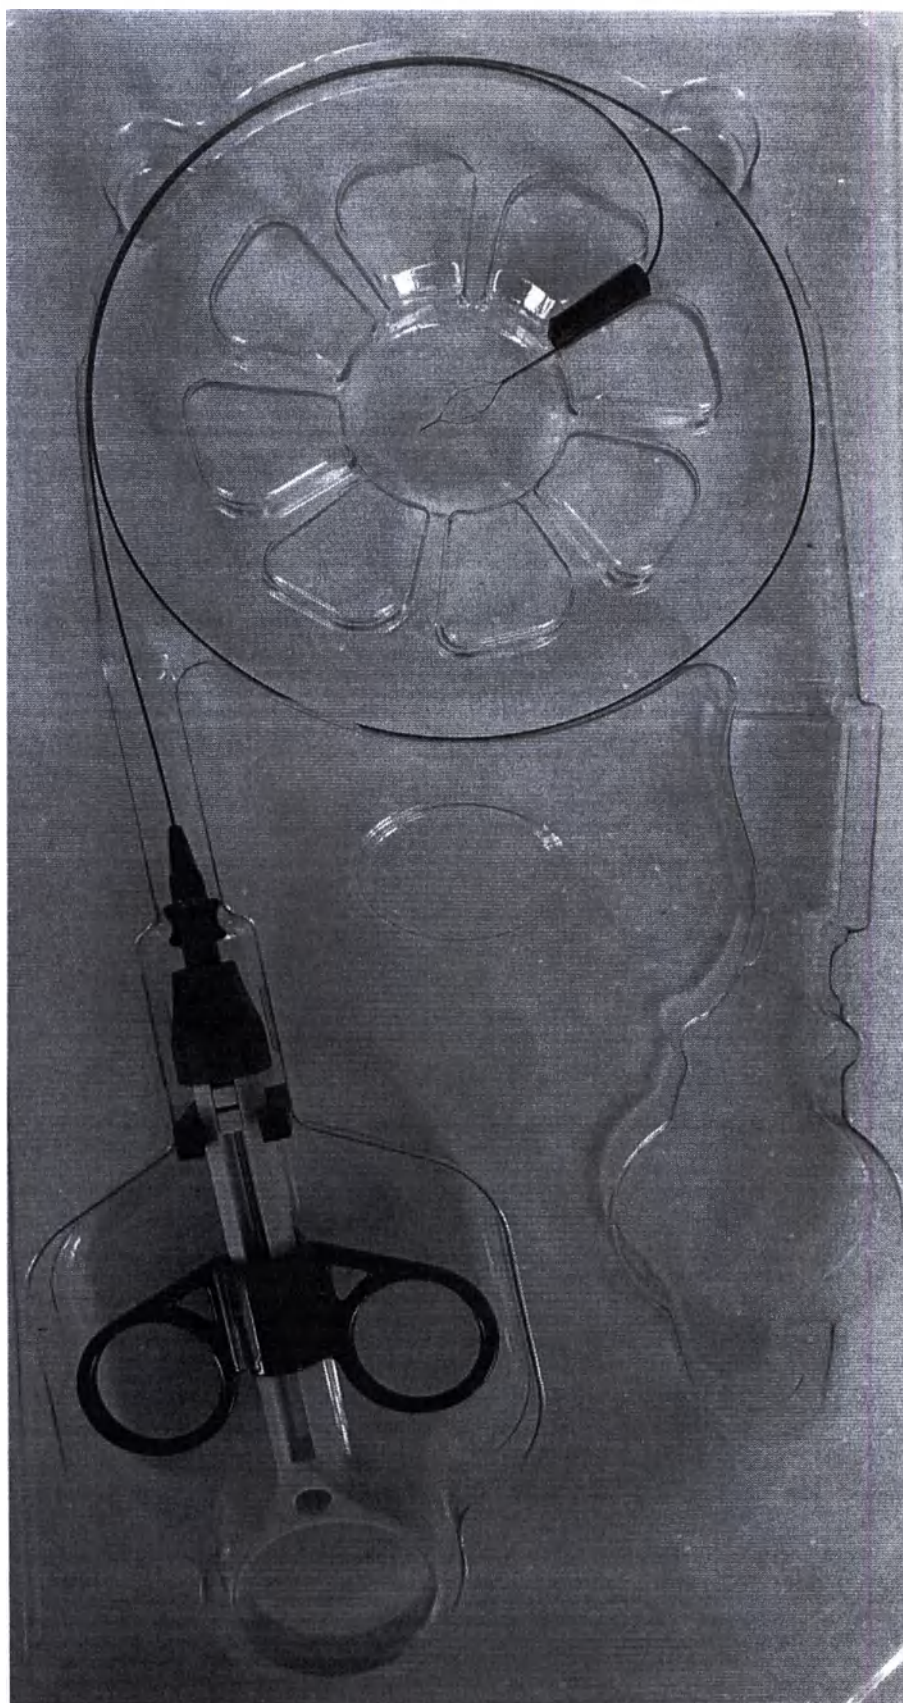


17) Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая с кончиком из нитинола, диаметр интродьюсера: 4.0 СН (1,30 мм), длина интродьюсера: 120 см, количество струн: 5, диаметр раскрытия: 12 мм, покрытие интродьюсера: ПТФЭ, тип рукоятки «Fish».

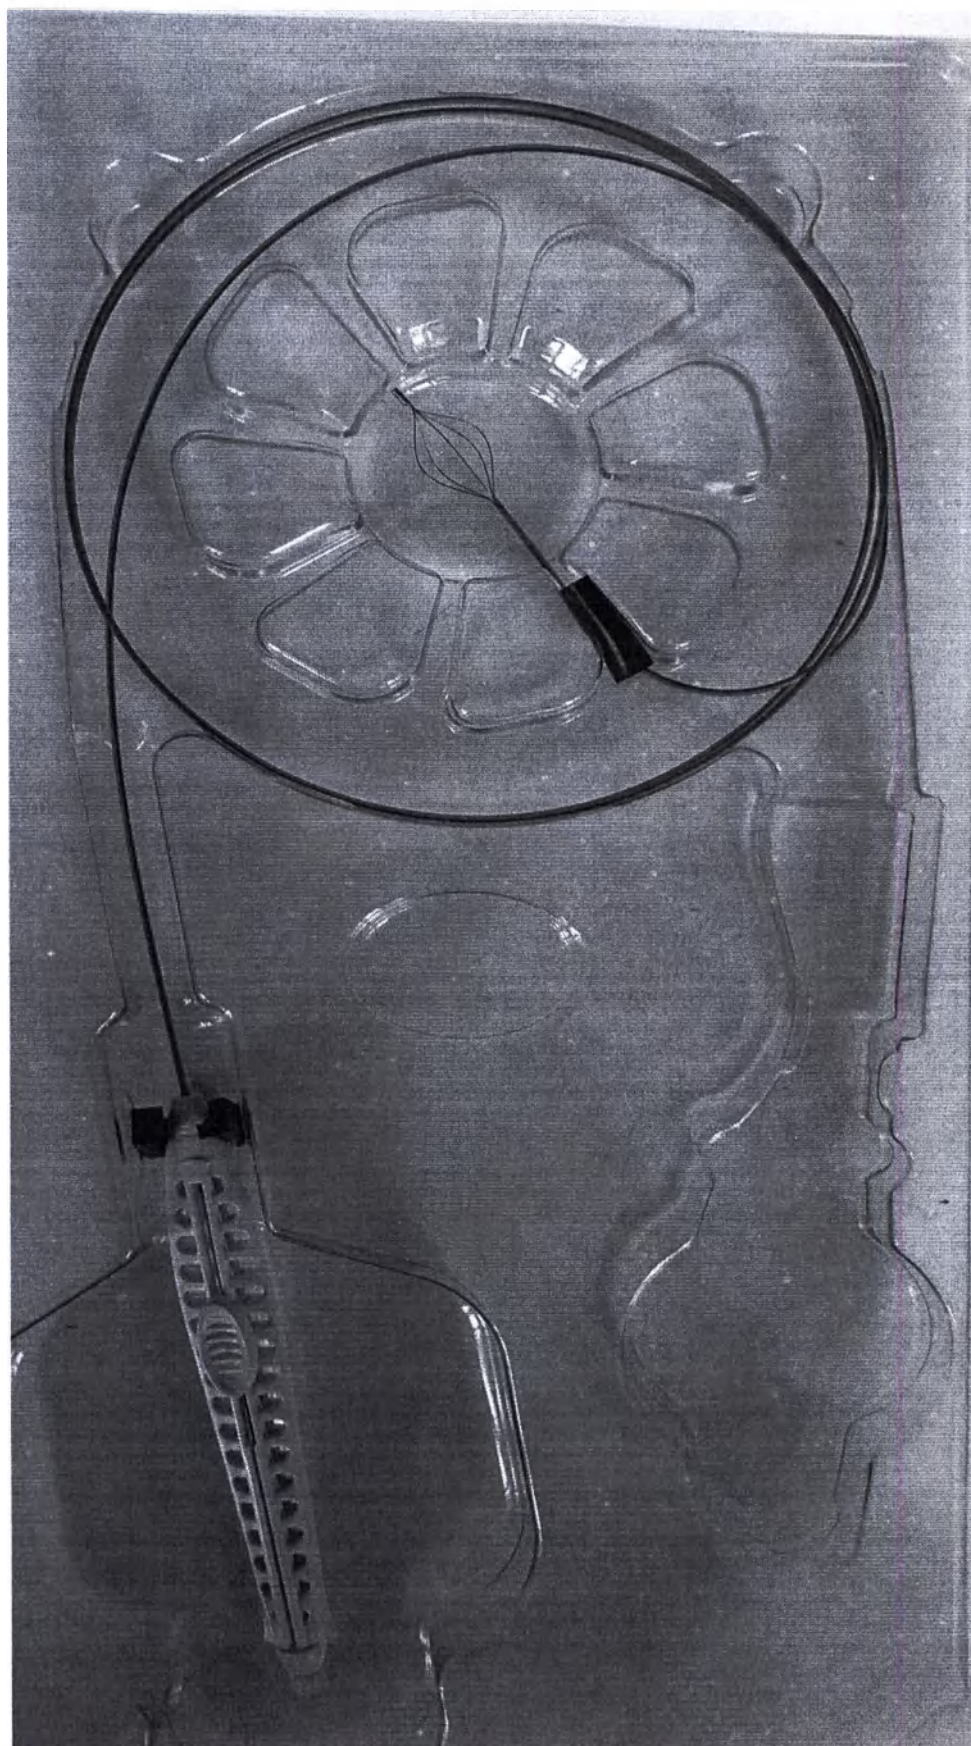


18) Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая с кончиком из нитинола, диаметр интродьюсера: 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 90 см, количество струн: 6, диаметр раскрытия: 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид плетеный, тип рукоятки «Scissor».

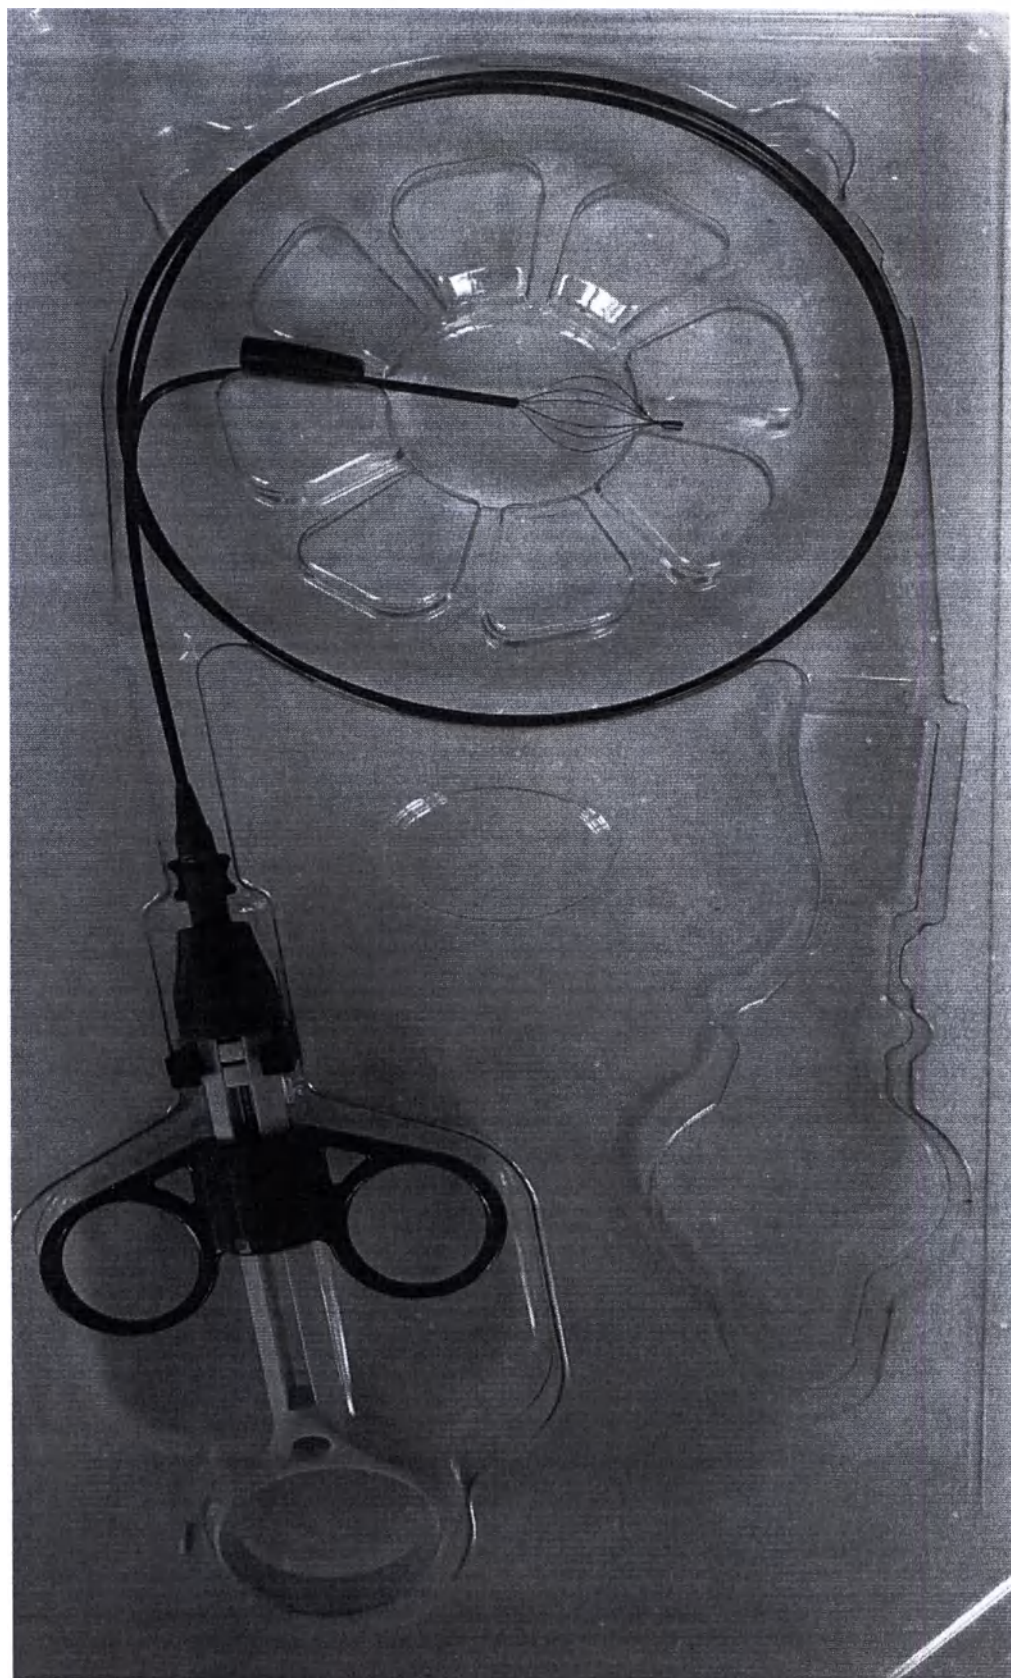


19) Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая с кончиком из нитинола, диаметр интродьюсера: 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 90 см, количество струн: 6, диаметр раскрытия: 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид, тип рукоятки «D-shape».

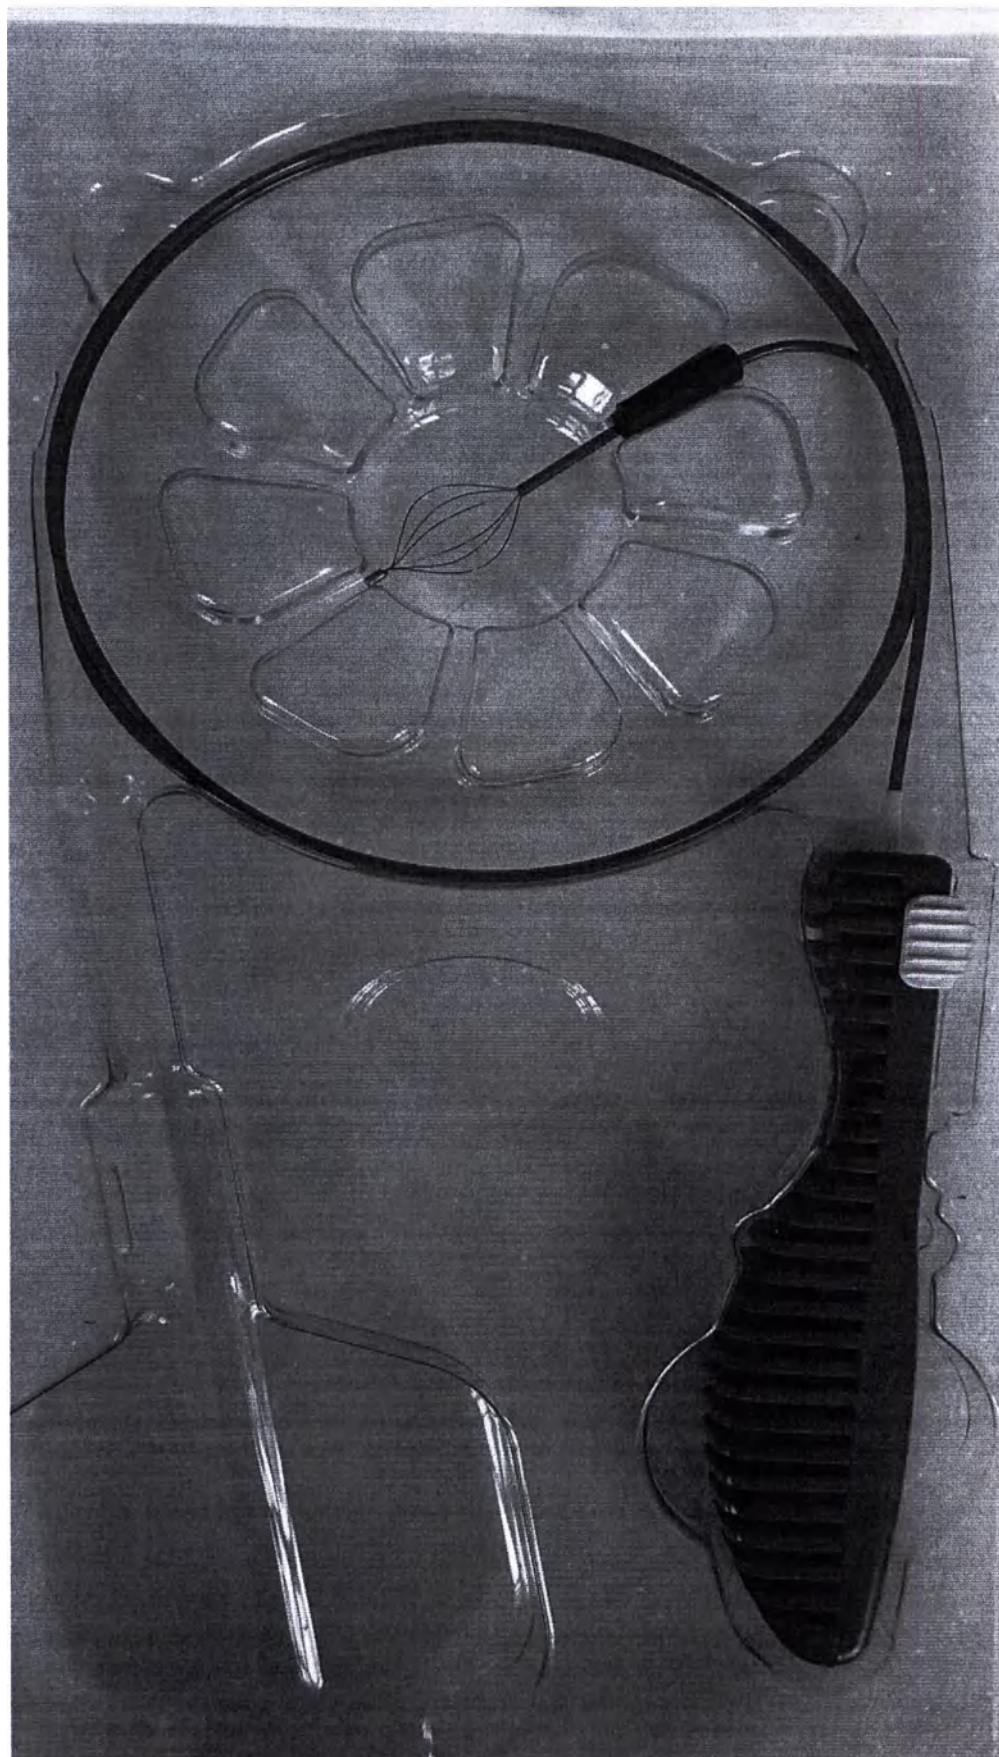


20) Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная без кончика из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.9 CH (0,63 мм), длина интродьюсера: 65 см, количество струн: 4, диаметр раскрытия: 9 мм, покрытие интродьюсера: ПТФЭ, тип рукоятки «Scissor».

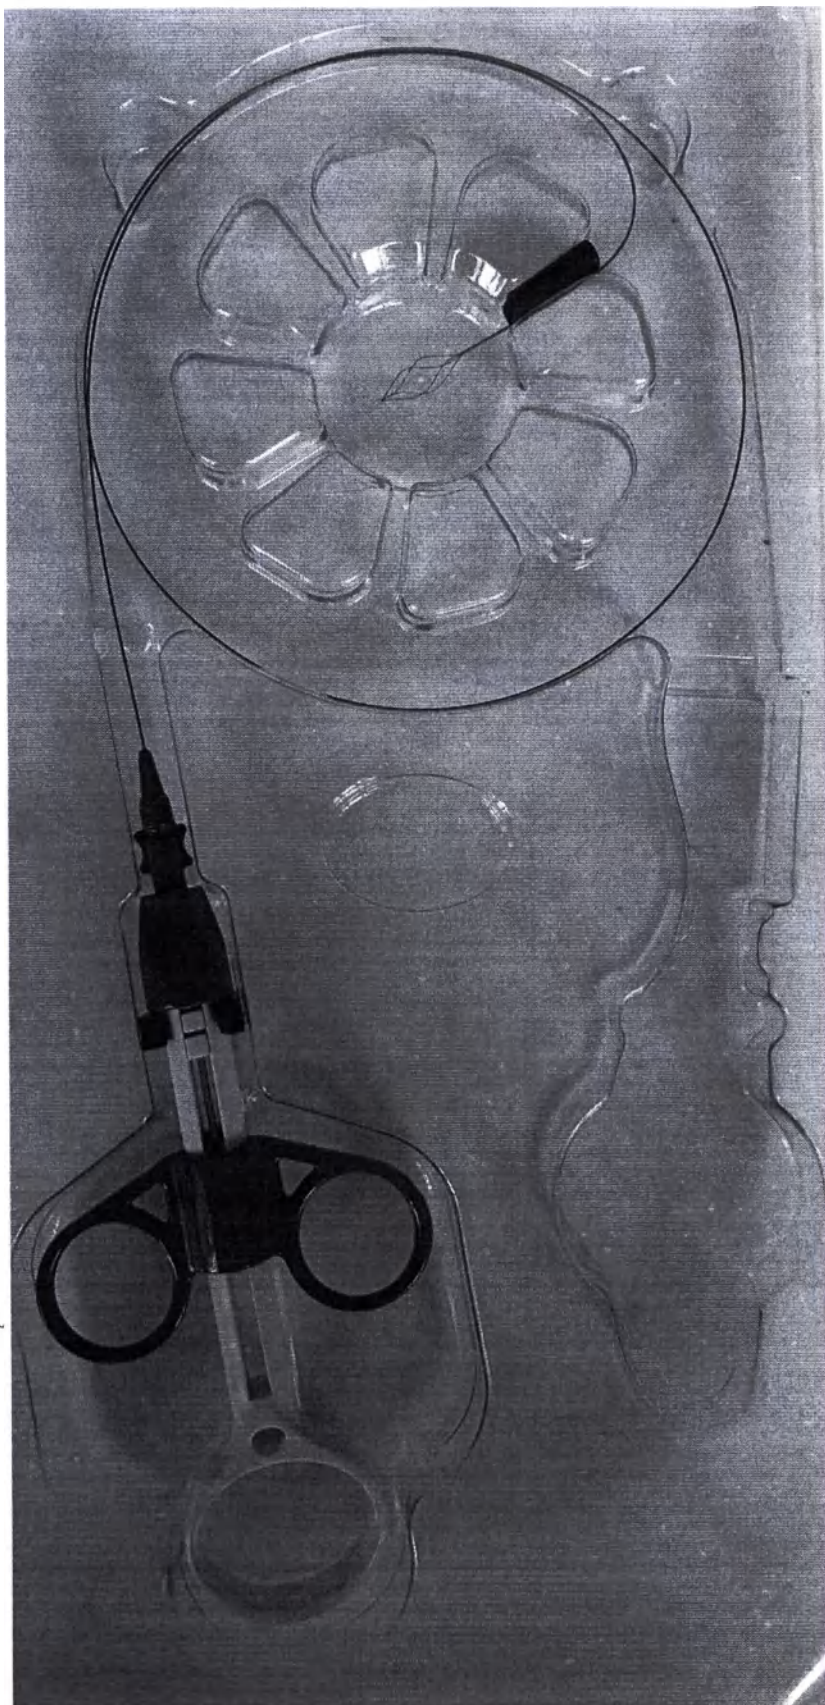


21) Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная без кончика из нитинола, диаметр интродьюсера: 2.5 СН (0,83 мм), длина интродьюсера: 100 см, количество струн: 6, диаметр раскрытия: 12 мм, покрытие интродьюсера: полиимид, тип рукоятки «Scissor».

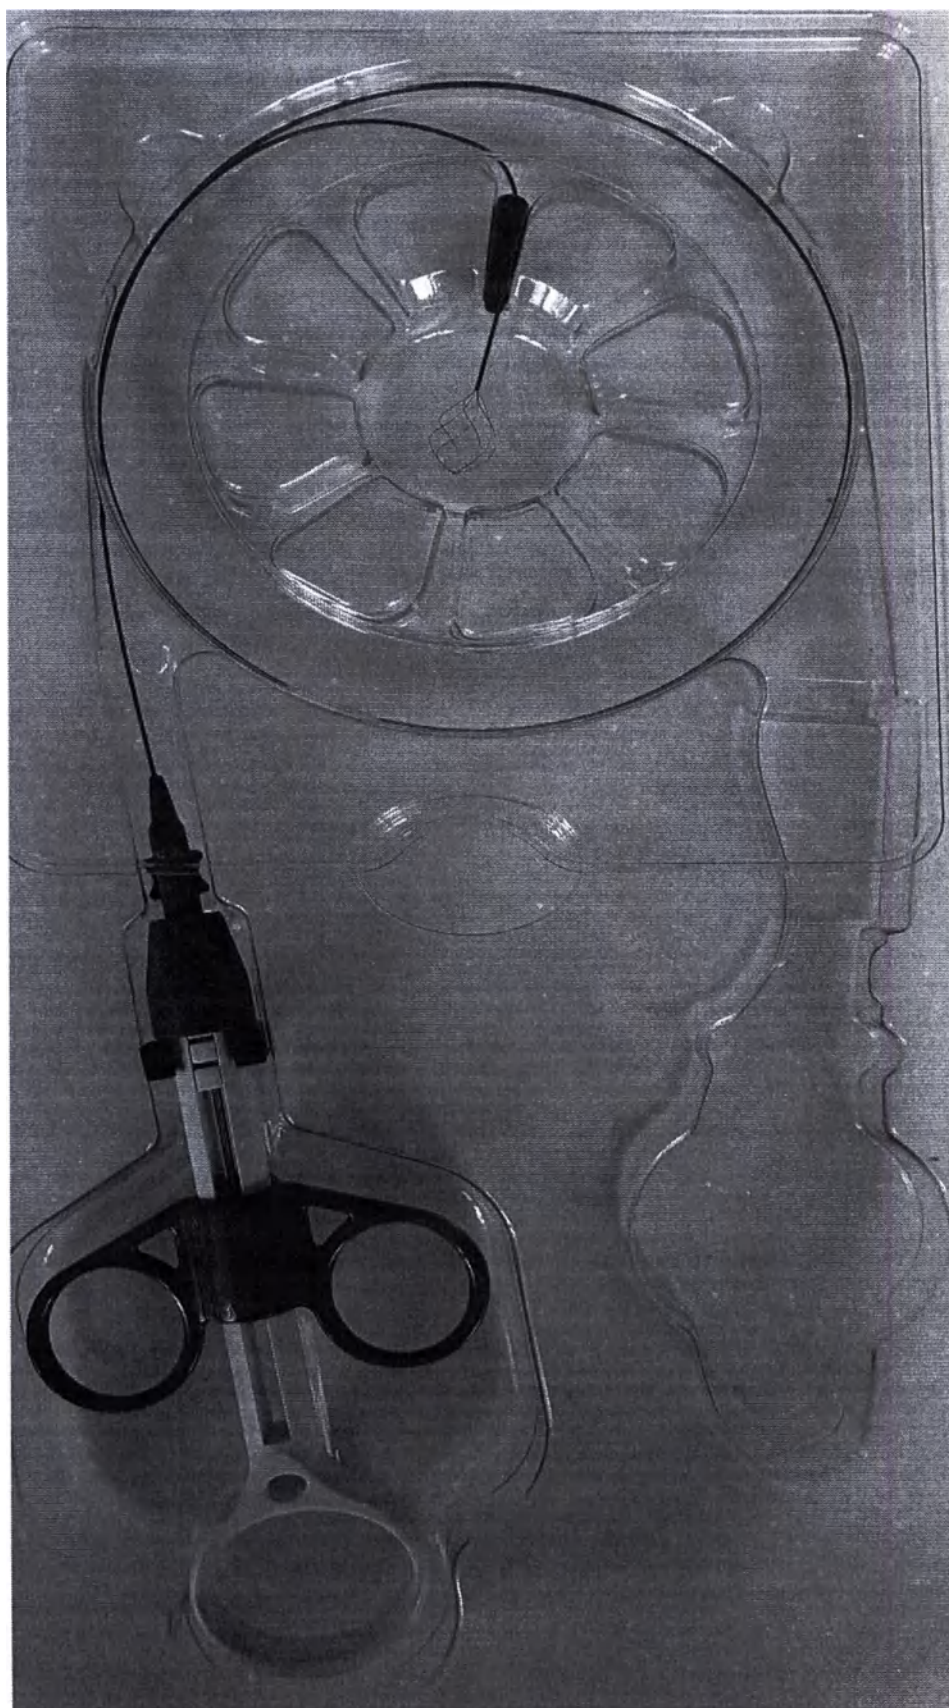


22) Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная без кончика из нитинола, диаметр интродьюсера: 6.0 CH (2,00 мм), длина интродьюсера: 90 см, количество струн: 6, диаметр раскрытия: 15 мм, покрытие интродьюсера: ПЭЭК, тип рукоятки «Scissor».

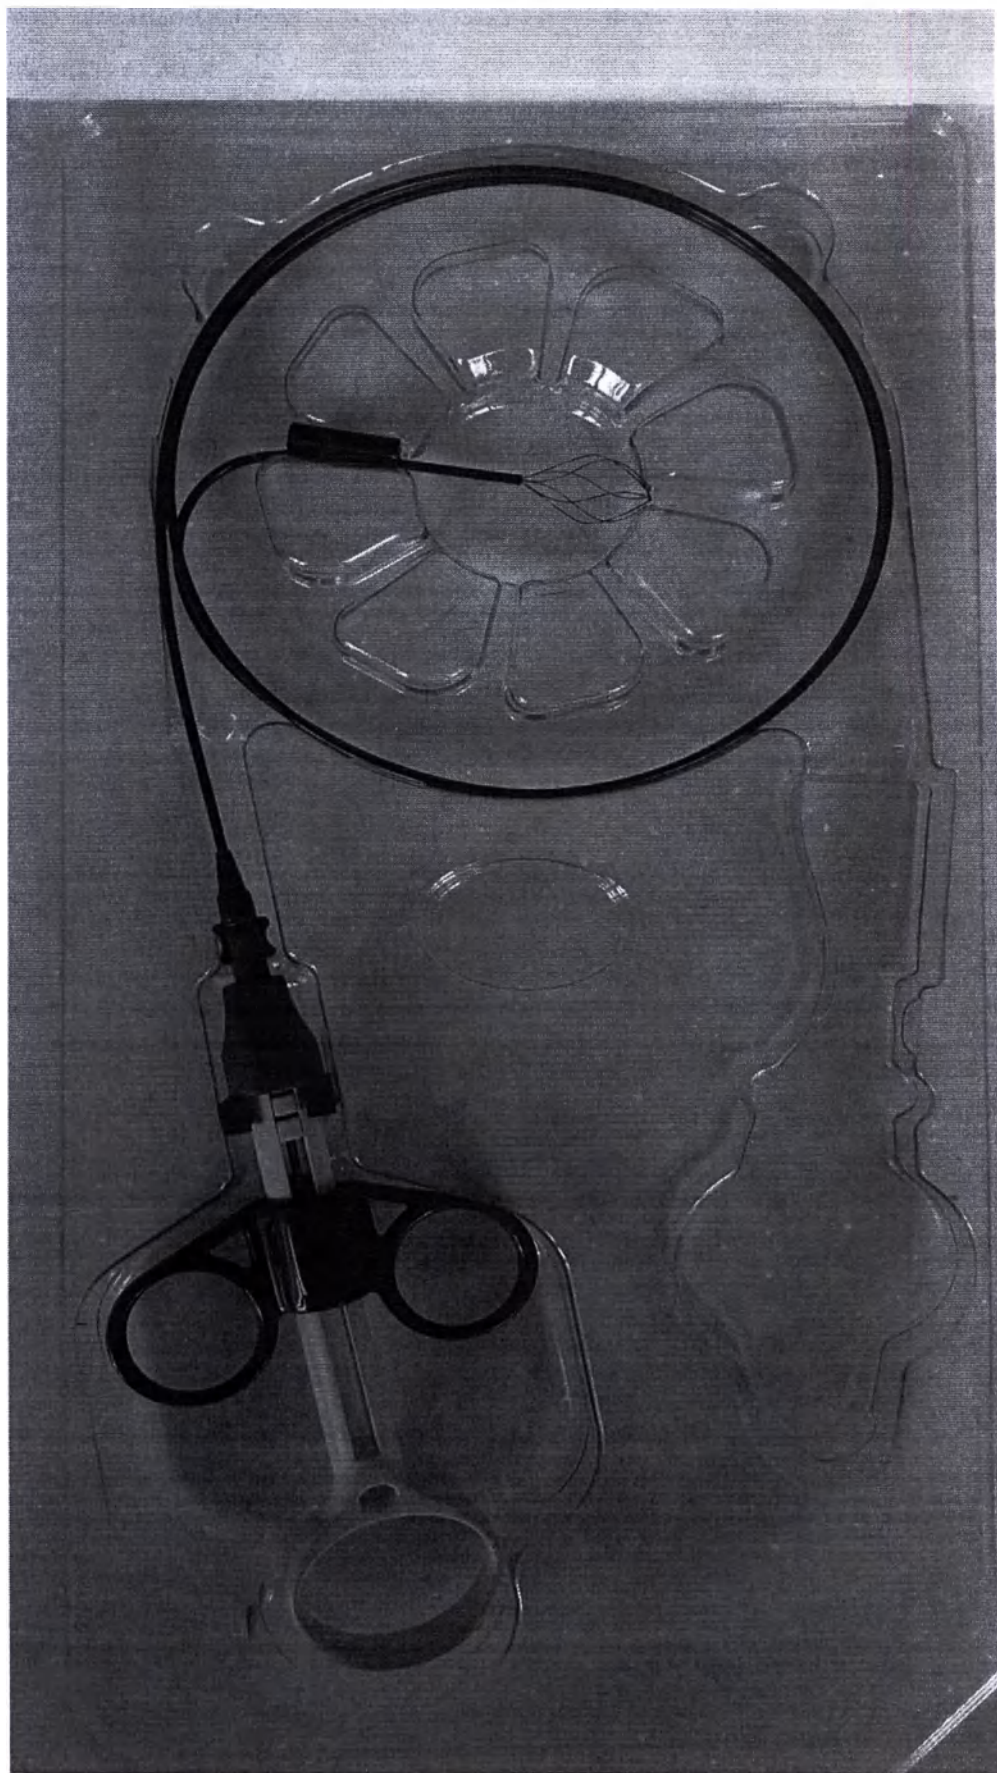


23) Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая без кончика из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.9 CH (0,63 мм), длина интродьюсера: 100 см, количество струн: 4, диаметр раскрытия: 12 мм, покрытие интродьюсера: полиимид, тип рукоятки «Scissor».

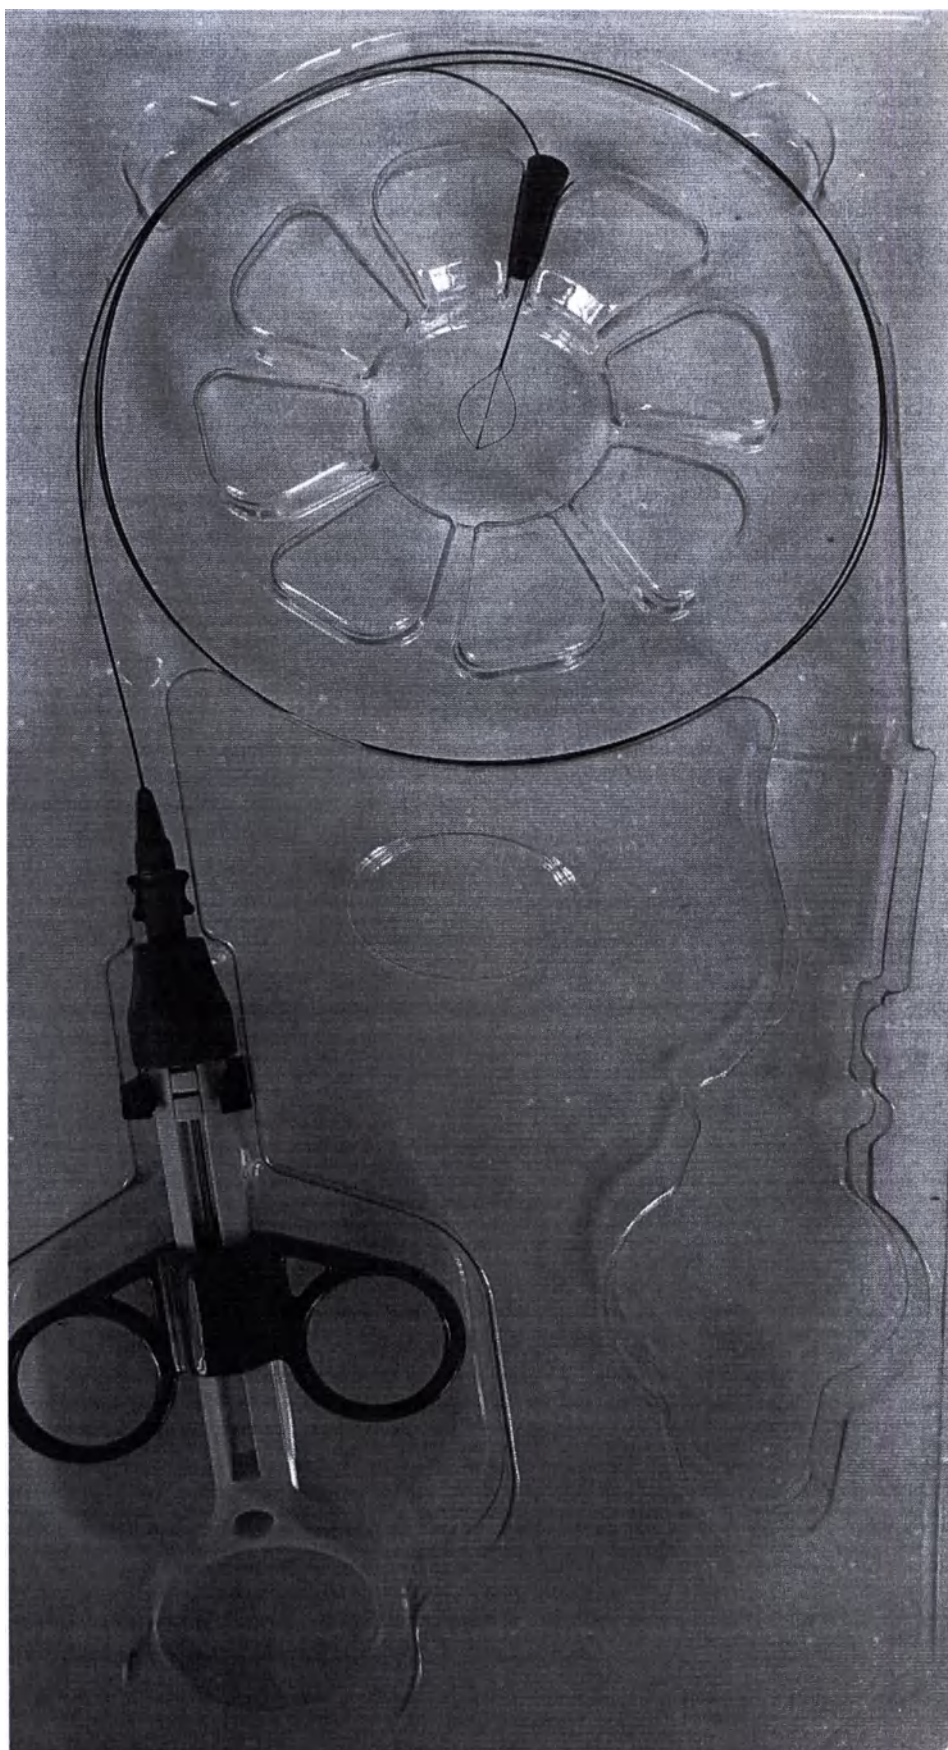


24) Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая без кончика из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.9 CH (0,63 мм), длина интродьюсера: 65 см, количество струн: 4, диаметр раскрытия: 9 мм, покрытие интродьюсера: полиимид плетеный, тип рукоятки «Scissor».

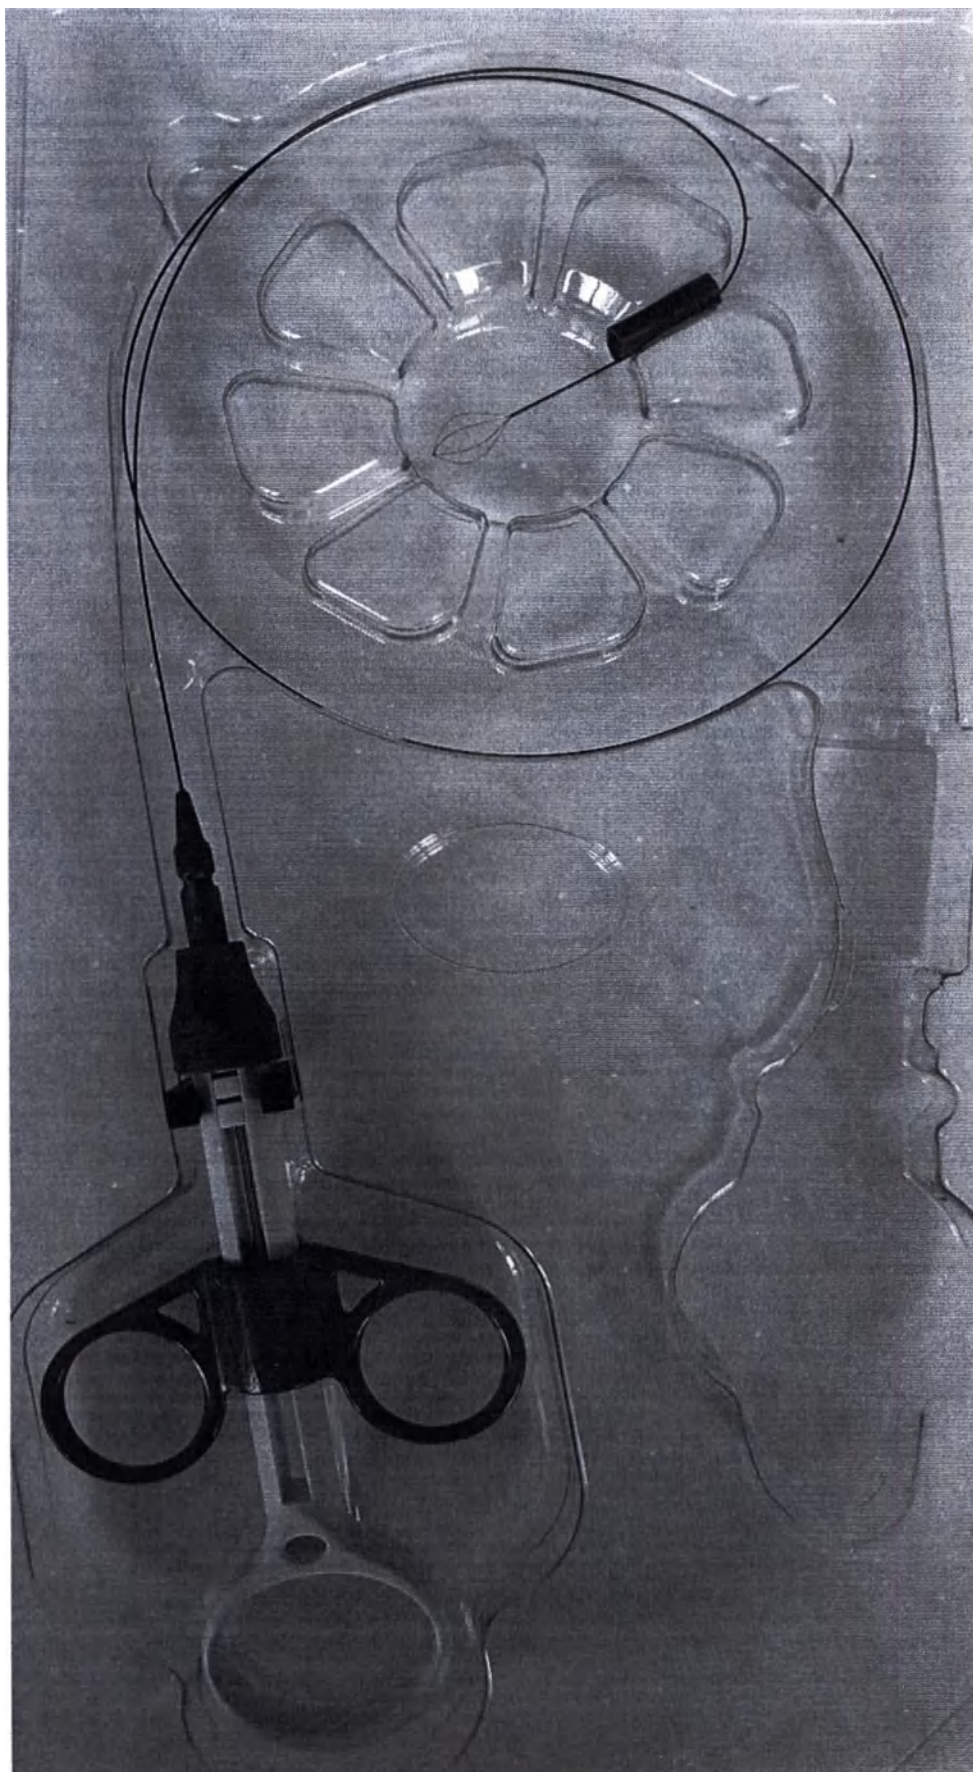


25) Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая без кончика из нитинола, диаметр интродьюсера: 5.0 CH (1,67 мм), длина интродьюсера: 110 см, количество струн: 6, диаметр раскрытия: 12 мм, покрытие интродьюсера: ПЭЭК, тип рукоятки «D-shape».

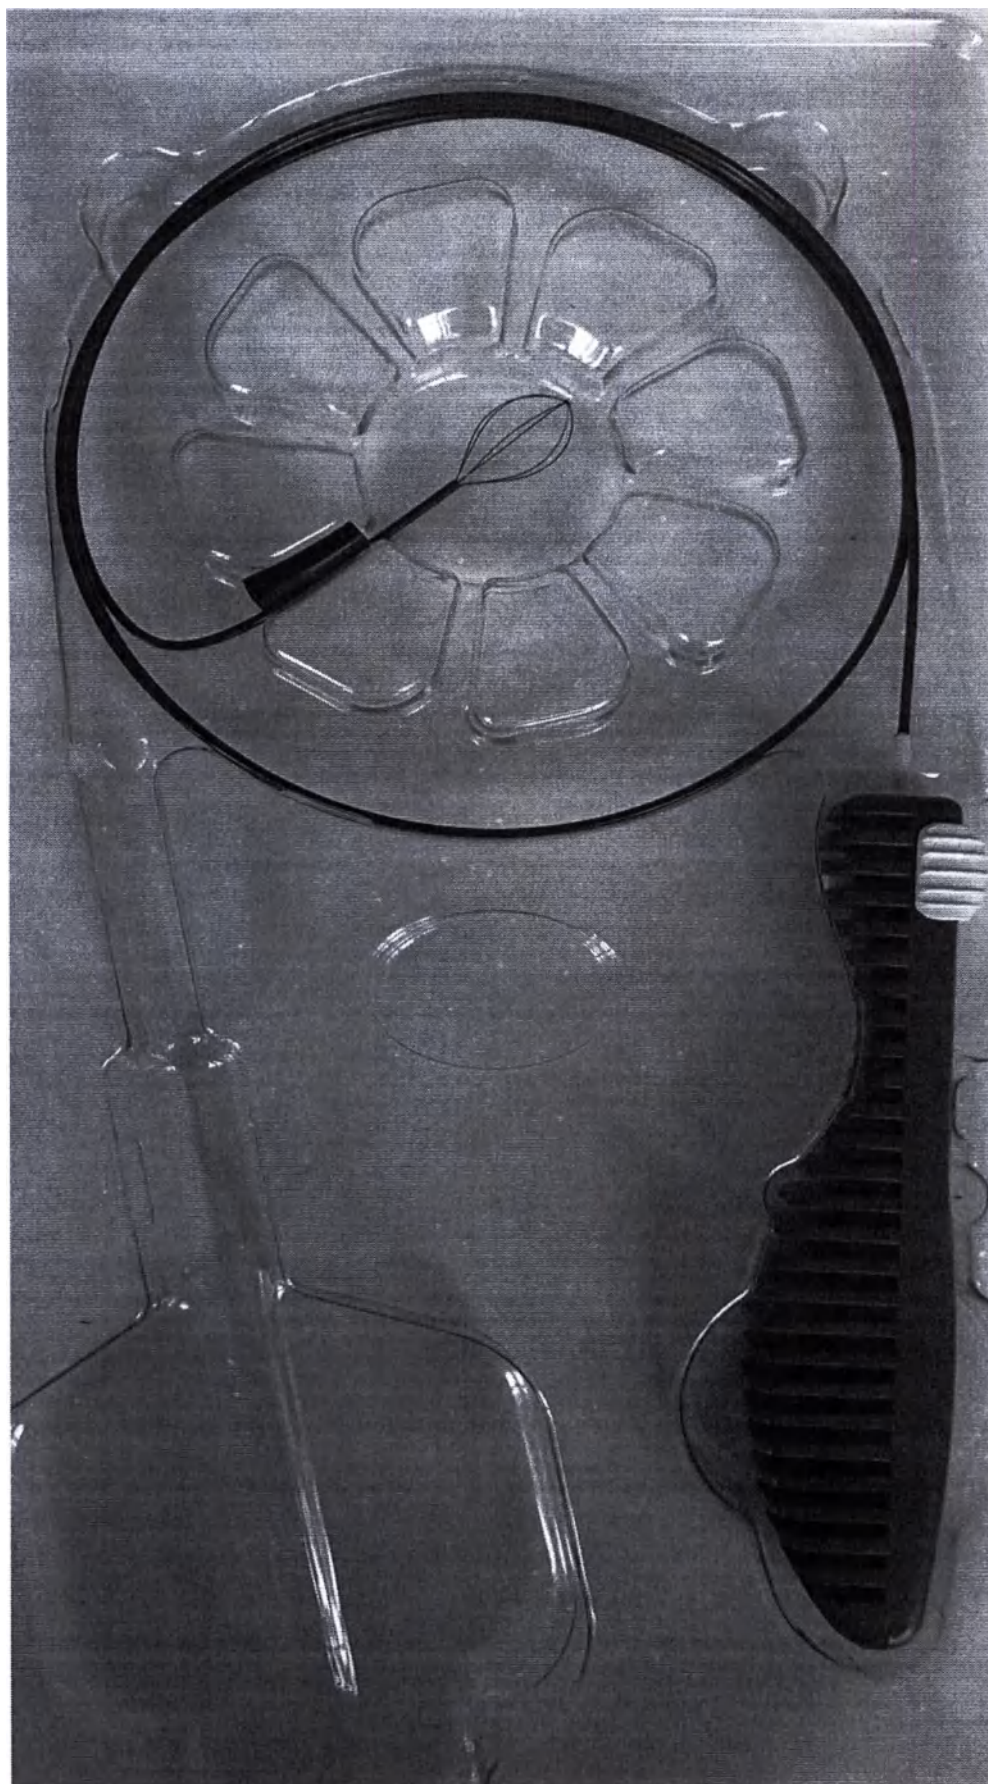


26) Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, G-PAW из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.9 CH (0,63 мм), длина интродьюсера: 70 см, количество струн: 3, диаметр раскрытия: 9 мм, покрытие интродьюсера: полиимид плетеный, тип рукоятки «Scissor».

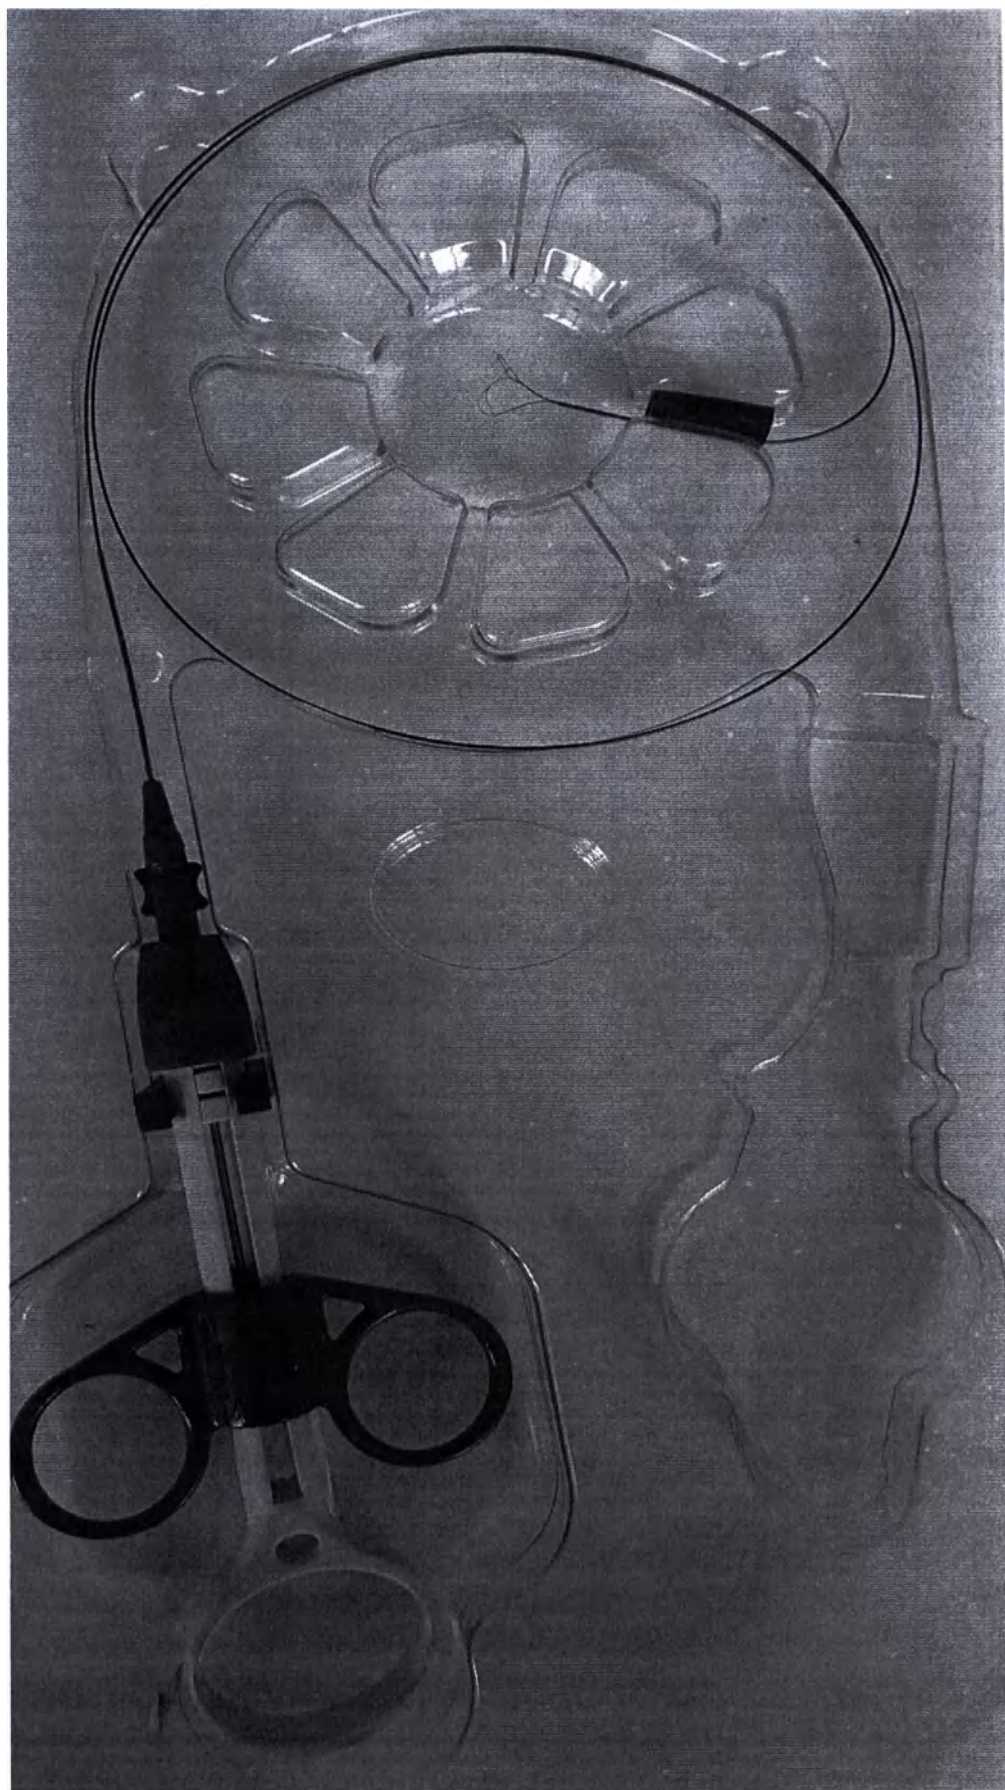


27) Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, G-PAW из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.9 СН (0,63 мм), длина интродьюсера: 90 см, количество струн: 3, диаметр раскрытия: 12 мм, покрытие интродьюсера: полиимид, тип рукоятки «Fish».

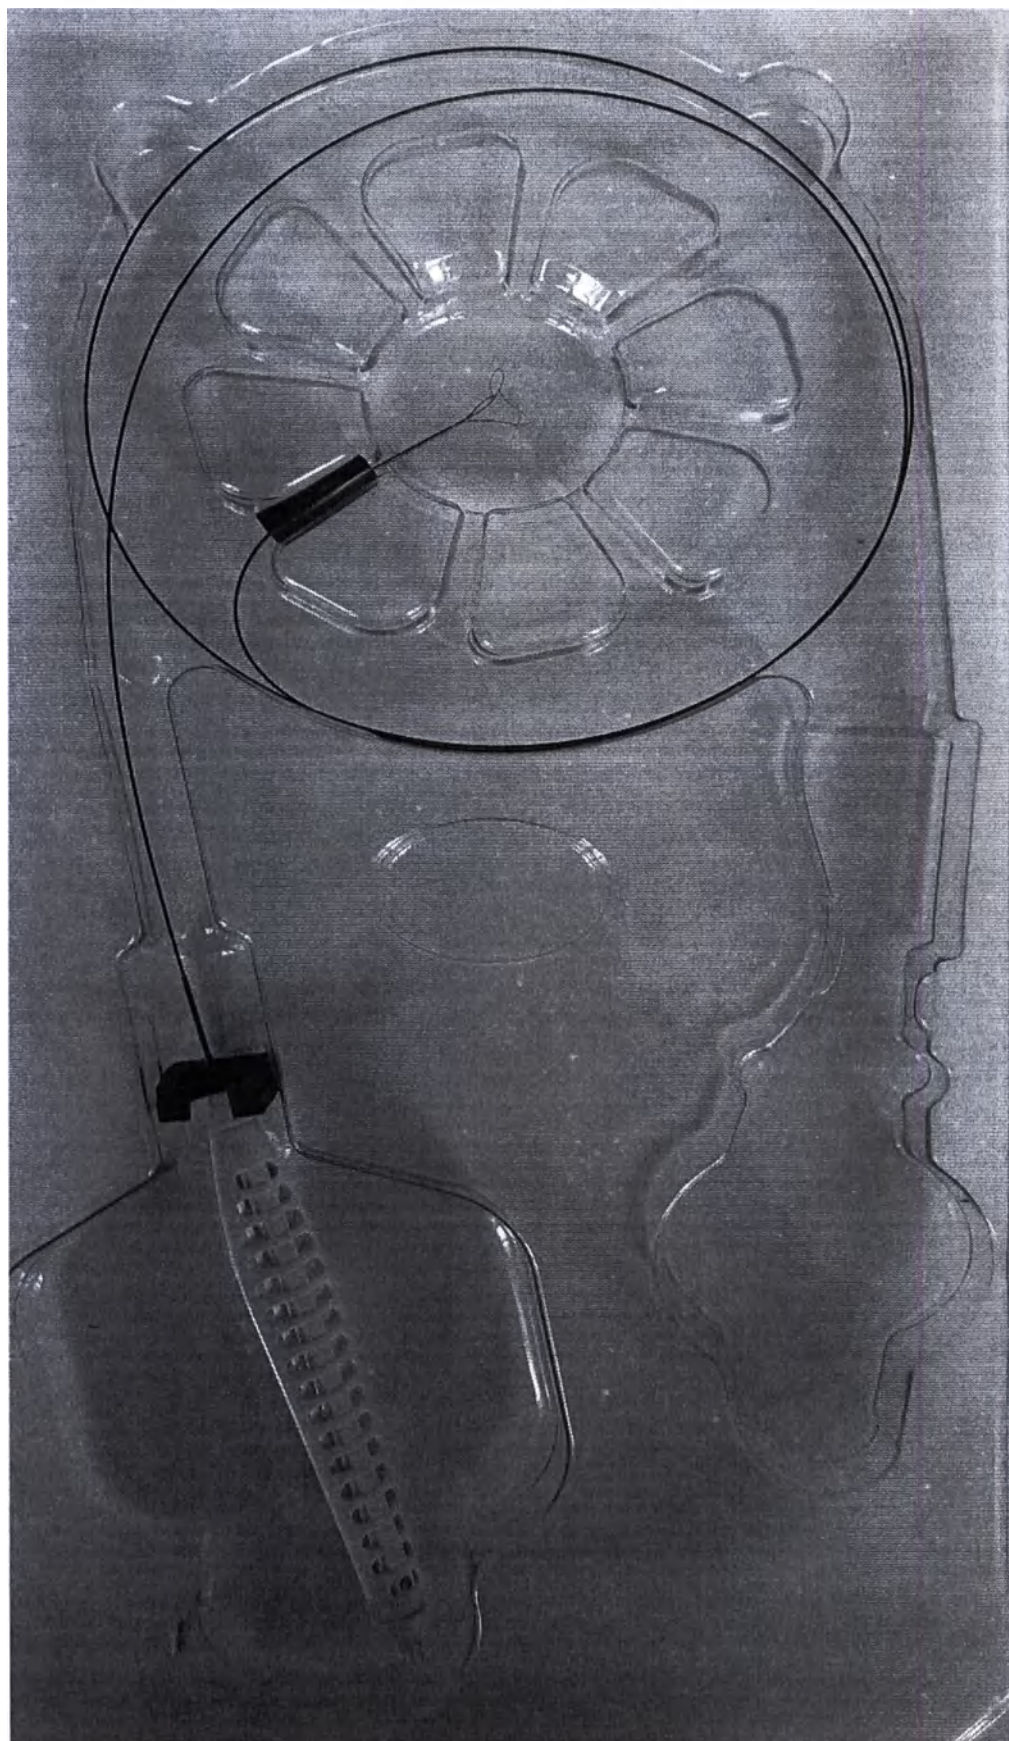


28) Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, G-PAW из нитинола, диаметр интродьюсера: 3.0 СН (1,00 мм), длина интродьюсера: 120 см, количество струн: 3, диаметр раскрытия: 15 мм, покрытие интродьюсера: ПЭЭК, тип рукоятки «D-shape».

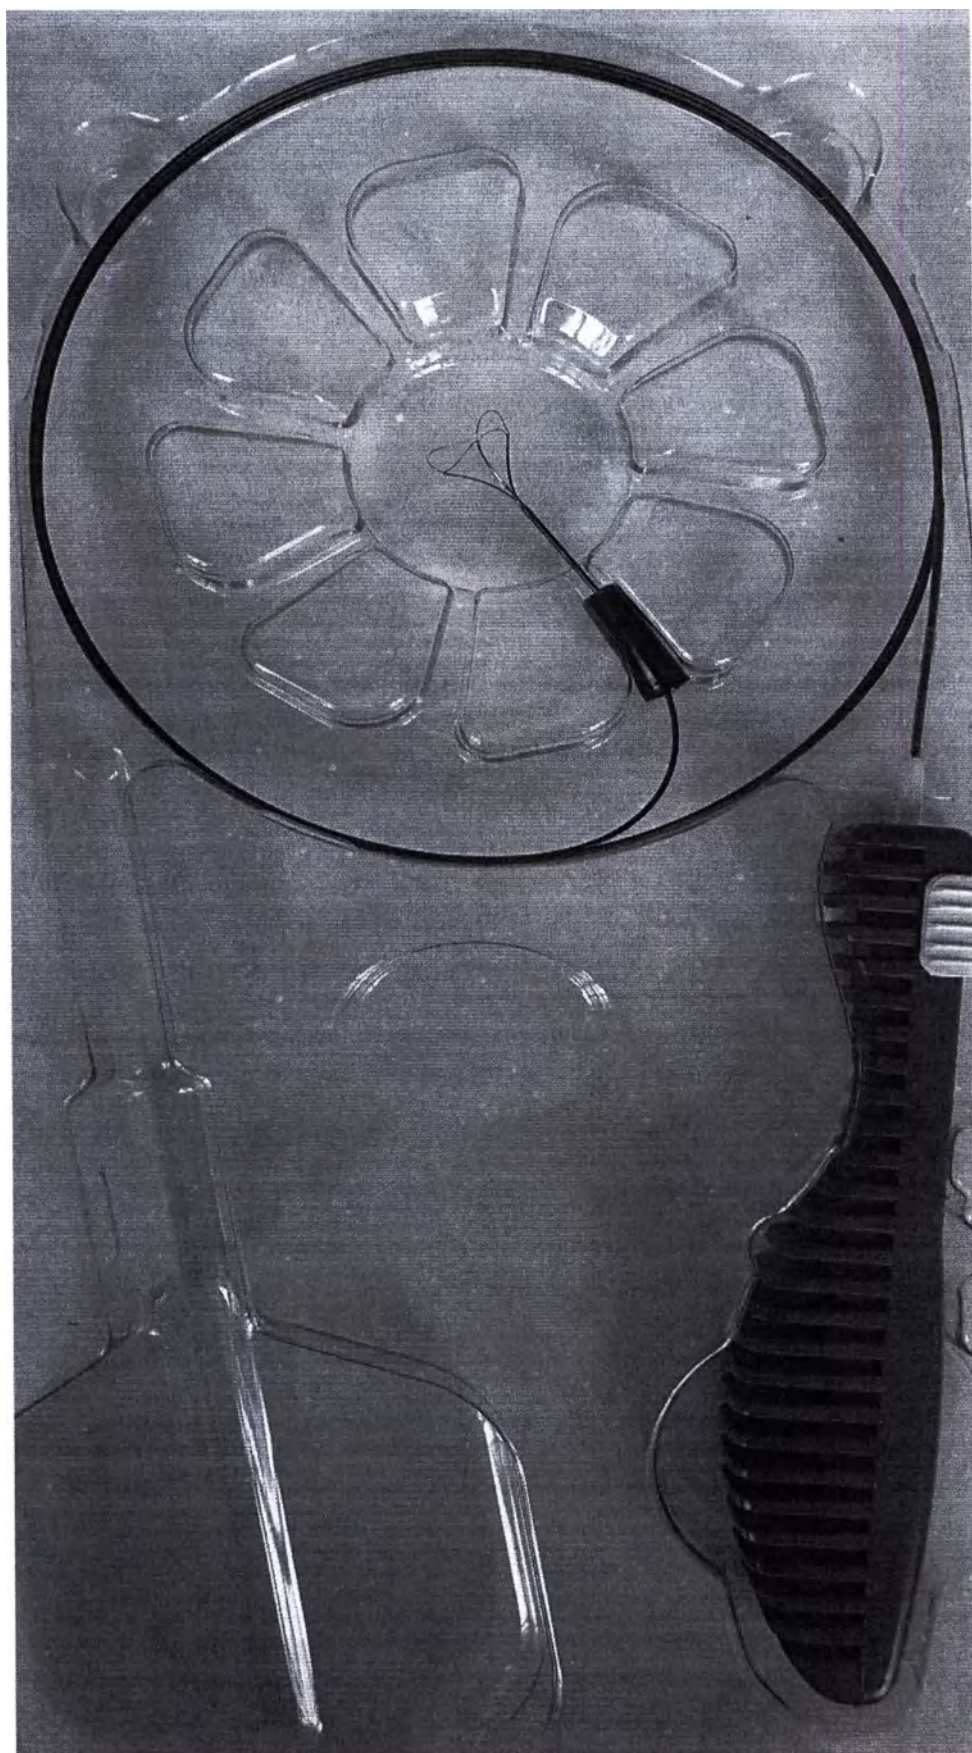


29) Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, X-CIRCLE из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.9 СН (0,63 мм), длина интродьюсера: 70 см, количество струн: 16, диаметр раскрытия: 12 мм, покрытие интродьюсера: ПТФЭ, тип рукоятки «Scissor».

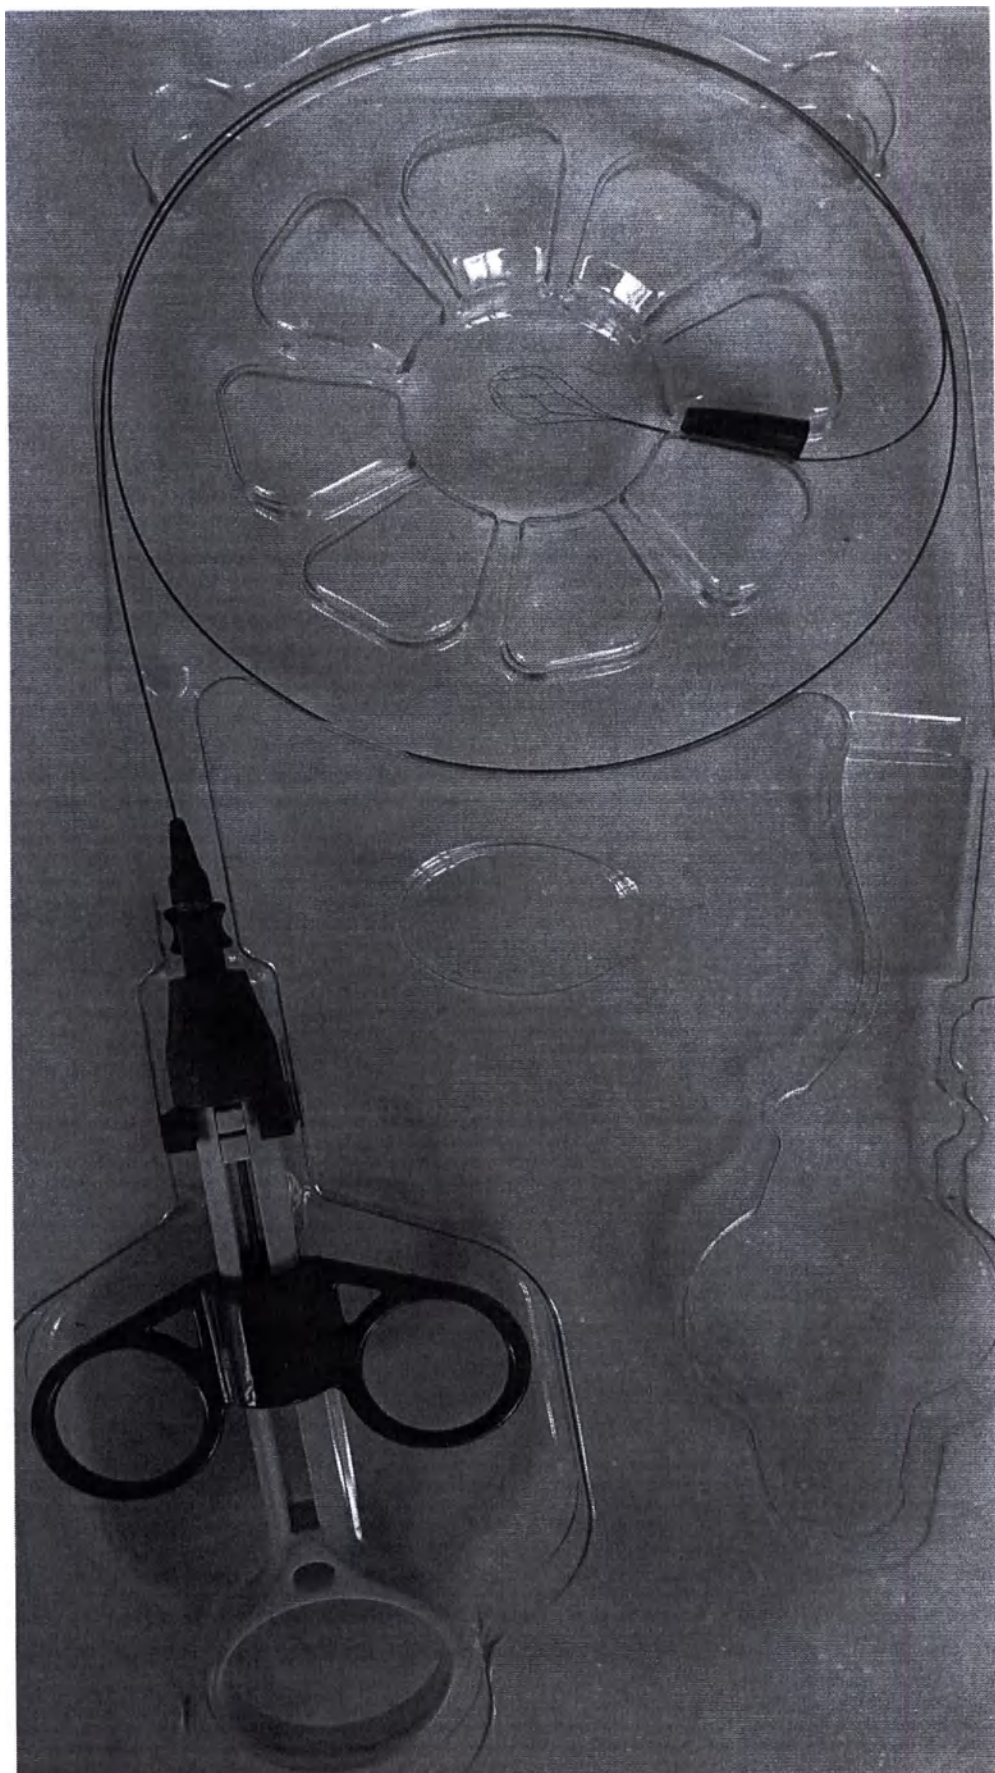


30) Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, GRASPER из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 2.5 CH (0,83 мм), длина интродьюсера: 70 см, количество етрук: 3, диаметр раскрытия: 9 мм, покрытие интродьюсера: ПТФЭ, тип рукоятки «Scissor».

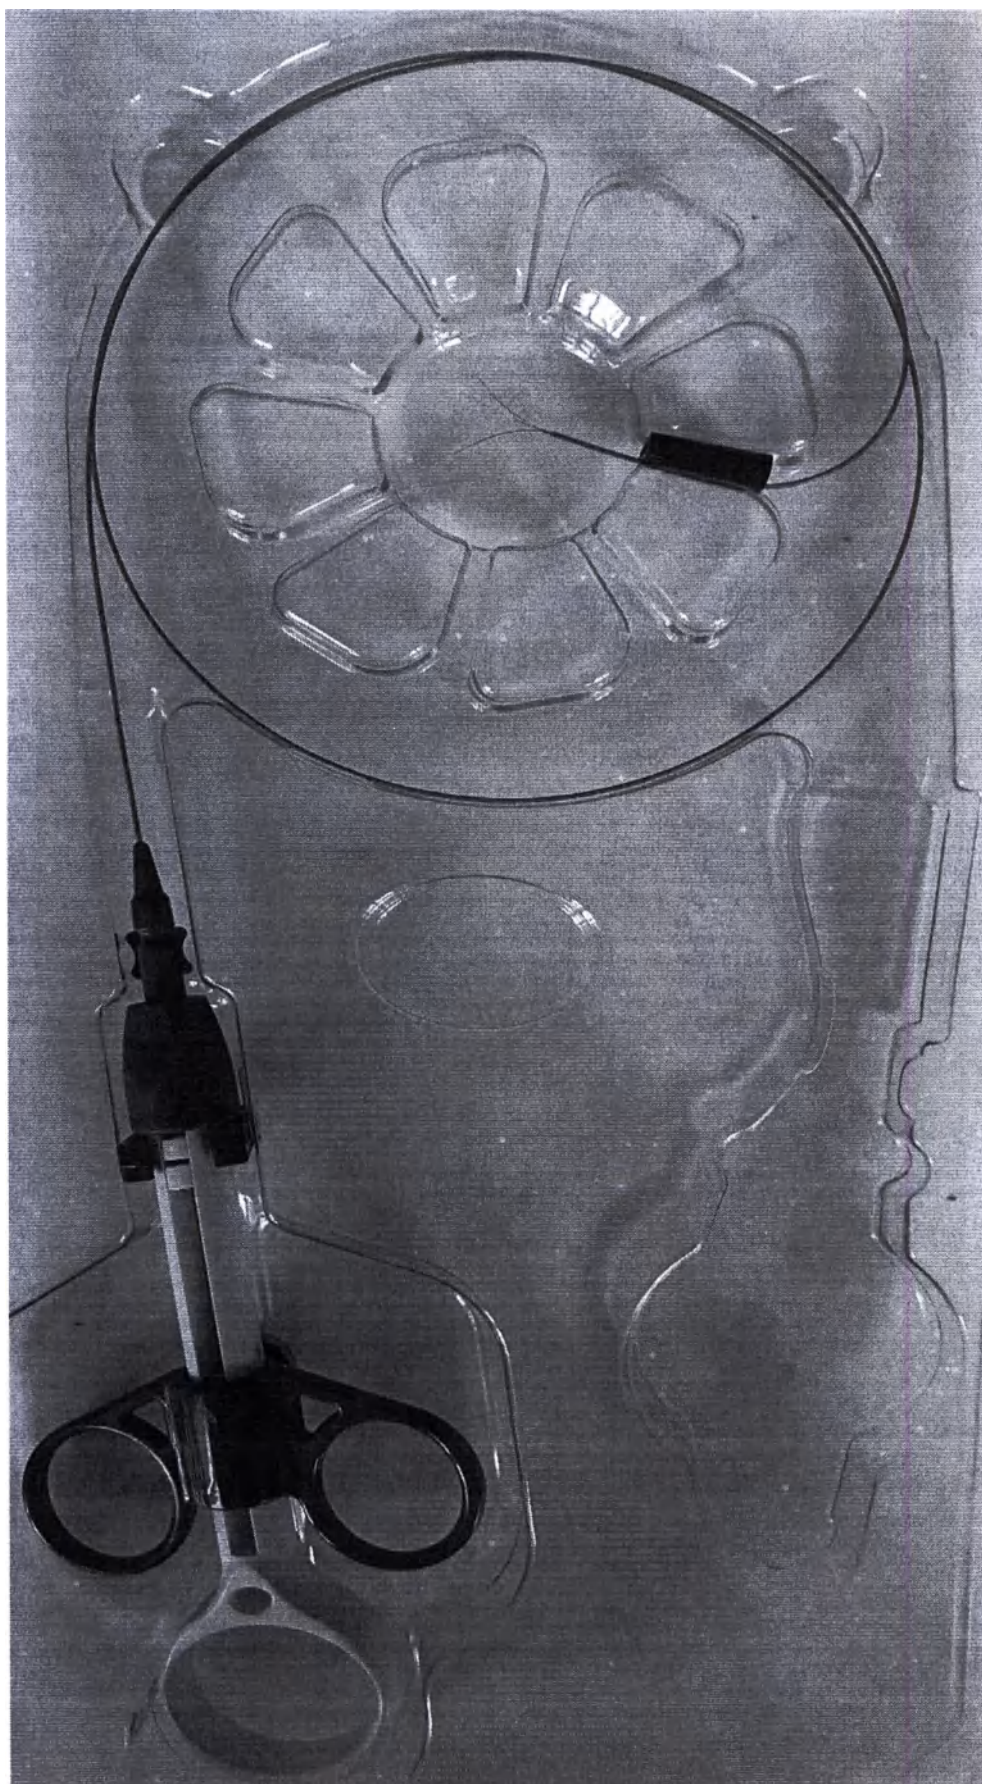


31) Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, GRASPER из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 6.0 CH (2,00 мм), длина интродьюсера: 90 см, количество струн: 3, диаметр раскрытия: 15 мм, покрытие интродьюсера: ПЭЭК, тип рукоятки «Fish».

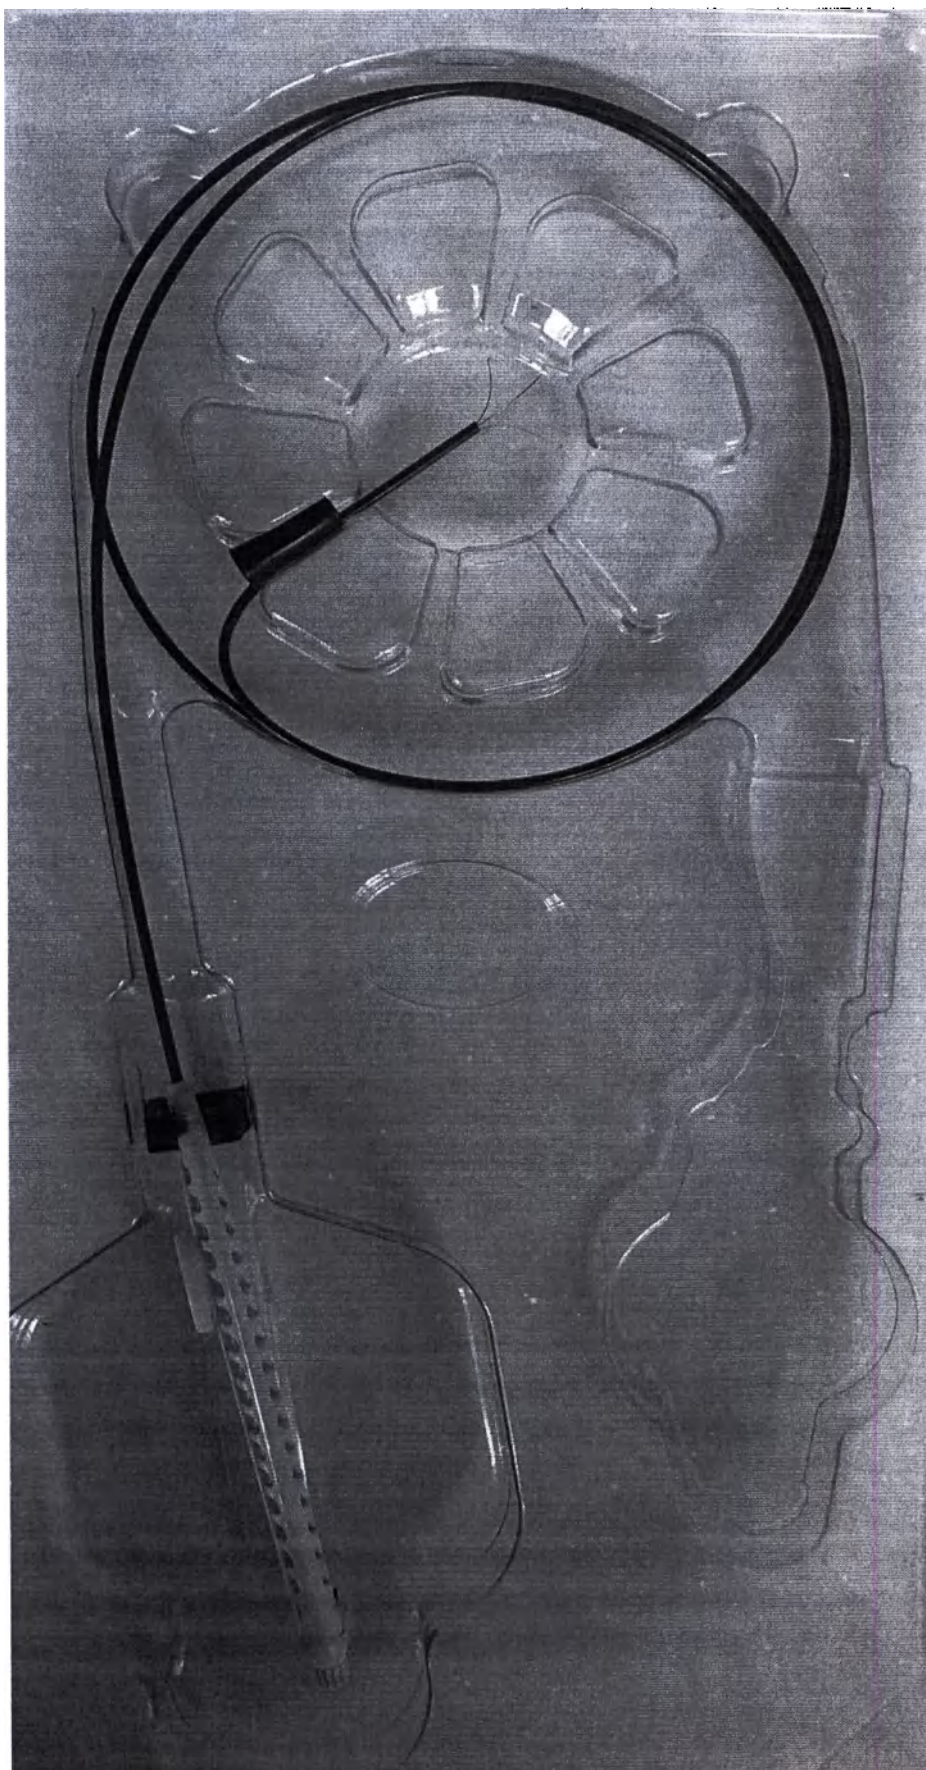



32) Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, без кончика из нитинола, для гибкого уретерореноскопа, диаметр интродьюсера: 2.4 CH (0,80 мм), длина интродьюсера: 120 см, количество струн: 4, диаметр раскрытия: 12 мм, покрытие интродьюсера: ПЭЭК, тип рукоятки «Scissor».

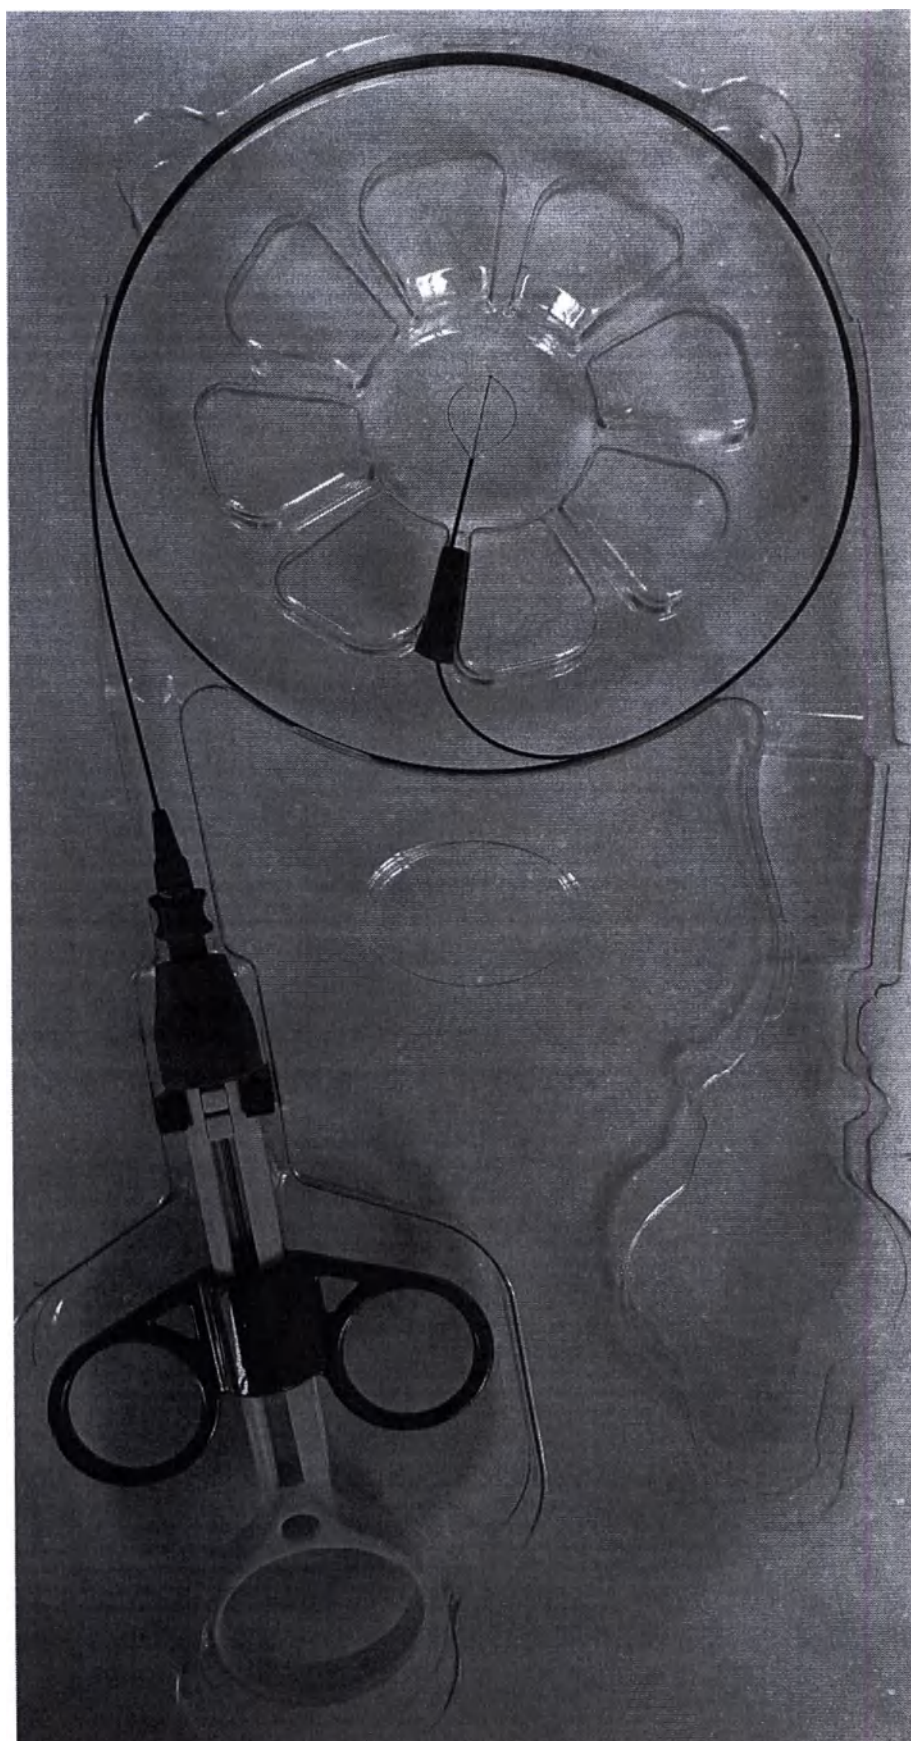


33) Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней при нефролитотомии Stone Stop с 6 витками из нитинола, диаметр интродьюсера: 3.0 CH (1,00 мм), длина интродьюсера: 90 см, количество струн: 1, диаметр раскрытия: 7 мм, покрытие интродьюсера: ПЭЭК, тип рукоятки «Clip».

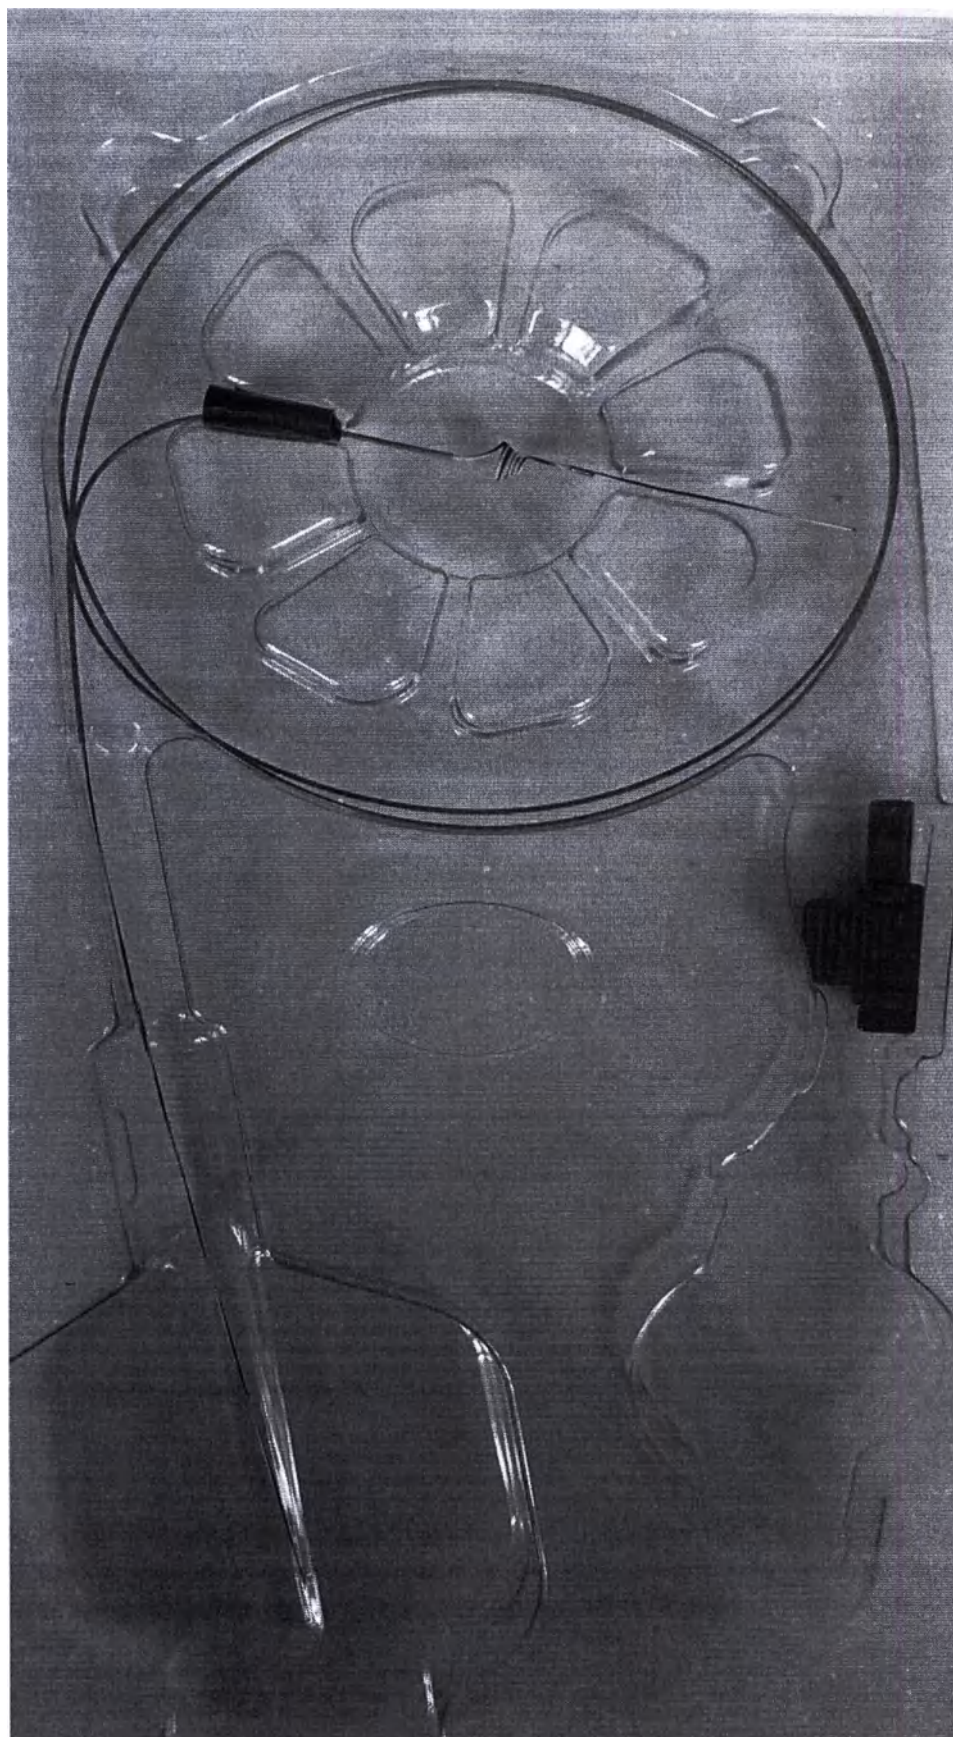

Пример упаковки и этикетки с нанесенной маркировкой

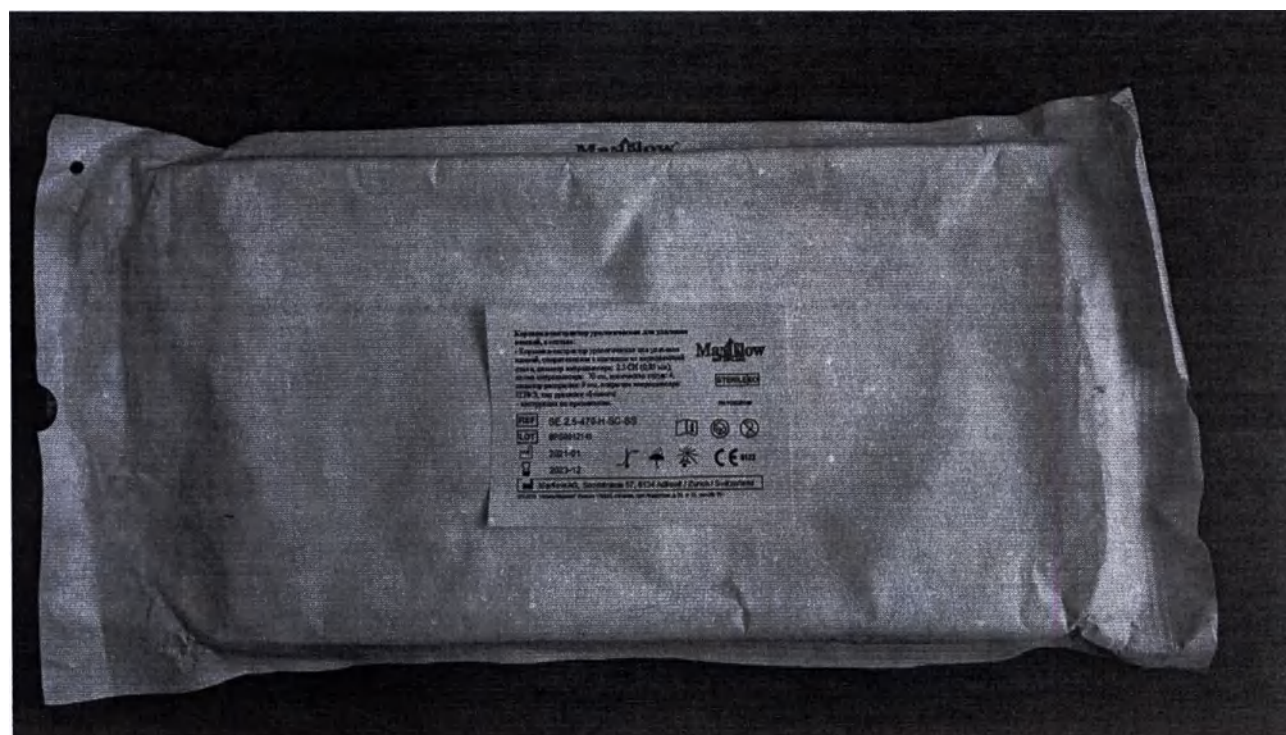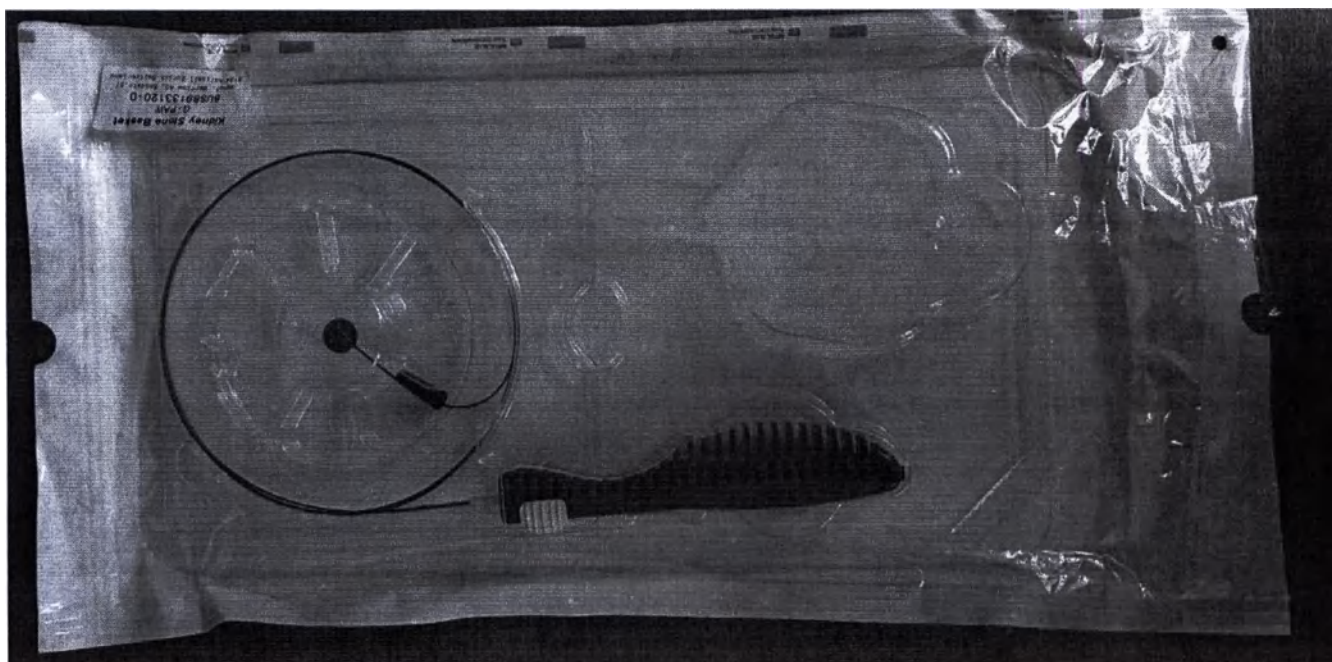

Транспортная упаковка:

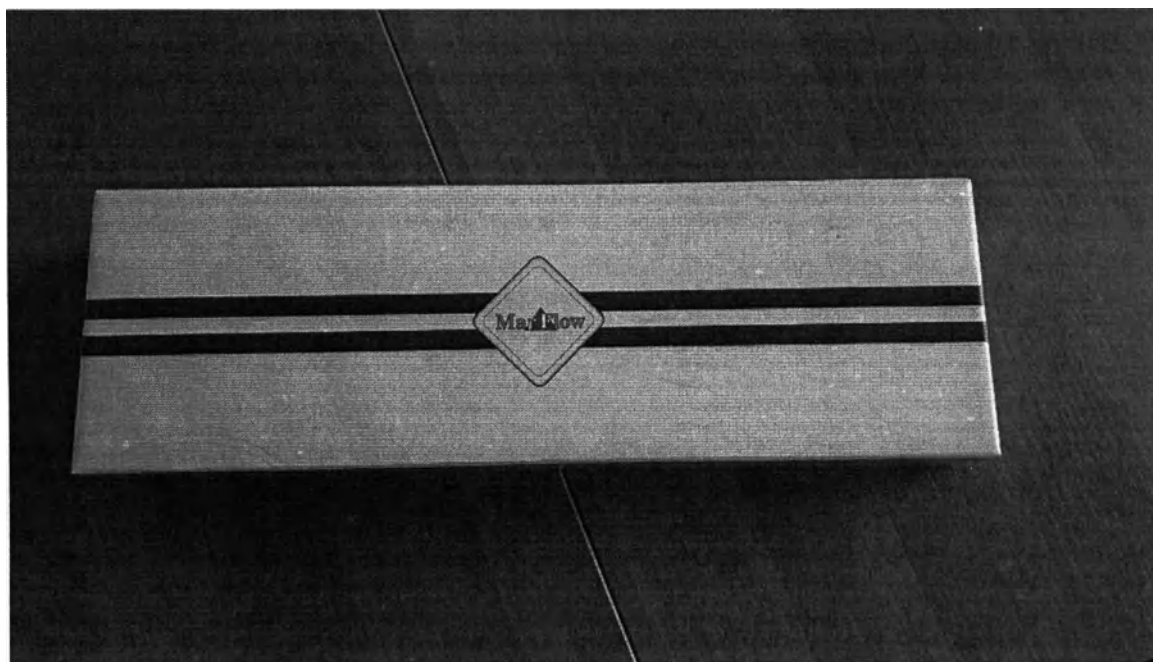

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью



_____ лист *ав*
Генеральный директор
ООО «Альна Медикал»

_____ Черный В.В.



Макет маркировки русскоязычного стикера медицинского изделия

КОРЗИНКА-ЭКСТРАКТОР УРОЛОГИЧЕСКАЯ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КАМНЕЙ

Производитель: «МАРФЛОУ АГ (MARFLOW AG), Швейцария
Soodstrasse 57, 8134 Adliswil, Zurich, Switzerland

Макет маркировки русскоязычного стикера на примере варианта исполнения «Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, в составе:

- Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, GRASPER из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 2.5 CH (0,83 мм), длина интродьюсера: 70 см, количество струн: 3, диаметр раскрытия: 9 мм, покрытие интродьюсера: ПТФЭ, тип рукоятки «Scissor»; - инструкция по применению»:

Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, в составе:

- Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, GRASPER из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 2.5 CH (0,83 мм), длина интродьюсера: 70 см, количество струн: 3, диаметр раскрытия: 9 мм, покрытие интродьюсера: ПТФЭ, тип рукоятки «Scissor»;
- инструкция по применению.

Marlow
ENGLAND

STERILE

НЕ ТОПИТЬ

REF

LOT

GF 3-25-70 SS

BPS0022104

2021-02

2024-01

📖

🚫

🕒

🔪

☂️

💣

CE 0123

Marlow AG, Soedstrasse 57, 8134 Adliswil / Zurich / Switzerland

УП: ООО "Амвентекс" Россия, 118038, Москва, стр. Архангельск, д. 22 стр. 50, комн. 20. Р/С:

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два) лист а

Генеральный директор
ООО «Альфа Медикал»

Черный В.В.

