

ООО «Пентакс Медикал Рус»

Юр. Адрес: 108811, г. Москва, вн.тер.г.поселение Московский, пос. Ульяновского Лесопарка, д.1,
стр.1, ком.90, 91

Почт. адрес: 108811, г. Москва, вн.тер.г.поселение Московский, пос. Ульяновского Лесопарка,
д.1, стр.1, ком 90, 91

ОГРН: 1177746171096

ИНН: 9701065002, КПП 775101001

Тел./факс: +7 495 721-3859

e-mail: service.ru@pentaxmedical.com

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
«Устройство управления навигацией PENTAX Medical NCU-7000»



Производства компании:

HOYA Corporation; 6-10-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023, Japan

Медведева Е.Г., Генеральный Директор ООО «Пентакс Медикал Рус»,
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, руководителя юридического лица
или иного лица, имеющего право действовать от имени этого
юридического лица)

"5" августа 2022 г.




(Подпись)

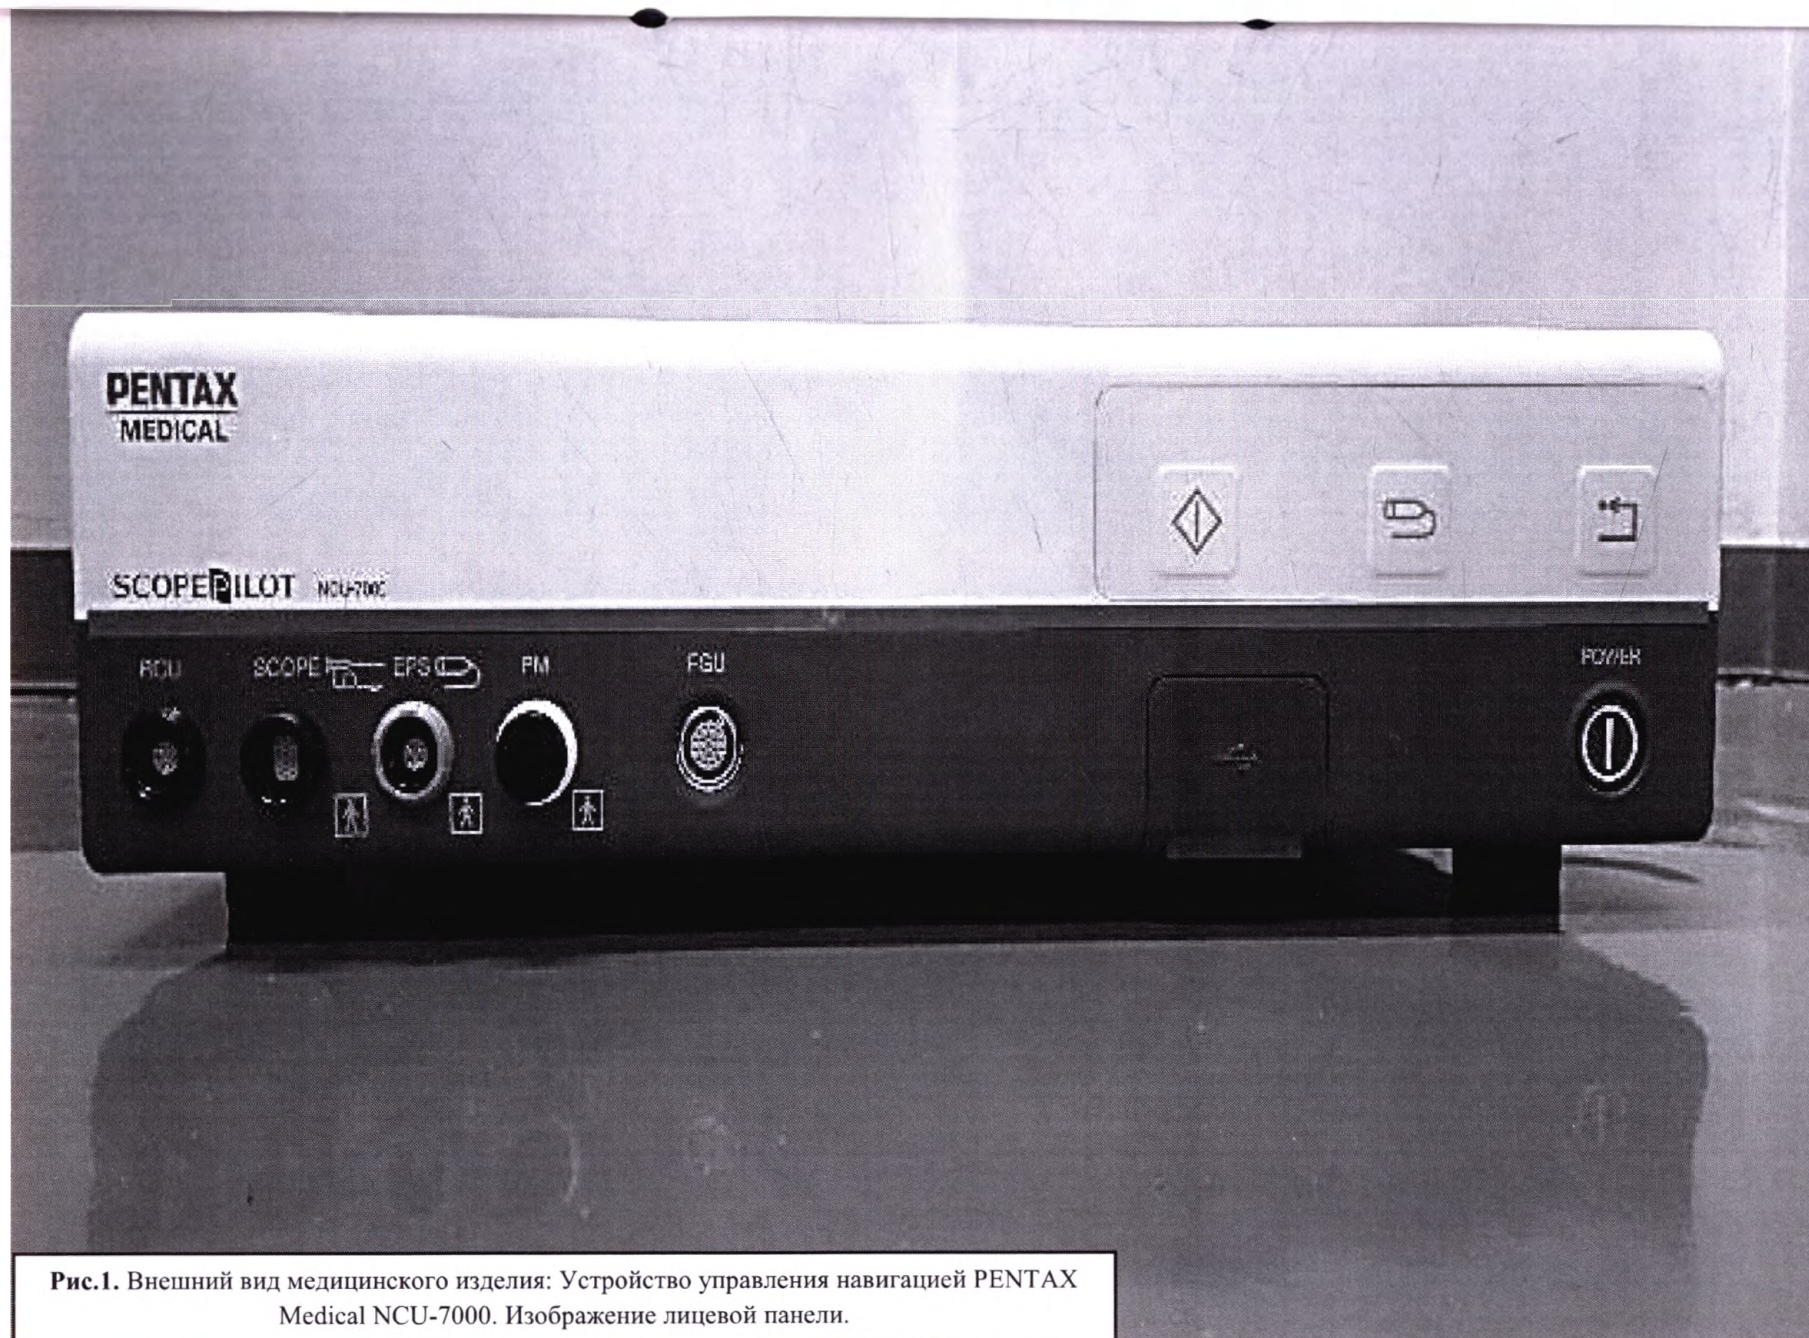


Рис.1. Внешний вид медицинского изделия: Устройство управления навигацией PENTAX Medical NCU-7000. Изображение лицевой панели.

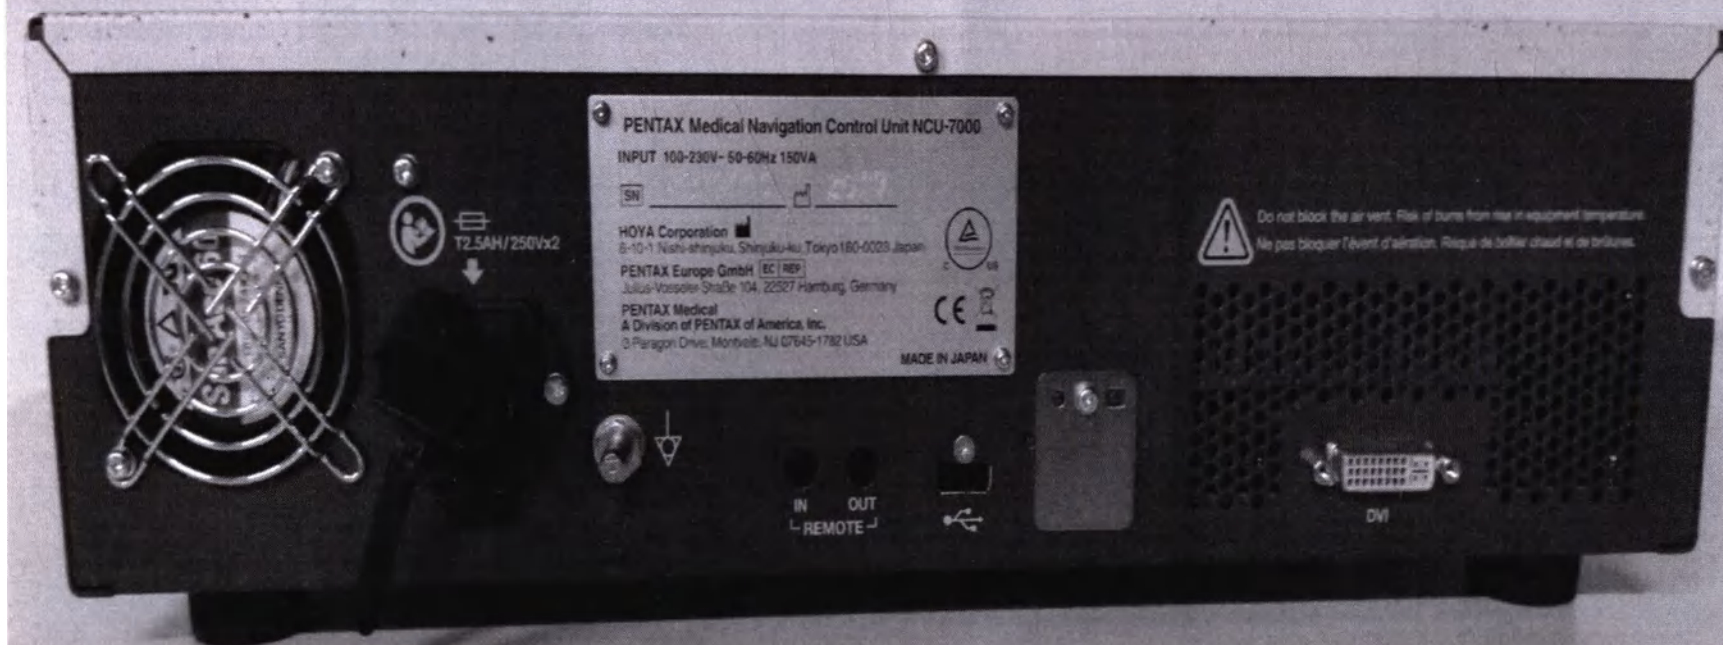
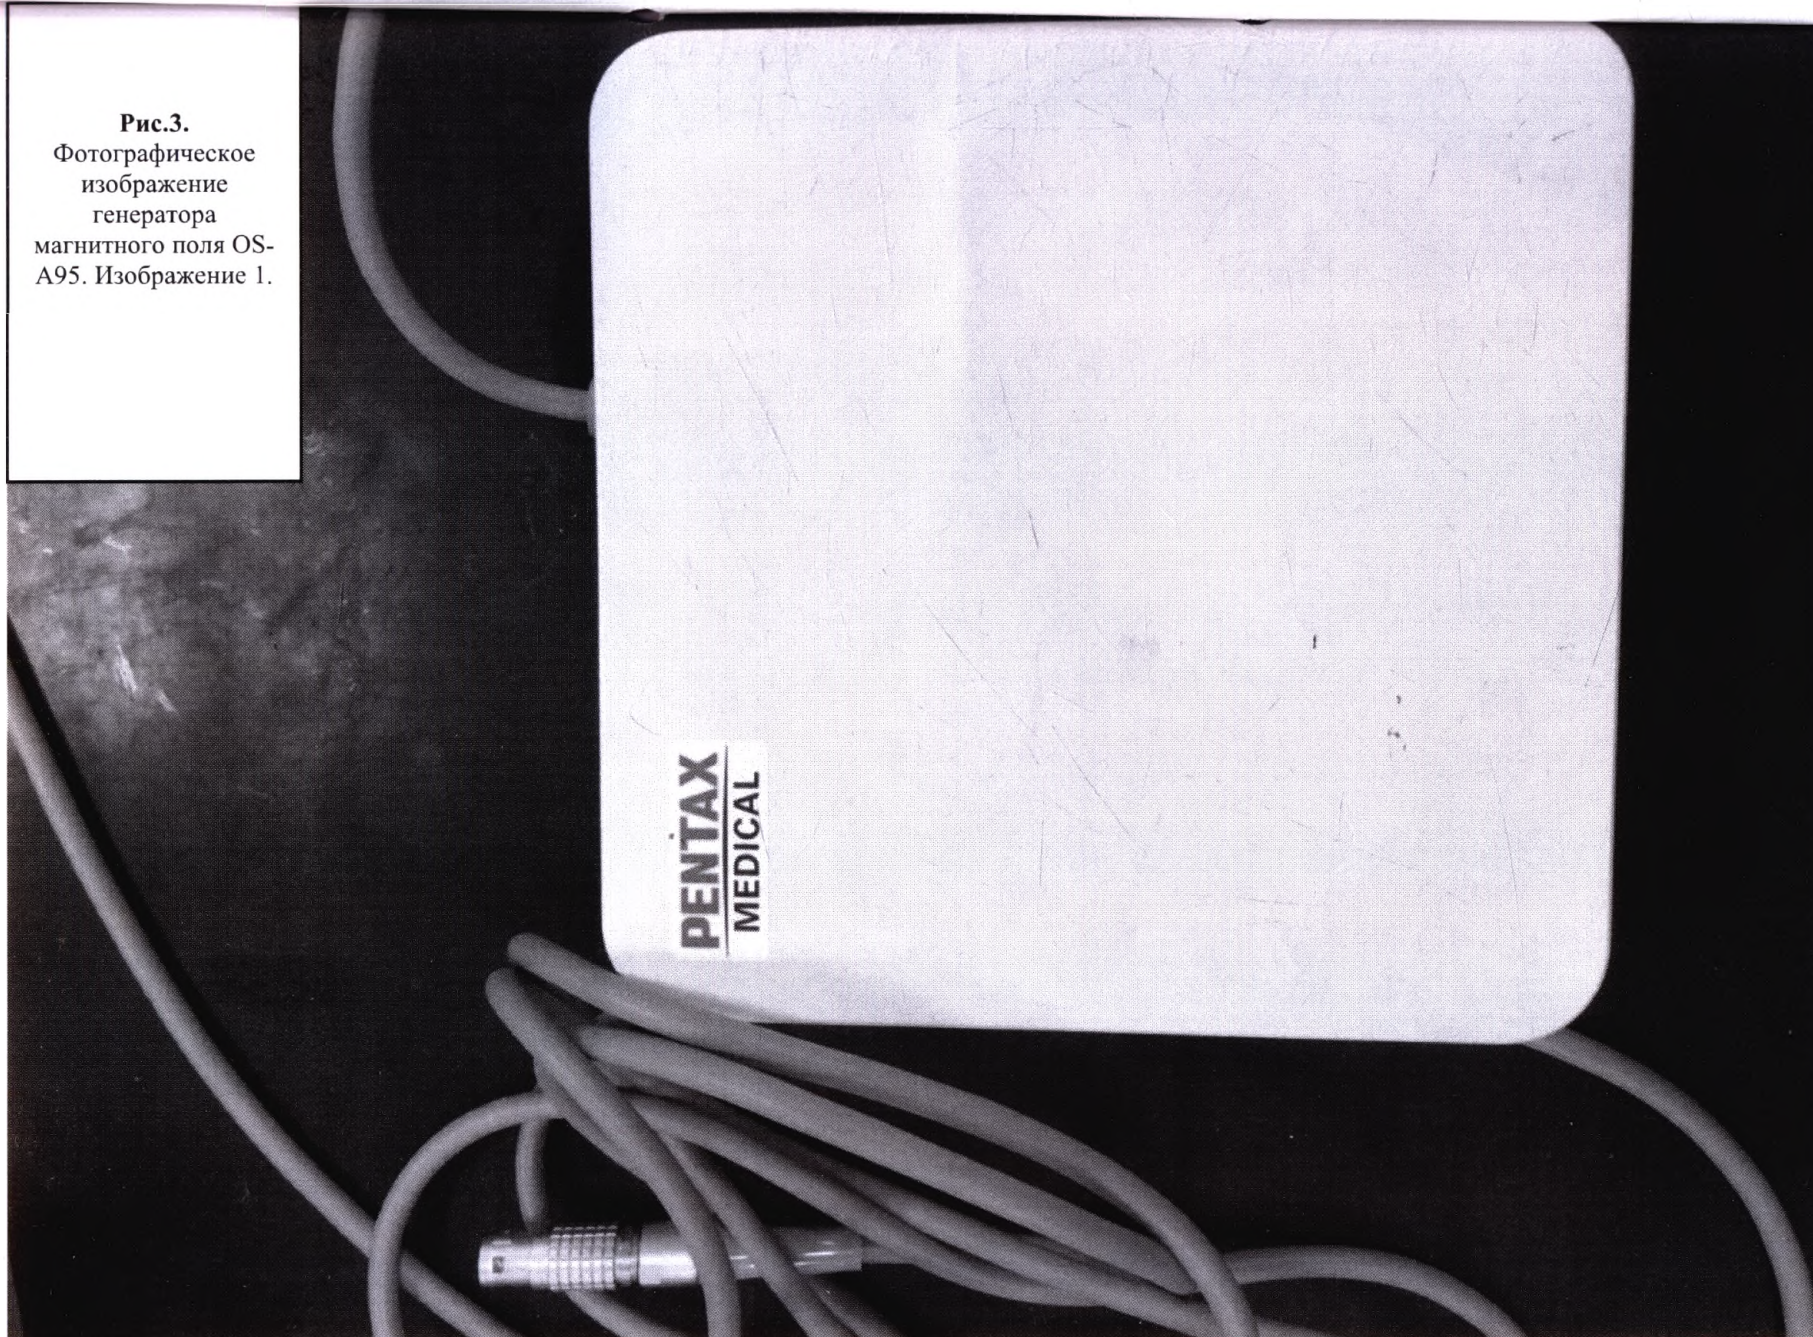


Рис.2. Внешний вид медицинского изделия: Устройство управления навигацией PENTAX Medical NCU-7000. Изображение задней панели.

Рис.3.
Фотографическое
изображение
генератора
магнитного поля OS-
A95. Изображение 1.



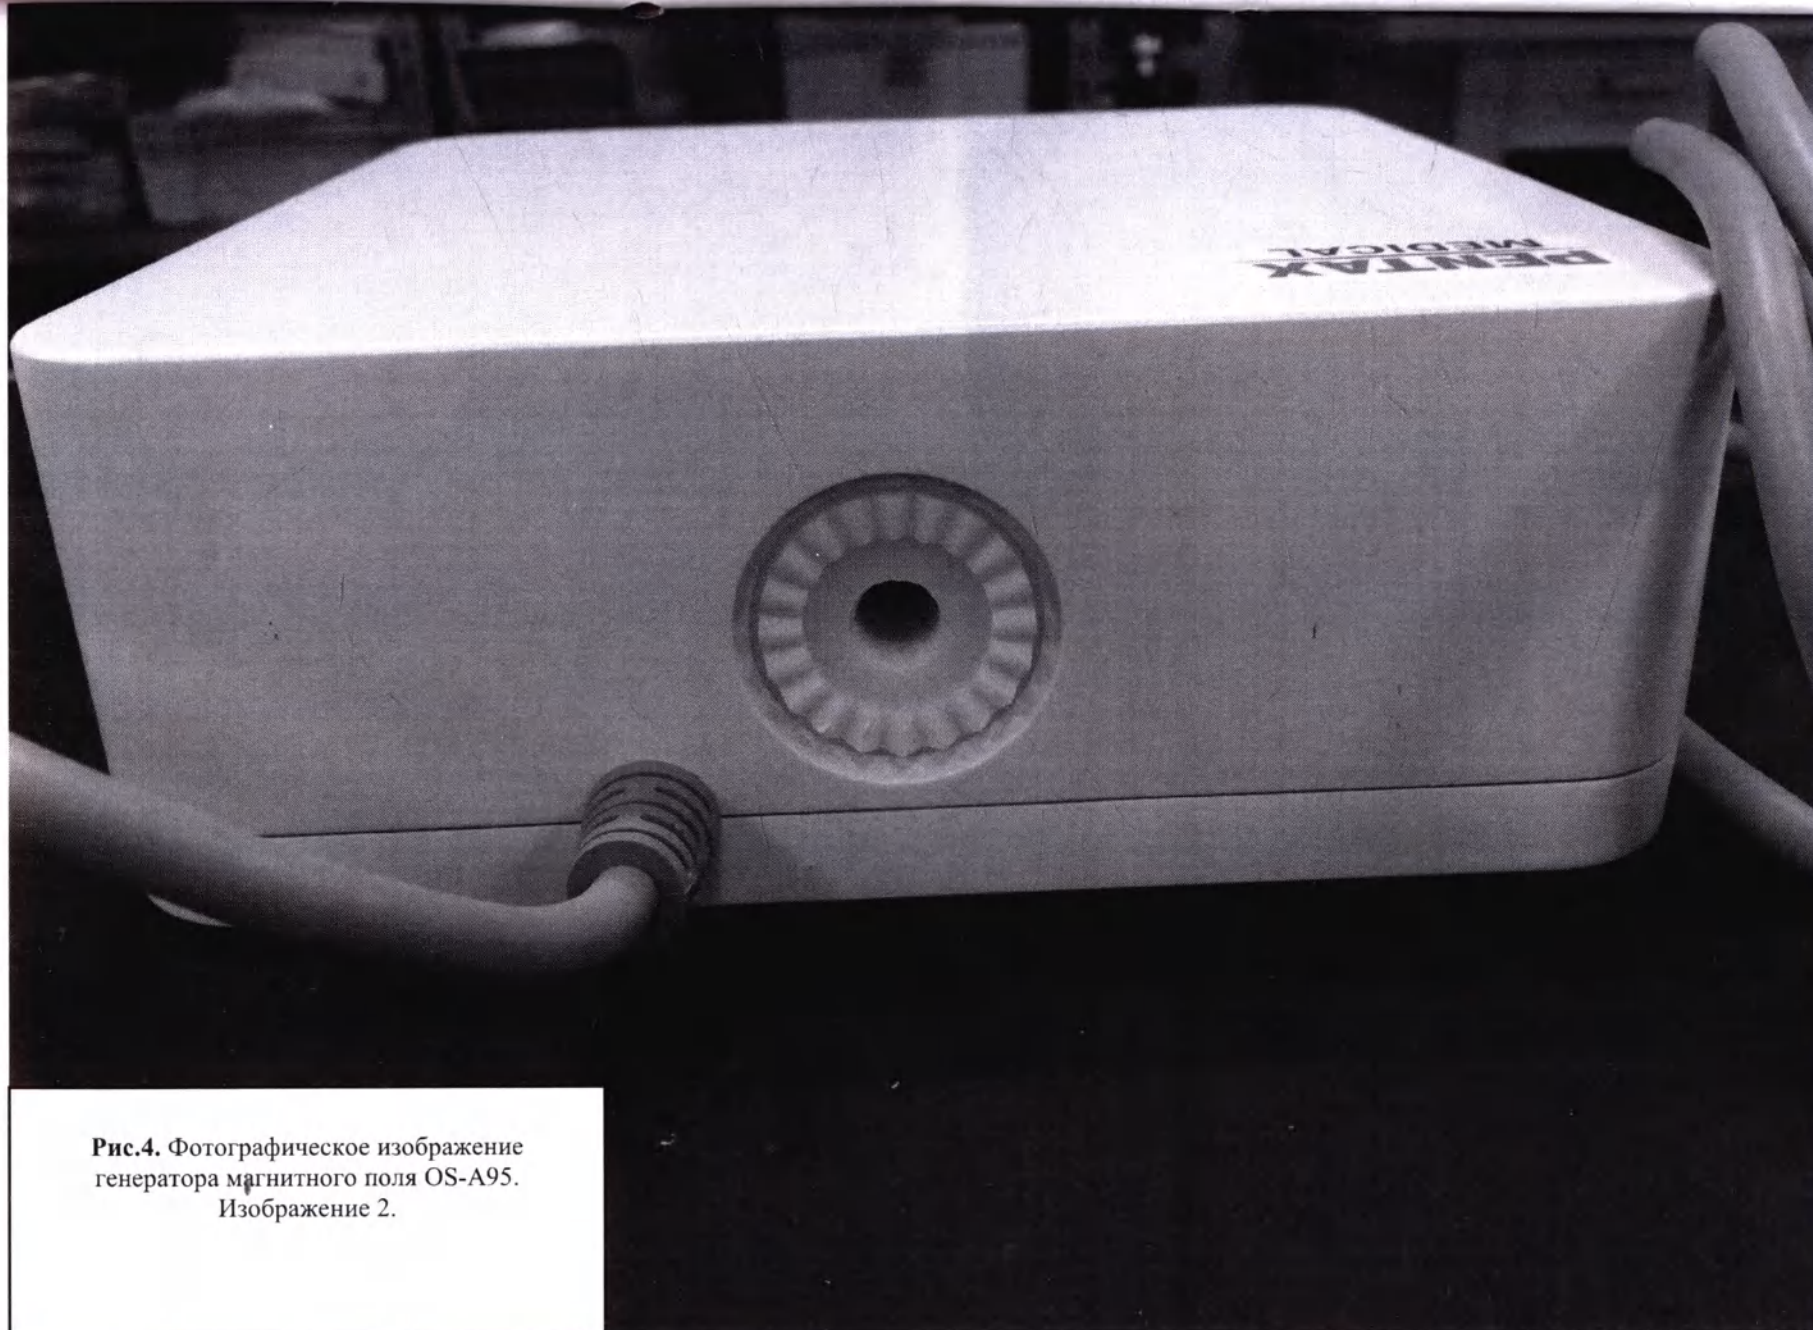


Рис.4. Фотографическое изображение
генератора магнитного поля OS-A95.
Изображение 2.



Рис.5. Фотографическое изображение
наружного датчика положения OS-A100.
Изображение 1.

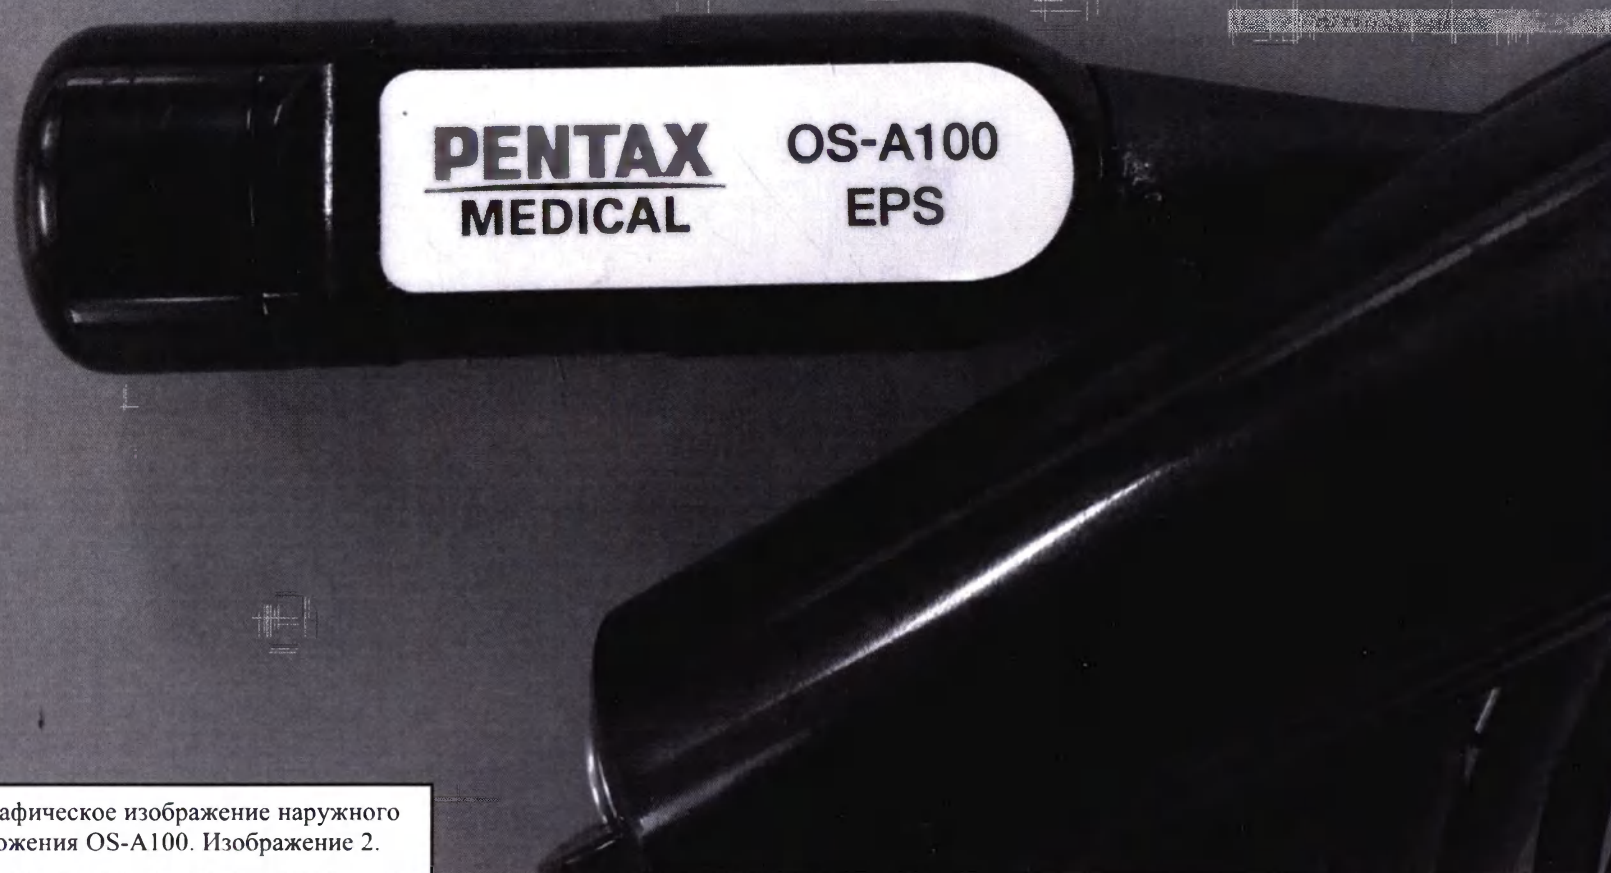


Рис.6. Фотографическое изображение наружного датчика положения OS-A100. Изображение 2.



Рис.7. Фотографическое изображение держателя для датчика положения OS-A100H. Изображение 1.

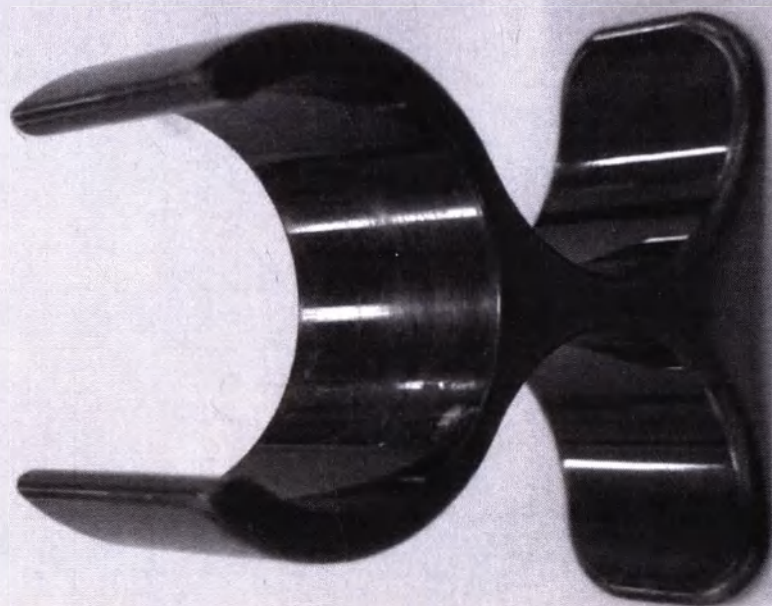
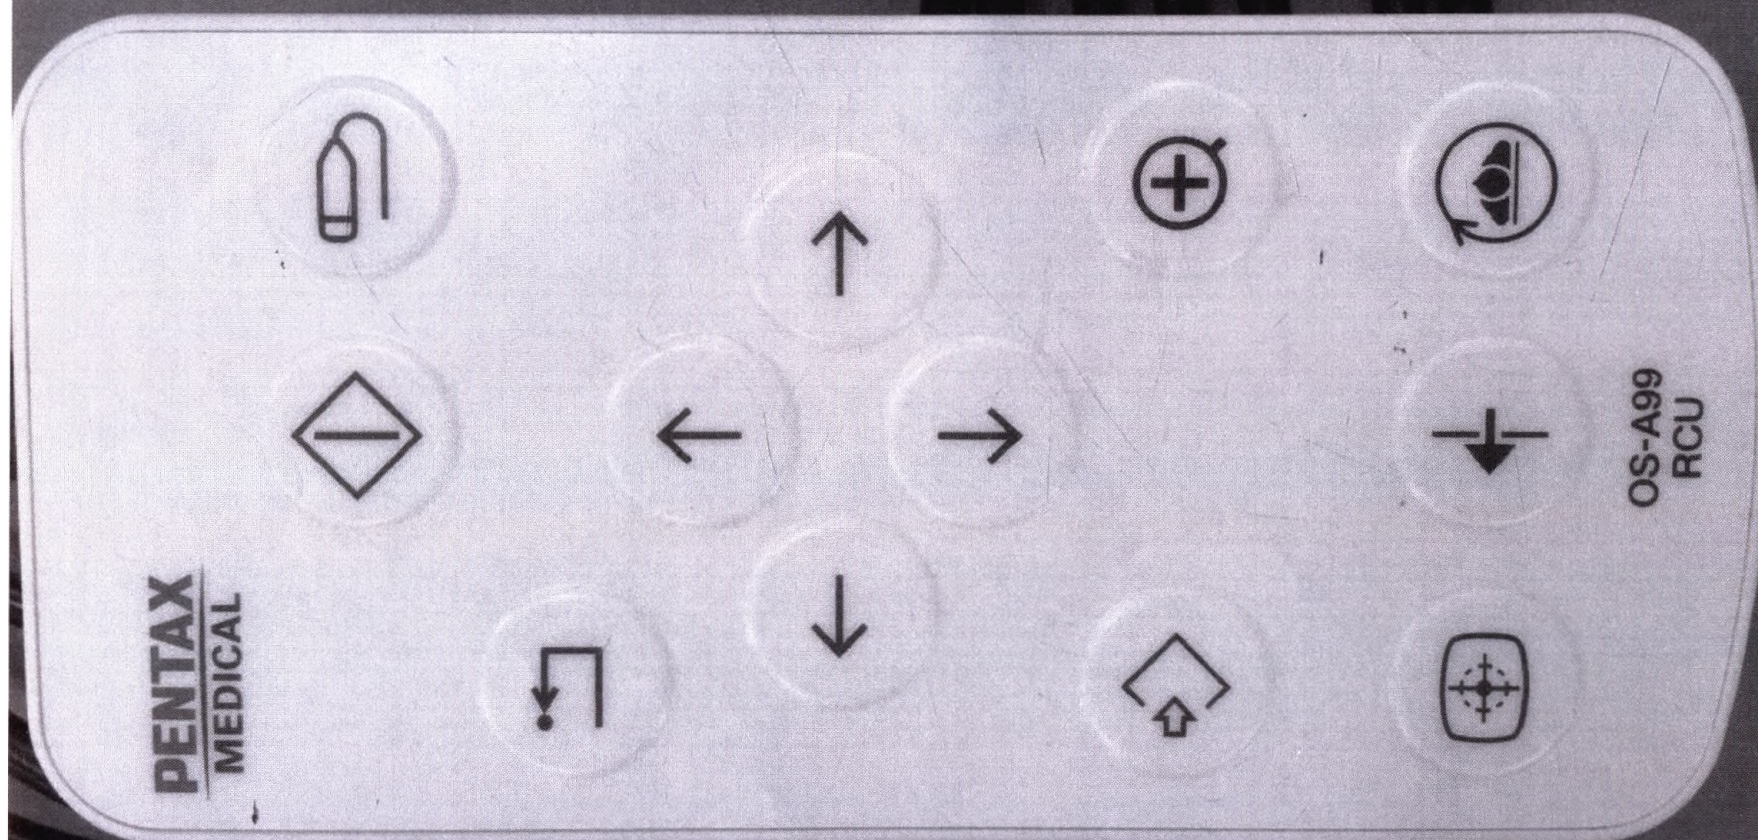


Рис.8. Фотографическое изображение держателя для датчика положения OS-A100H. Изображение 2.

Рис.9. Фотографическое изображение пульта дистанционного управления OS-A99 для NCU-7000.
Изображение 1.



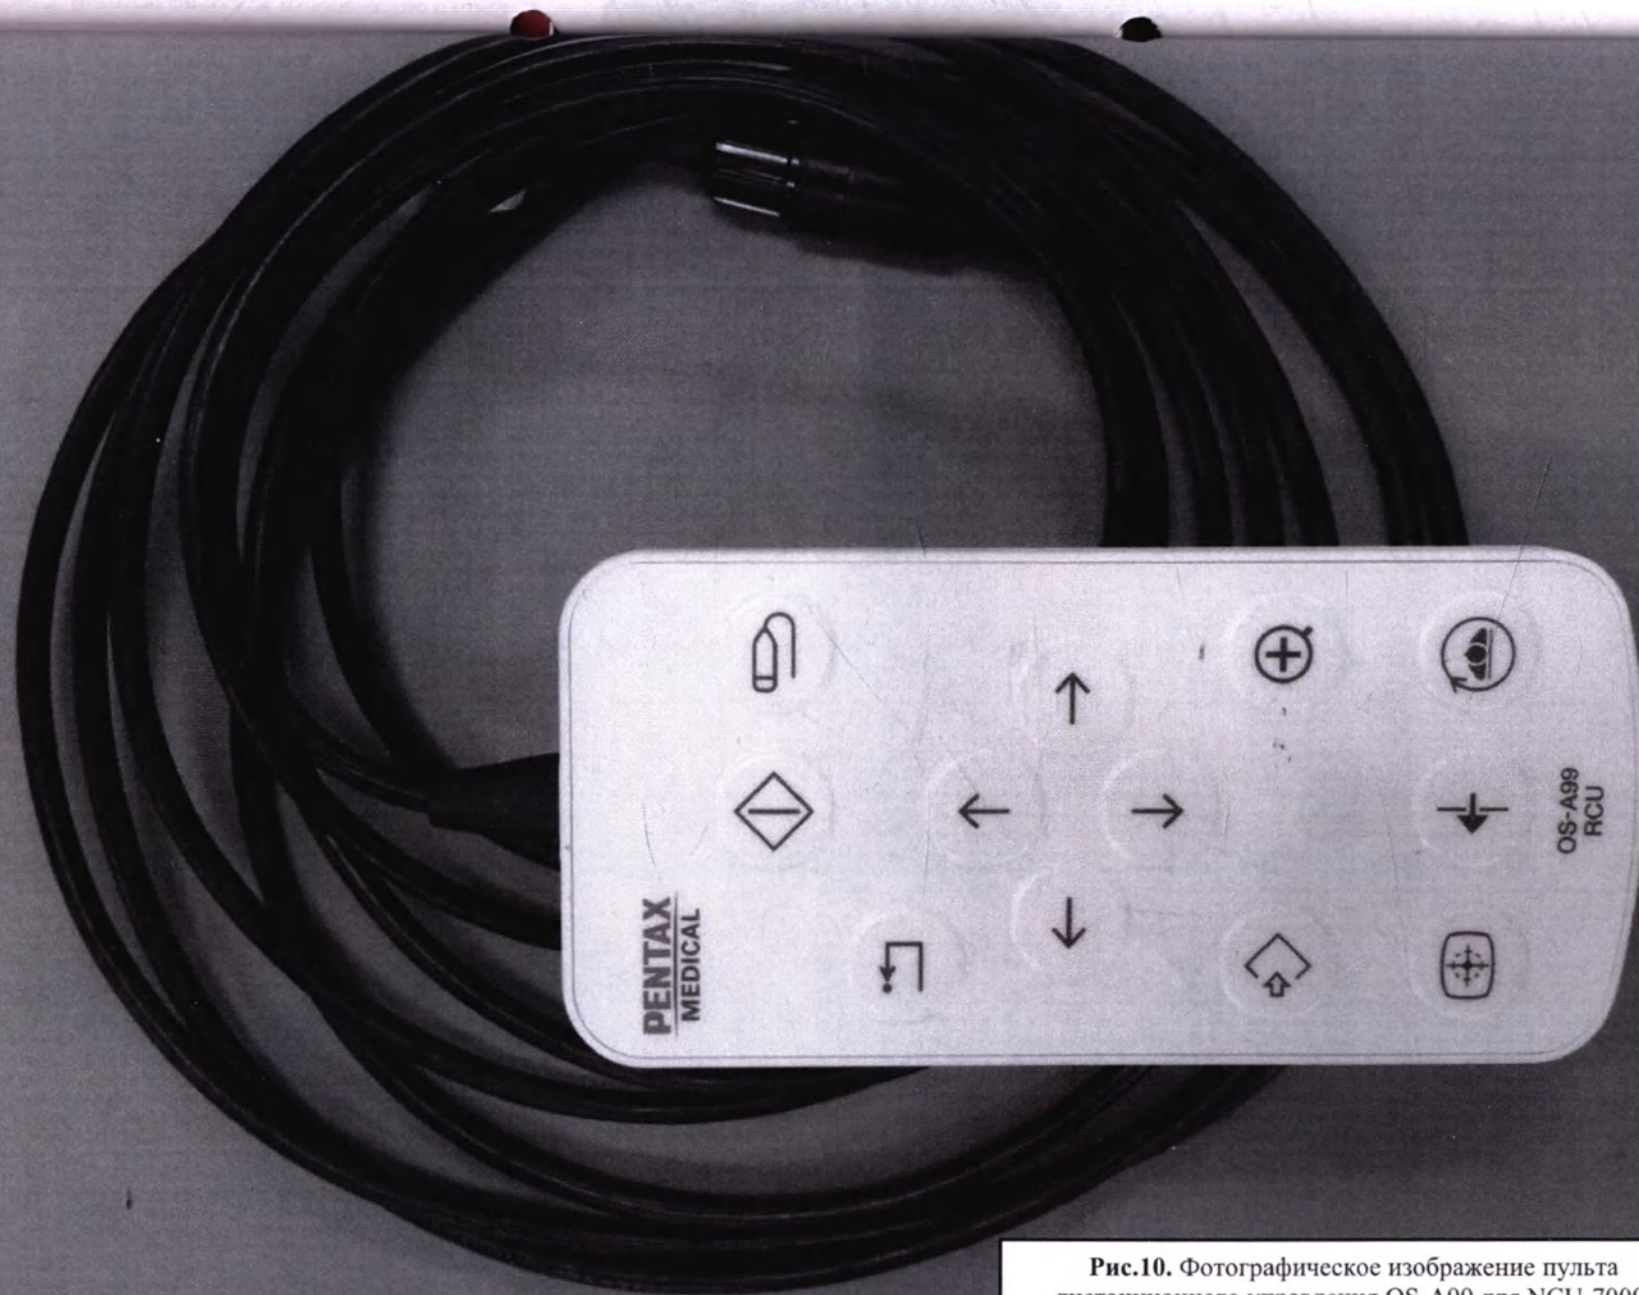


Рис.10. Фотографическое изображение пульта дистанционного управления OS-A99 для NCU-7000.
Изображение 2.

Рис. 1. Фотографическое изображение кабеля для подключения видеоэндоскопа OS-A98 к NCU-7000.

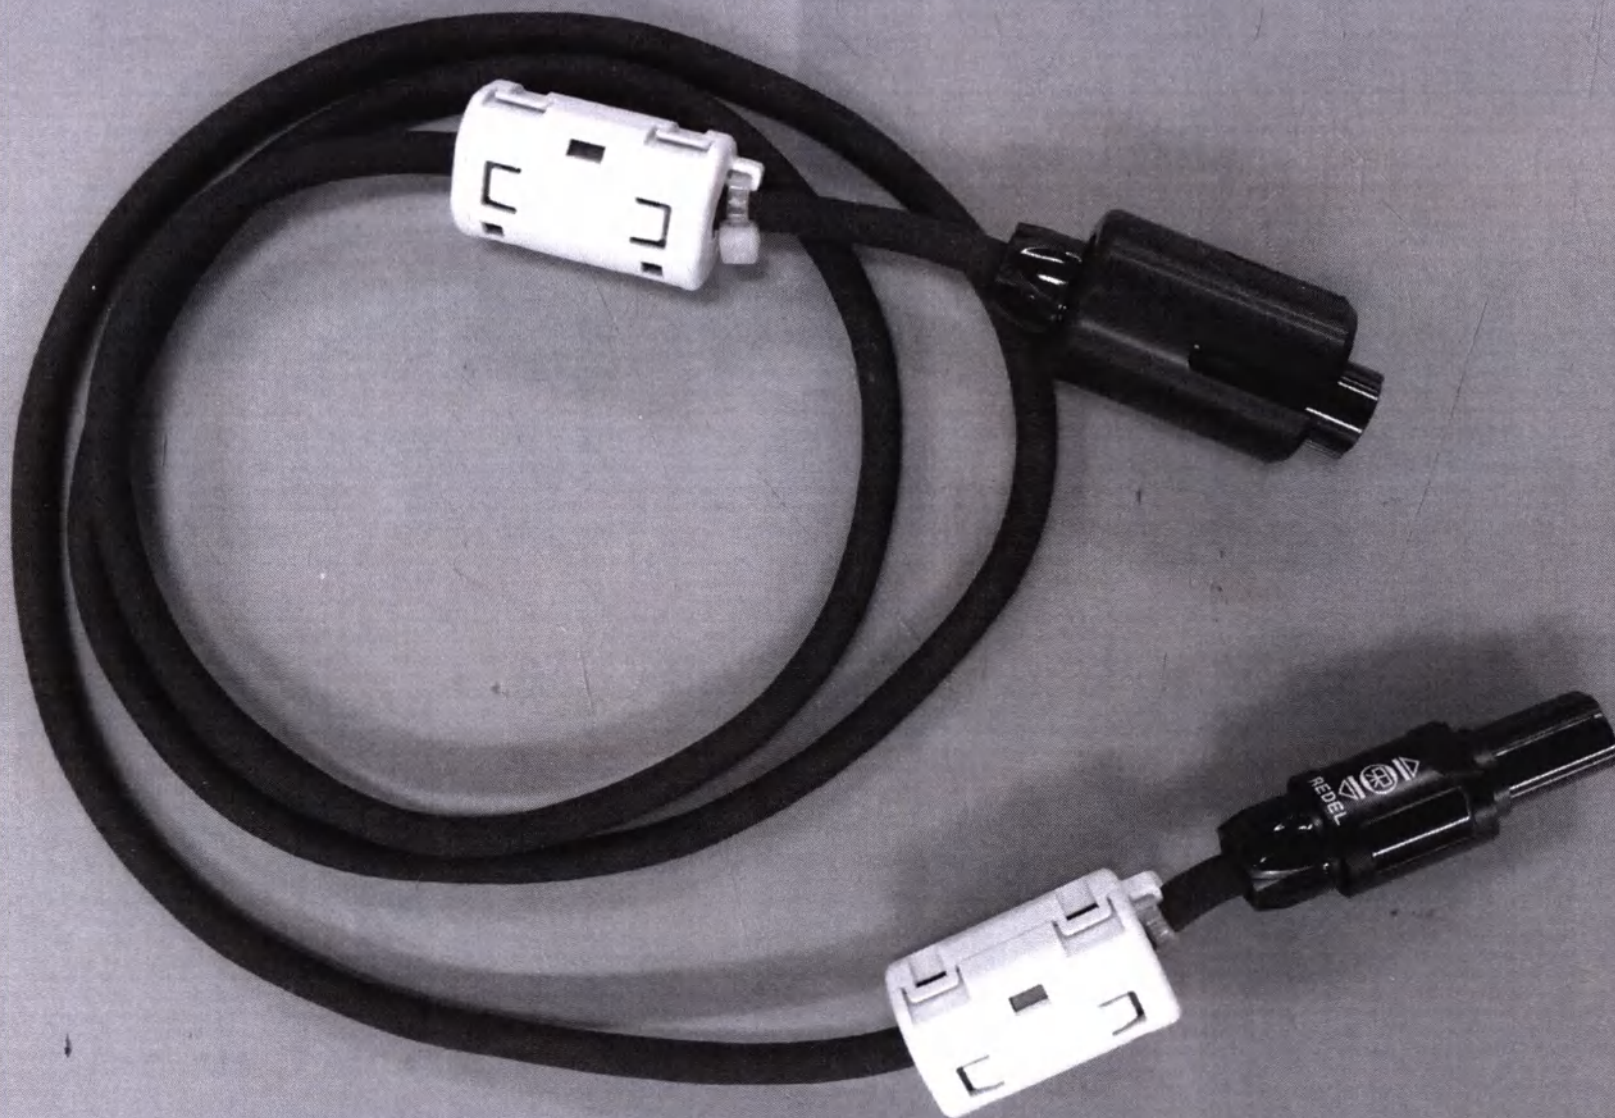


Рис.12. Фотографическое изображение подставки-стойки
мобильной генератора магнитного поля OS-A96.

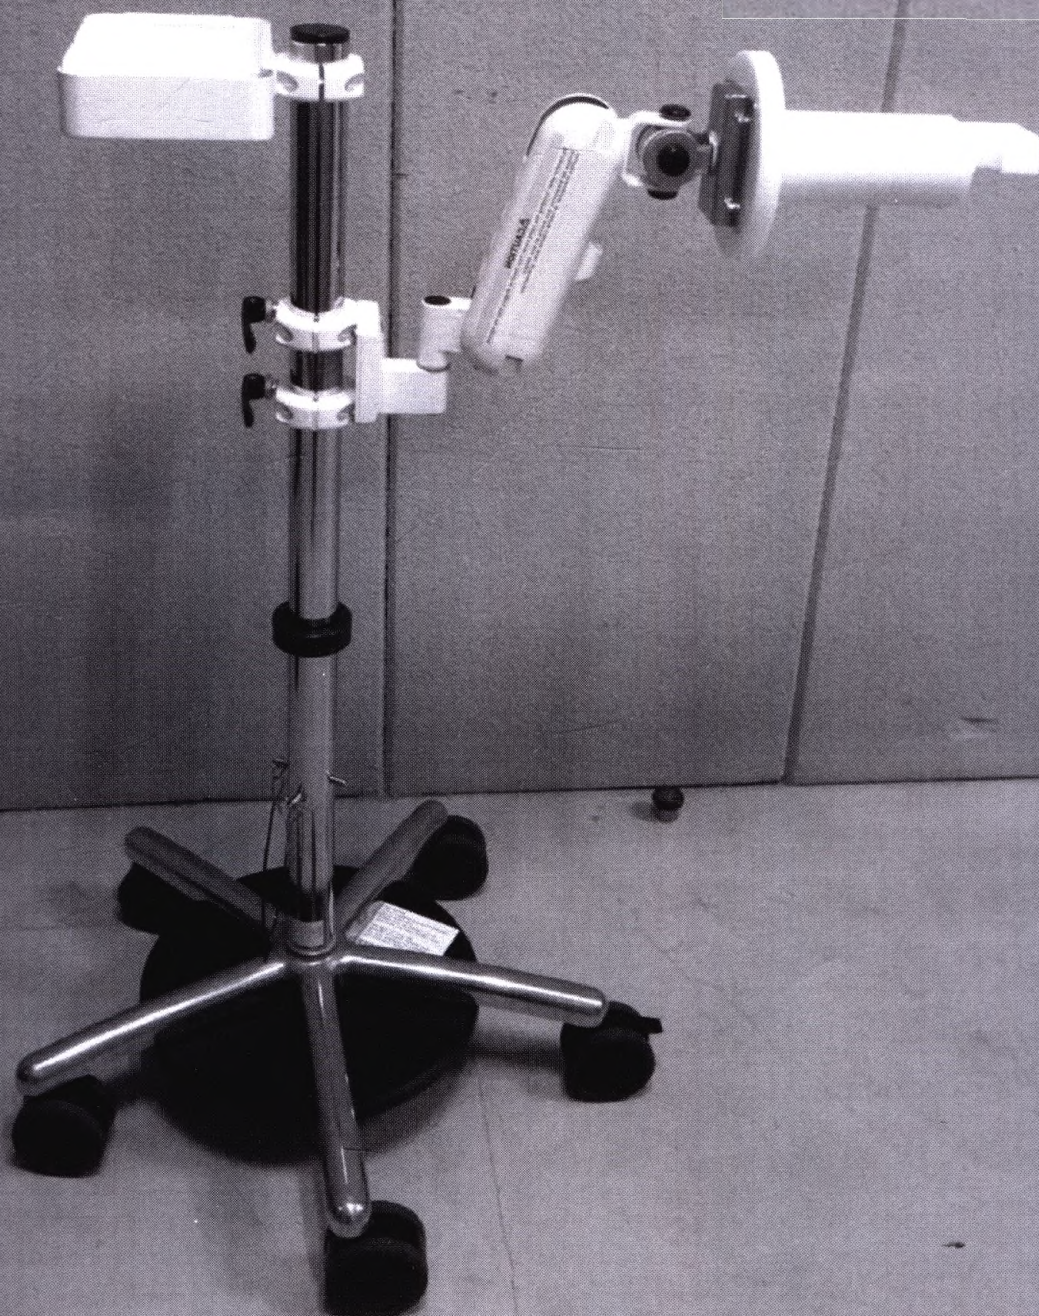
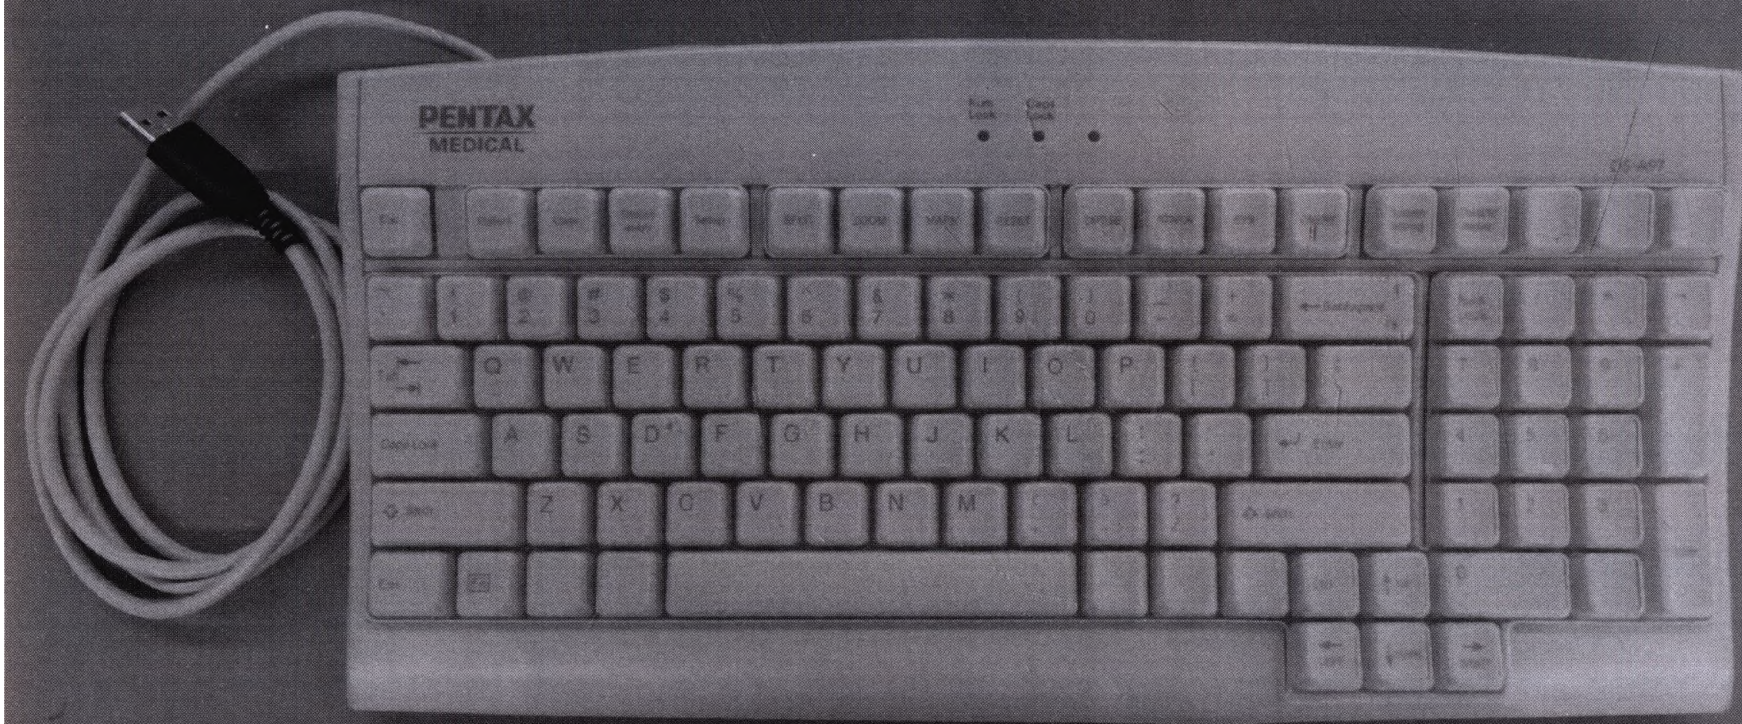


Рис.13. Фотографическое изображение клавиатуры для
NCU-7000 OS-A97




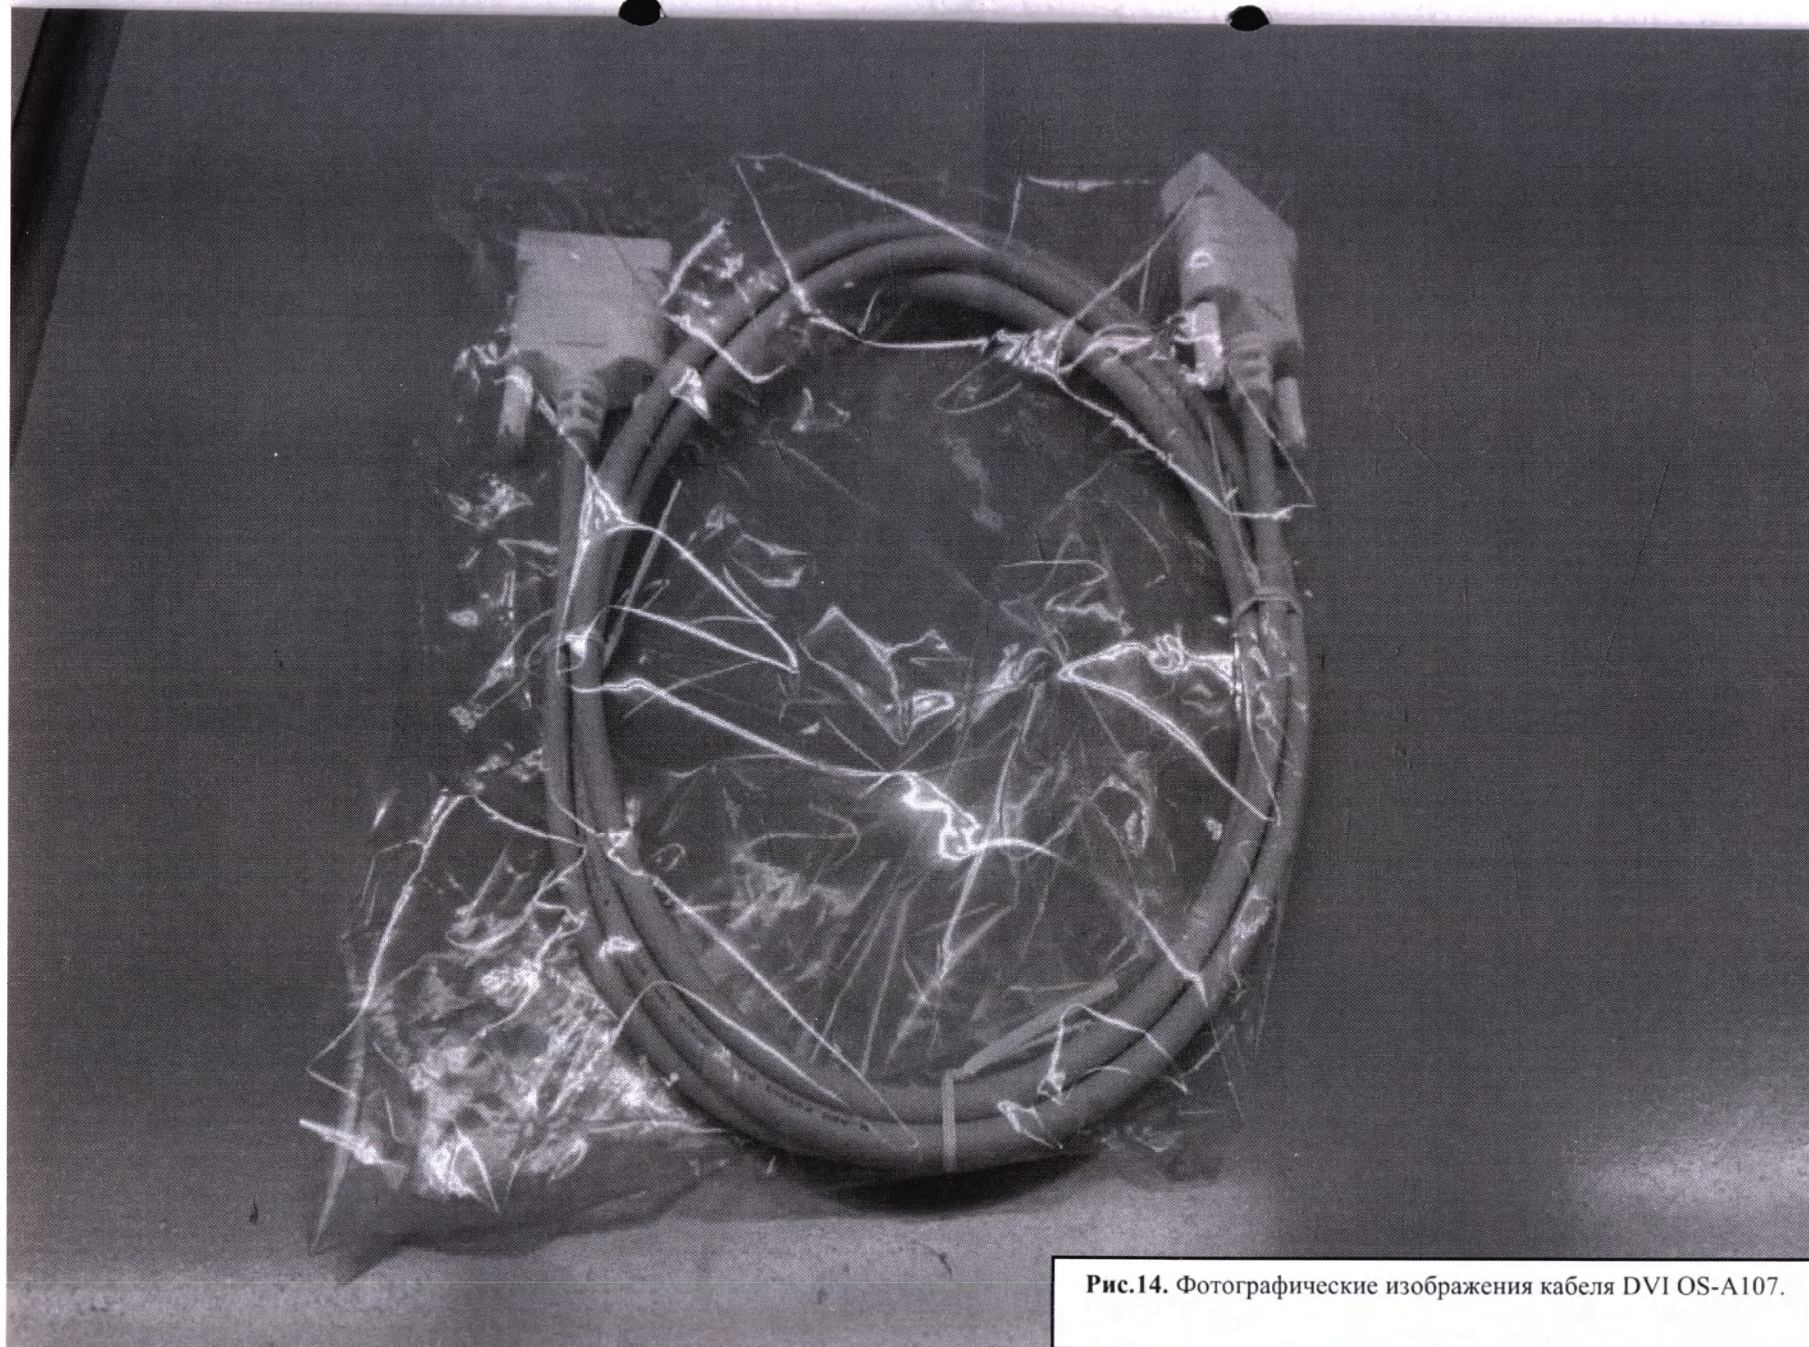


Рис.14. Фотографические изображения кабеля DVI OS-A107.

Рис.15. Фотографическое изображение кабеля питания.

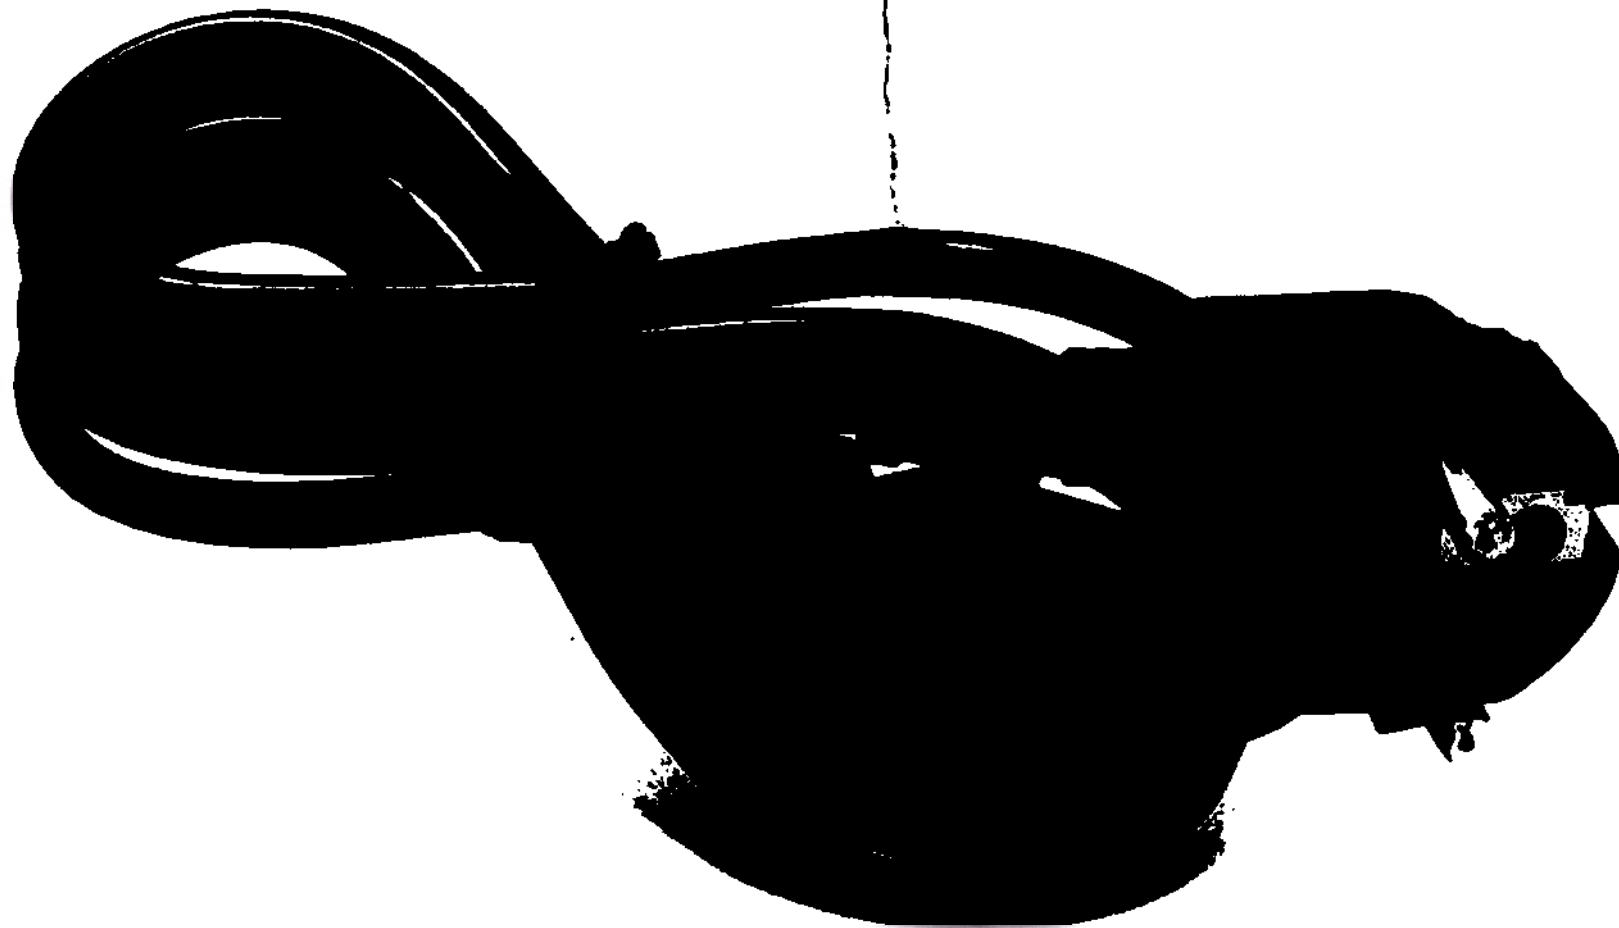

Пронумеровано, прошнуровано, прошито
и скреплено печатью

16 (шестнадцать) ЛИСТОВ

Генеральный директор
ООО «ПЕНТАКС МЕДИКАЛ РУС»


Е.Г. Медведева

