

«Утверждаю»

Генеральный директор
ООО «МЕДИКА ТРЕЙД»

М. В. Кольшкин

«24» *генеральный директор* 2021 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Аппарат искусственной вентиляции легких, в вариантах исполнения:

LAVI 40, LAVI 45, CARAT I pro, CARAT II pro»



1.1. Аппарат ИВЛ LAVI 40, основной блок



1.2. Импульсный источник питания FSP090-RACM1



1.3. Держатель блока питания со встроенным сбросом напряжения


Сетевой шнур



1.4. Сетевой шнур



1.5. Внутренняя батарея RRC2054

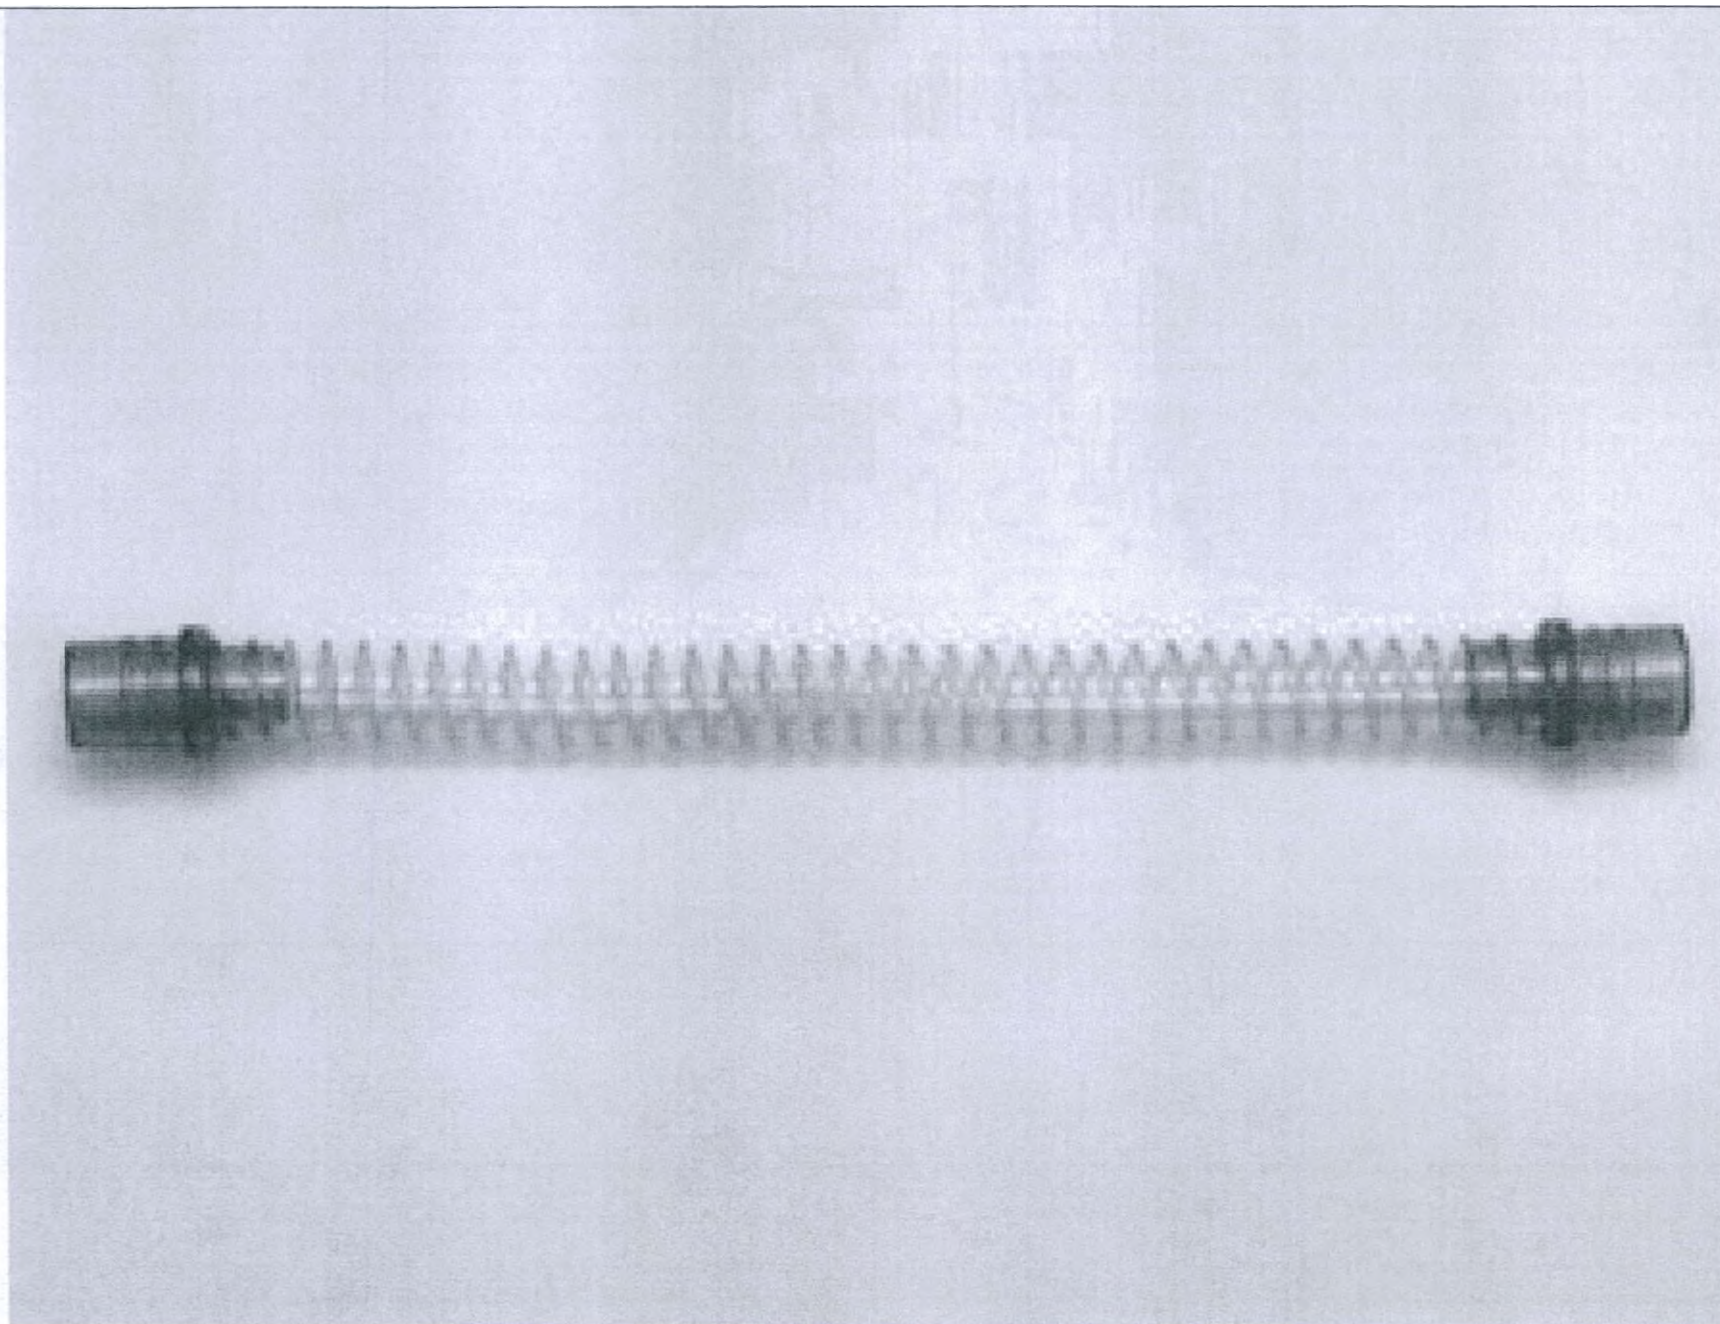

1.6. Трубка вывода контура




1.7. Прямой переходник соединения O2



Запасная
фильтрующая
кассета открытая


1.8. Запасная фильтрующая кассета, полная (открытая) с фильтрами

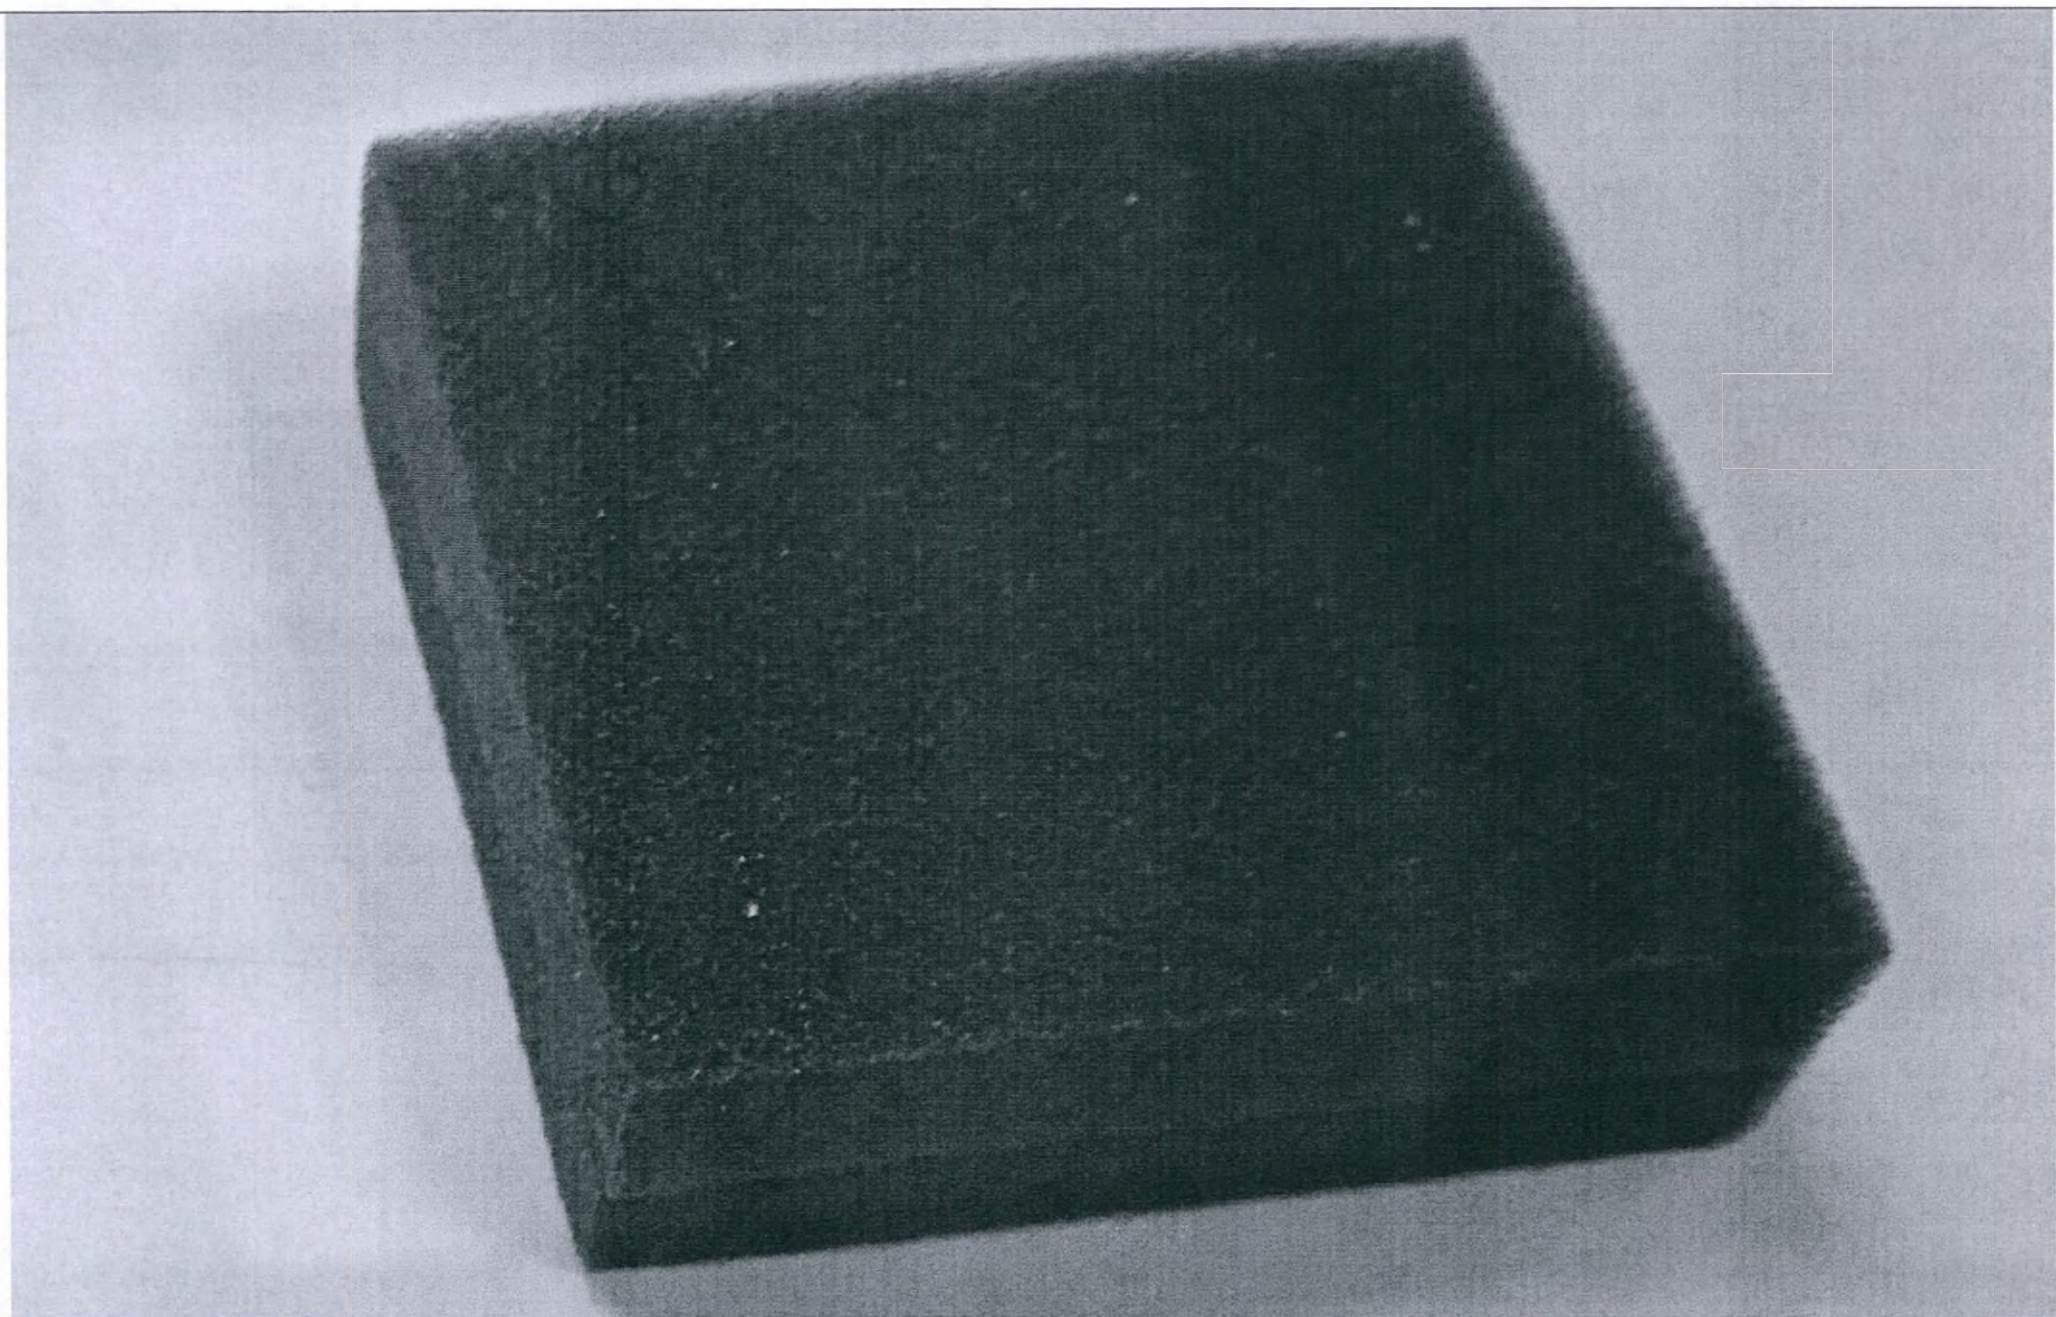

1.9. Запасной фильтр грубой очистки, 1 упаковка (2 штуки)



1.10. SD –карта

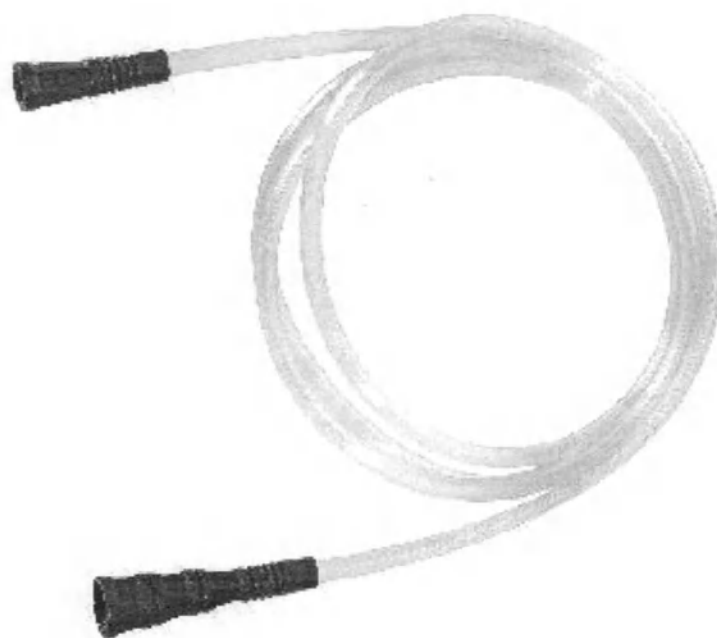


2.1. Система утечки трубок



2.2. Подогреваемая трубка утечки Система ComfortTube



2.3. Пассивный клапан выдоха

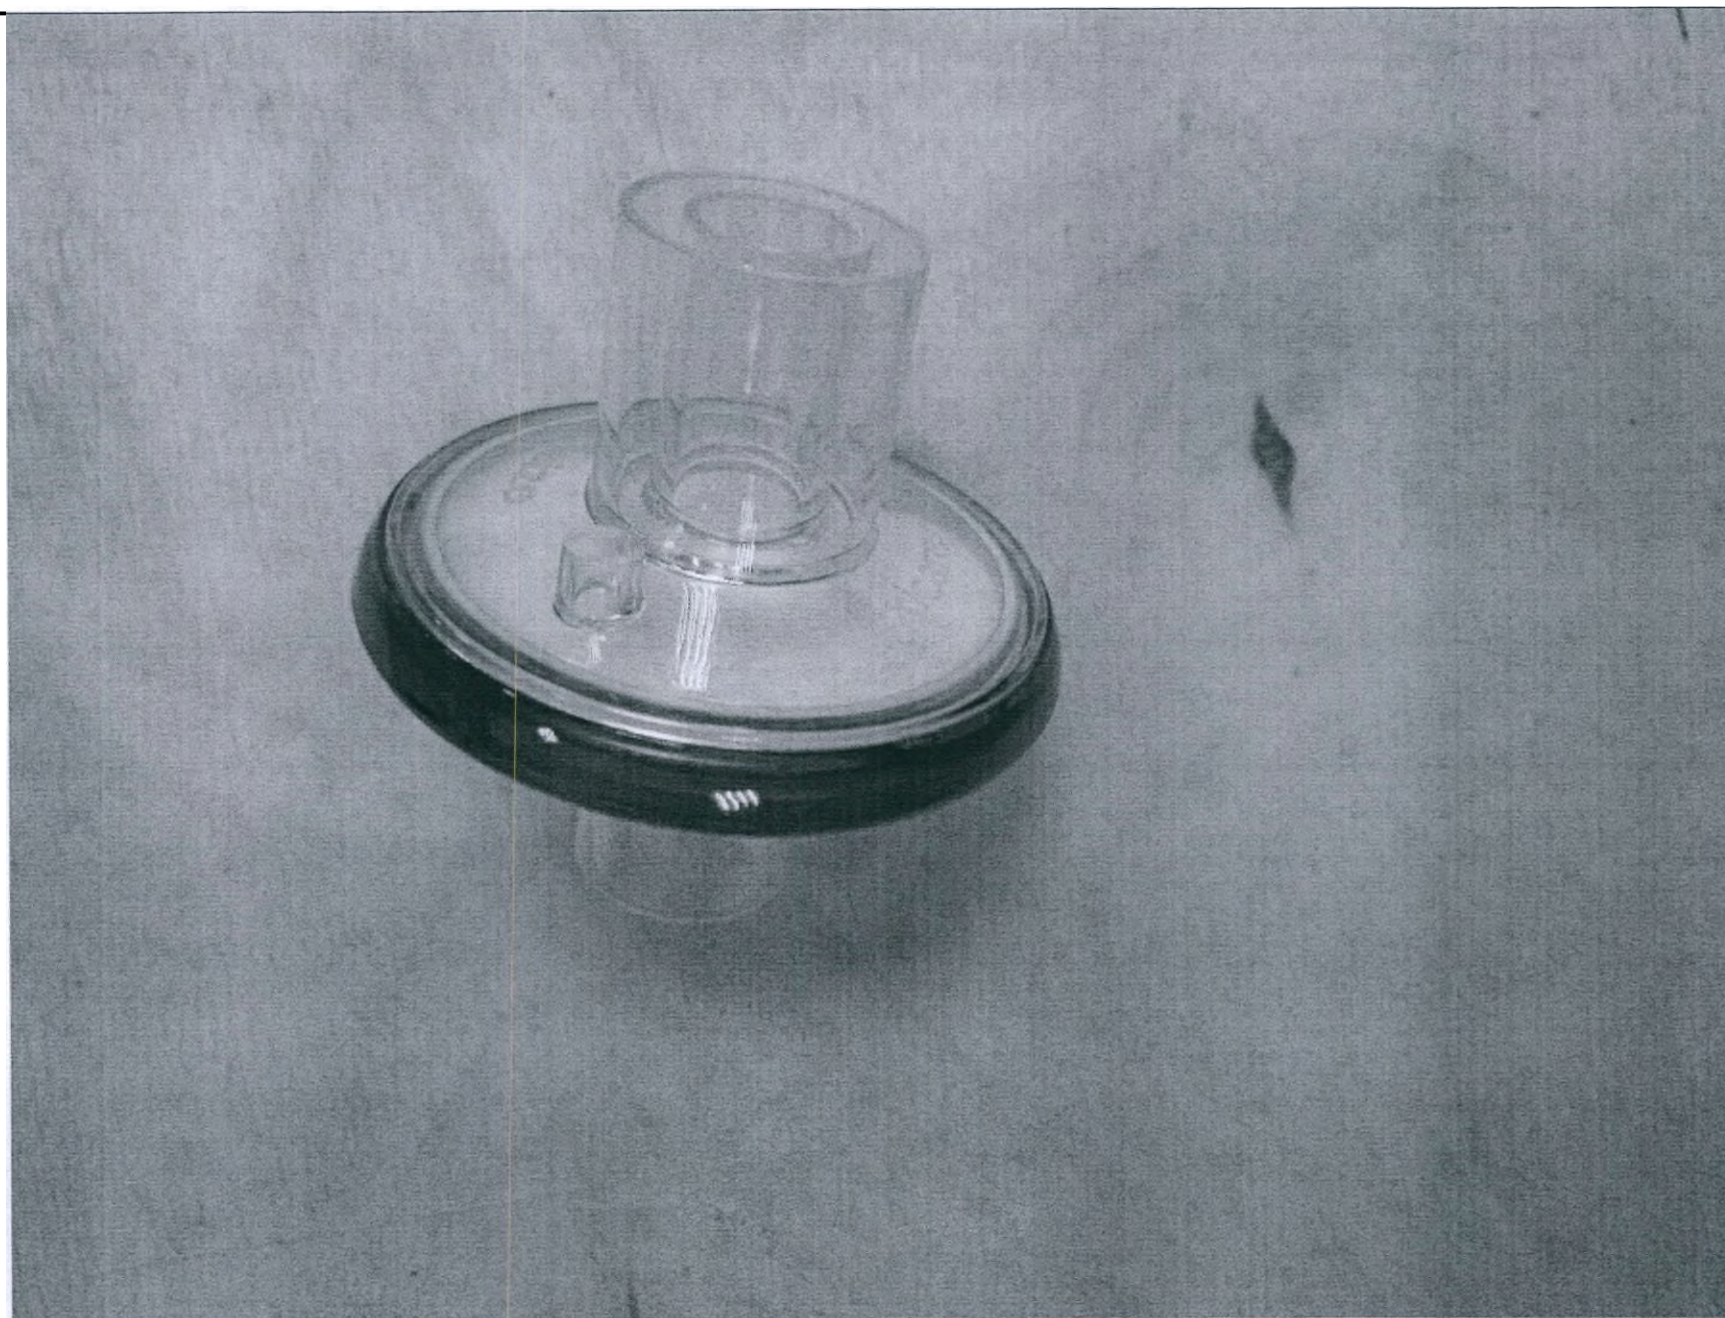

2.4. Бактериальный фильтр, 1 упаковка (50 шт.)




2.5. Увлажнитель Aqua TREND uni




2.6. Адаптер подключения O2, прямой



2.7. Адаптер подключения O2, угловой

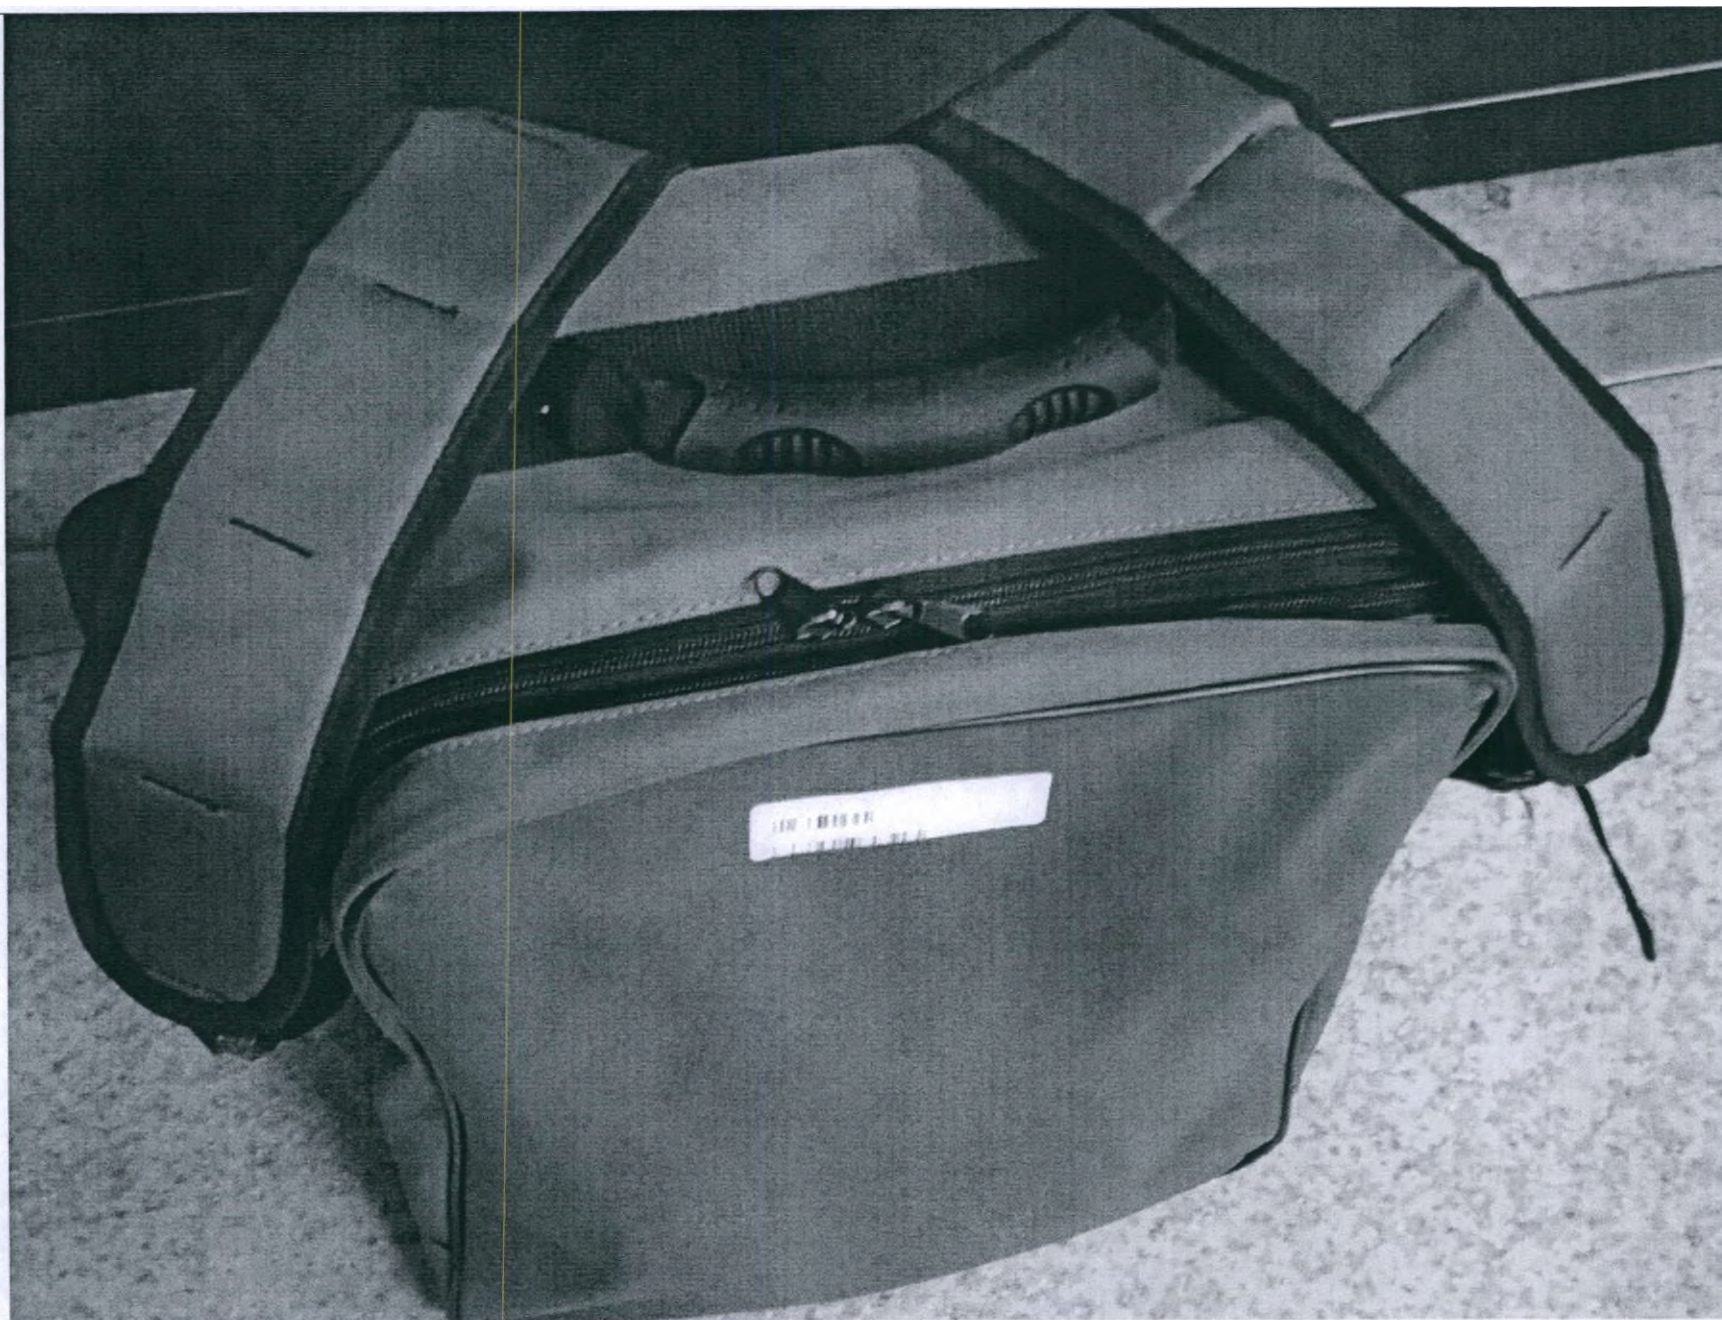

2.8. Чехол для переносок

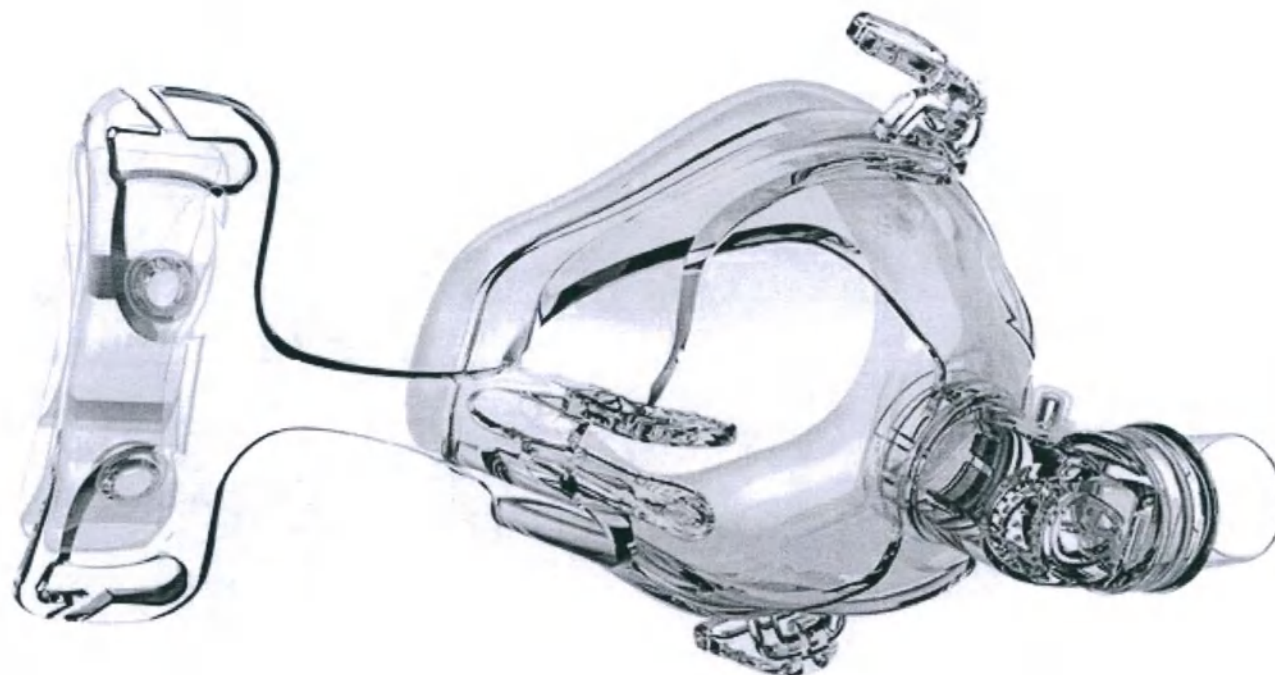

2.9. Маски, модели: 00003551, 00003452, 00003498




2.9. Маски, модели: 00003497, 00003486, 00003487, 00003488



2.9. Маски, модели: 00003483, 00003484, 00003485




2.9. Маски, модели: 00003441, 00003436, 00003437

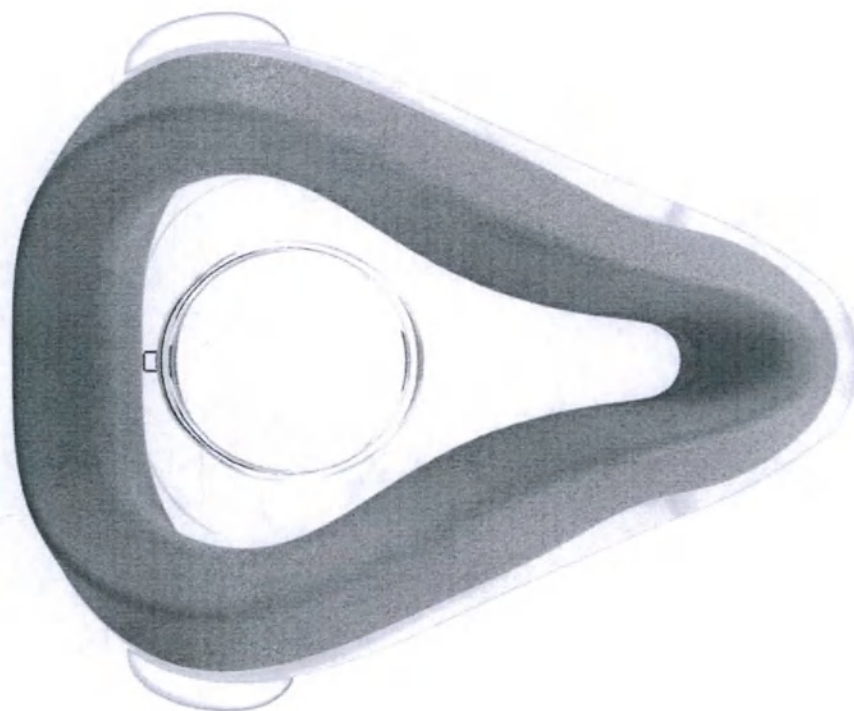


2.9. Маски, модели: 00003435, 00003499




2.9. Маски, модели: 00003440, 00003434, 00003435

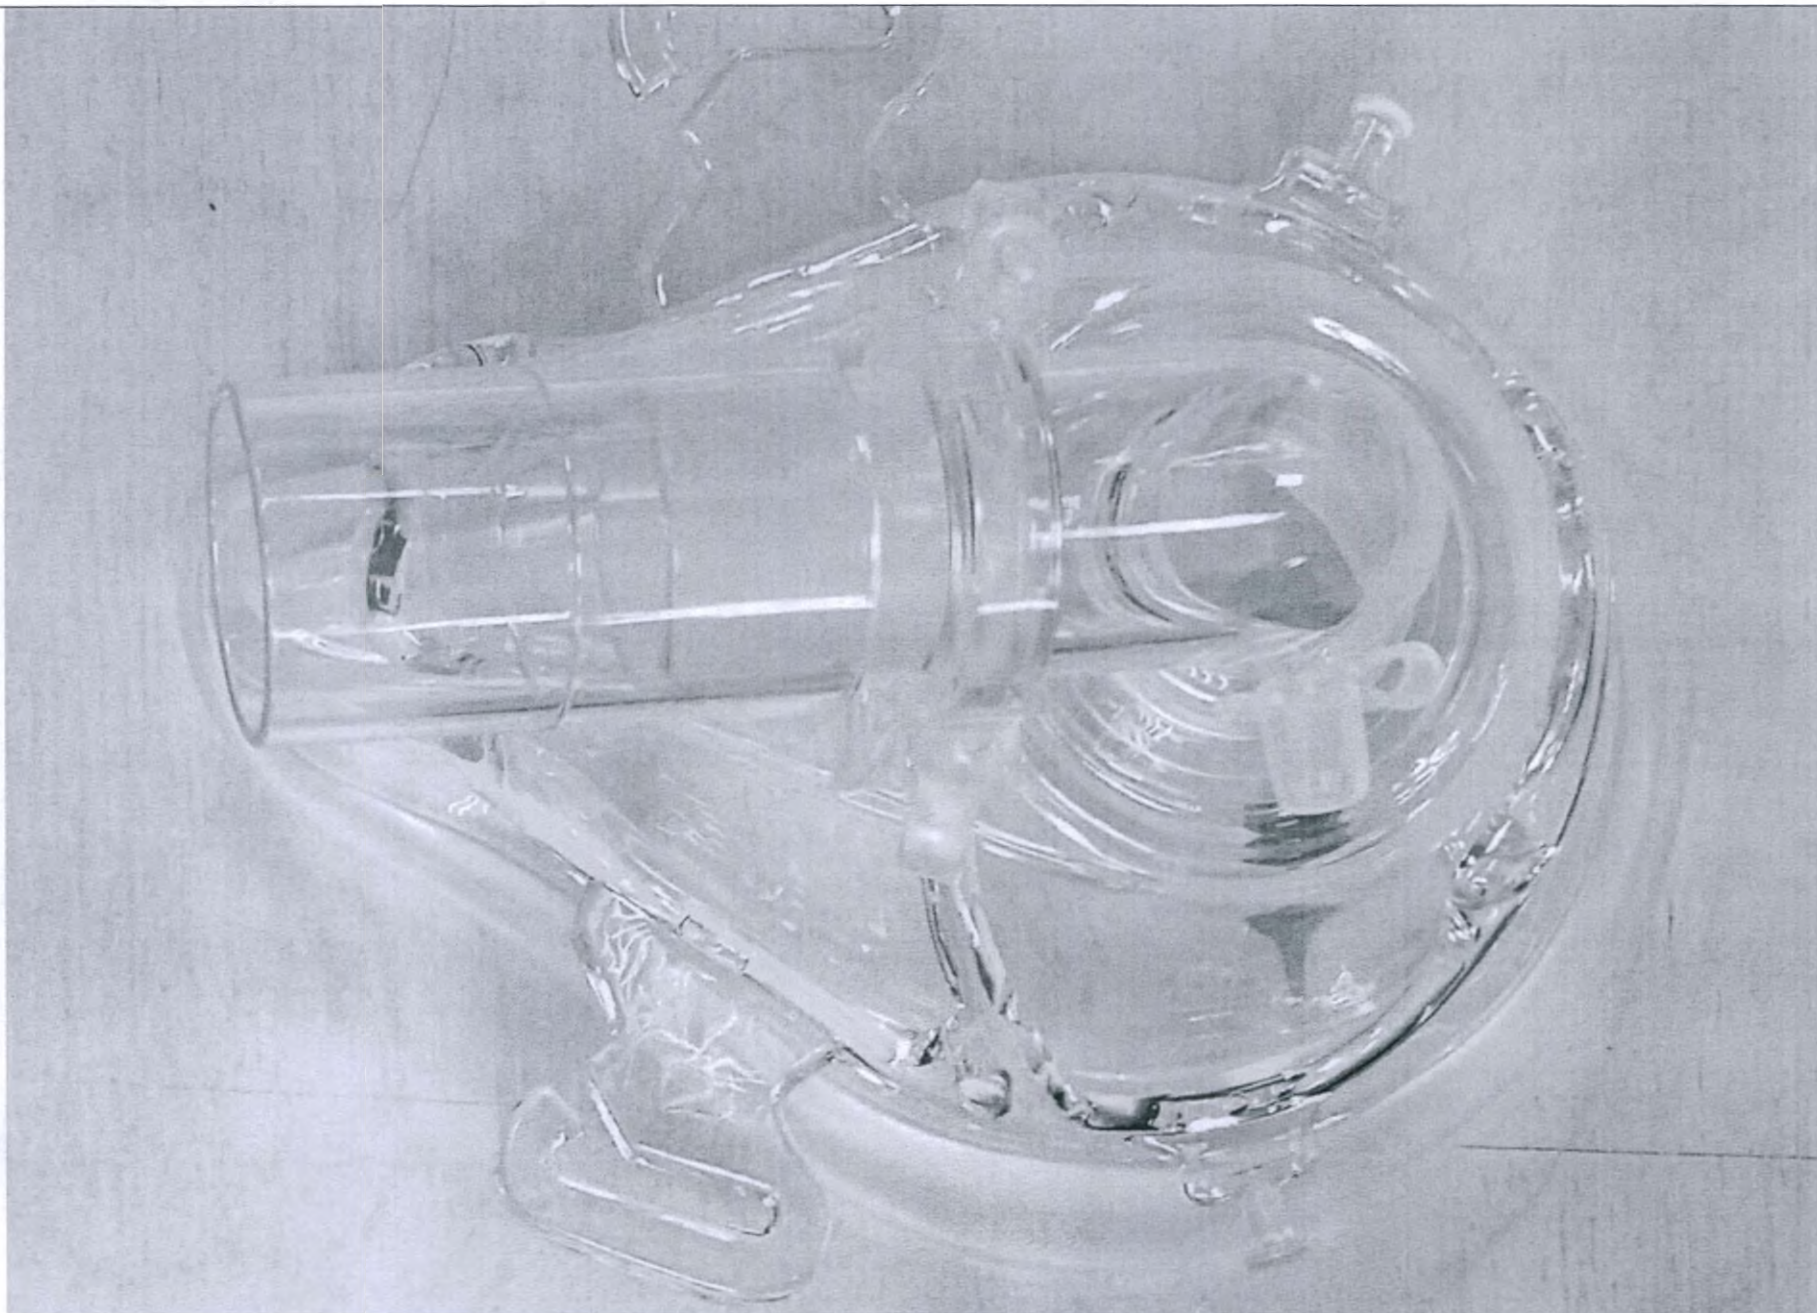

2.9. Маска, модели: 00003461, 00003442, 00003438, 00003462, 00003439

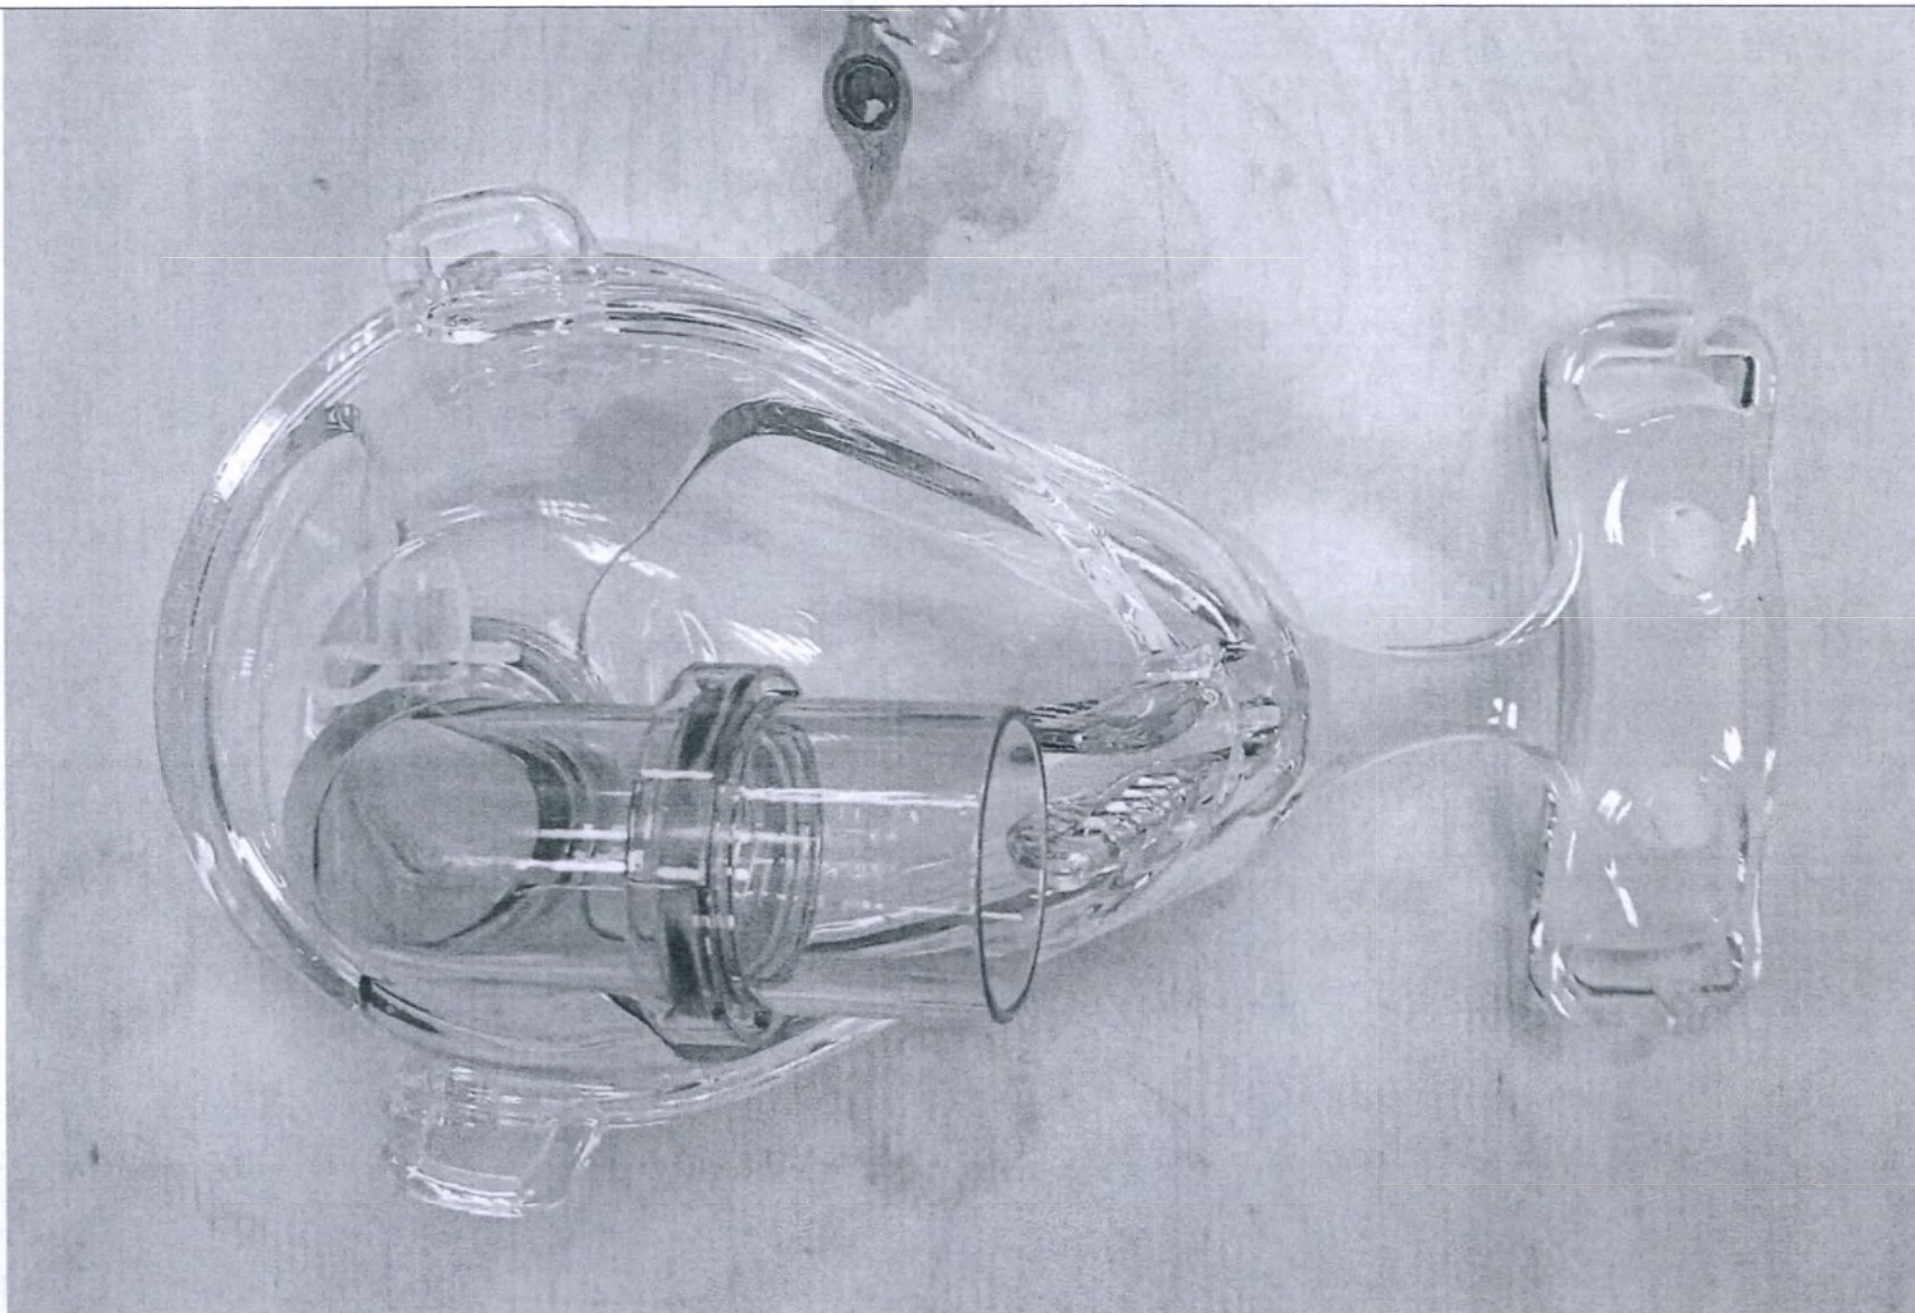

2.9. Маска, модели: 00003489, 00003490, 00003491

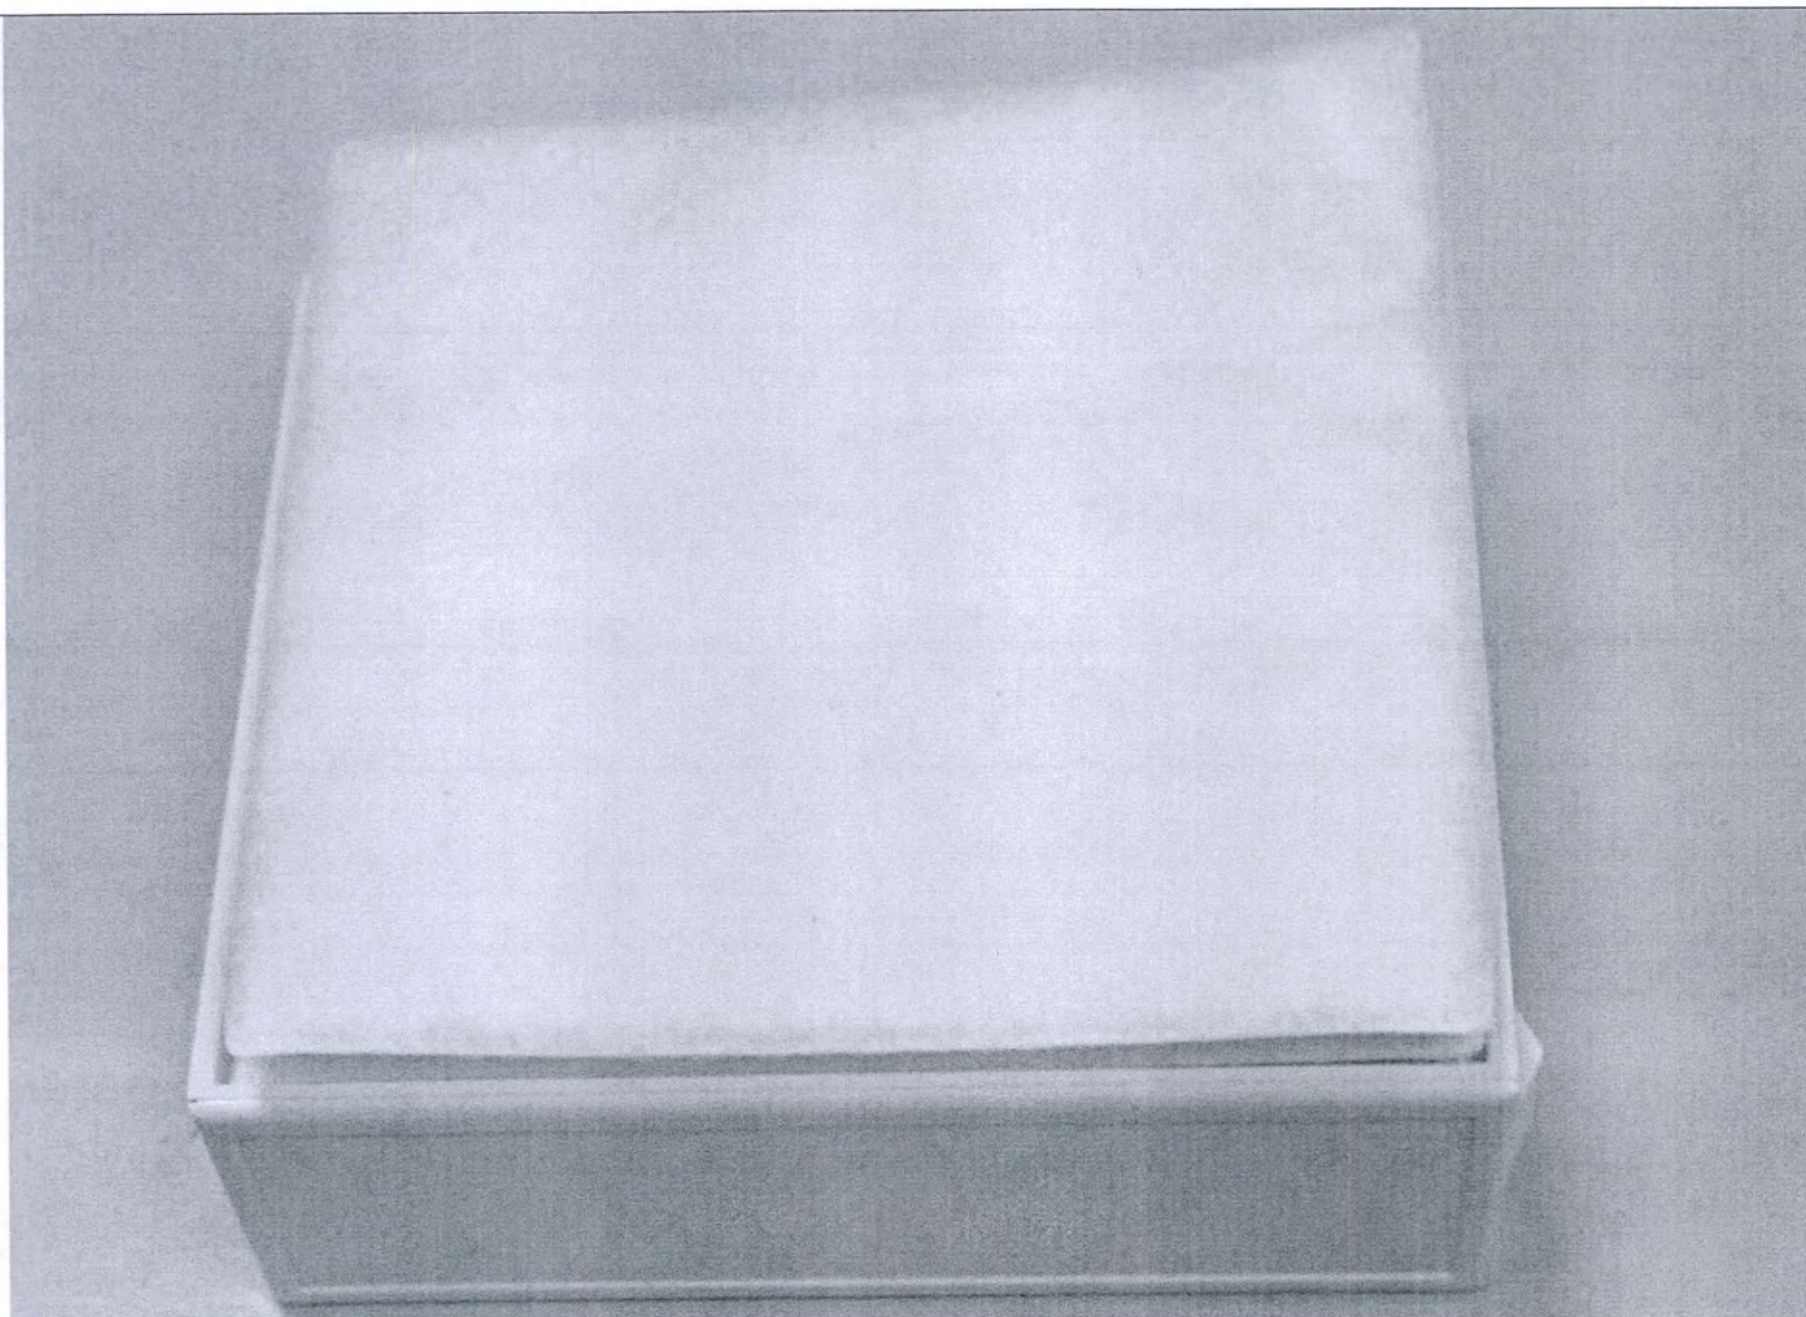


2.10. Запасной фильтр тонкой очистки, 1 упаковка (5 штук)



2.11. Датчик FiO_2



2.12. Пульт

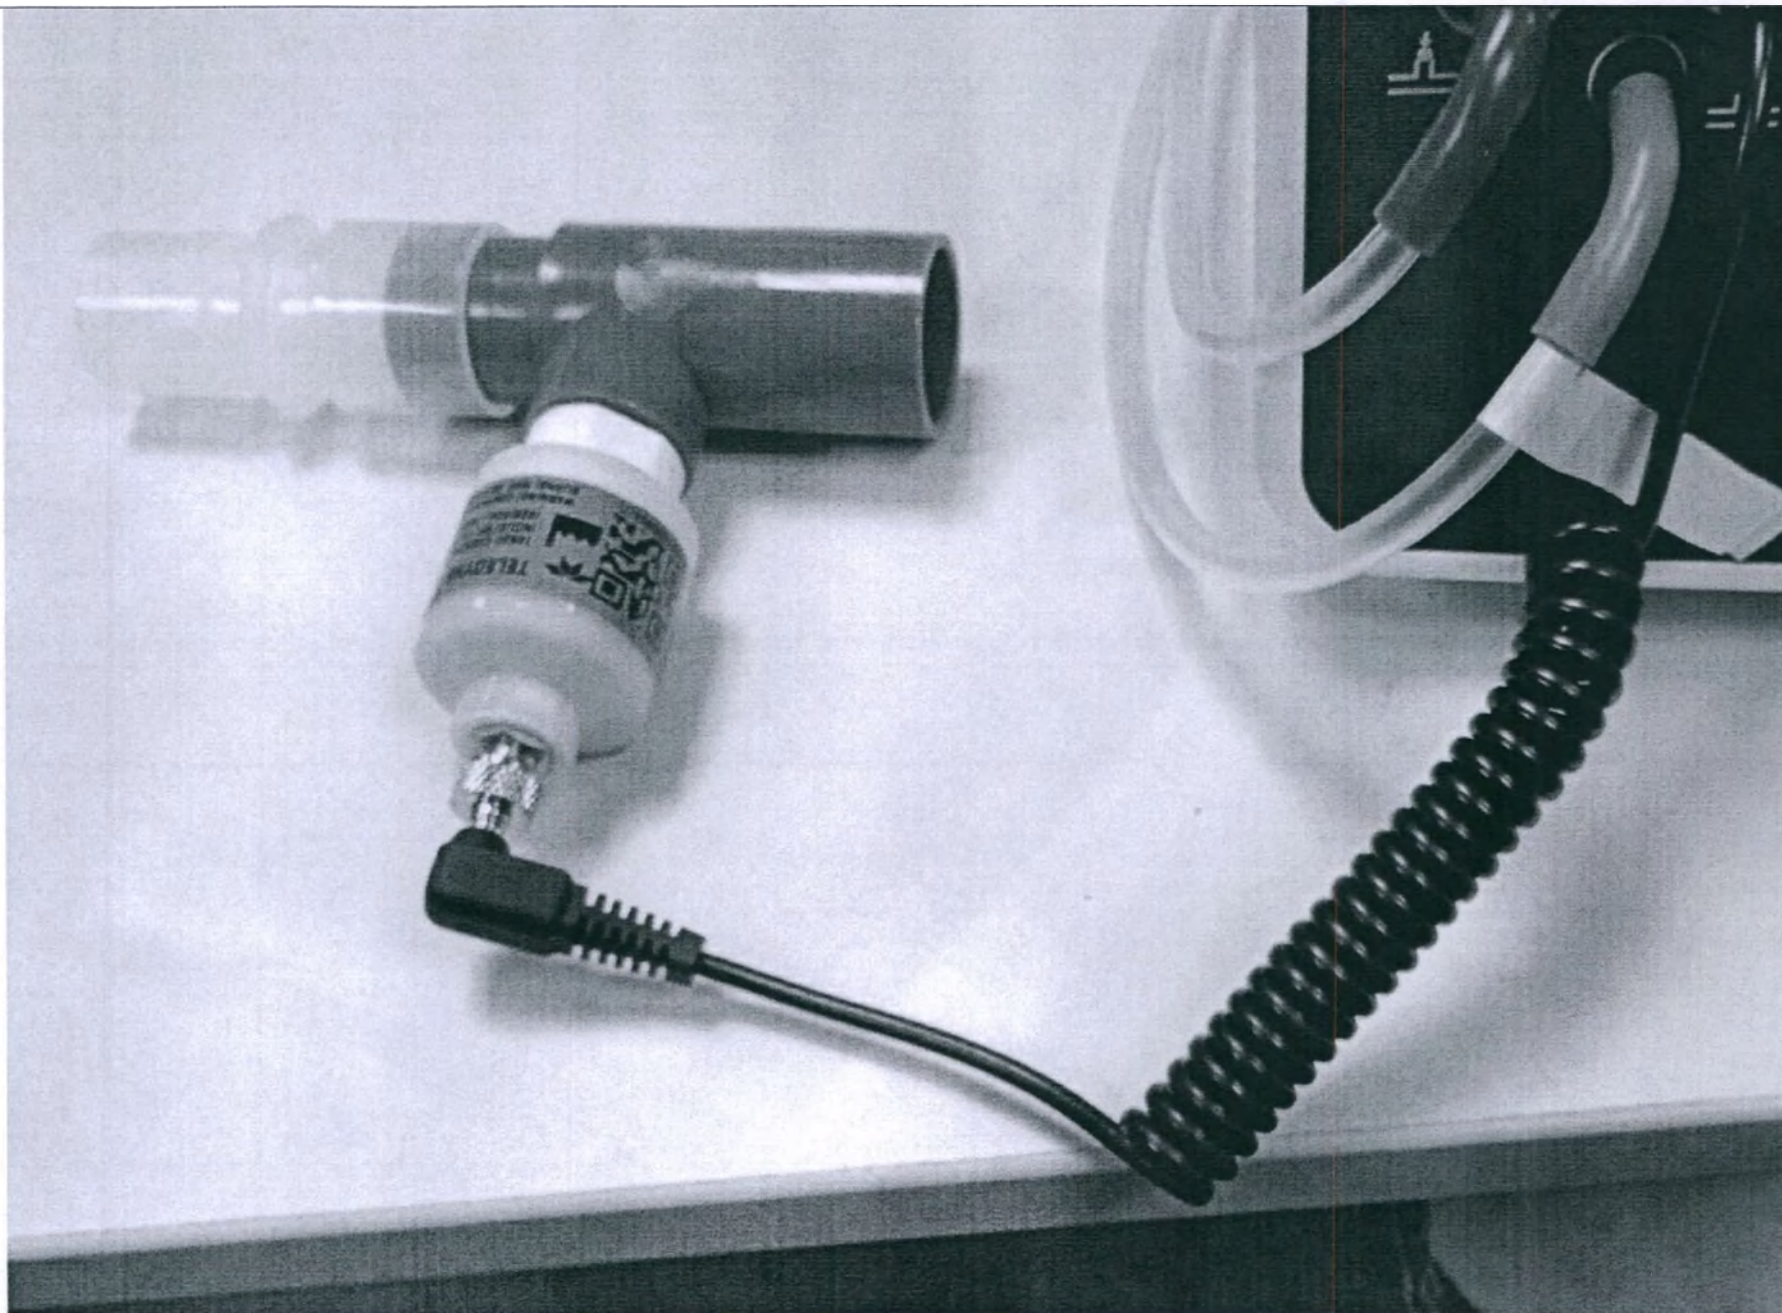

2.13. Адаптер прямого соединения FiO₂ (Комплект для измерения FiO₂, состоящий из FiO₂, датчика, Т-адаптера, адаптера датчика FiO₂, соединительной линии FiO₂-датчик с винтовым соединением)



3.1. Аппарат ИВЛ LAVI 45, основной блок



3.2. Импульсный блок питания




3.3. Держатель блока питания со встроенным сбросом напряжения

Сетевой шнур



3.4. Сетевой шнур

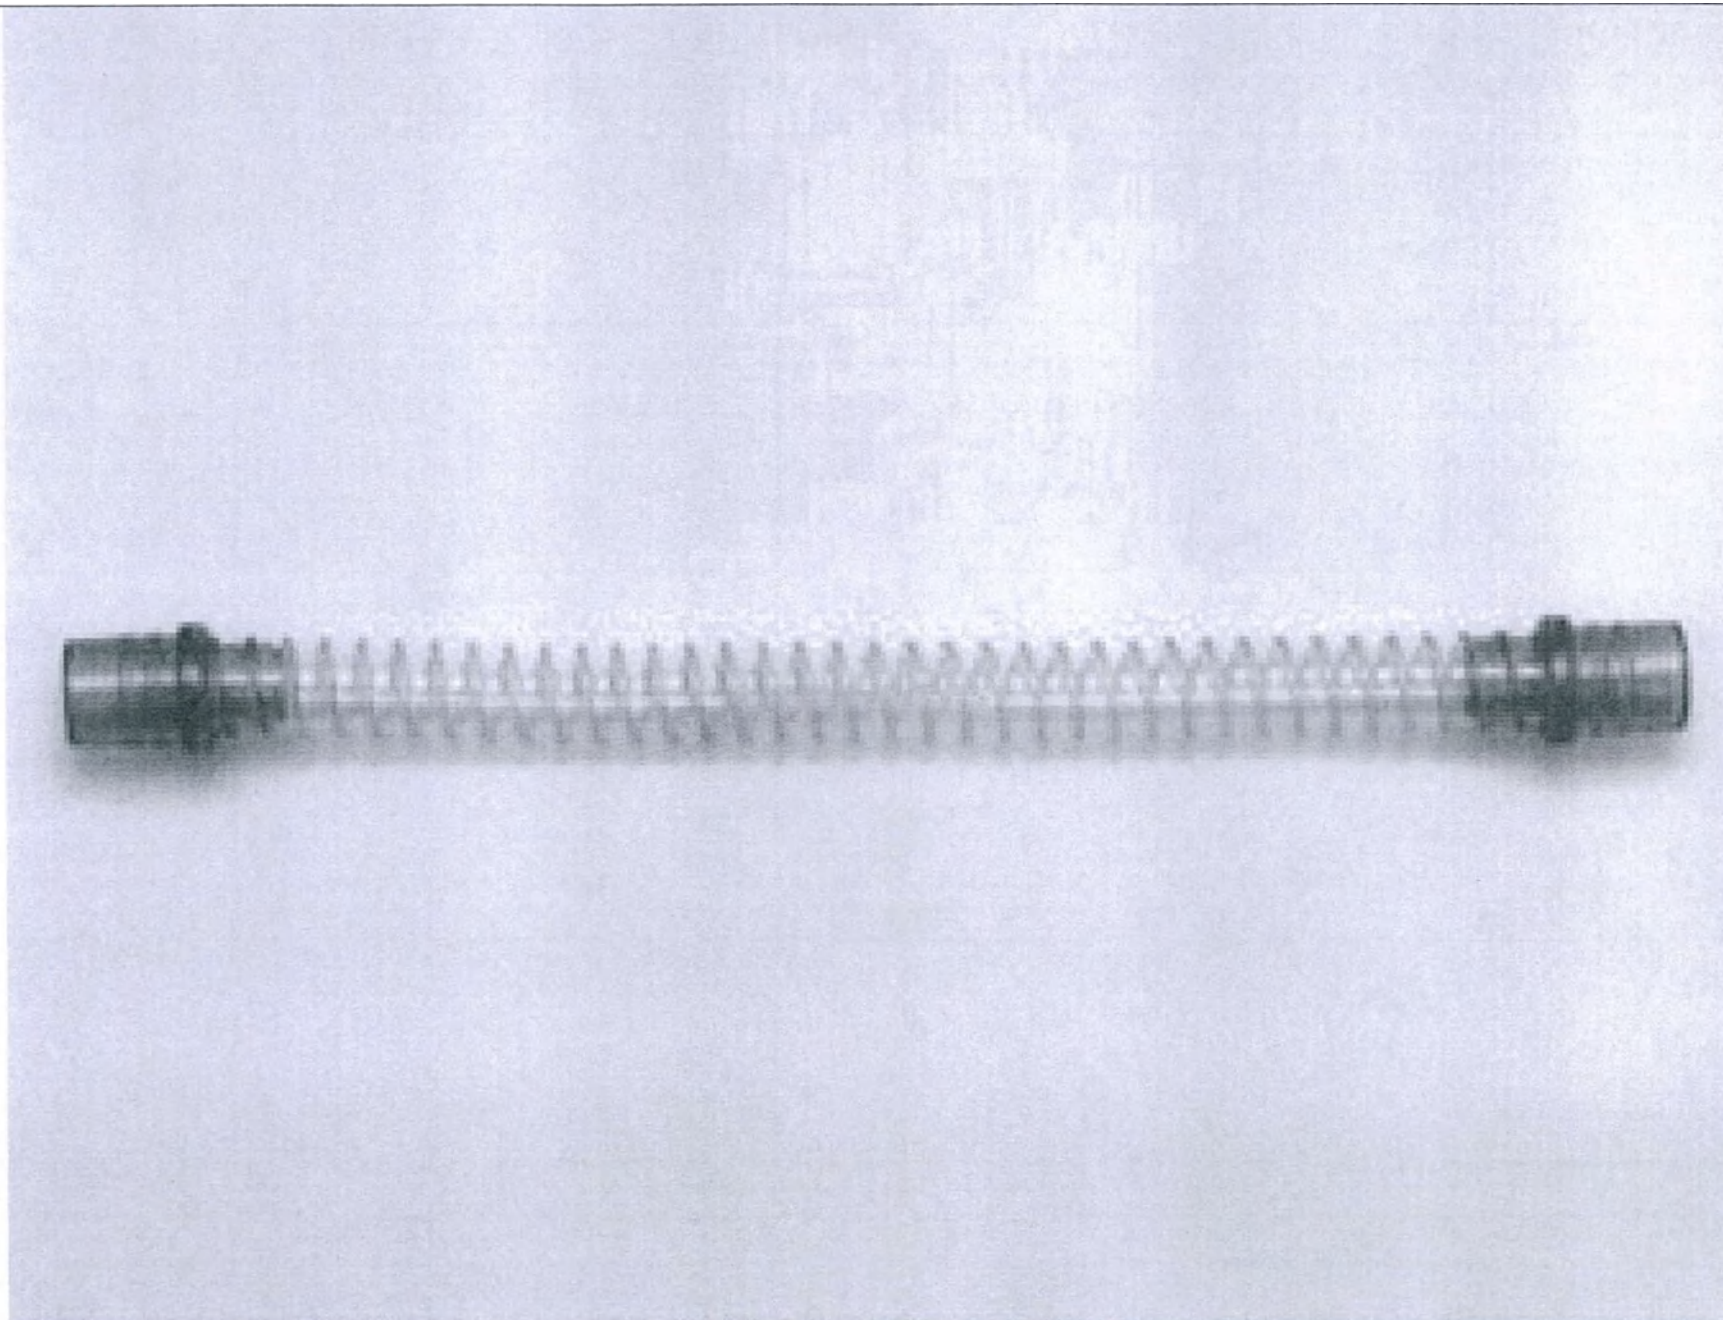


3.5. Трубка вывода контура



Запасная
фильтрующая
кассета открытая


3.6. Запасная фильтрующая кассета, полная (открытая) с фильтрами

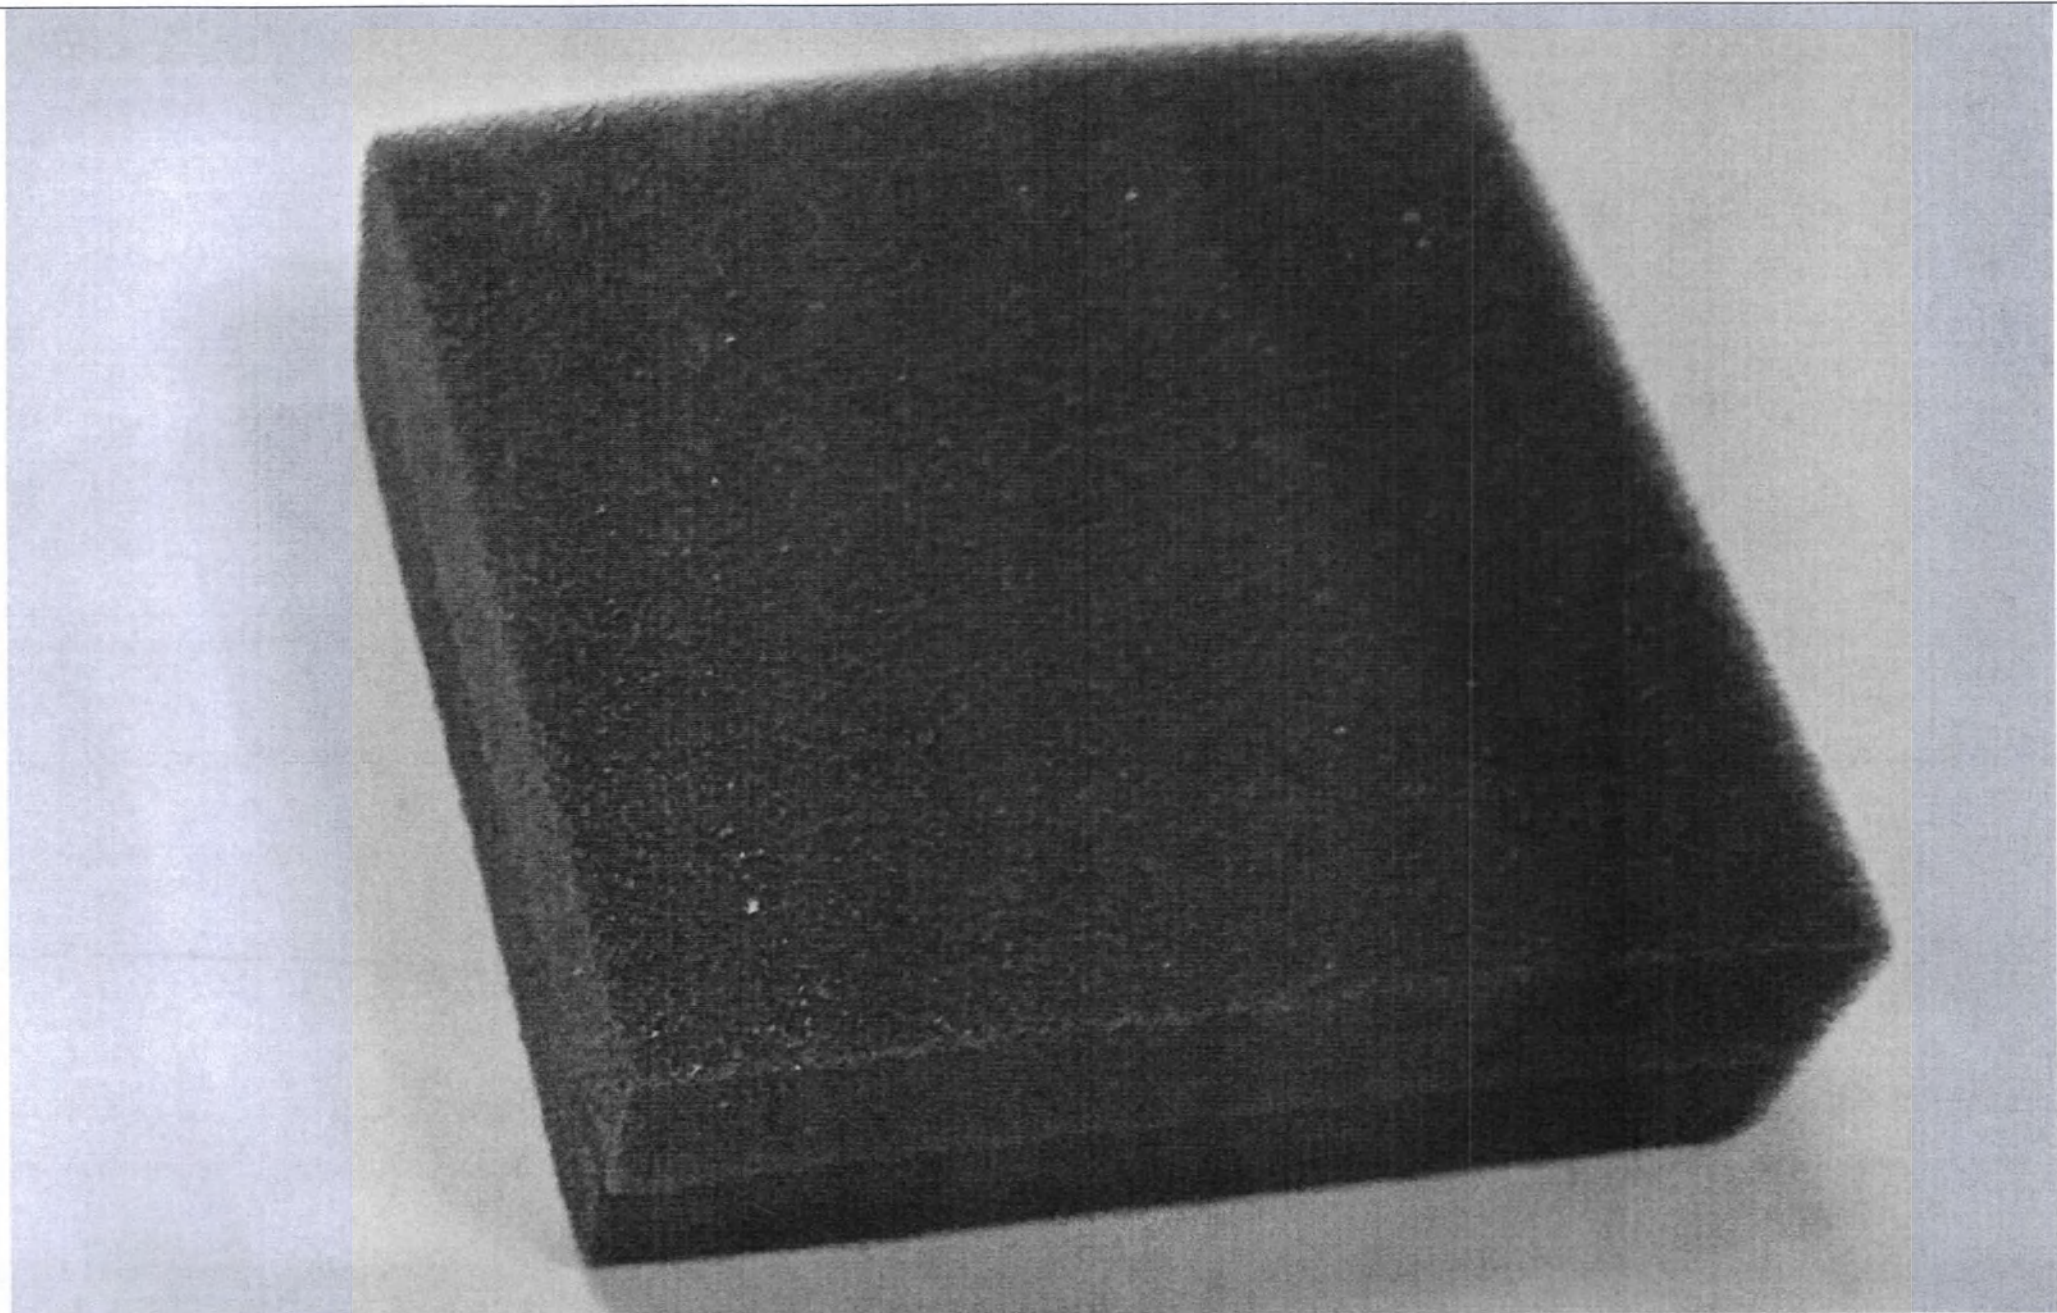

3.7. Запасной фильтр грубой очистки, 1 упаковка (2 штуки)




3.8. SD –карта

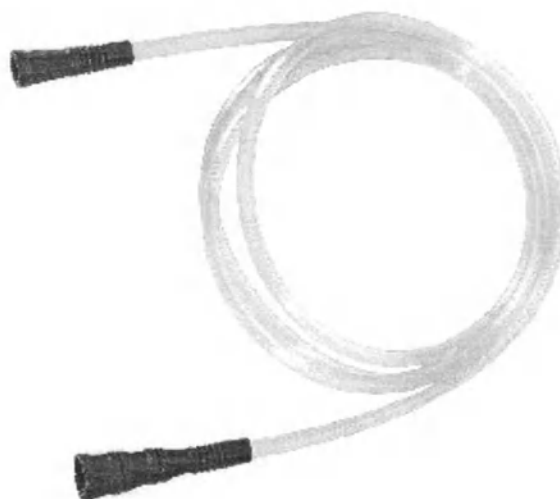


4.1. Система утечки трубок



4.2. Подогреваемая трубка утечки Система ComfortTube

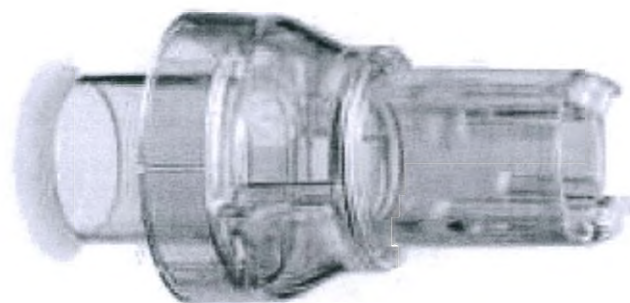

4.3. Пассивный клапан выдоха

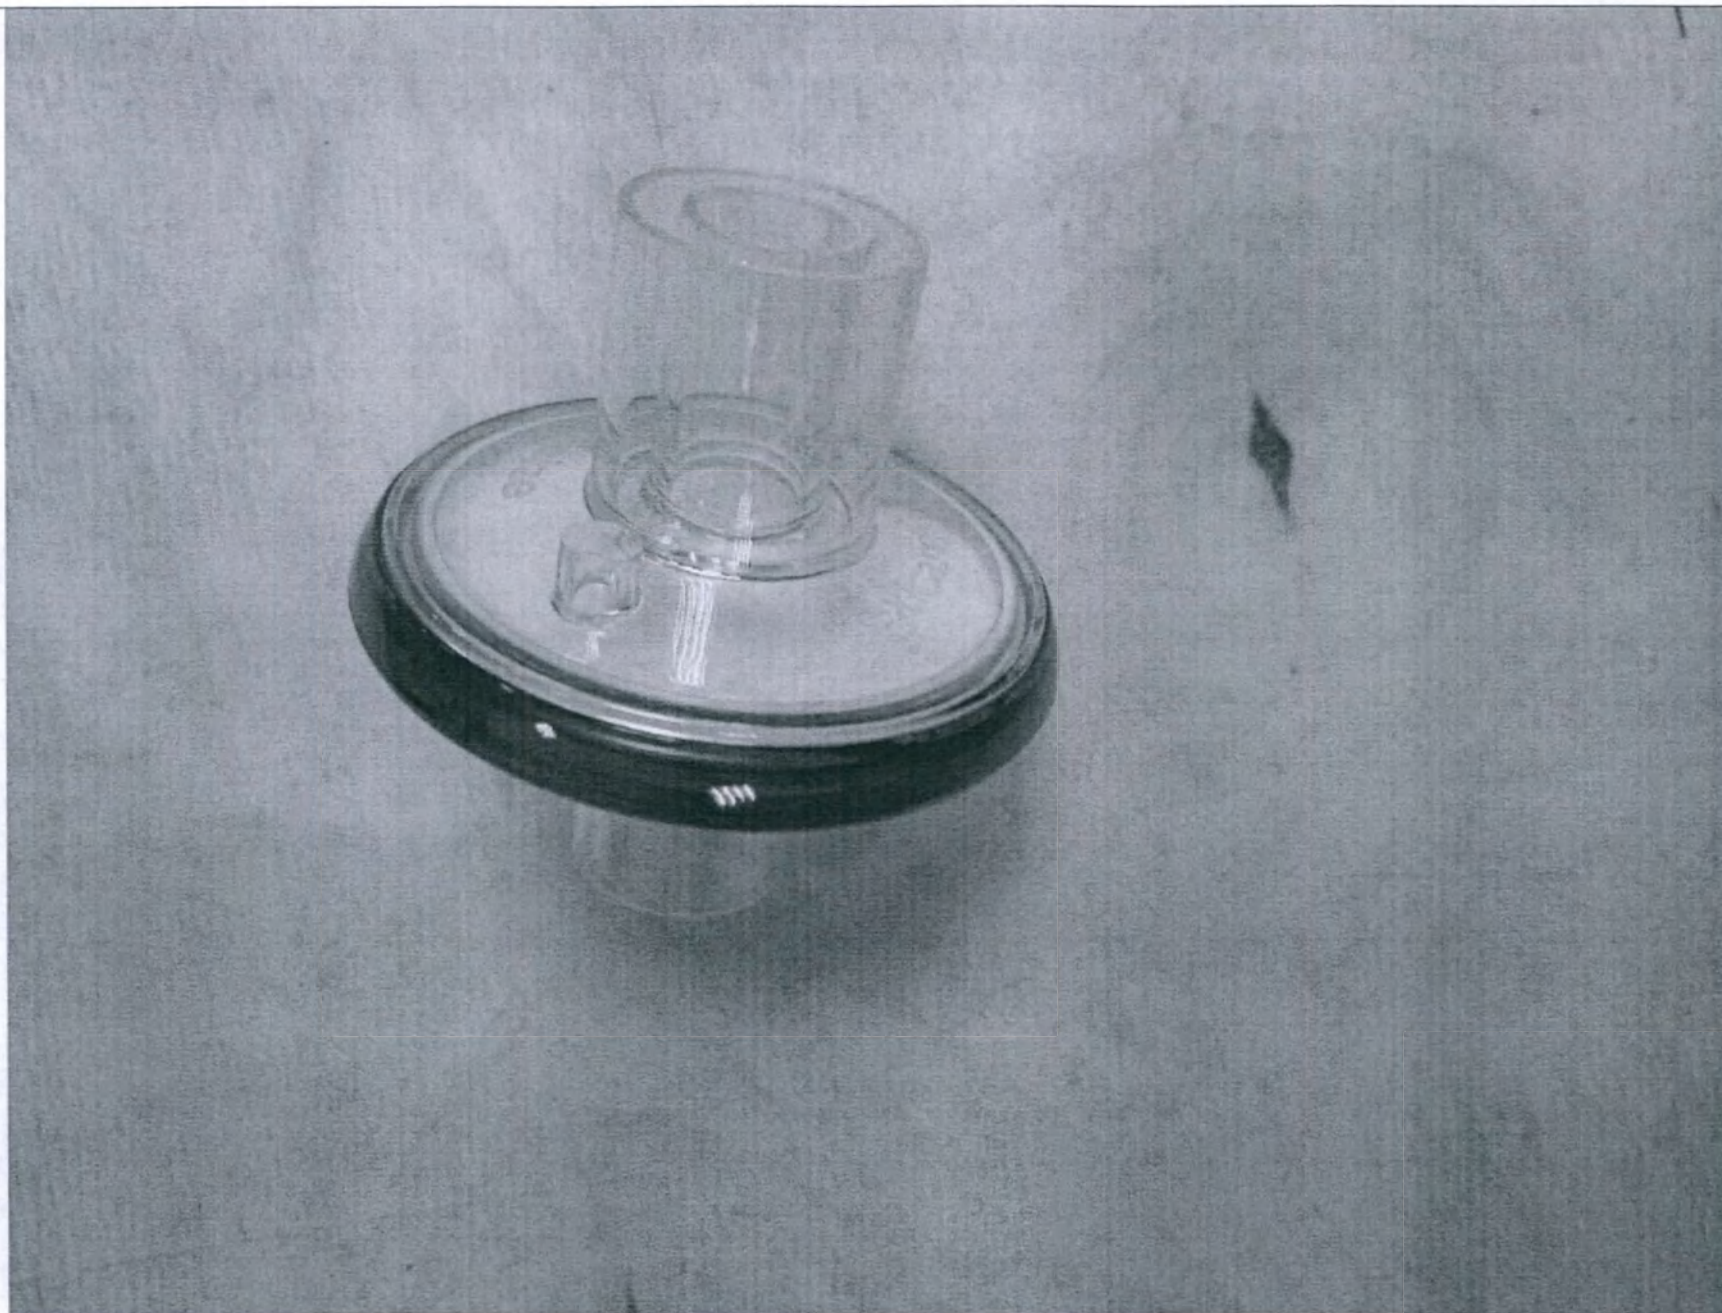

4.4. Бактериальный фильтр, 1 упаковка (50 шт.)




4.5. Увлажнитель Aqua TREND uni




4.6. Адаптер подключения O2, прямой




4.7. Адаптер подключения O2, угловой

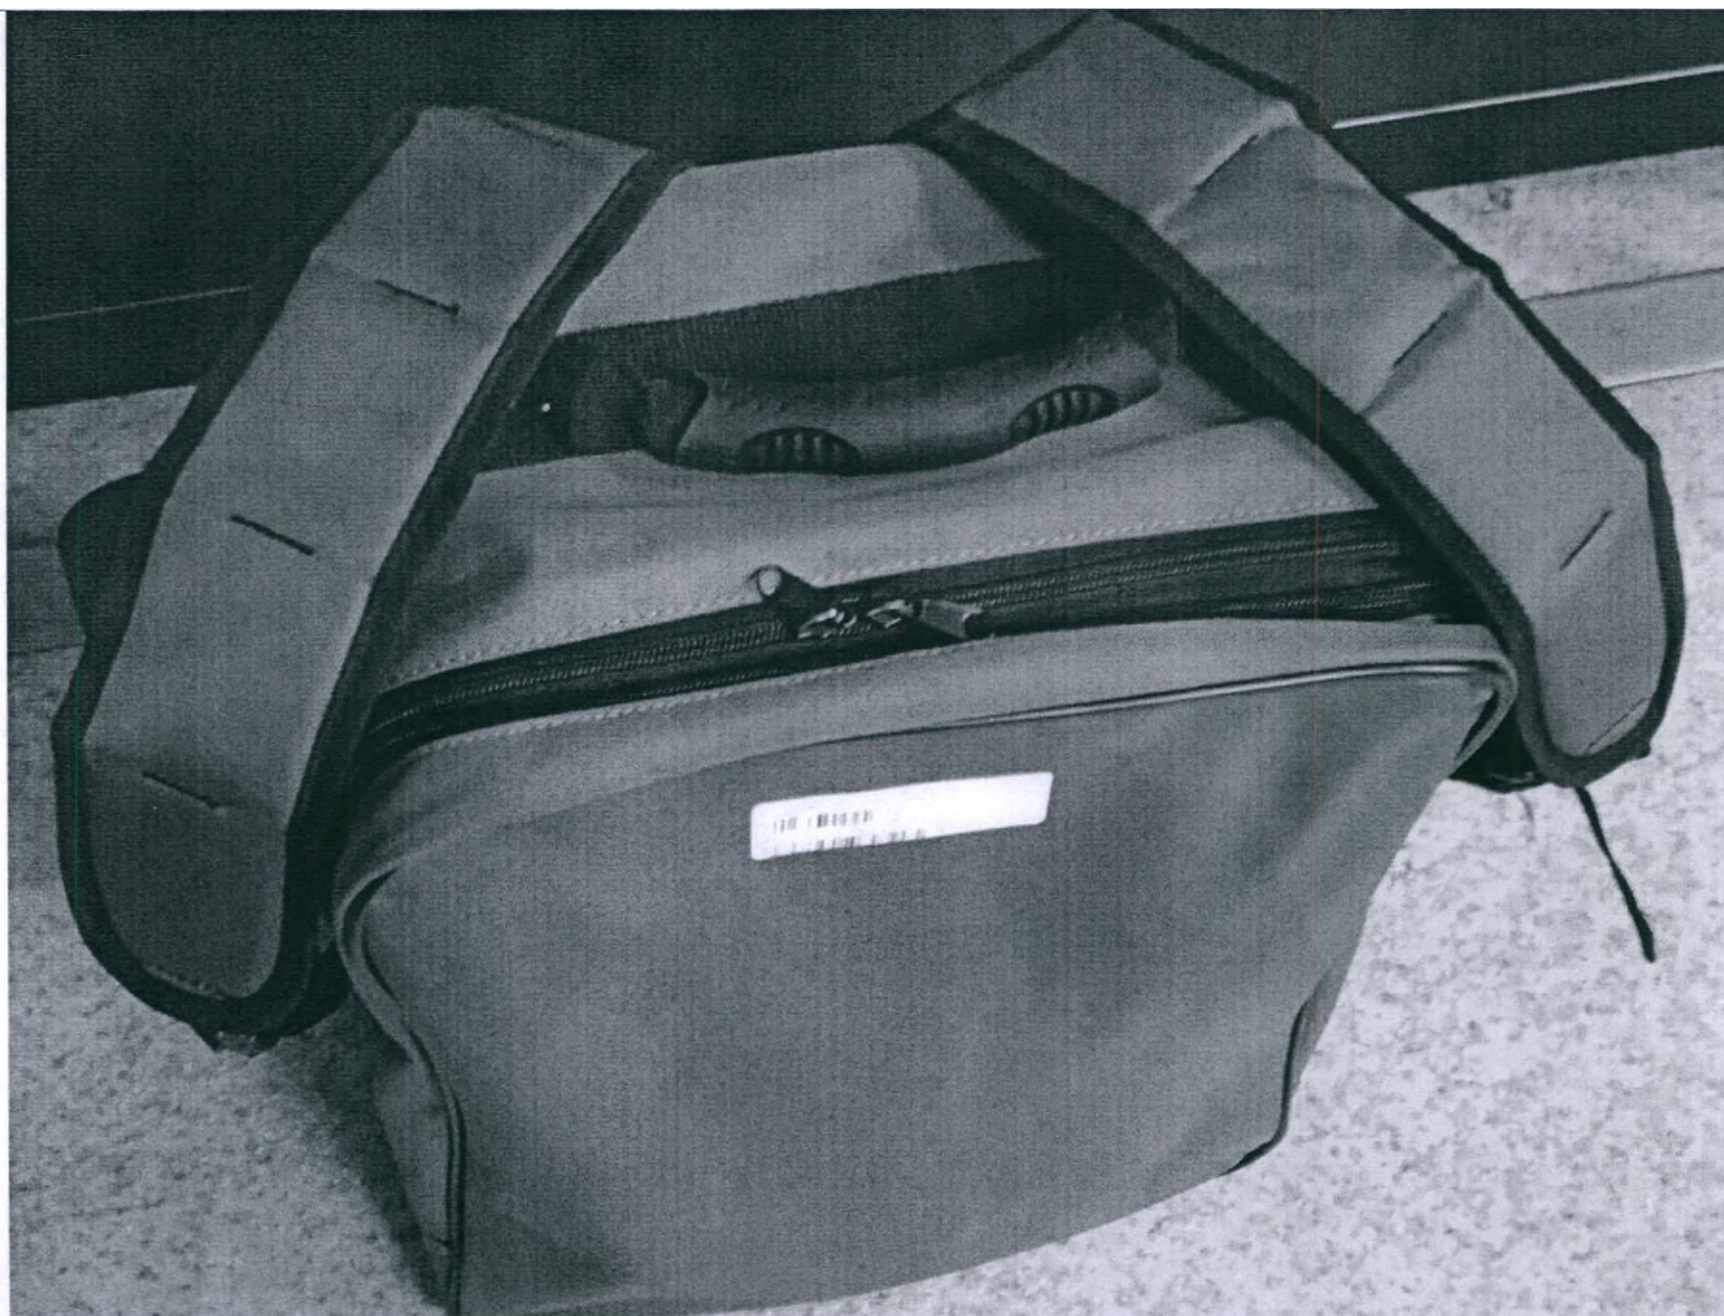

4.8. Чехол для переносок

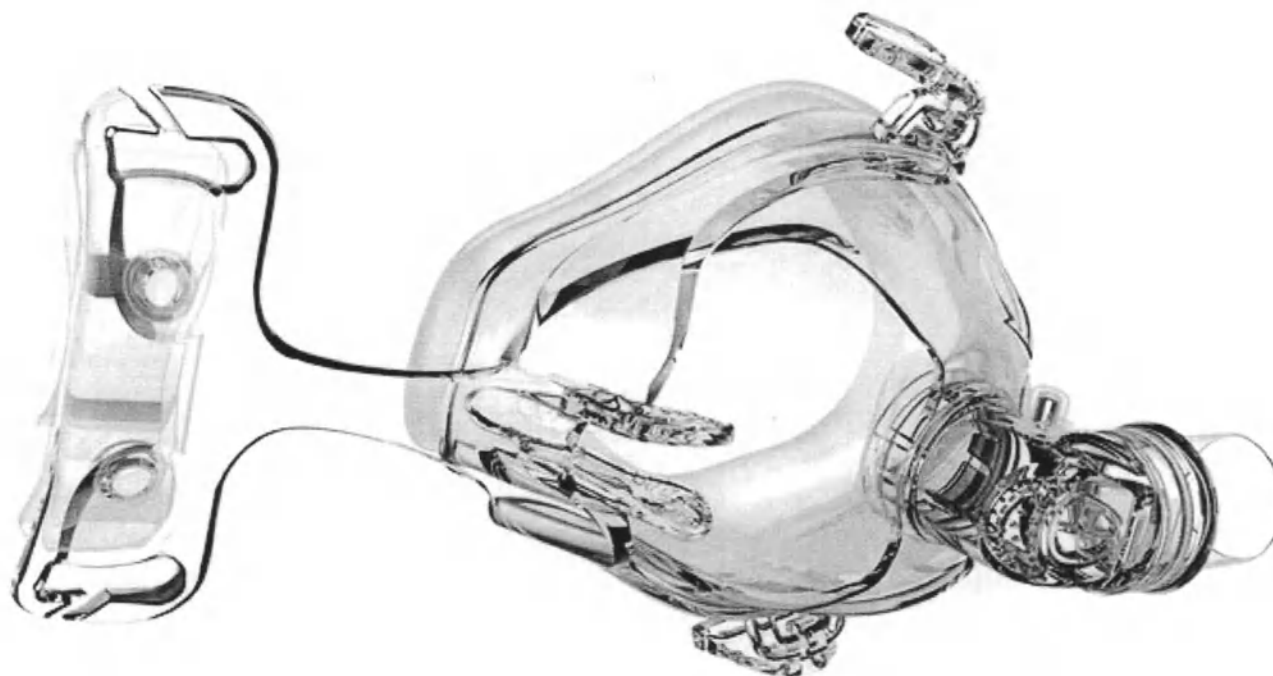

4.9. Маски, модели: 00003551, 00003452, 00003498

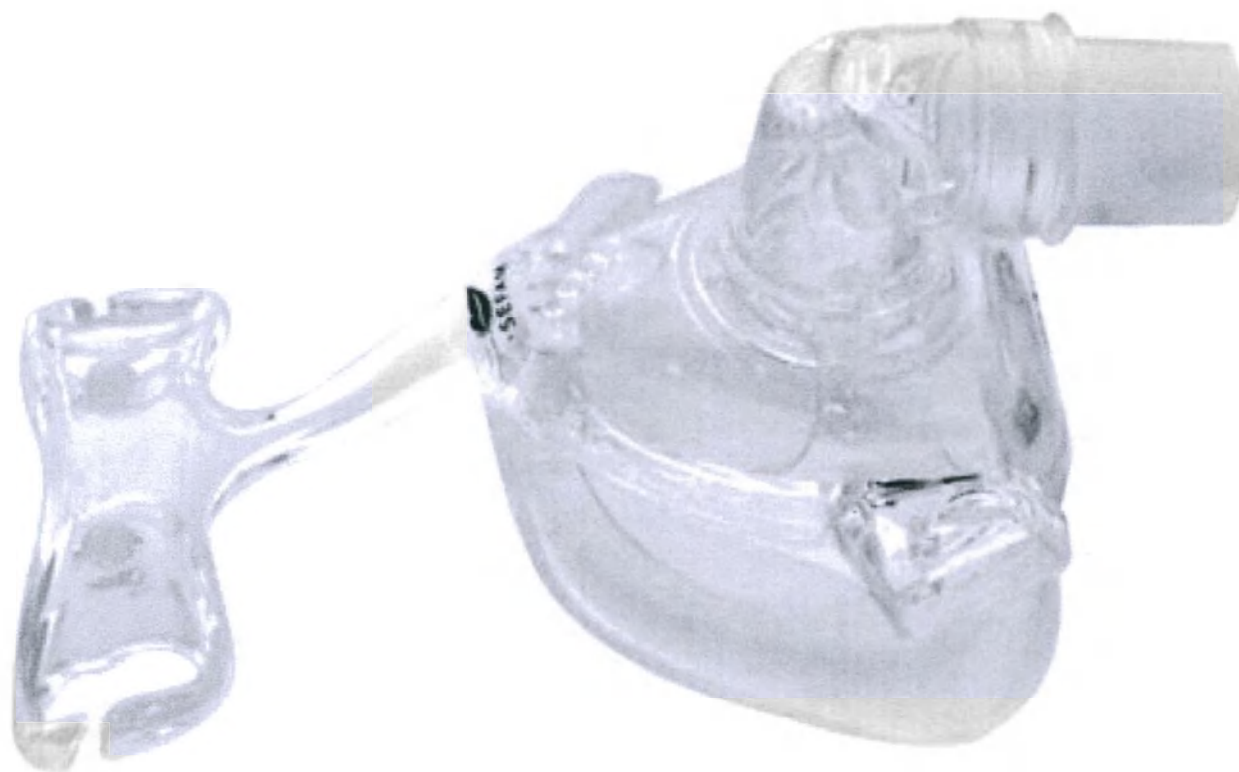


4.9. Маски, модели: 00003497, 00003486, 00003487, 00003488



4.9. Маски, модели: 00003483, 00003484, 00003485




4.9. Маски, модели: 00003441, 00003436, 00003437

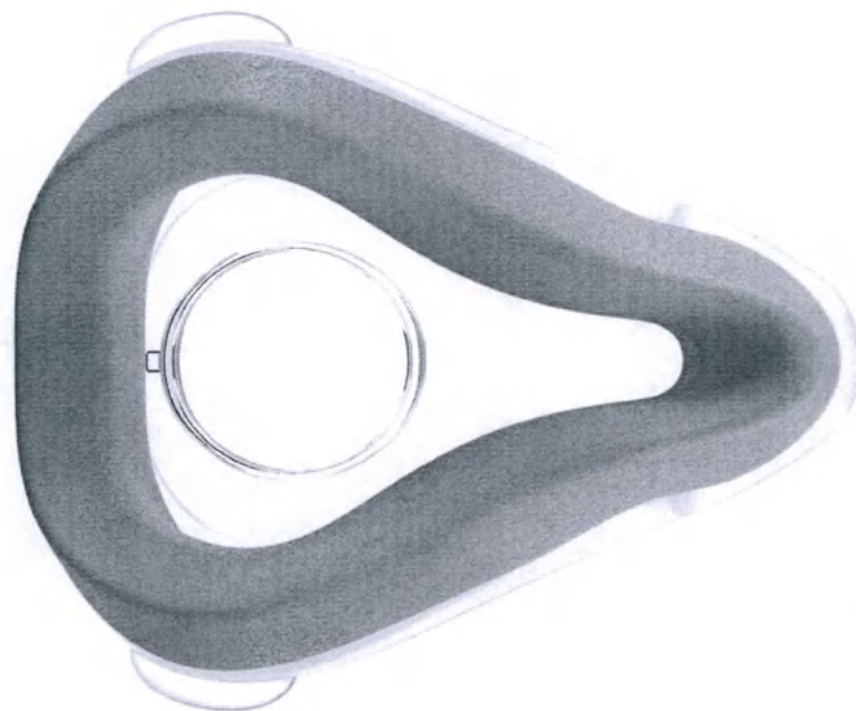


4.9. Маски, модели: 00003435, 00003499



4.9. Маски, модели: 00003440, 00003434, 00003435

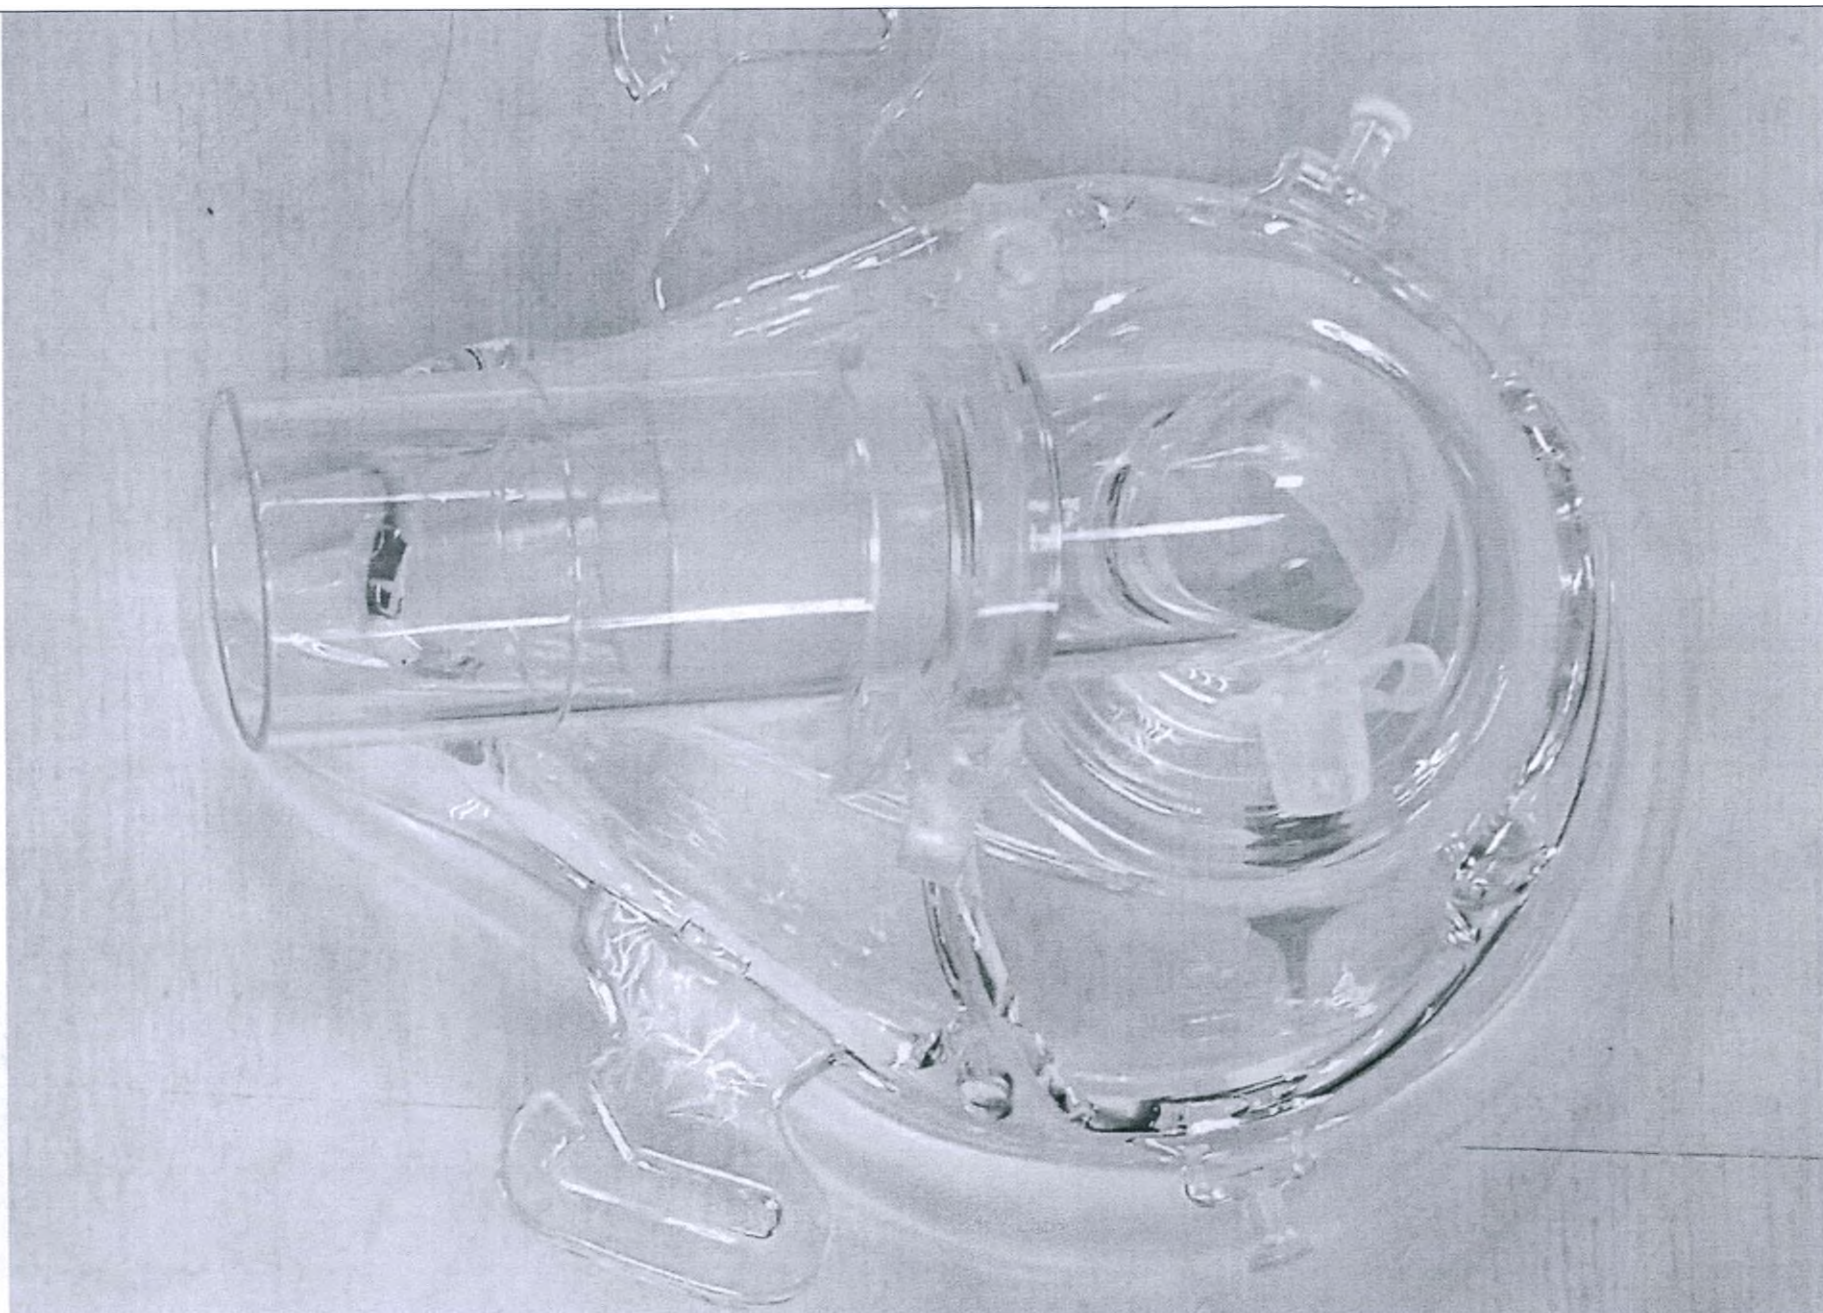


4.9. Маска, модели: 00003461, 00003442, 00003438, 00003462, 00003439

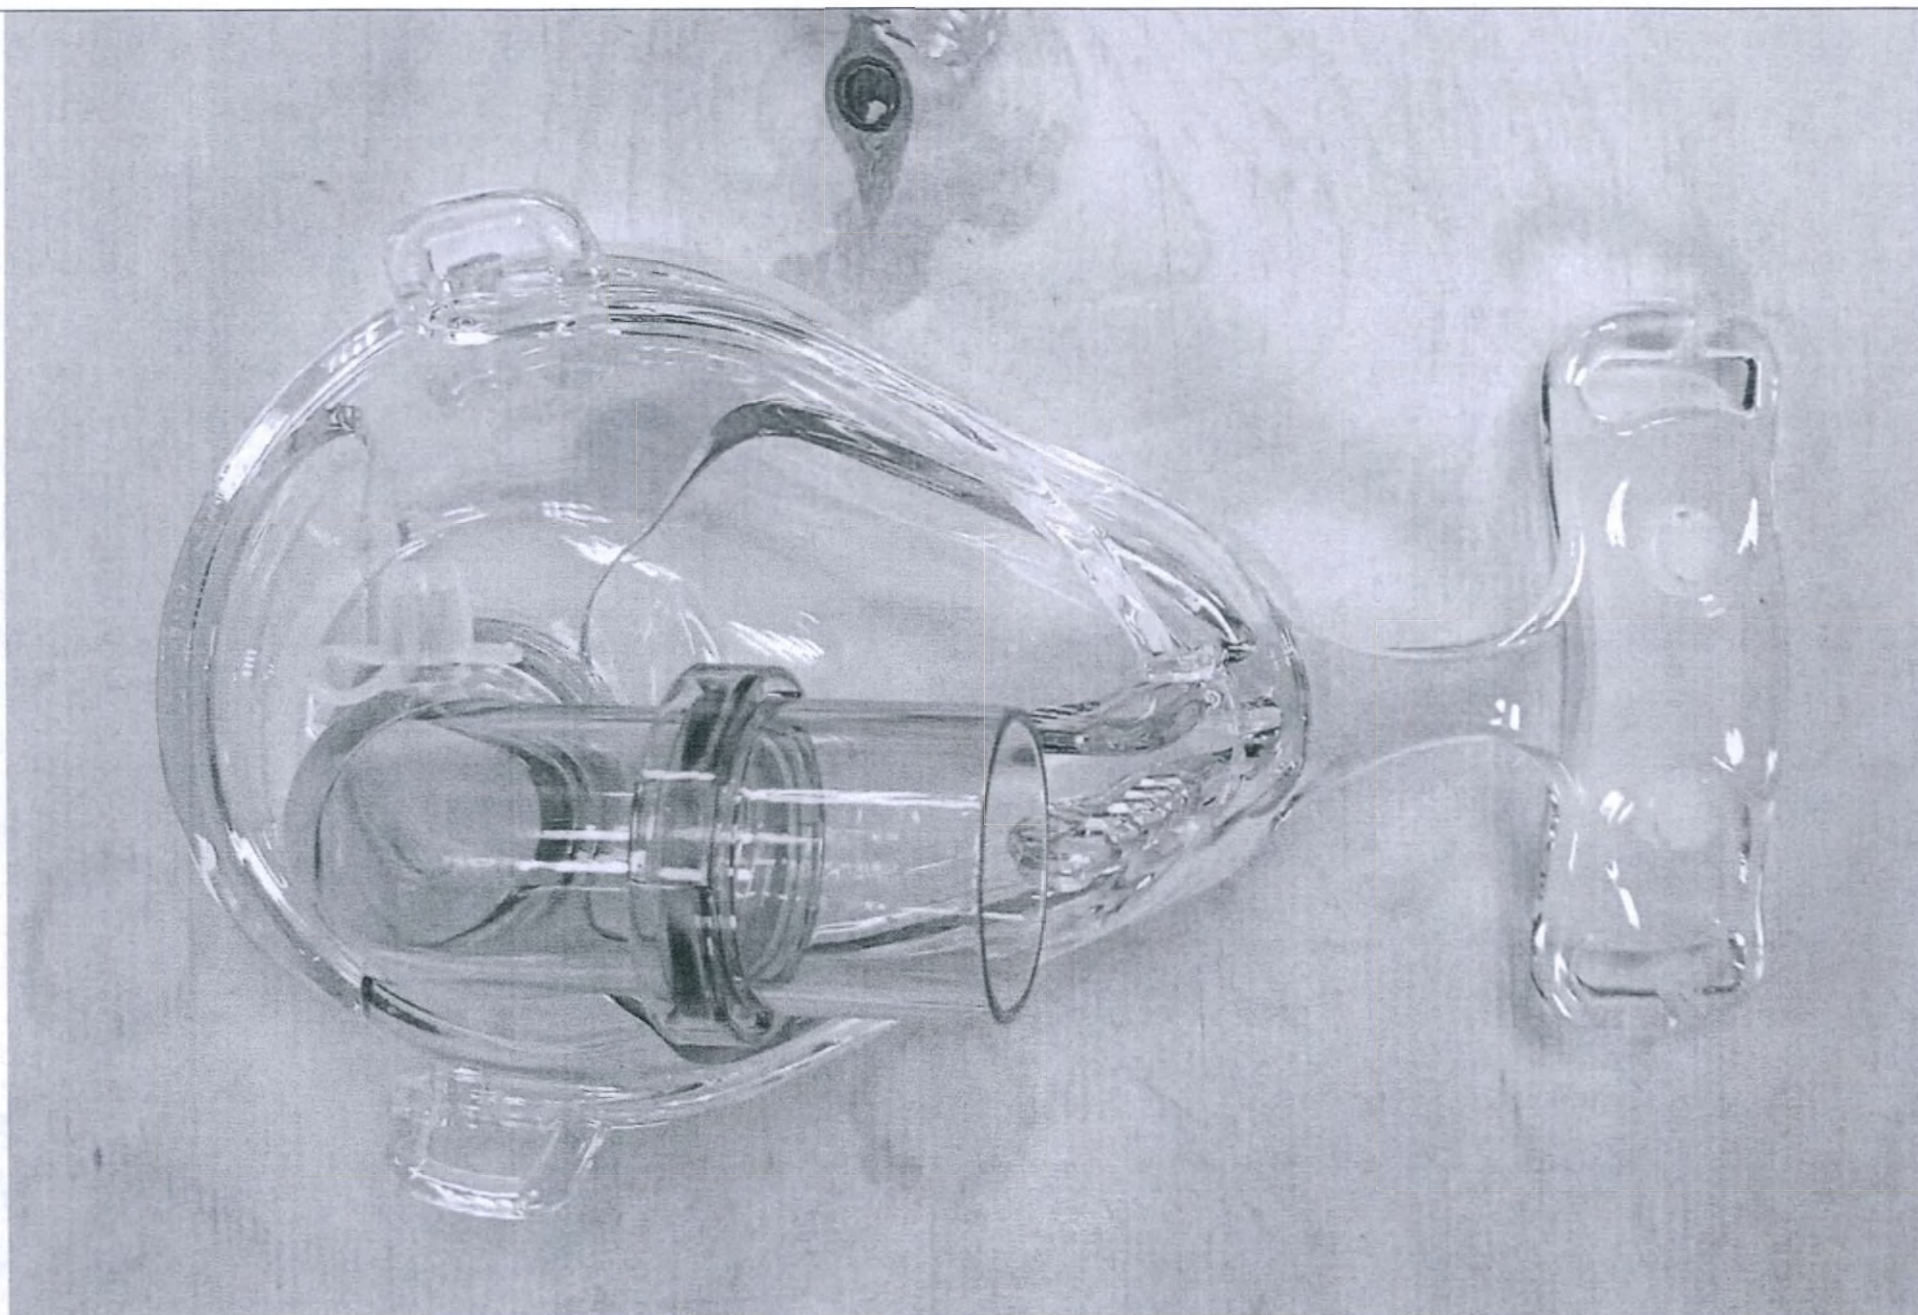

4.9. Маска, модели: 00003489, 00003490, 00003491




4.10. Прямой переходник соединения O2

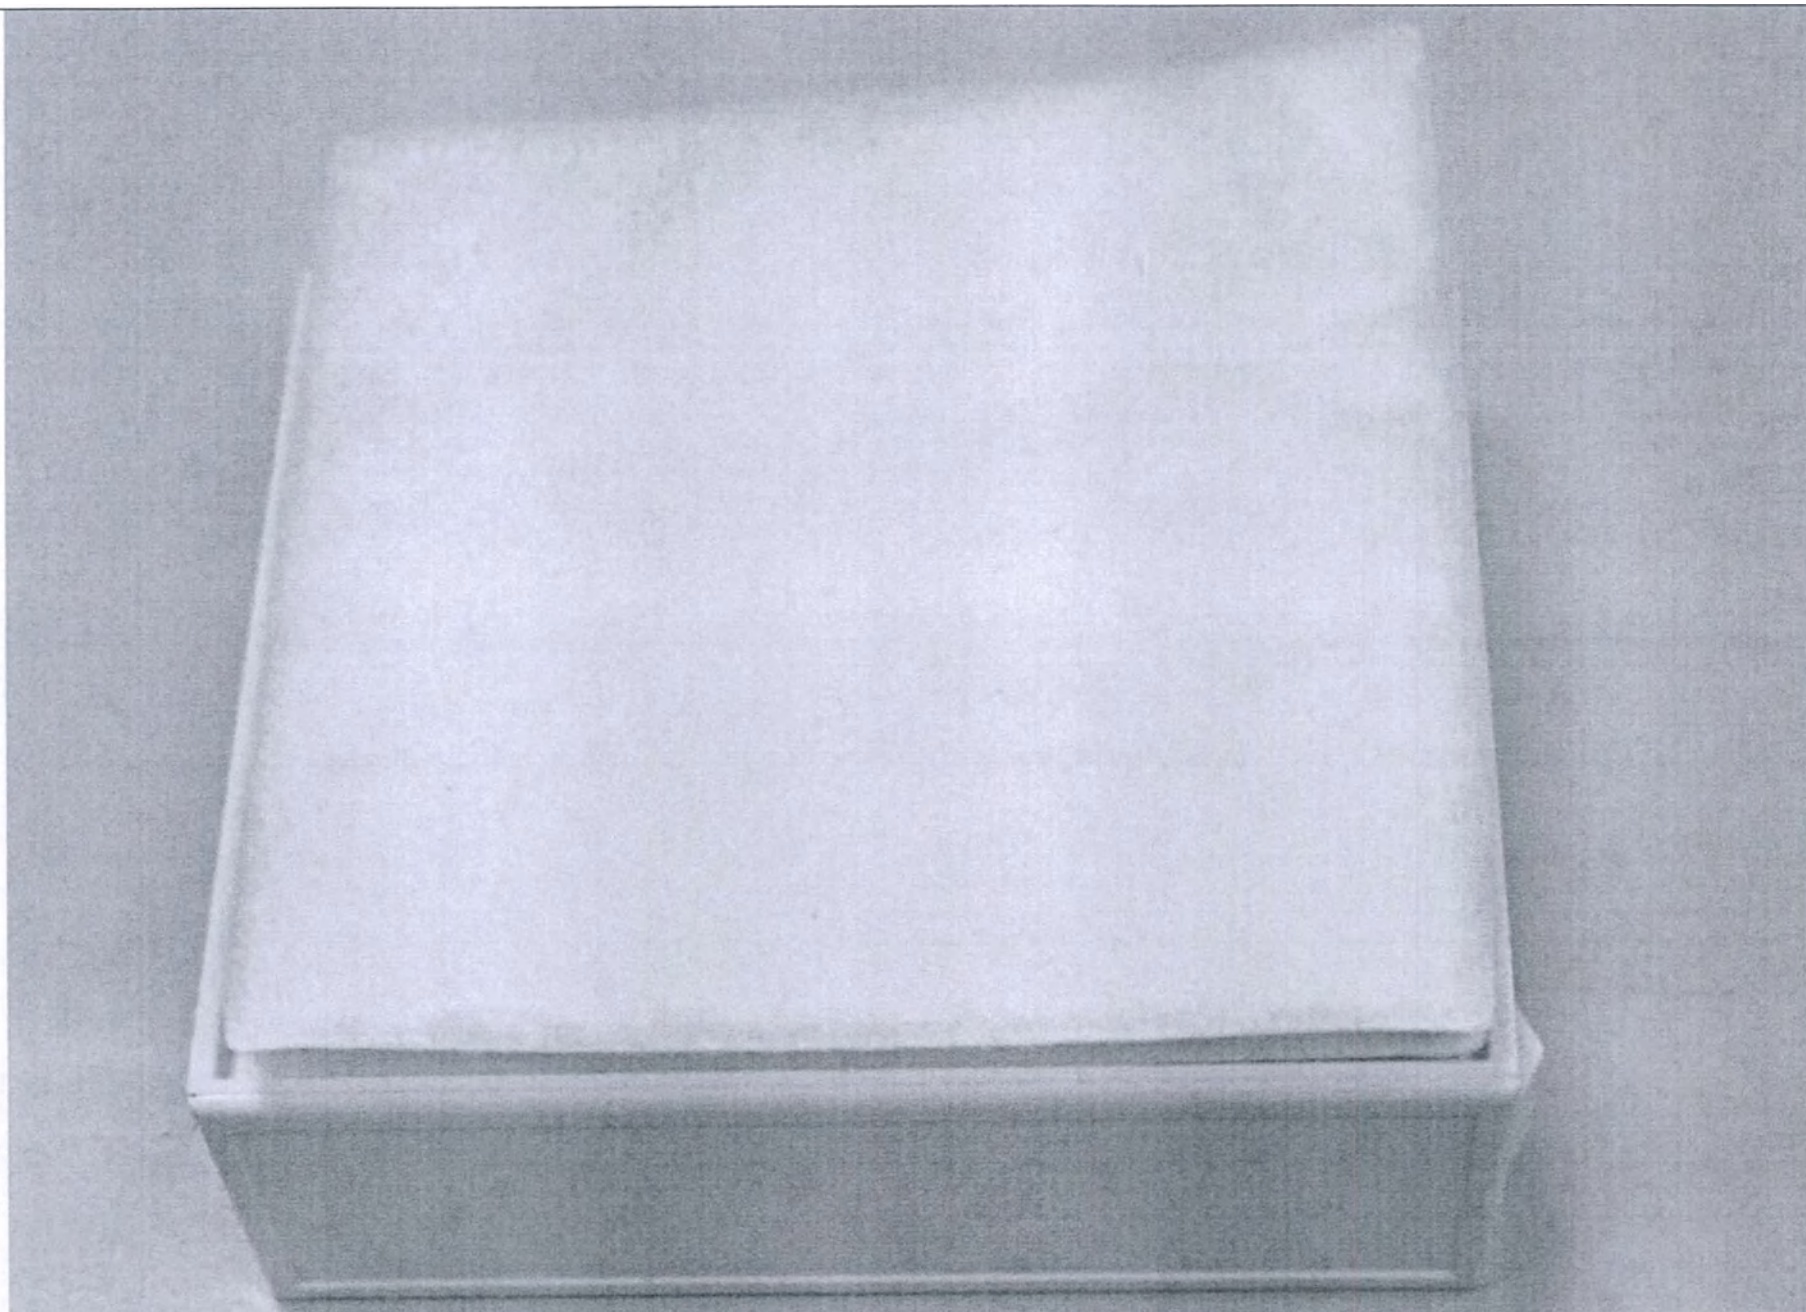


4.11. Запасной фильтр тонкой очистки, 1 упаковка (5 штук)



4.12. Датчик FiO₂

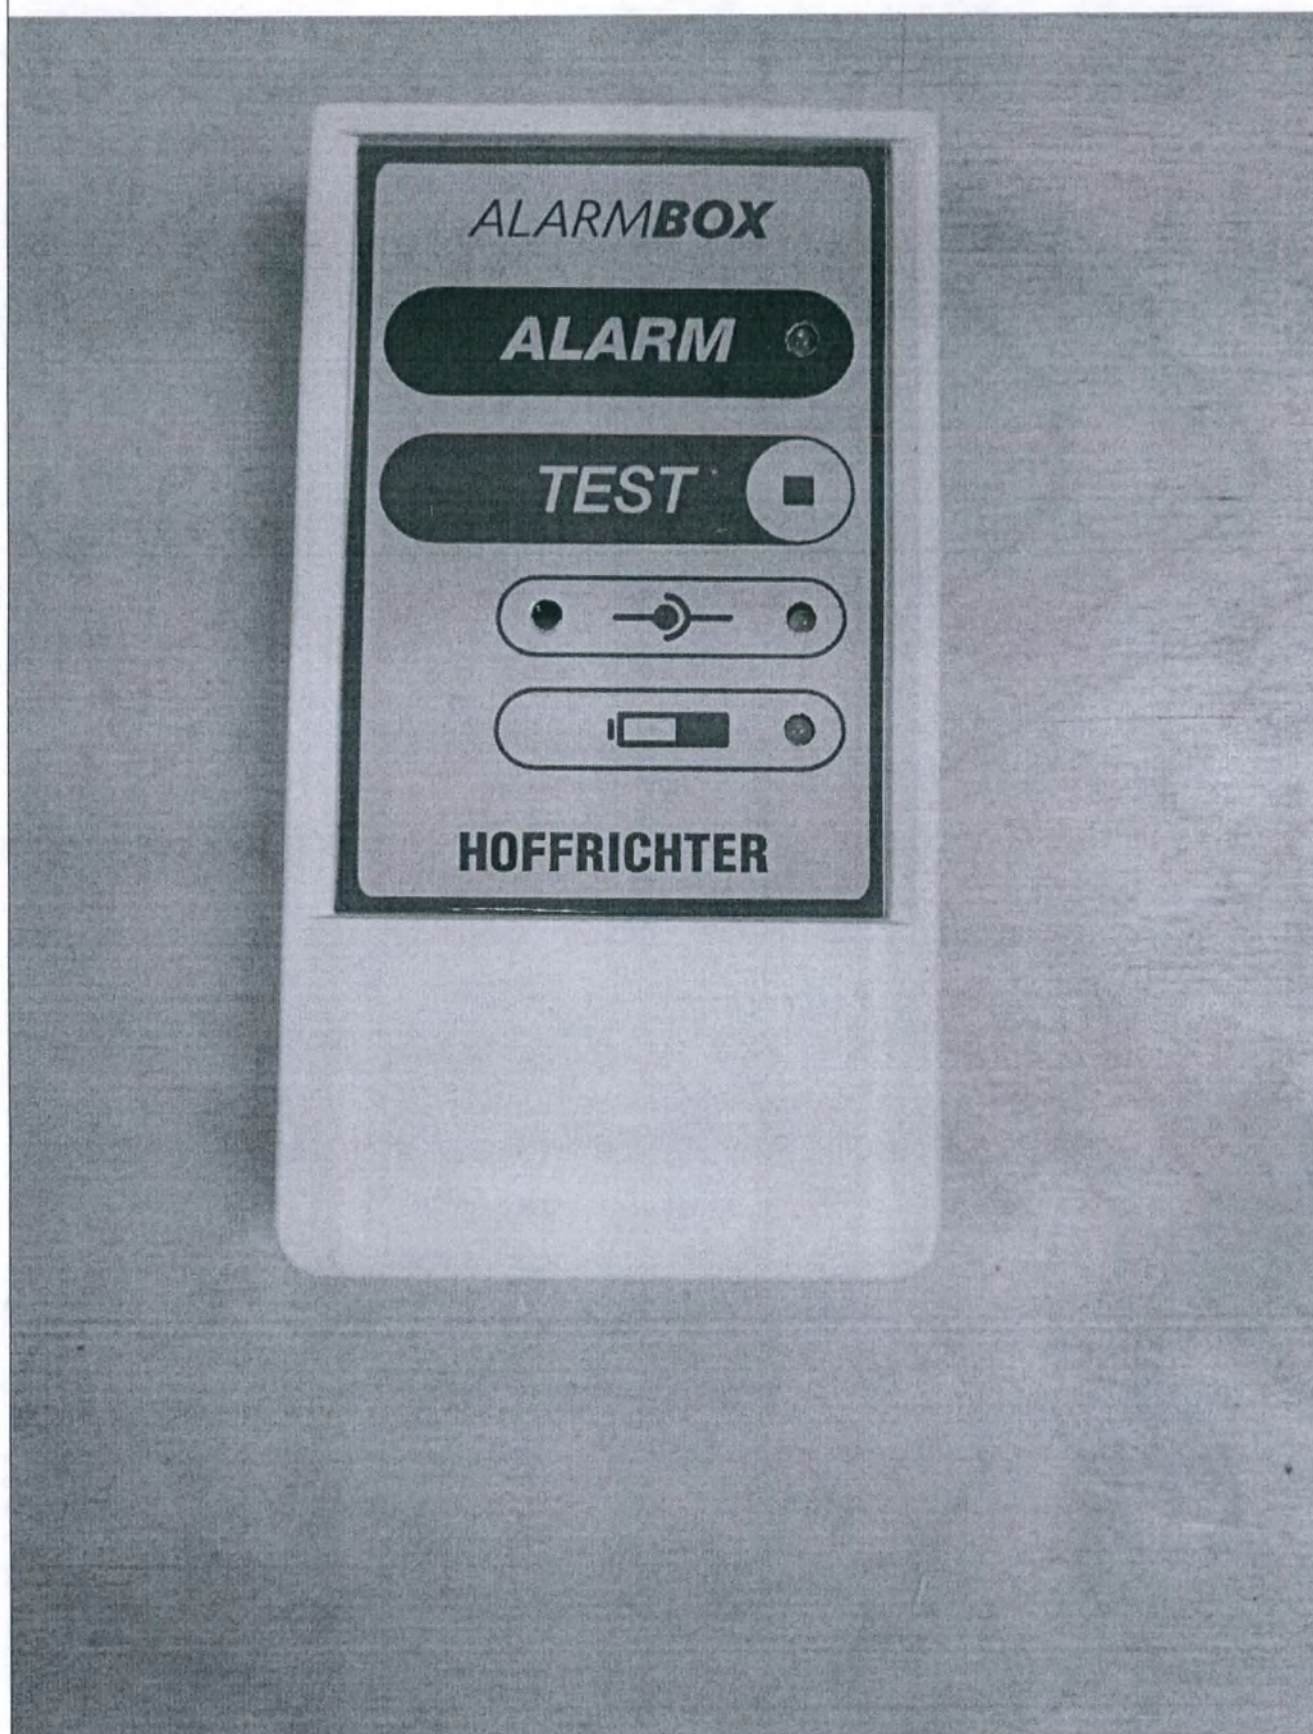

4.13. Пульт

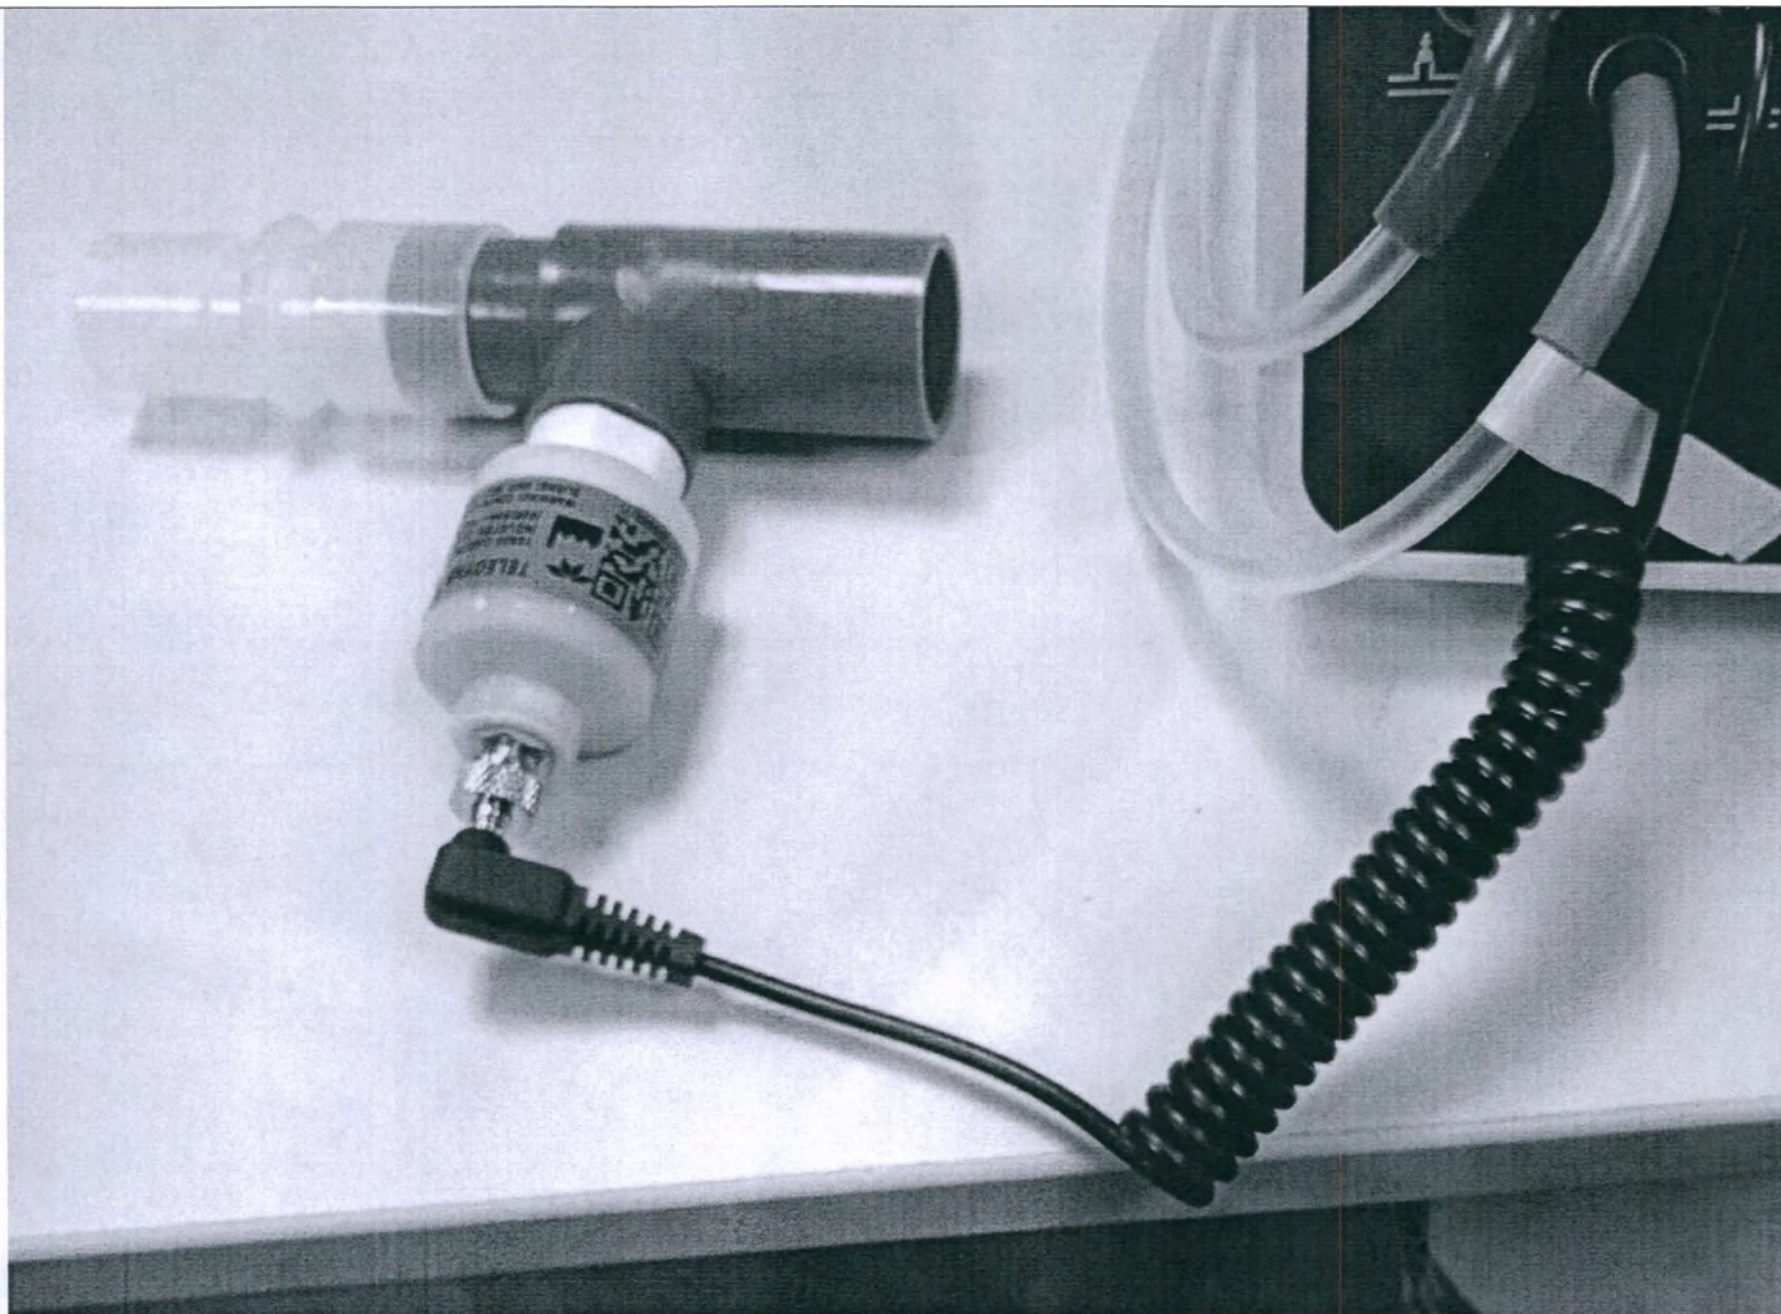

4.14. Адаптер прямого соединения FiO₂ (Комплект для измерения FiO₂, состоящий из FiO₂, датчика, Т-адаптера, адаптера датчика FiO₂, соединительной линии FiO₂-датчик с винтовым соединением)




5.1. Аппарат ИВЛ CARAT I pro, основной блок

Сетевой шнур



5.3. Сетевой шнур

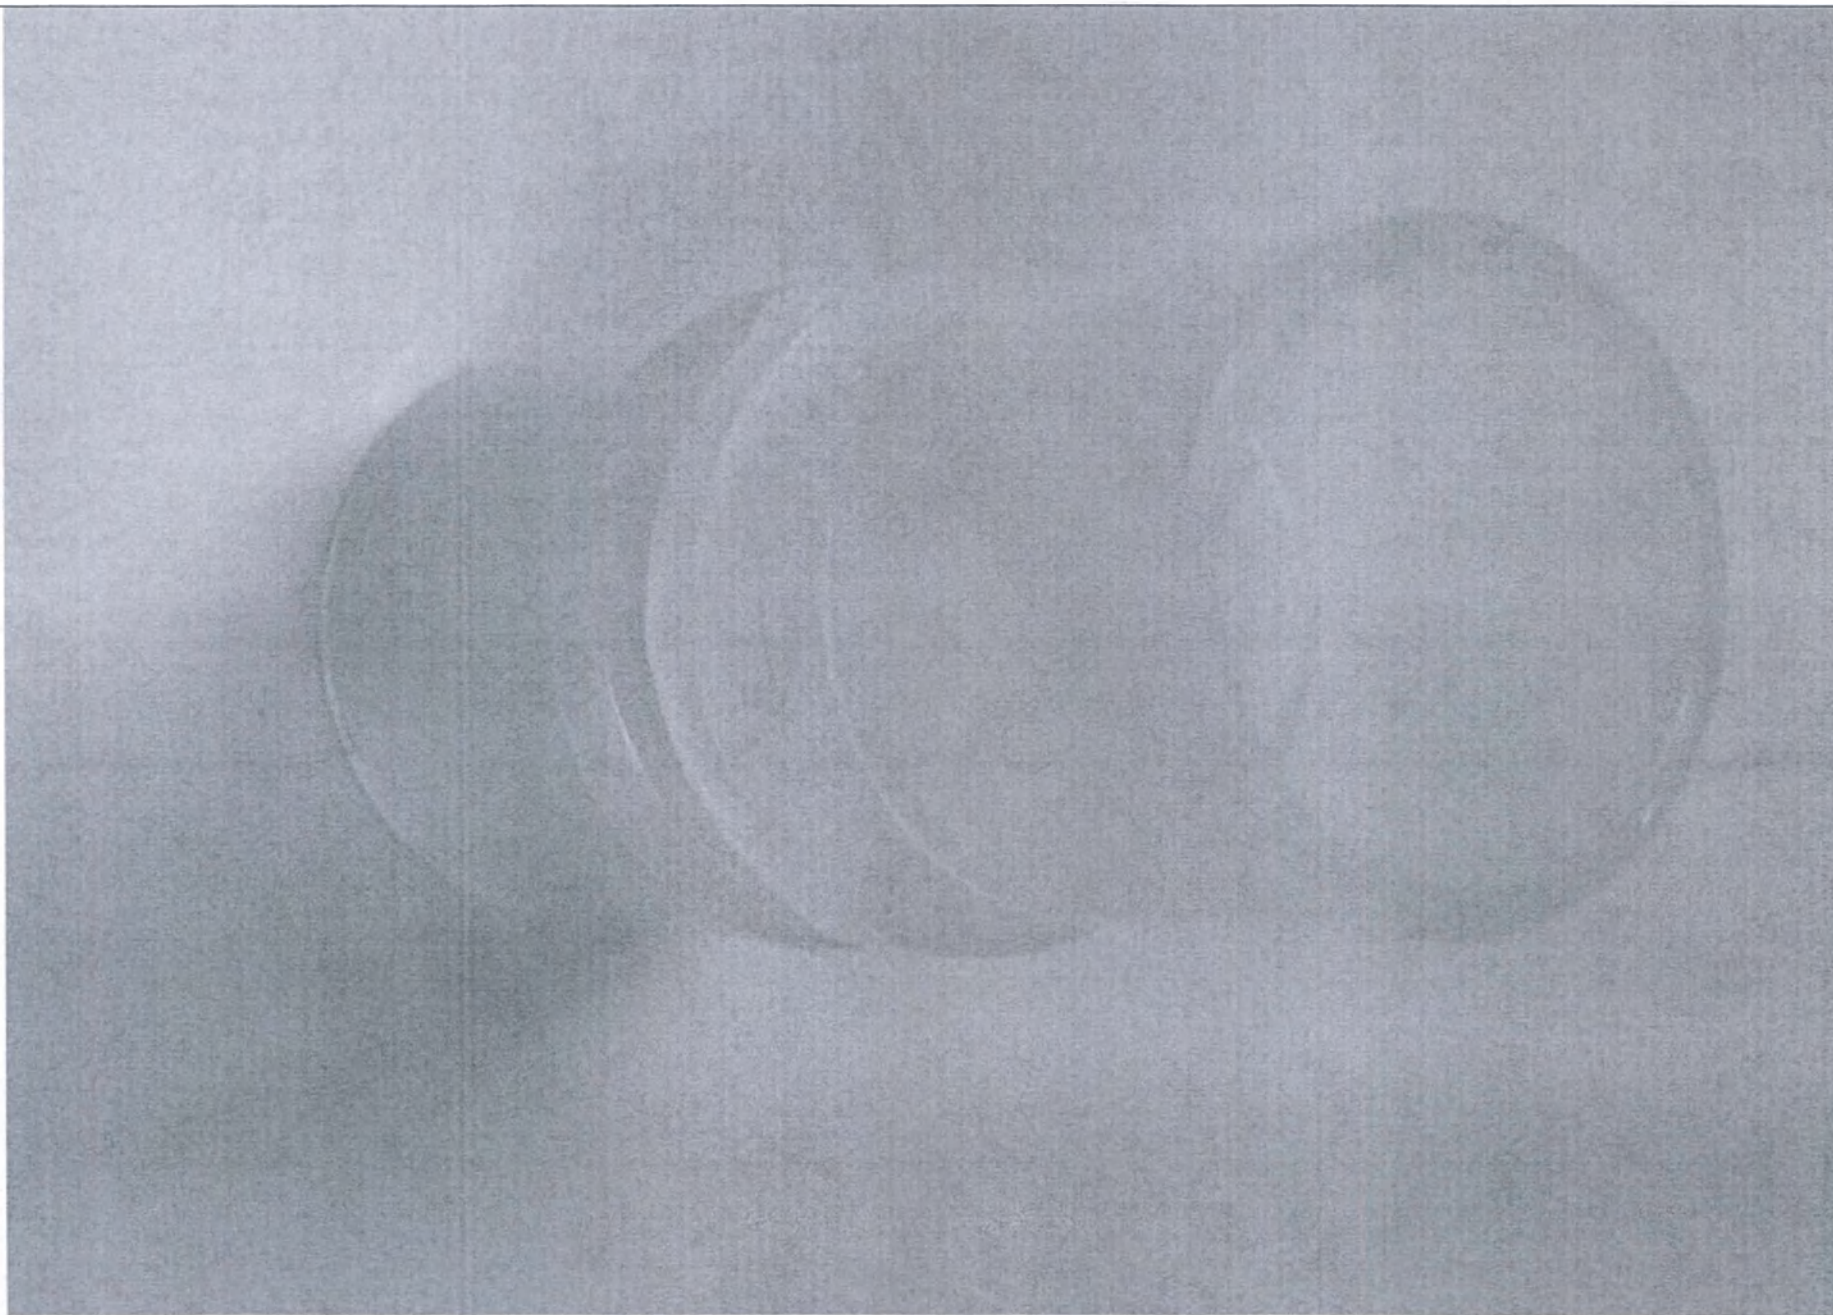

5.4. Насадка для бактериального фильтра




5.5. SD карта




Запасная
фильтрующая
кассета открытая


5.6. Запасная фильтрующая кассета, полная (открытая) с фильтрами

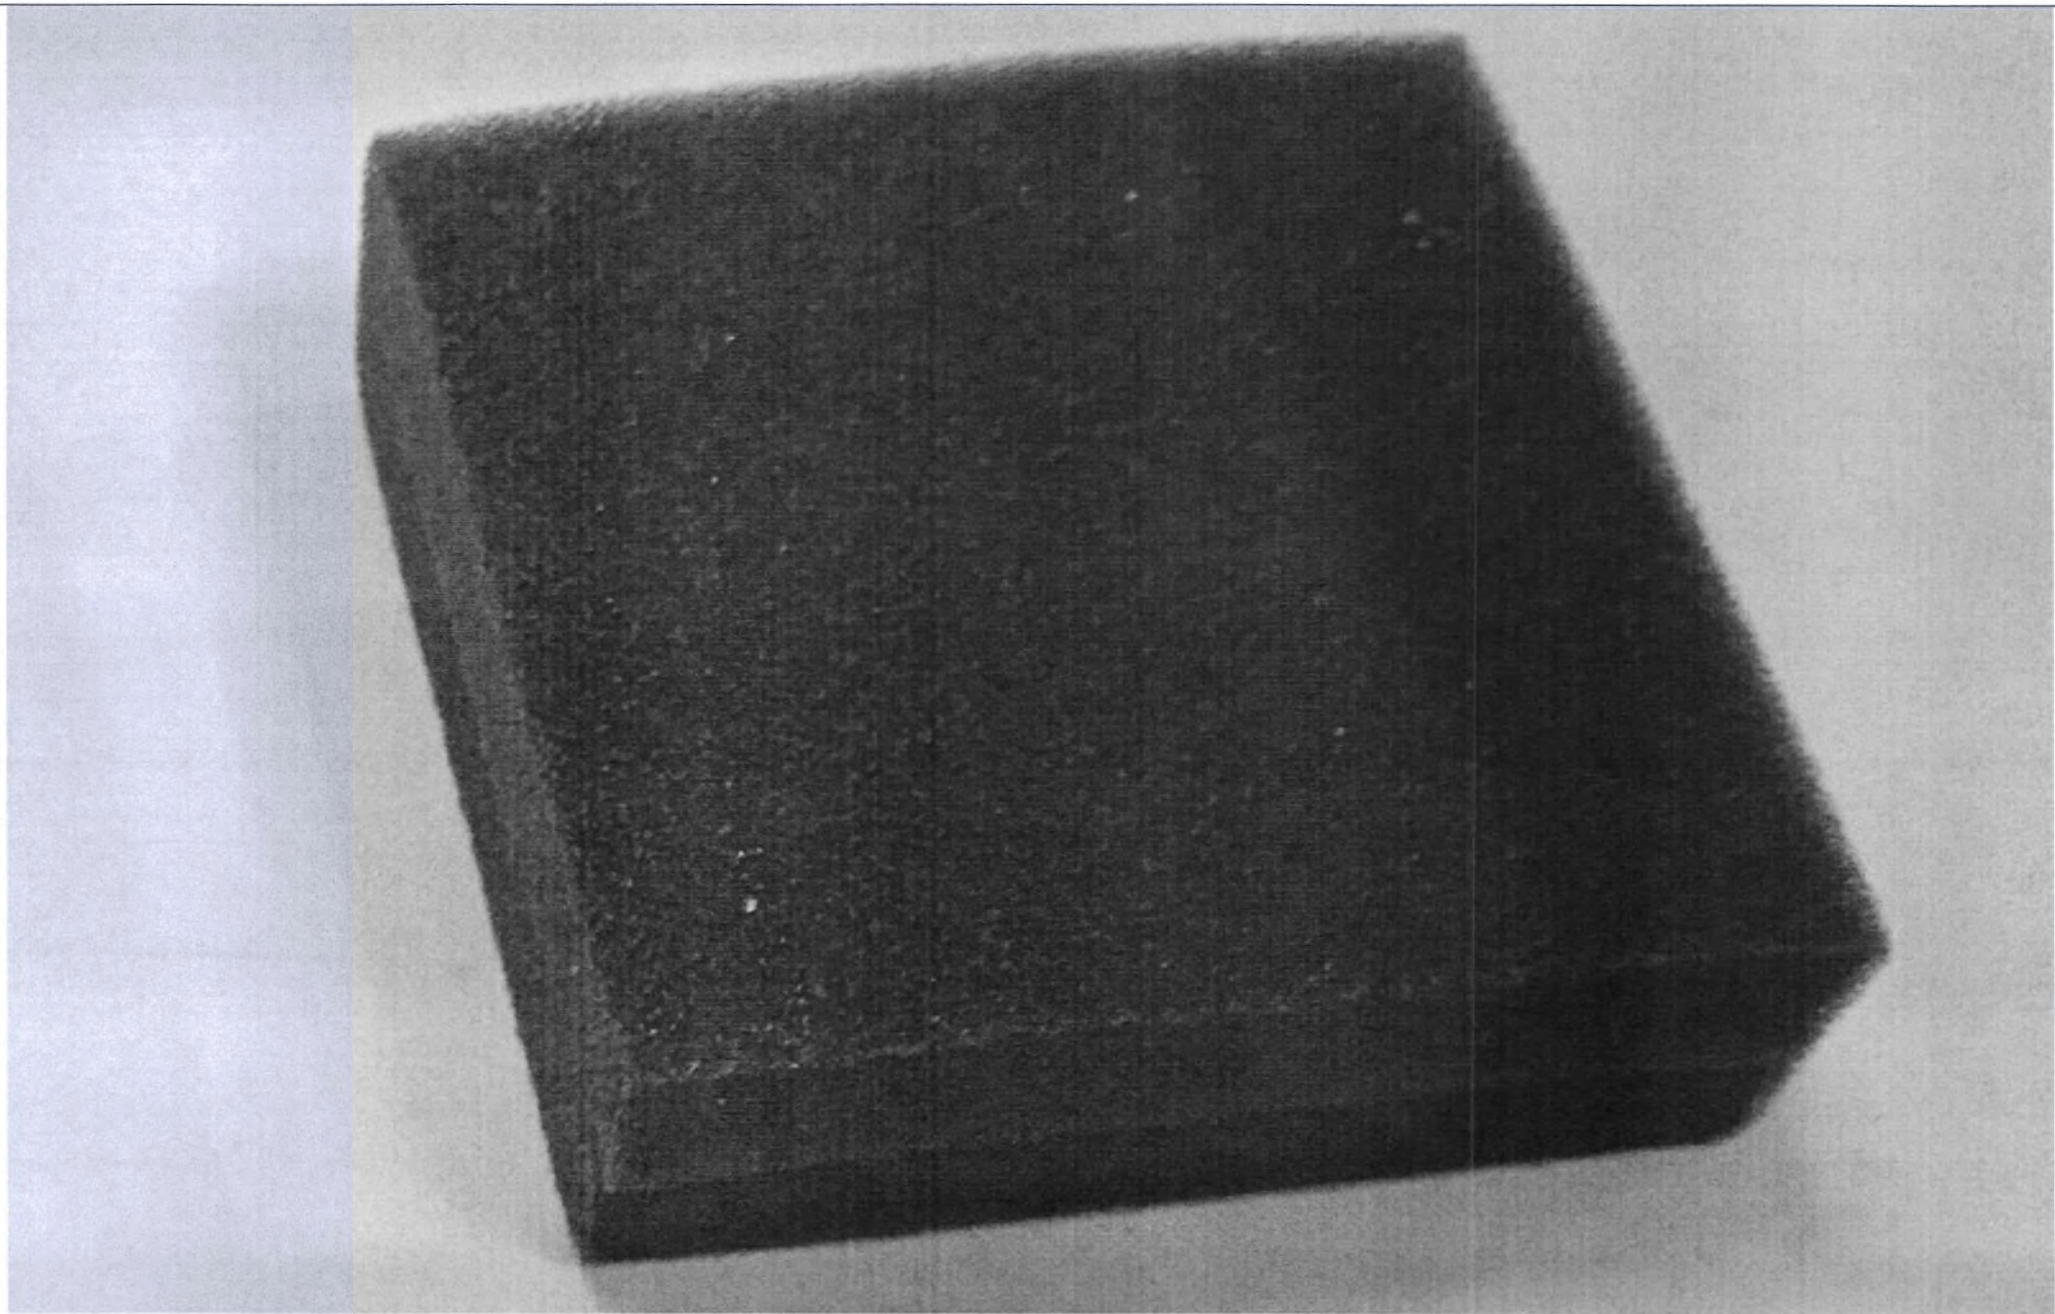


5.7. Запасной фильтр грубой очистки, 1 упаковка (2 шт.)

6.1. Внешний аккумуляторный блок

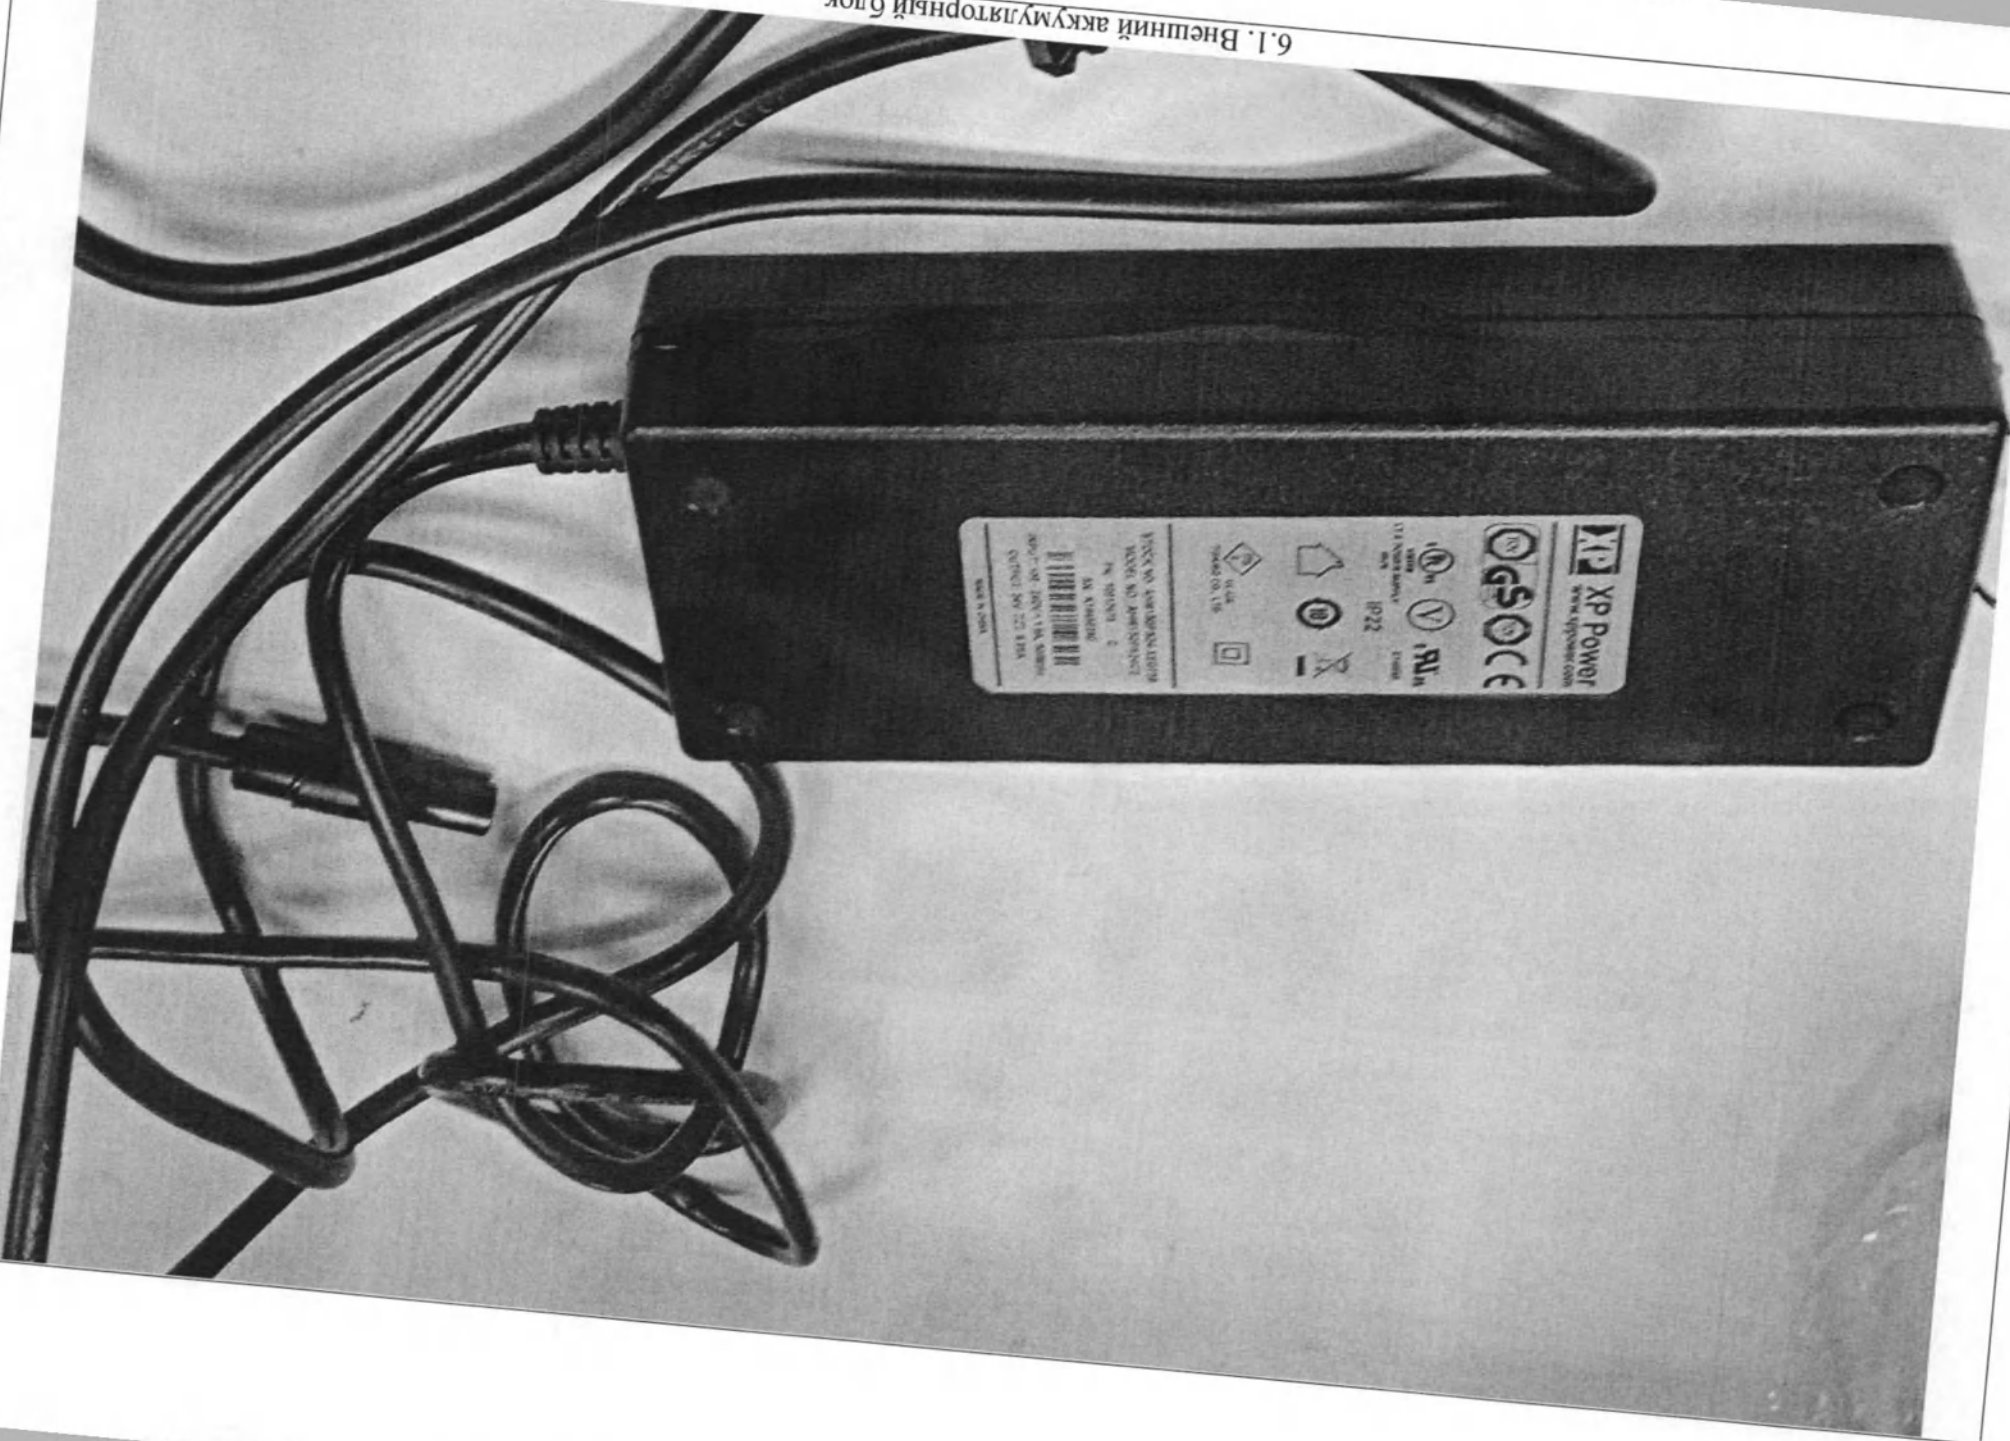


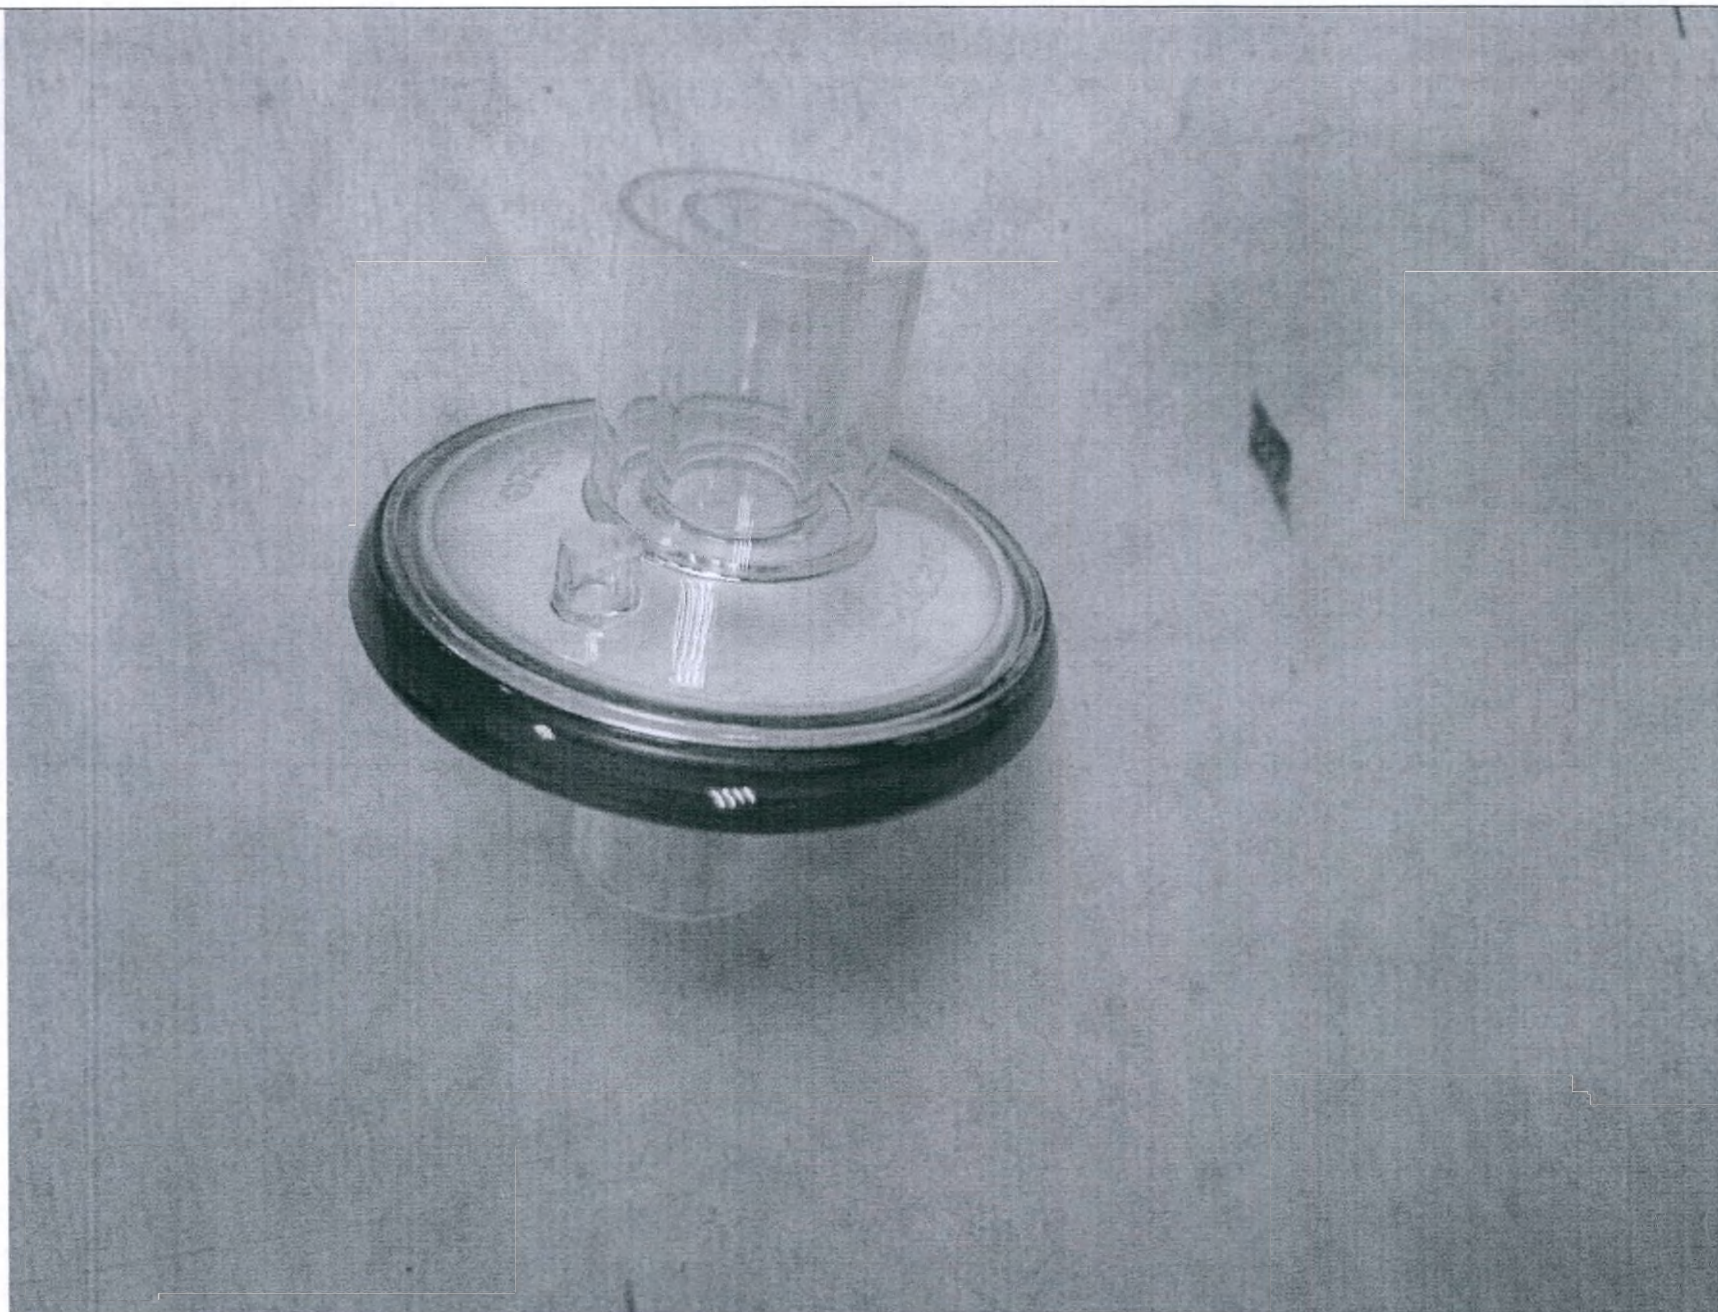

6.2. Бактериальный фильтр

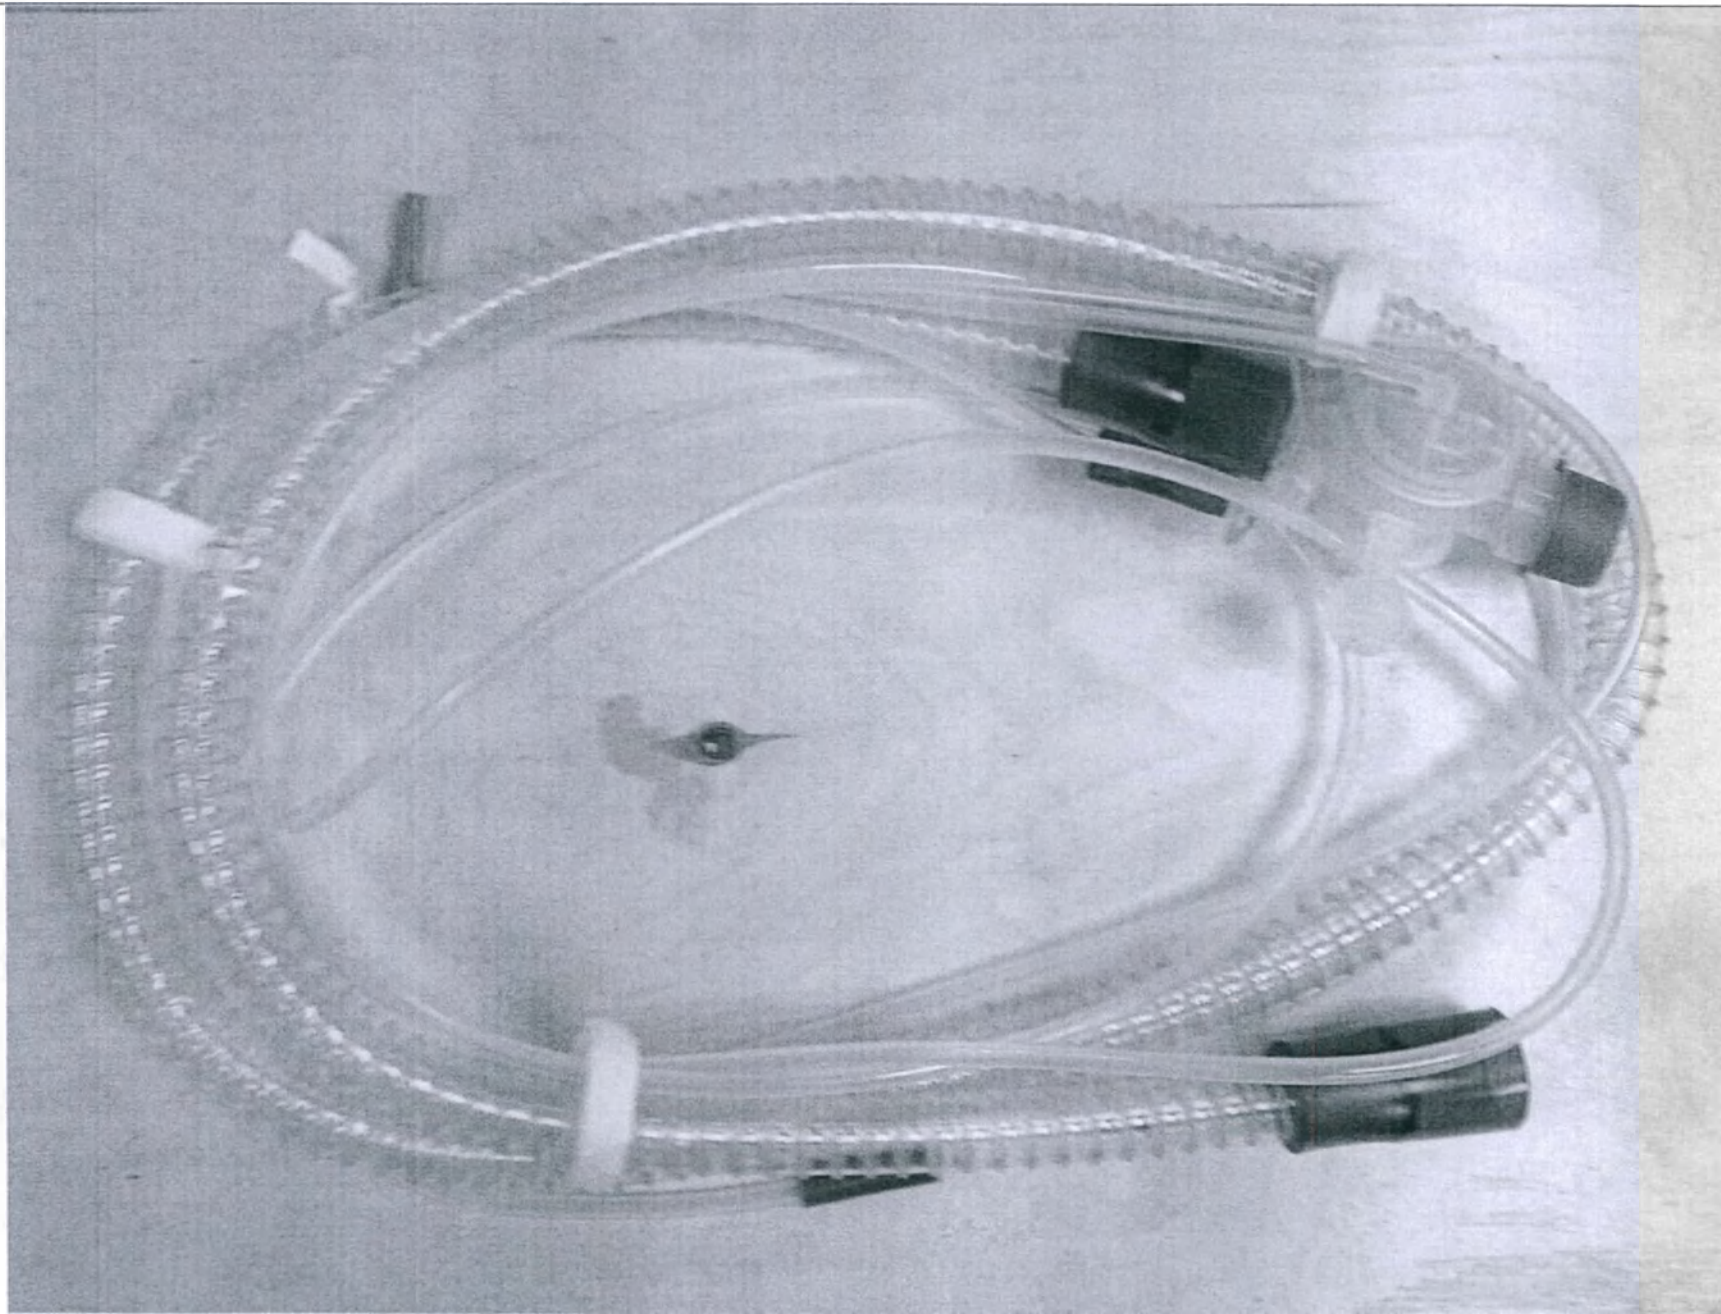

6.3. SERVOVENT Односторонняя дыхательная система SBS 15 SBU 15 ID/150 см для детей

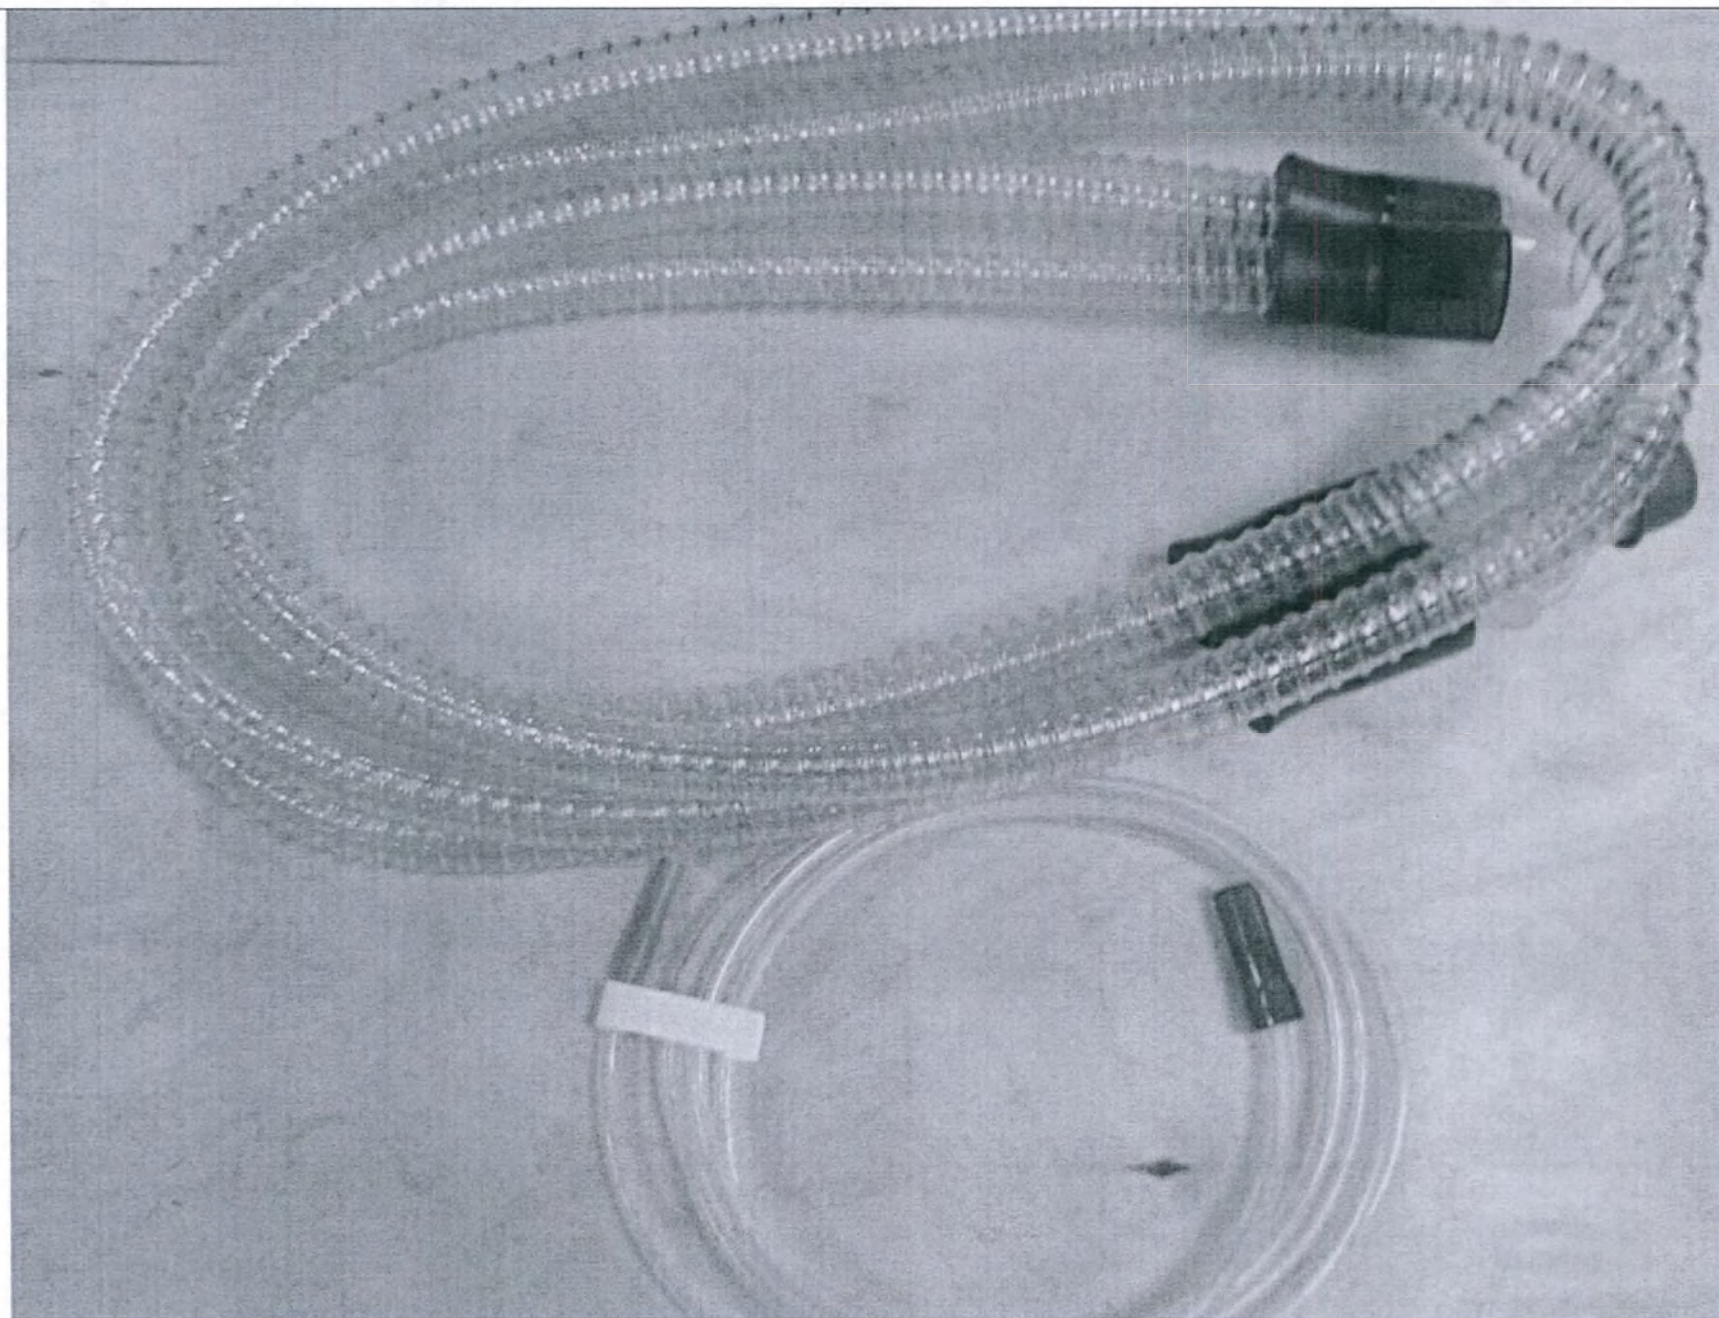

6.4. SERVOENT Двухканальная дыхательная система DBS 15 SBU 15 ID/150 см для детей


Адаптер датчика O2



6.5. Адаптер датчика O2




6.6. Кабель датчика O2 с винтовым разъемом

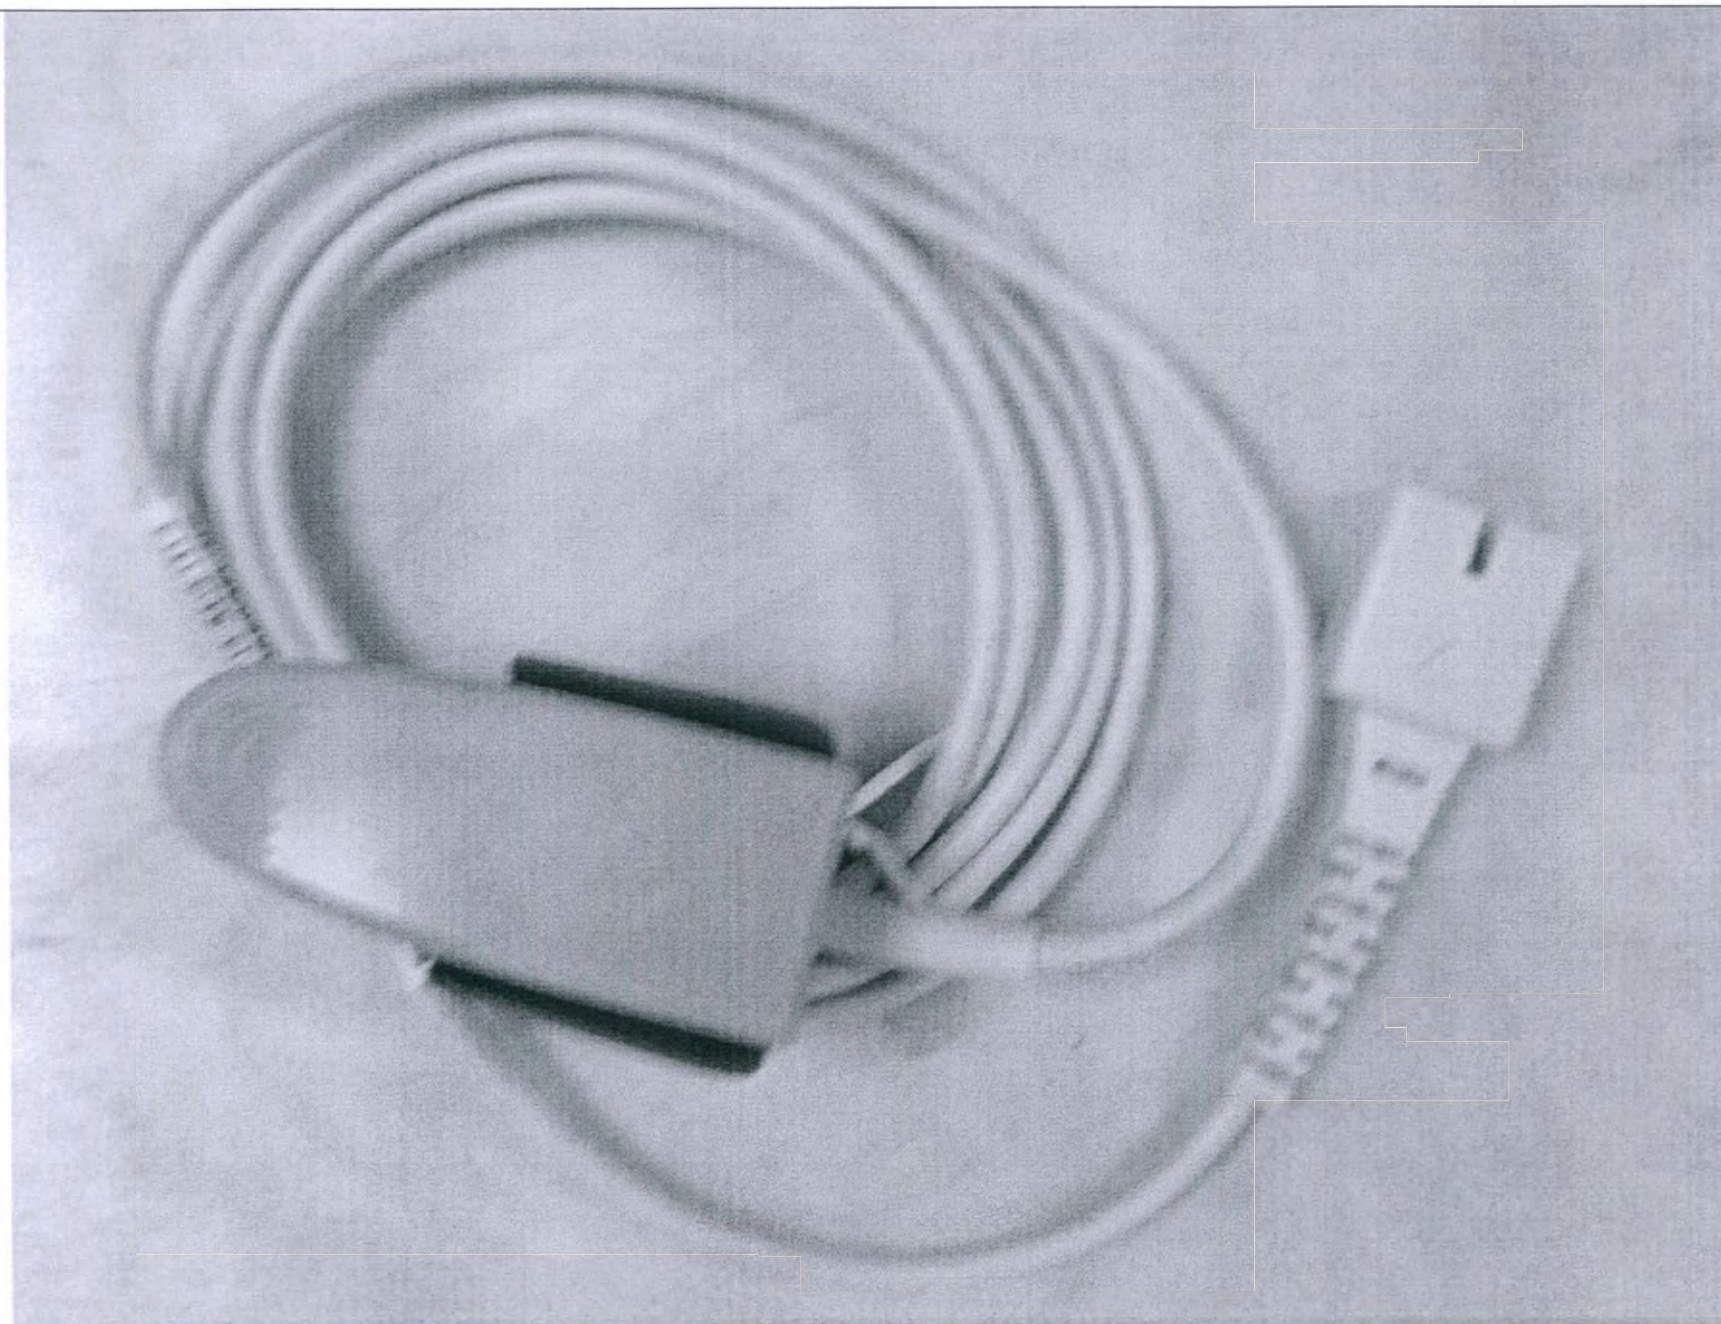


6.7. SpO2 датчик-зажим на палец с кабелем 2 м




6.8. Тестовое легкое

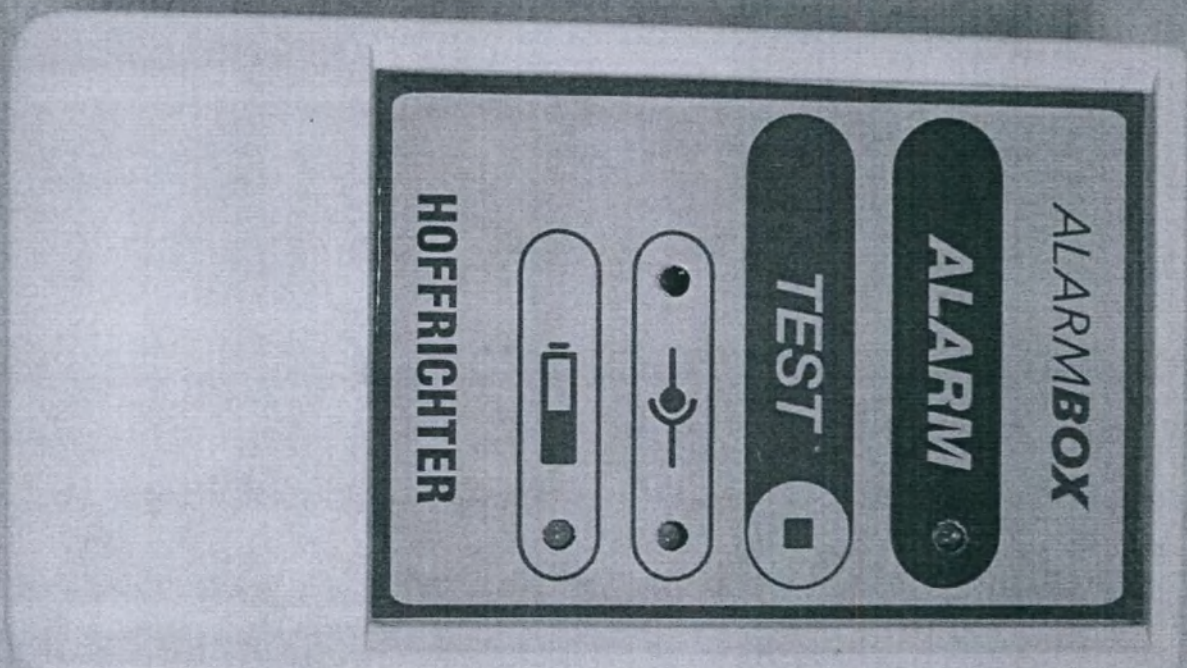


6.9. Выносной будильник

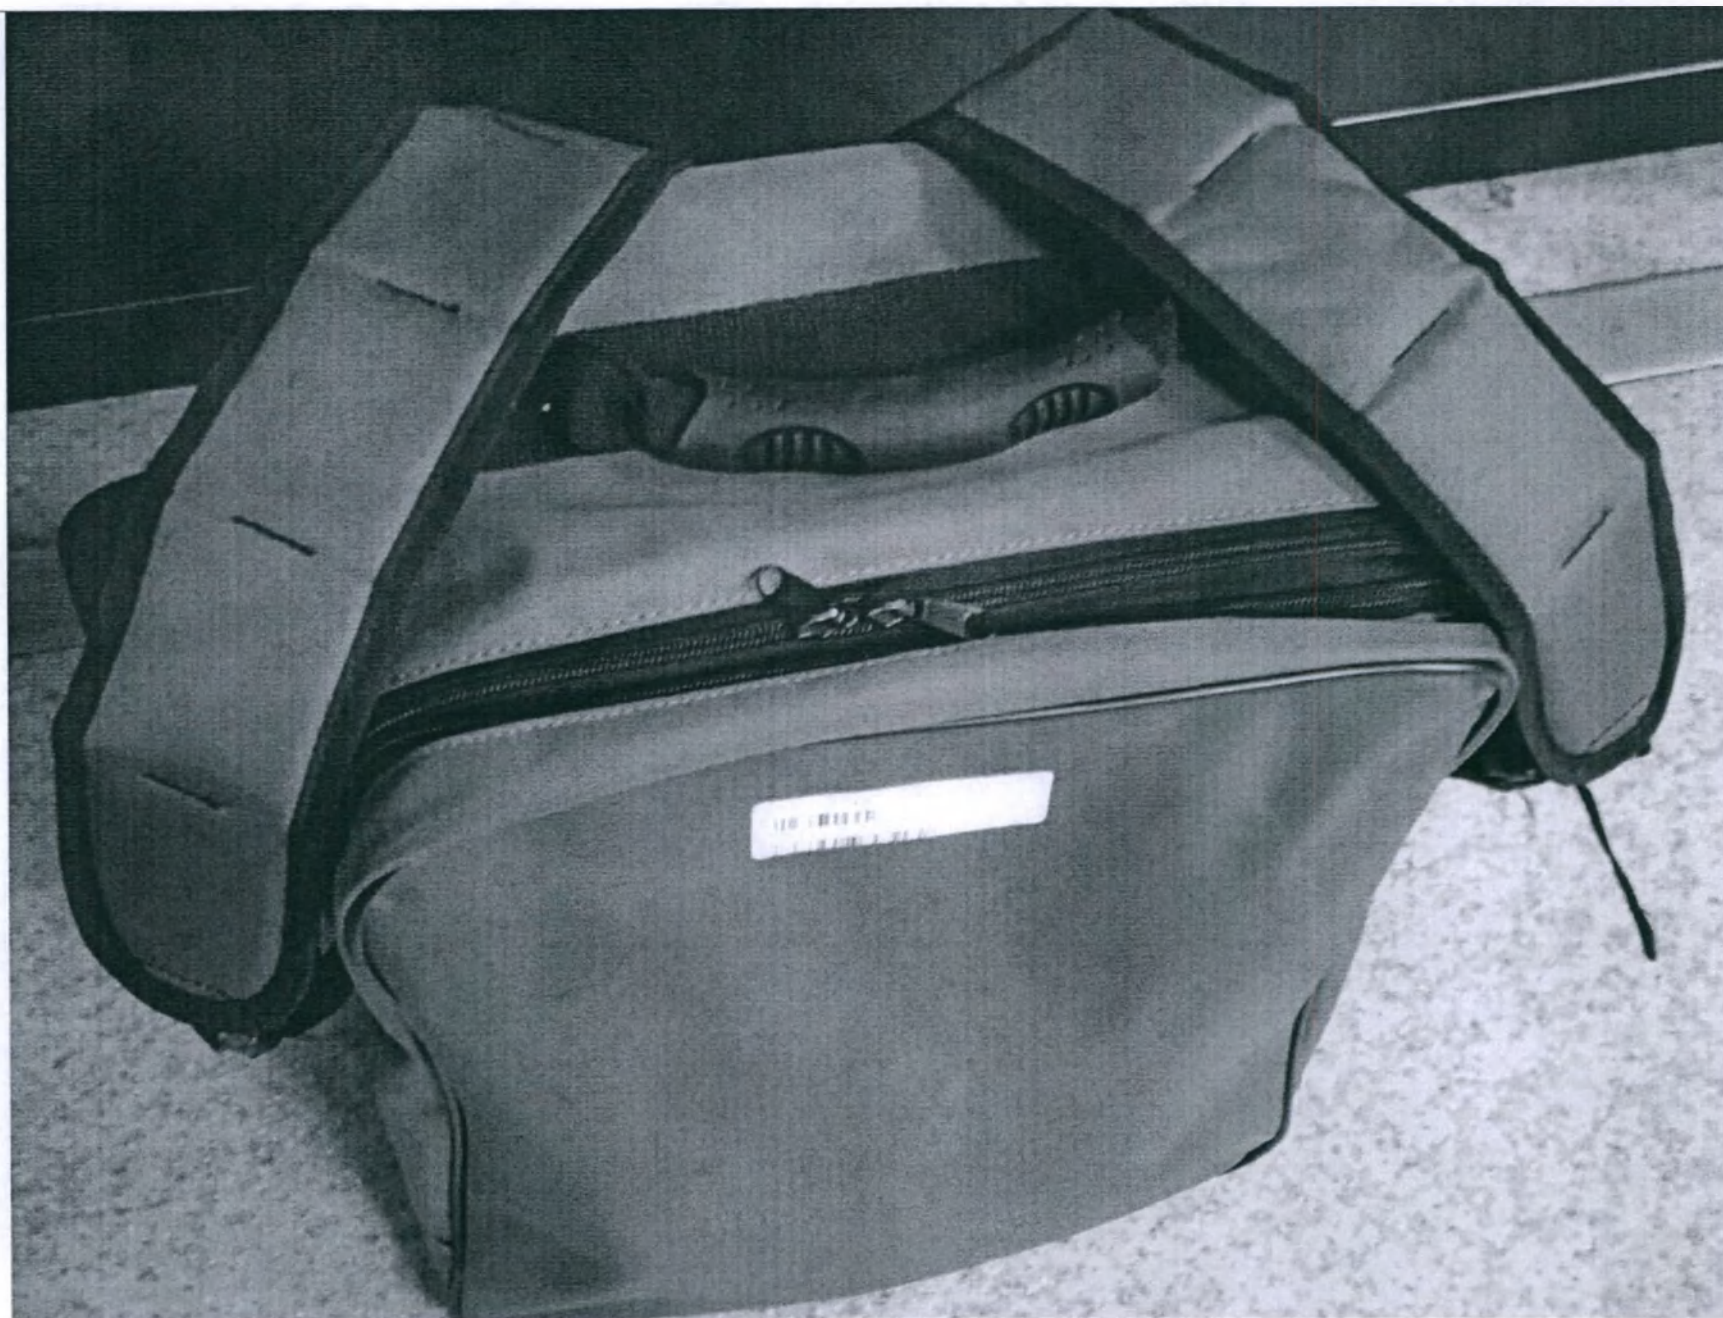


6.10. Чехол для переносок

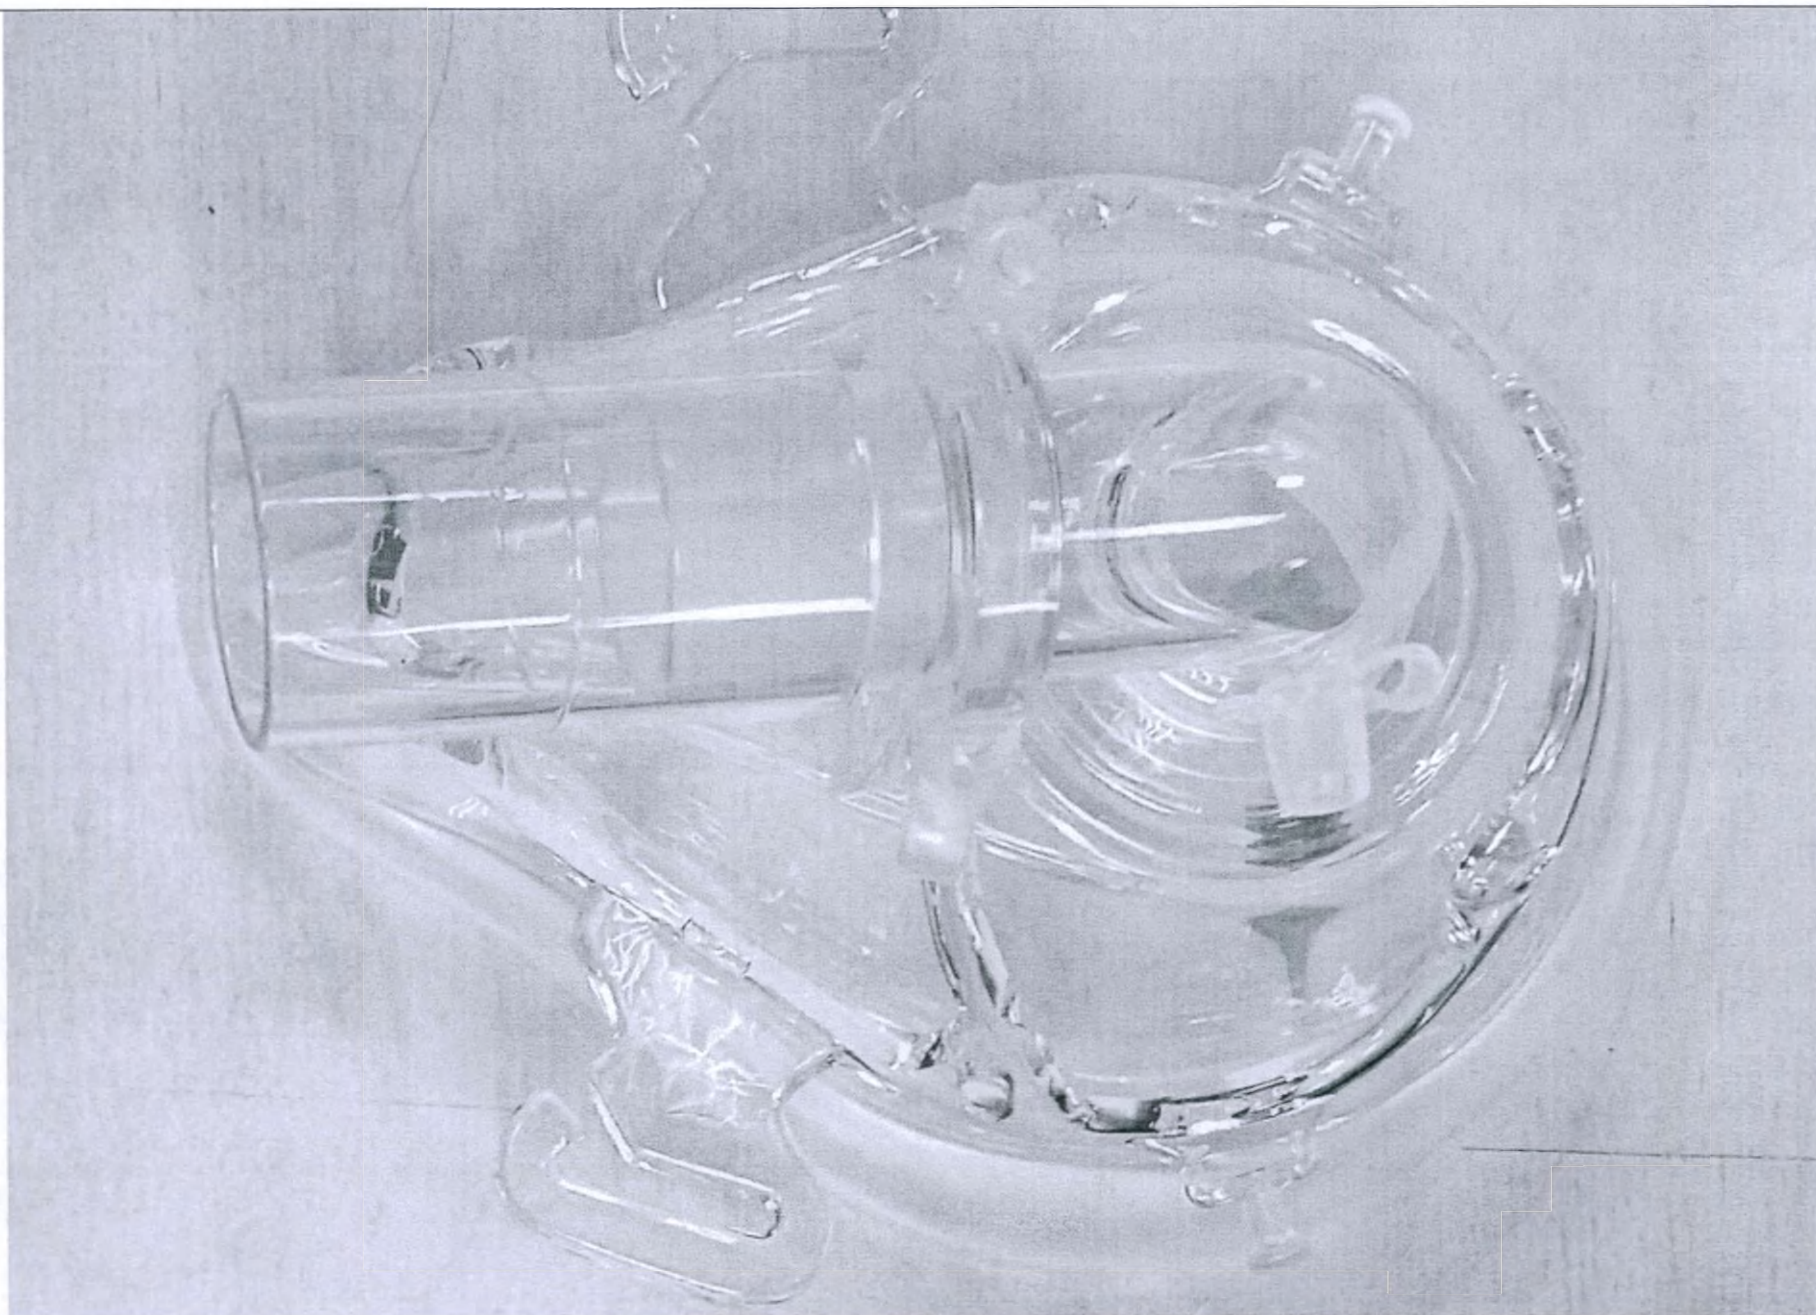


6.11. Маска, модели: 00003461, 00003442, 00003438, 00003462, 00003439

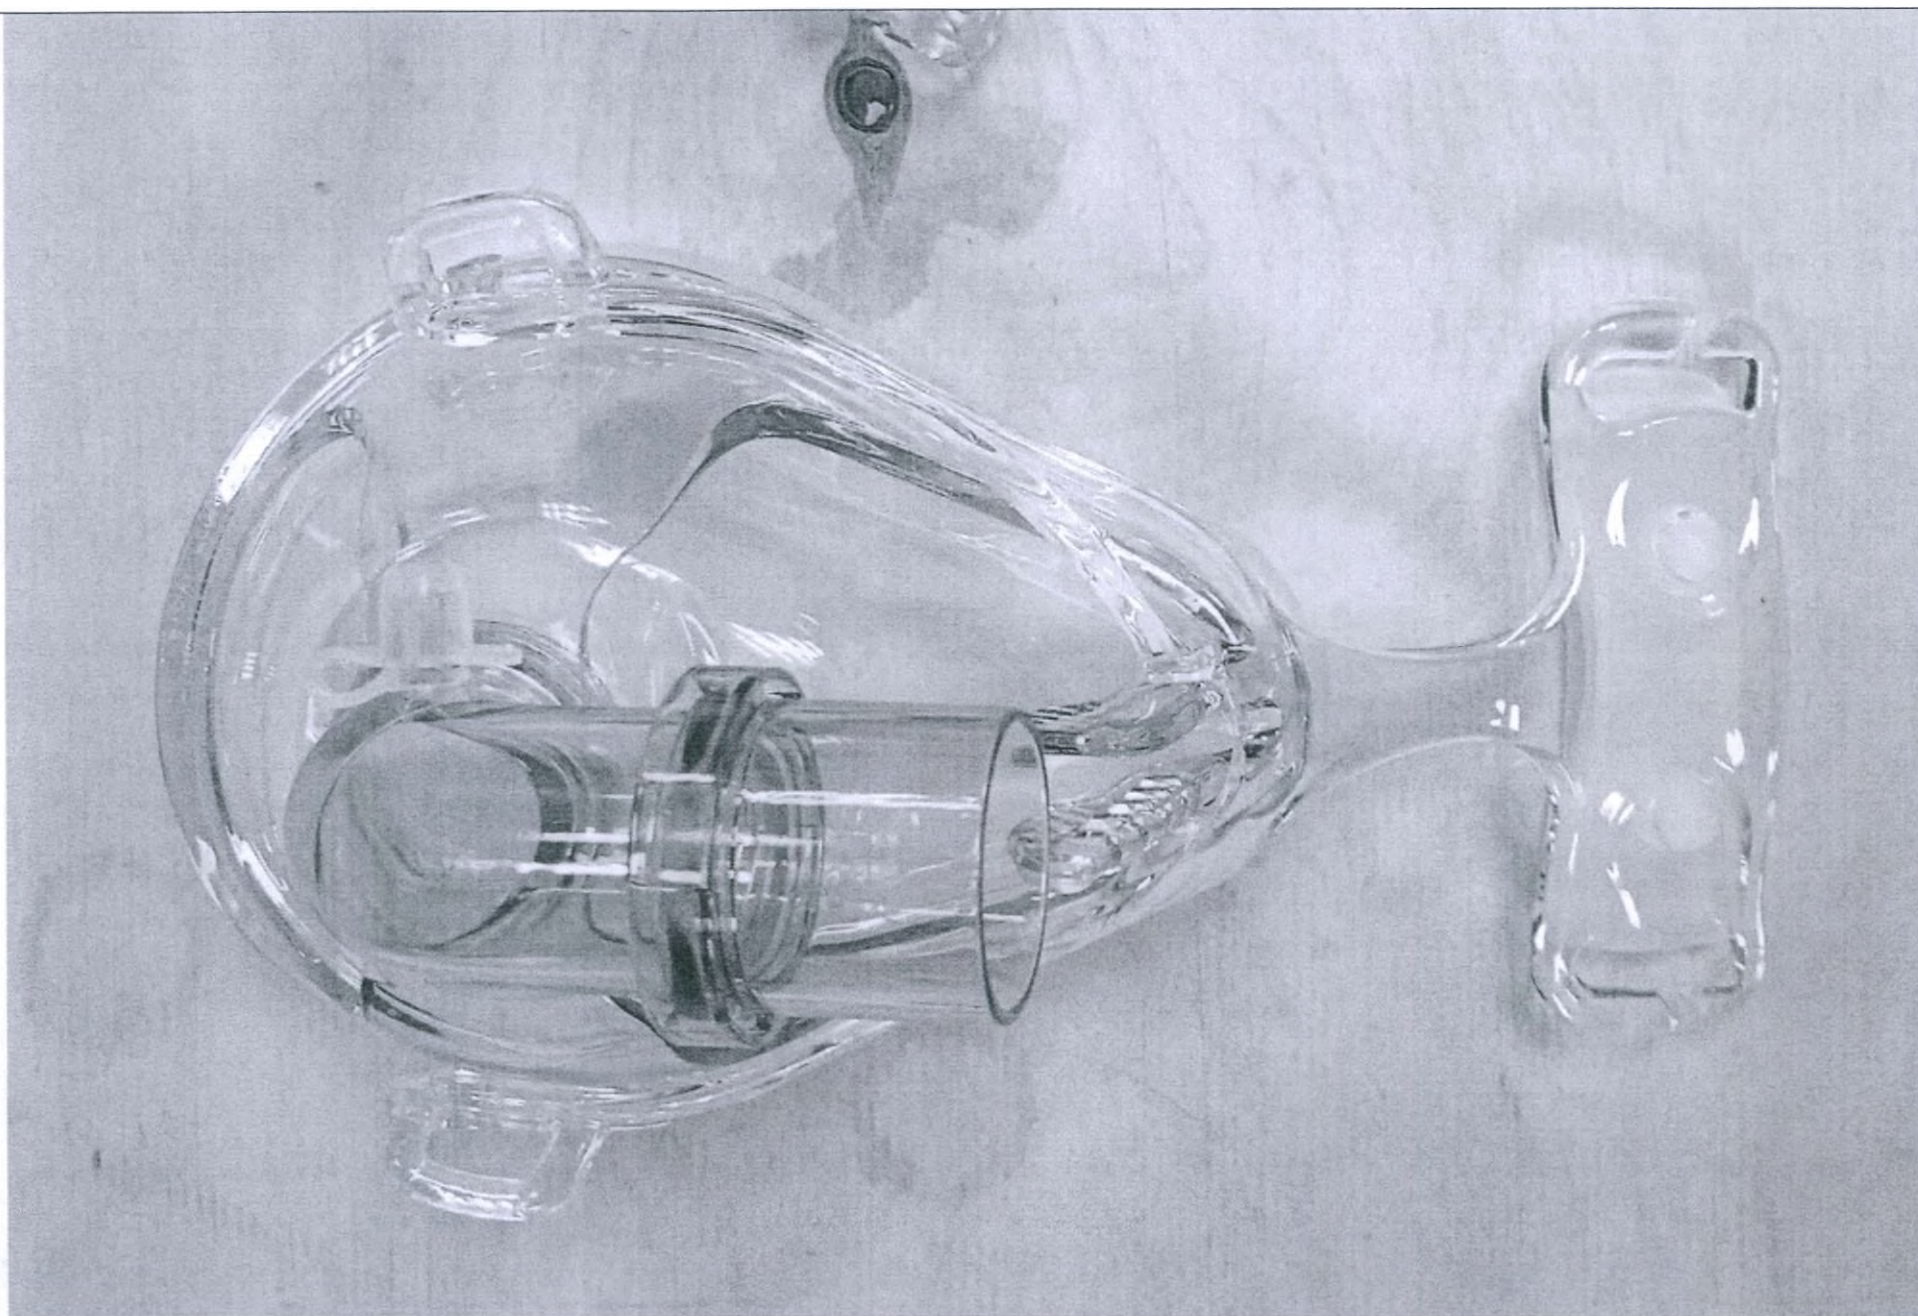

6.11. Маска, модели: 00003489, 00003490, 00003491

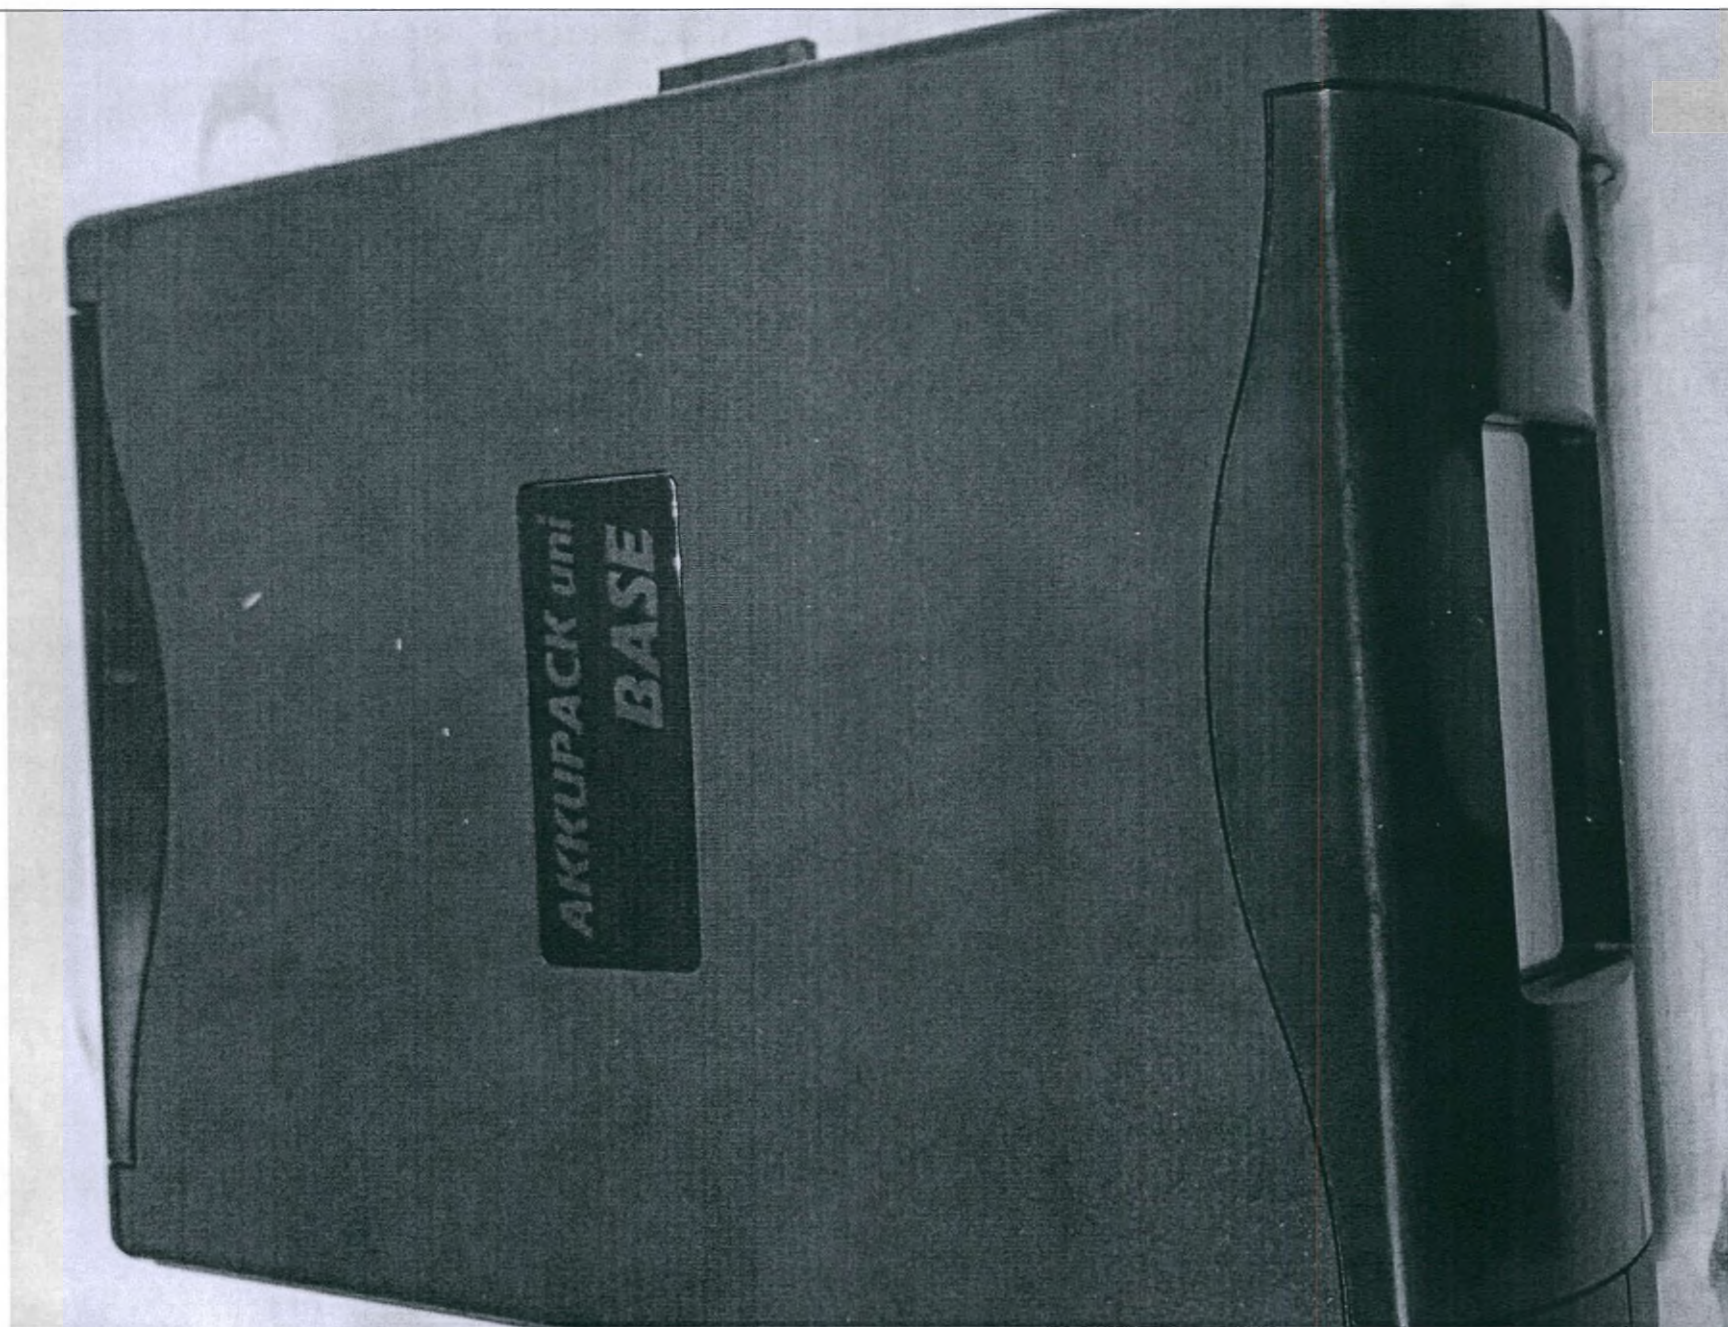


6.12. Блок питания AKKUPACK uni BASE

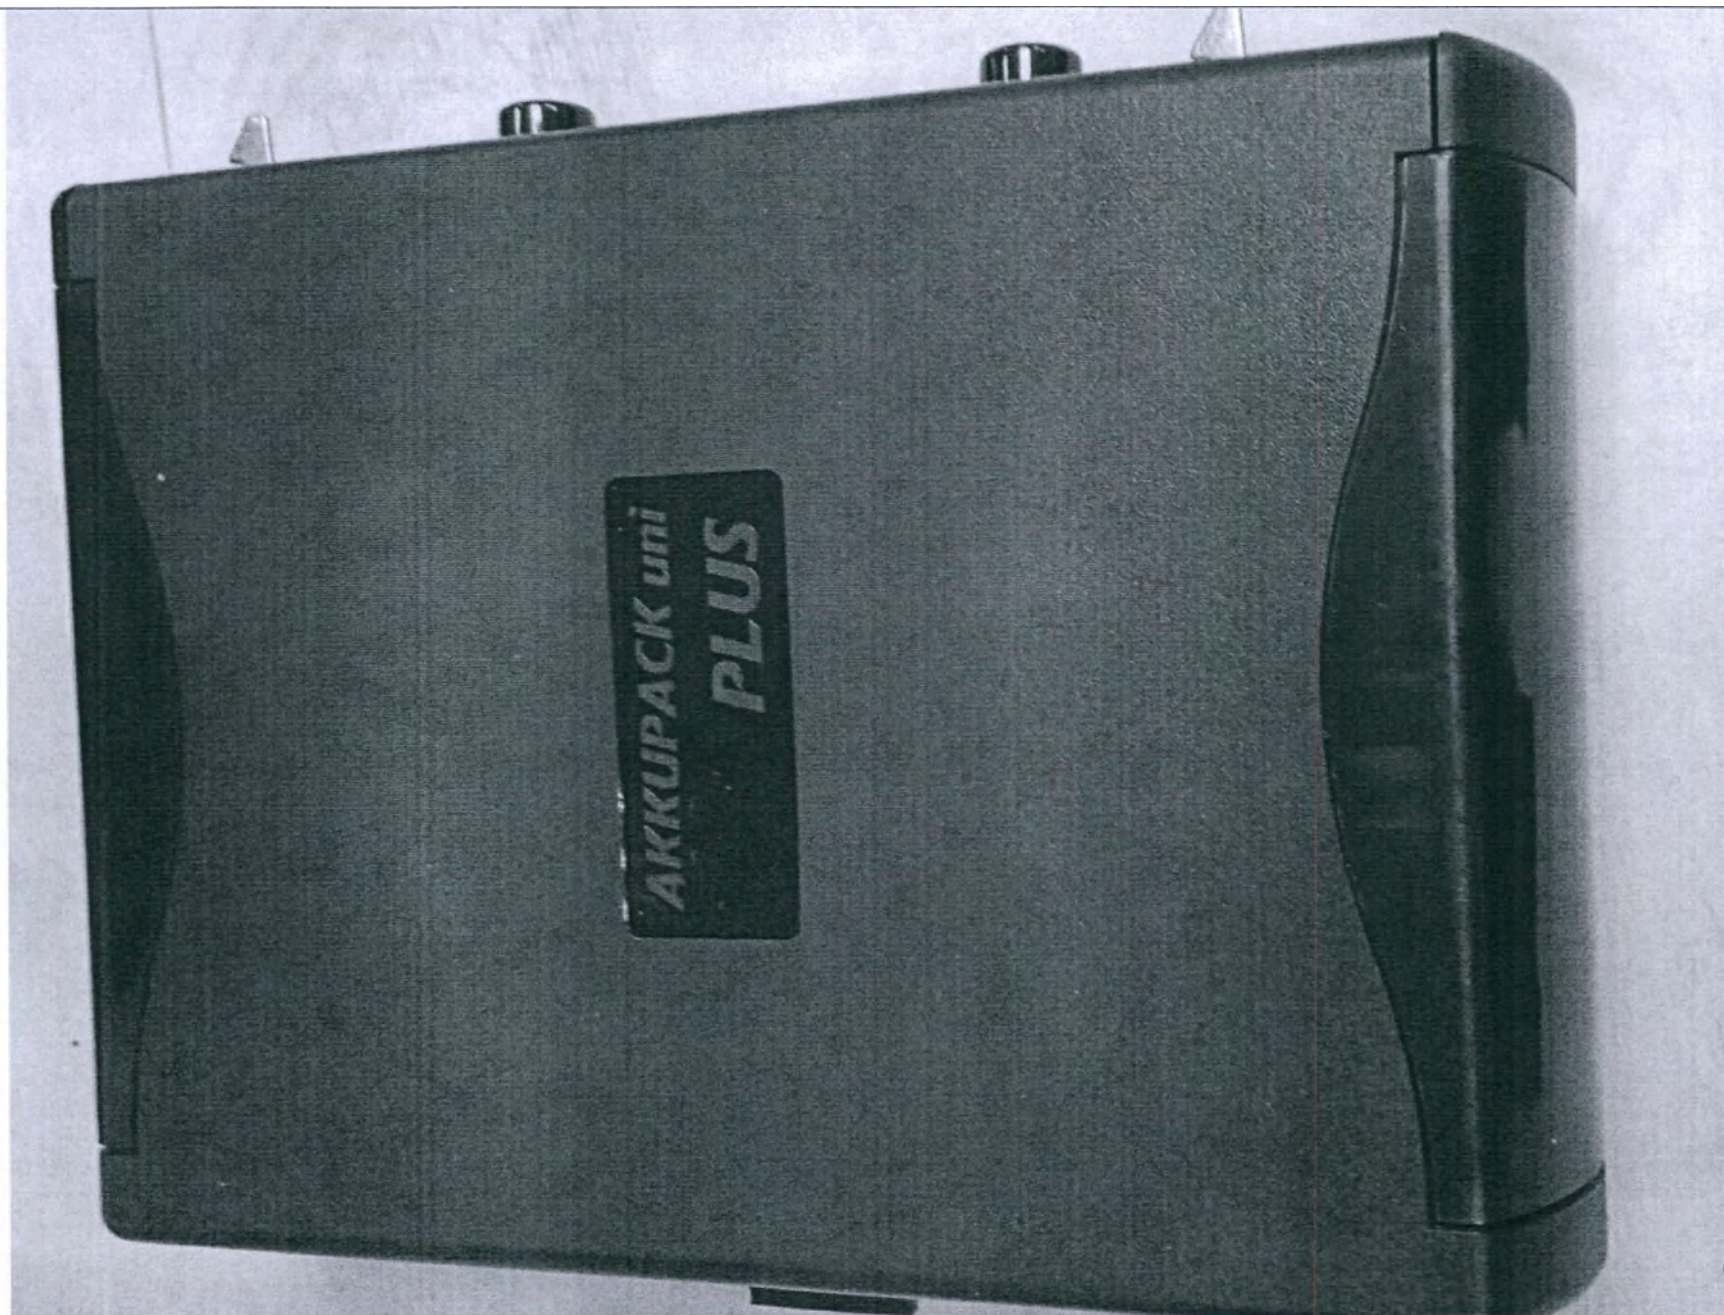


6.13. Блок питания AKKUPACK uni PLUS

Дыхательный контур аппарата ИВЛ с измерительной трубкой давления и контрольной трубкой SBS 22 SBU/180 см



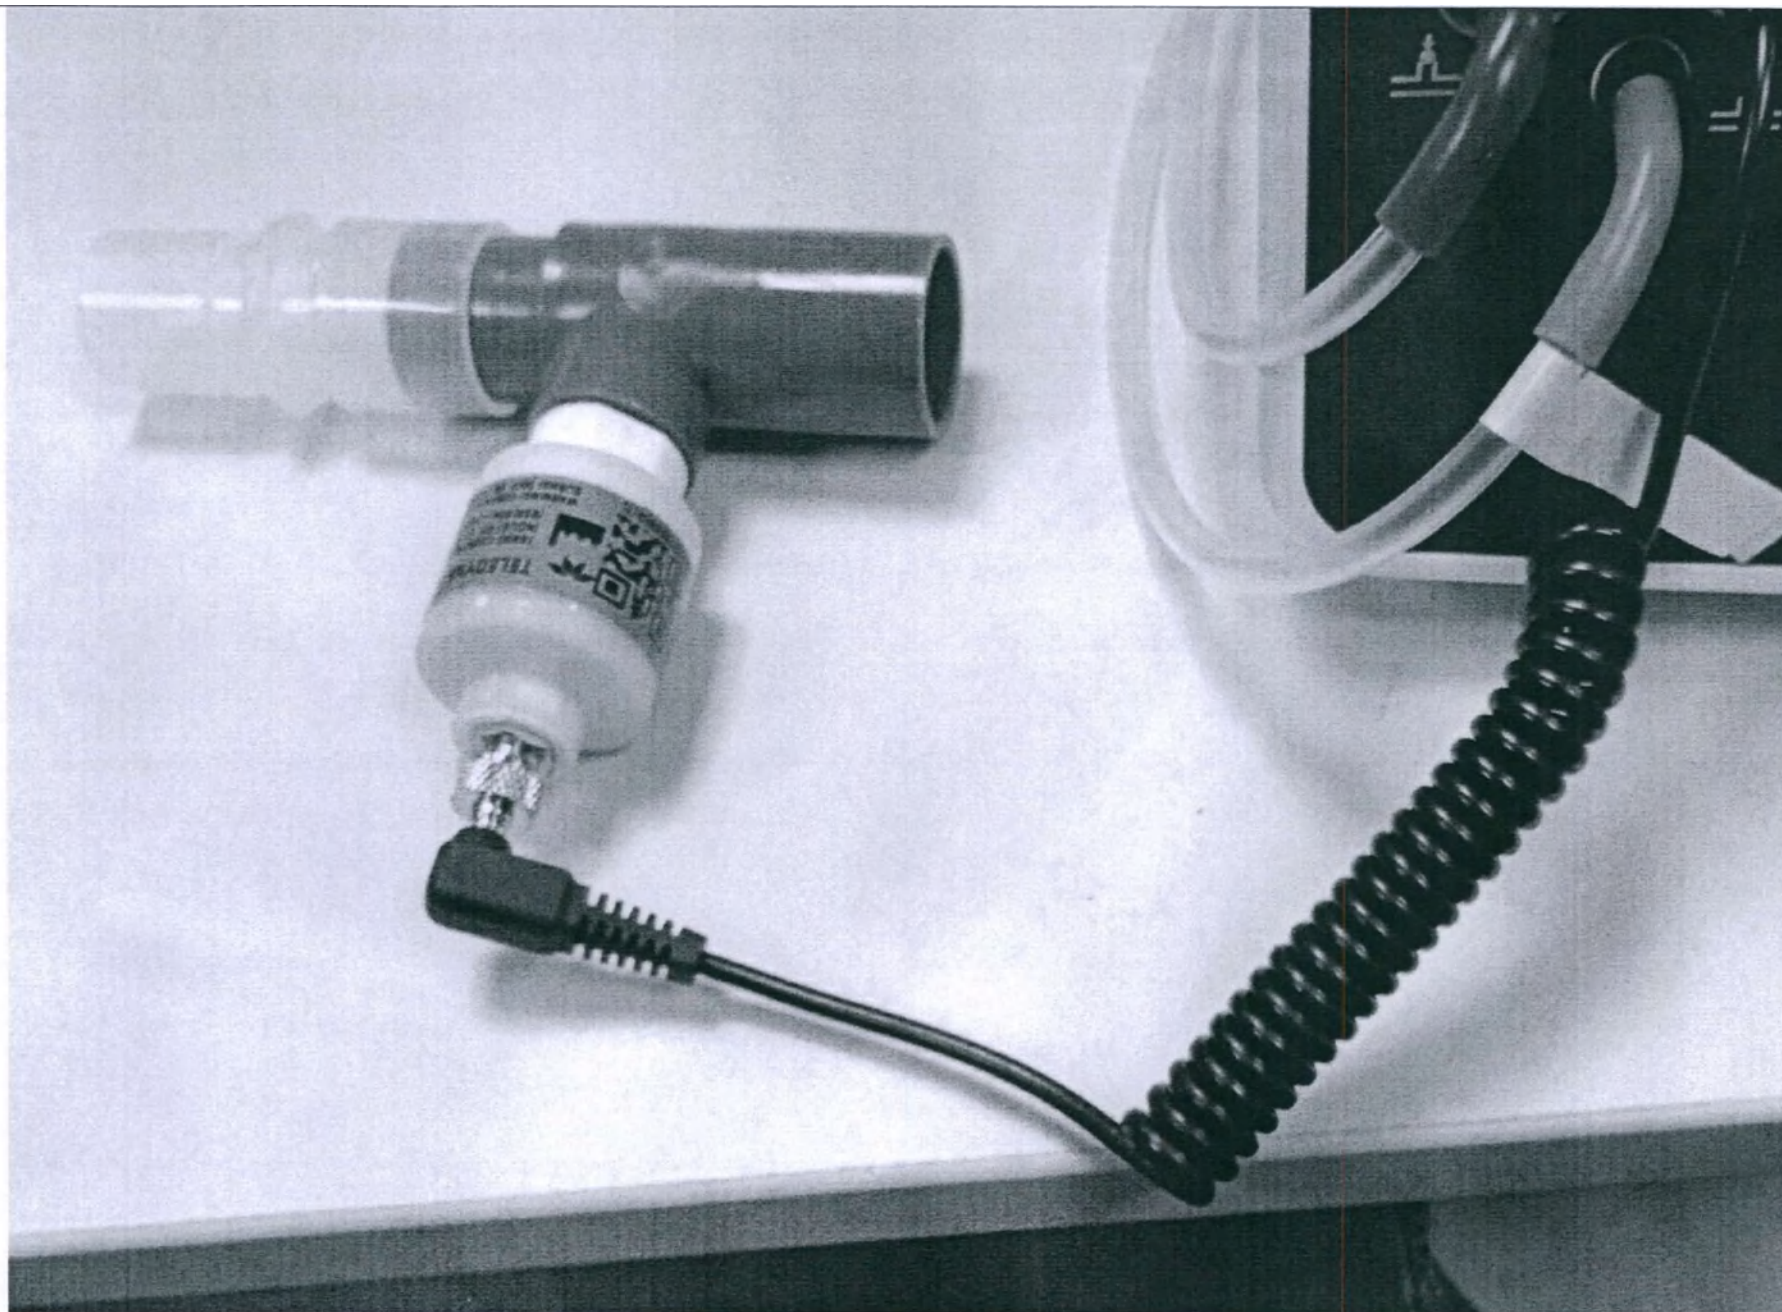

6.15. Адаптер прямого соединения FiO₂ (Комплект для измерения FiO₂, состоящий из FiO₂, датчика, Т-адаптера, адаптера датчика FiO₂, соединительной линии FiO₂-датчик с винтовым соединением)

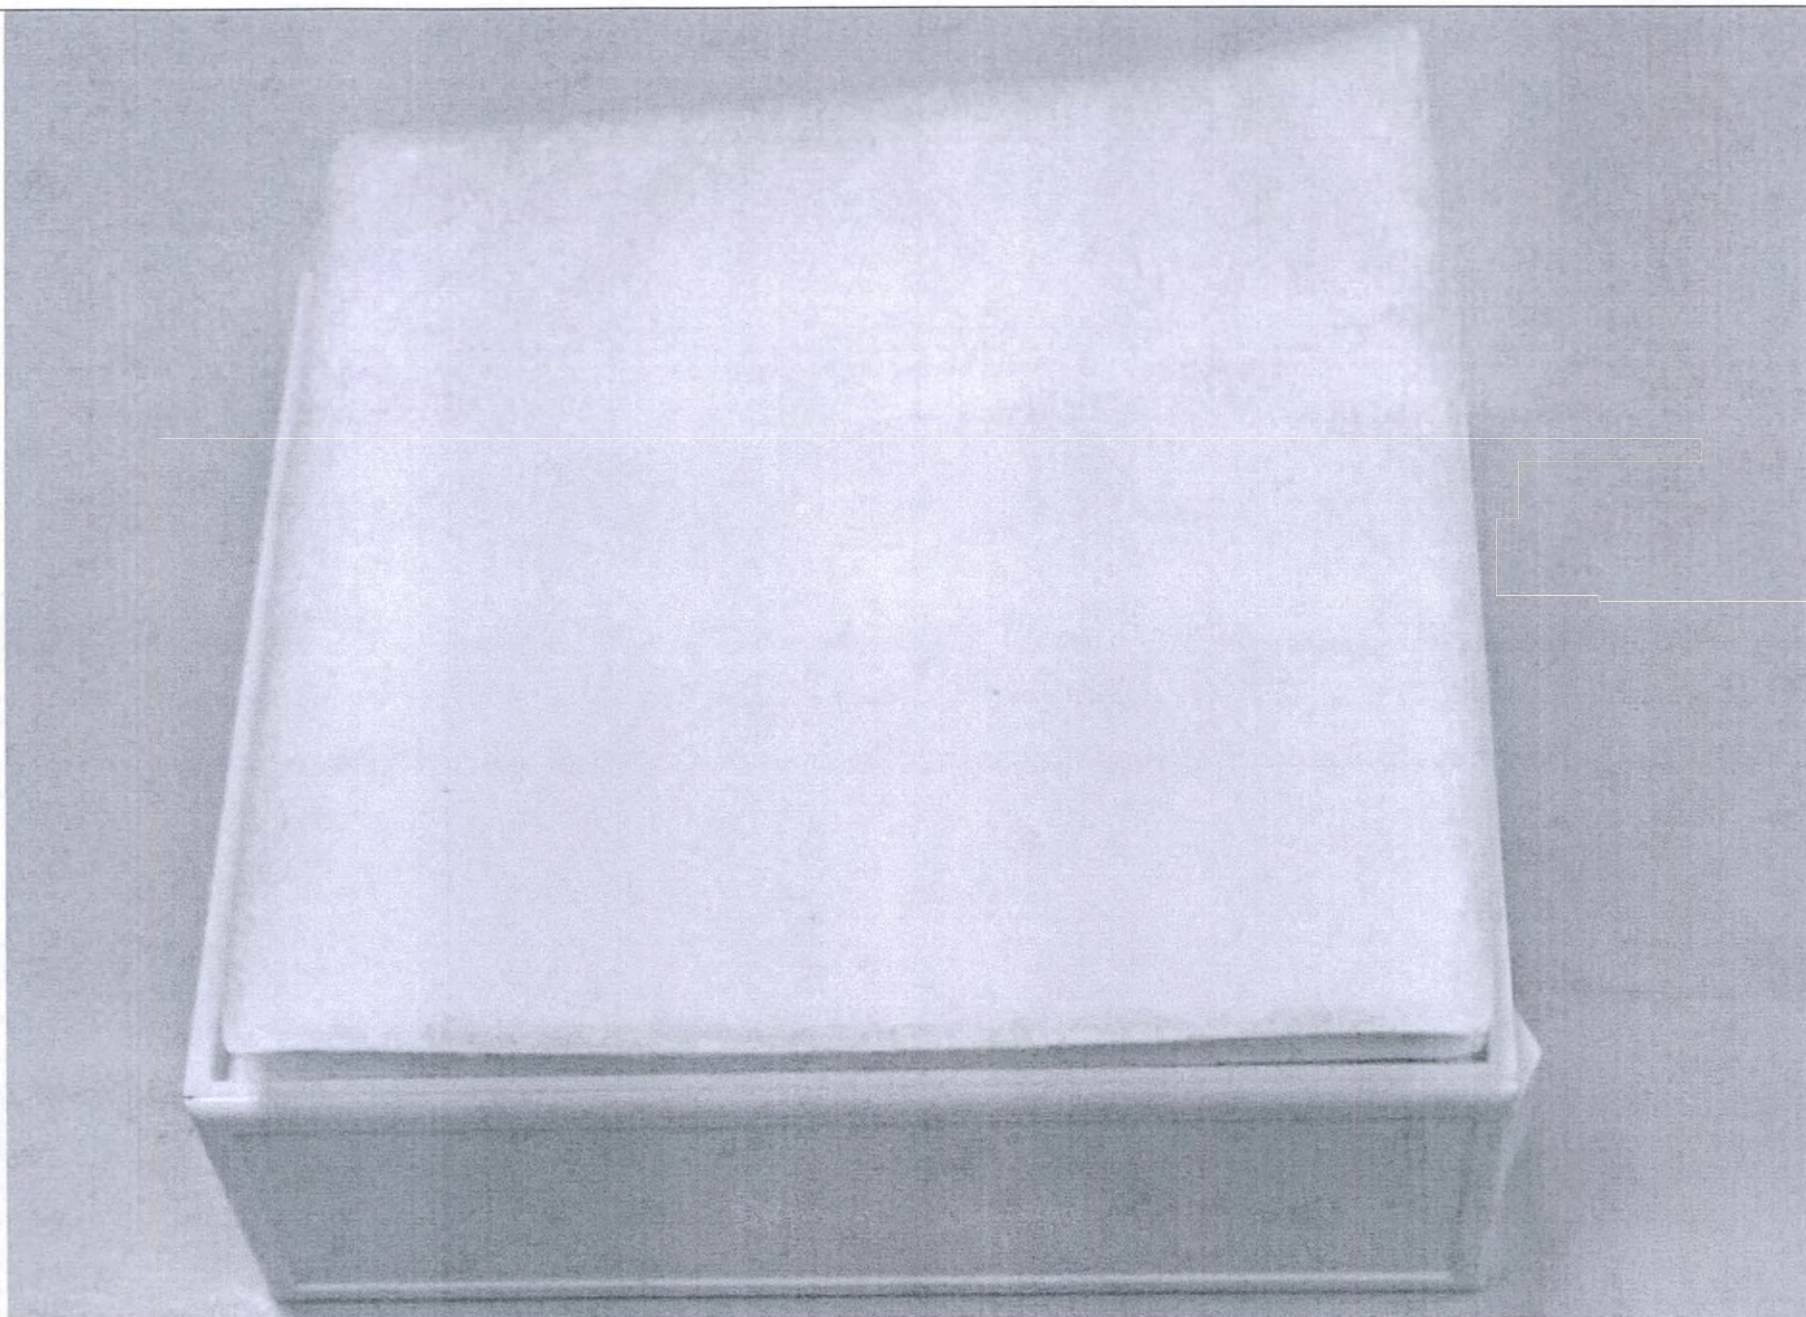

6.16. Запасной фильтр тонкой очистки, 1 упаковка (5 шт.)




7.1. Аппарат ИВЛ CARAT II рго, основной блок


Сетевой шнур




7.3. Сетевой шнур

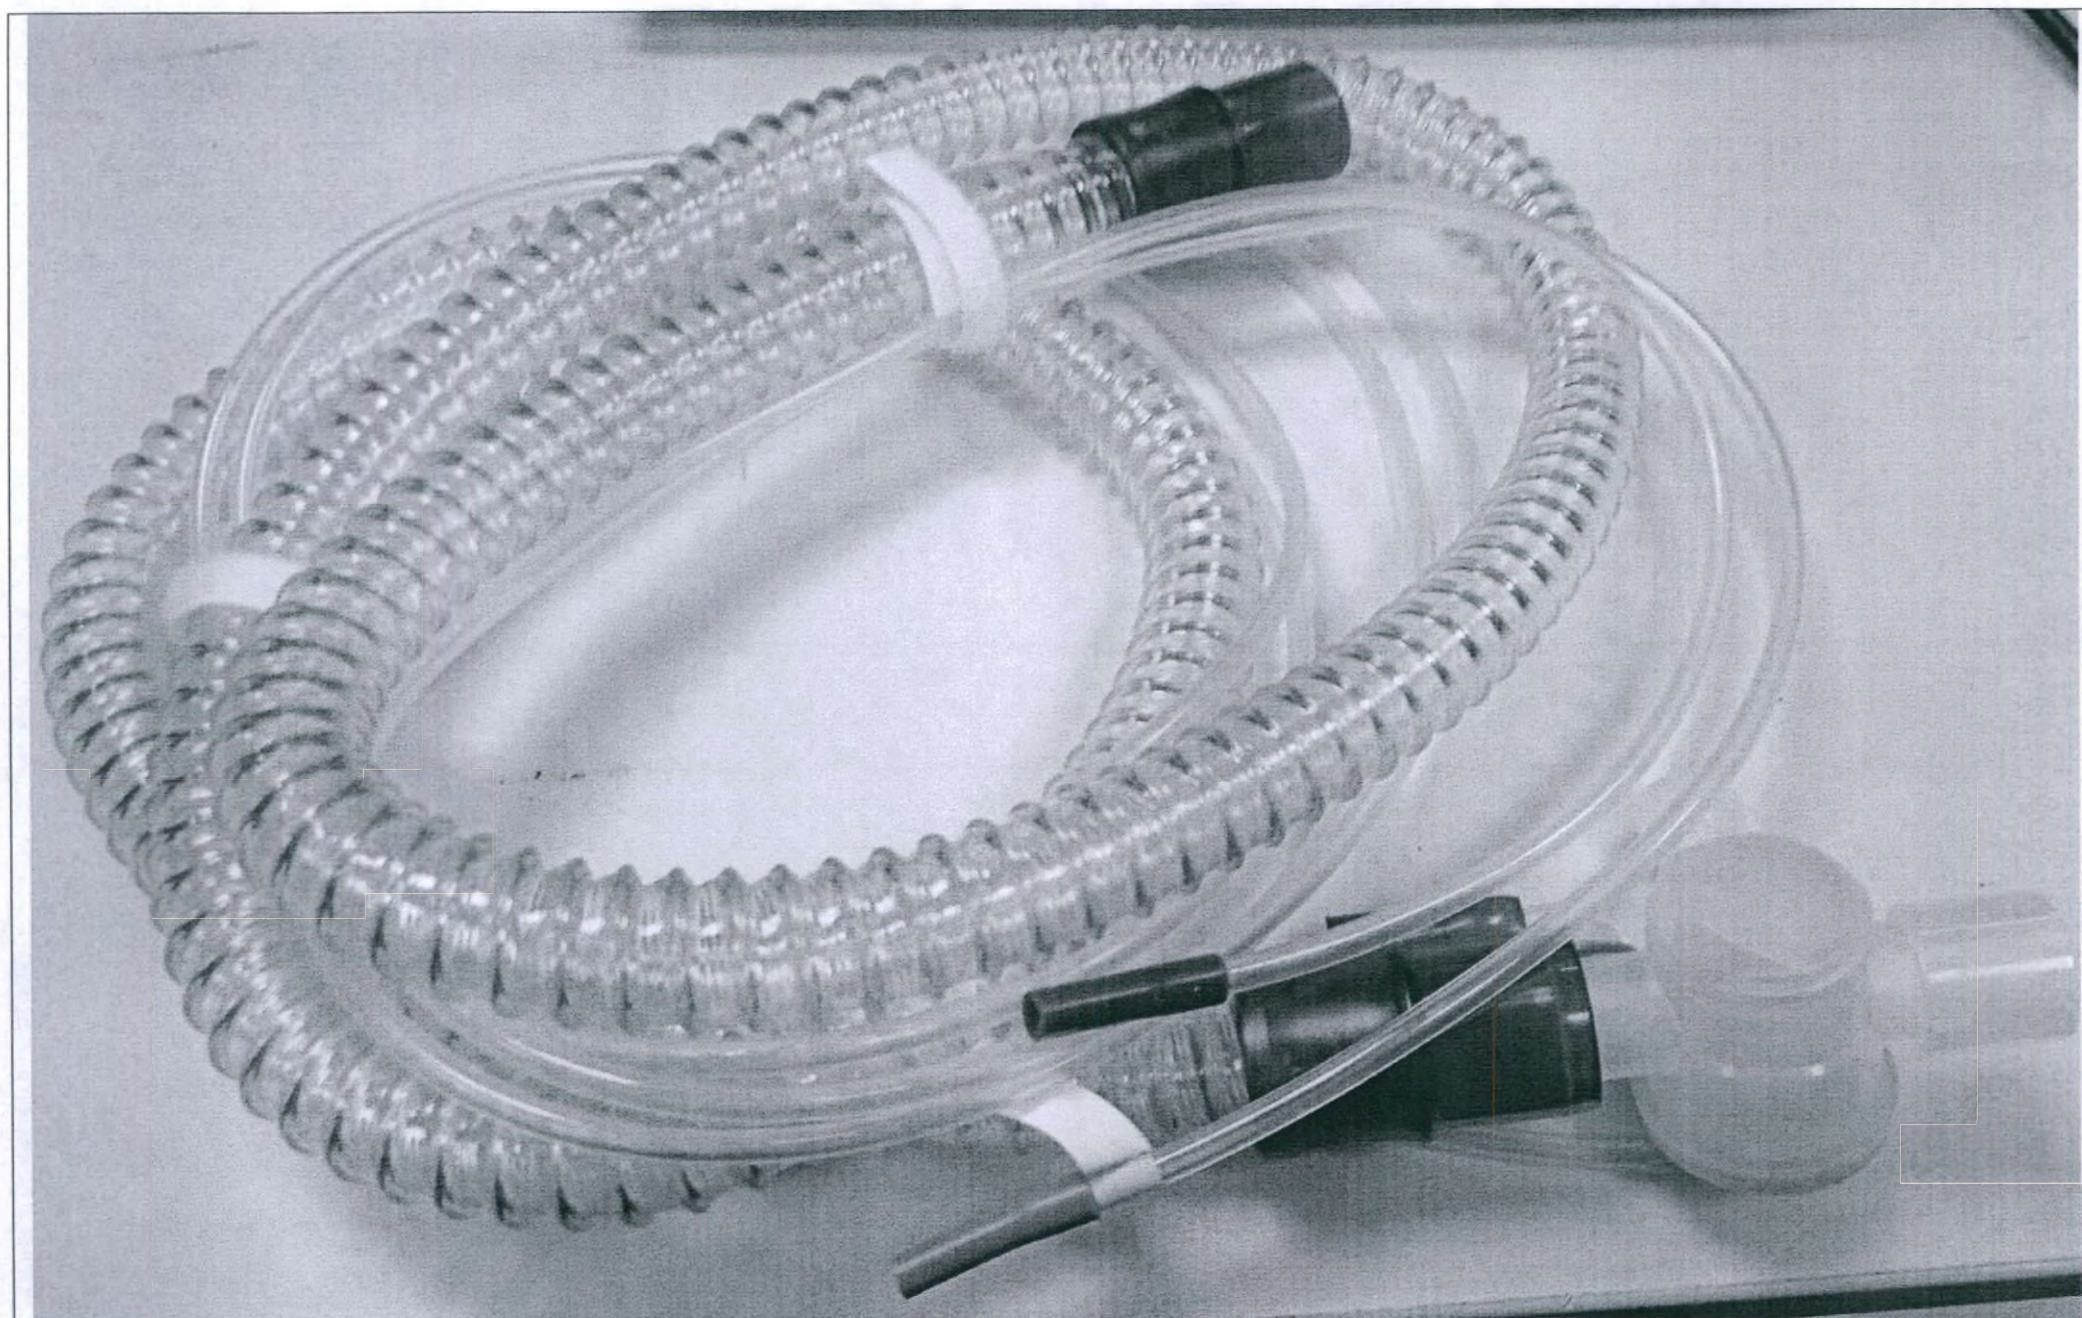

7.4. Лвойной дыхательный контур аппарата ИВЛ с измерительной трубкой давления и контрольной трубкой.

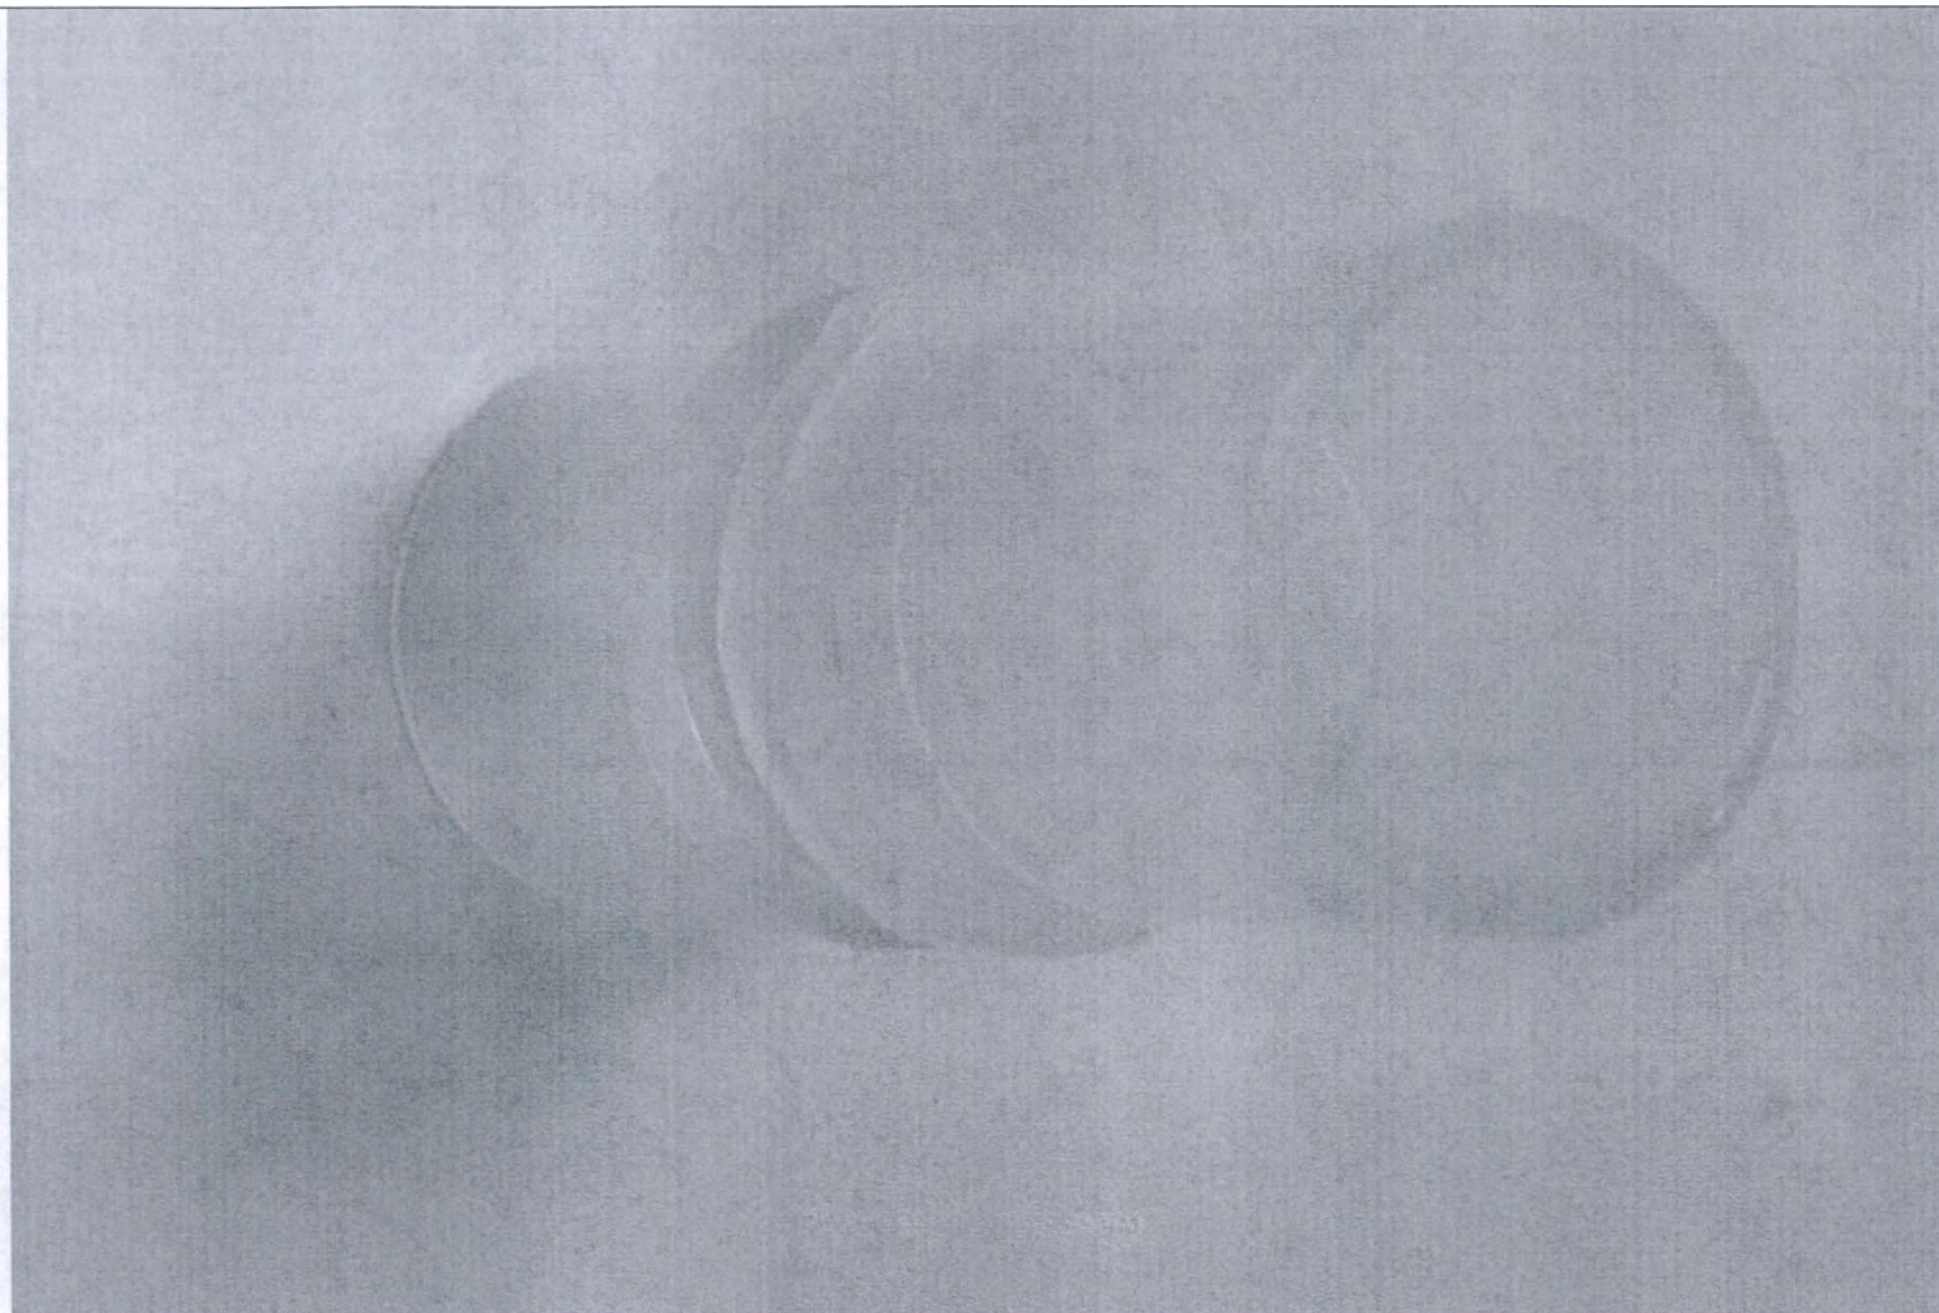


7.5. Насадка для бактериального фильтра

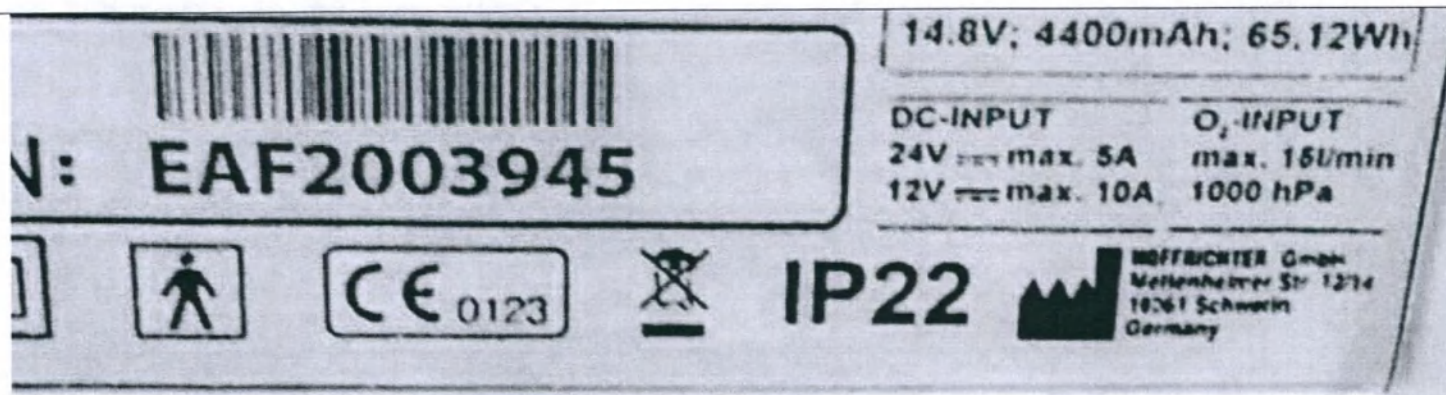


7.6. SD карта



Запасная
фильтрующая
кассета открытая

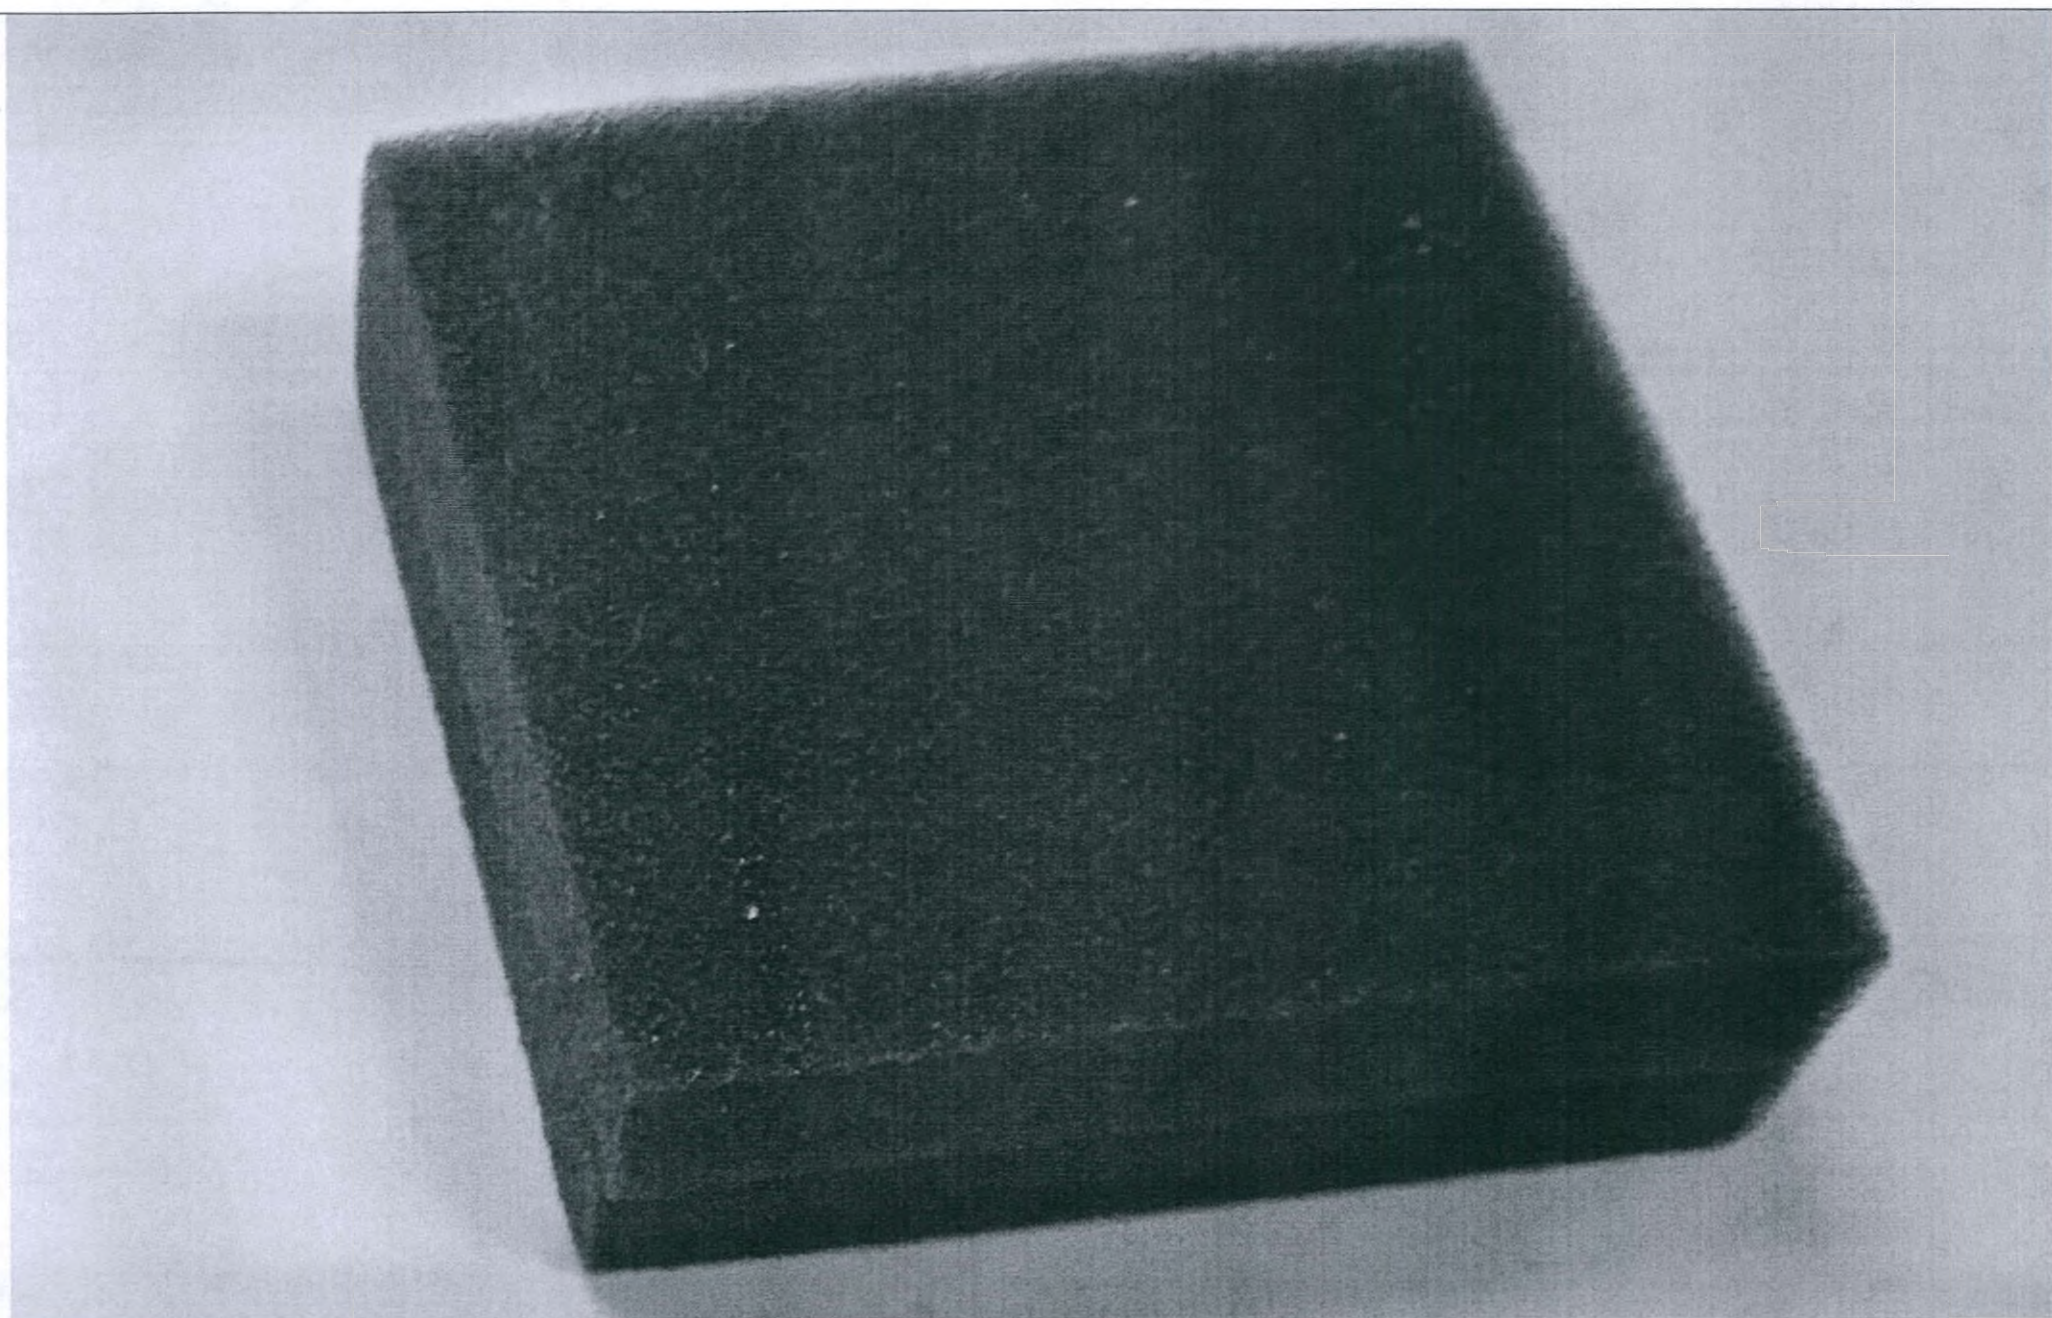


7.8. Запасной фильтр грубой очистки, 1 упаковка (2 шт.)

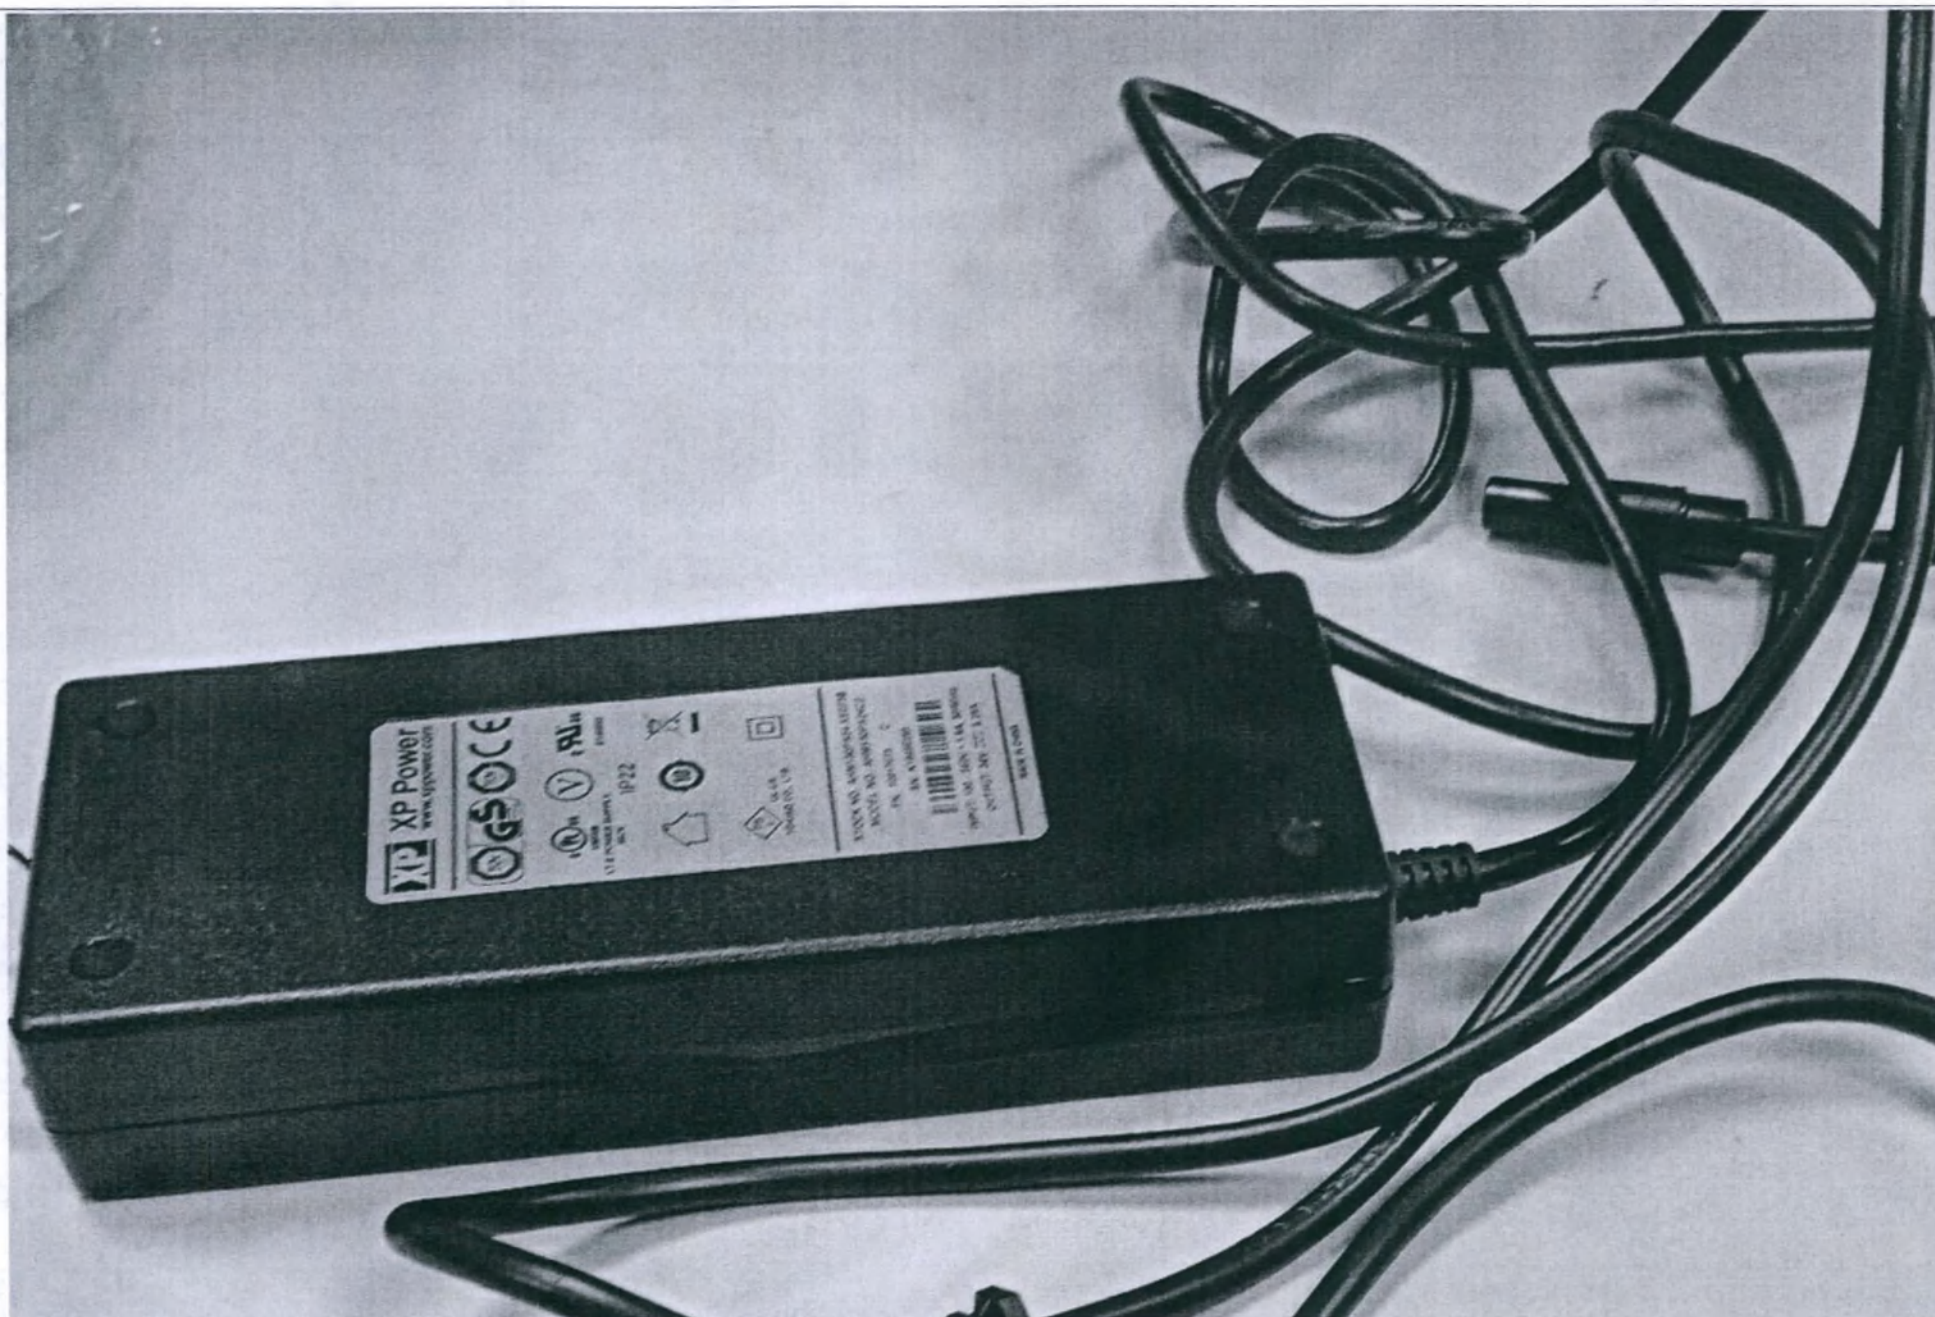


8.1. Внешний аккумуляторный блок



8.2. Бактериальный фильтр (при необходимости)

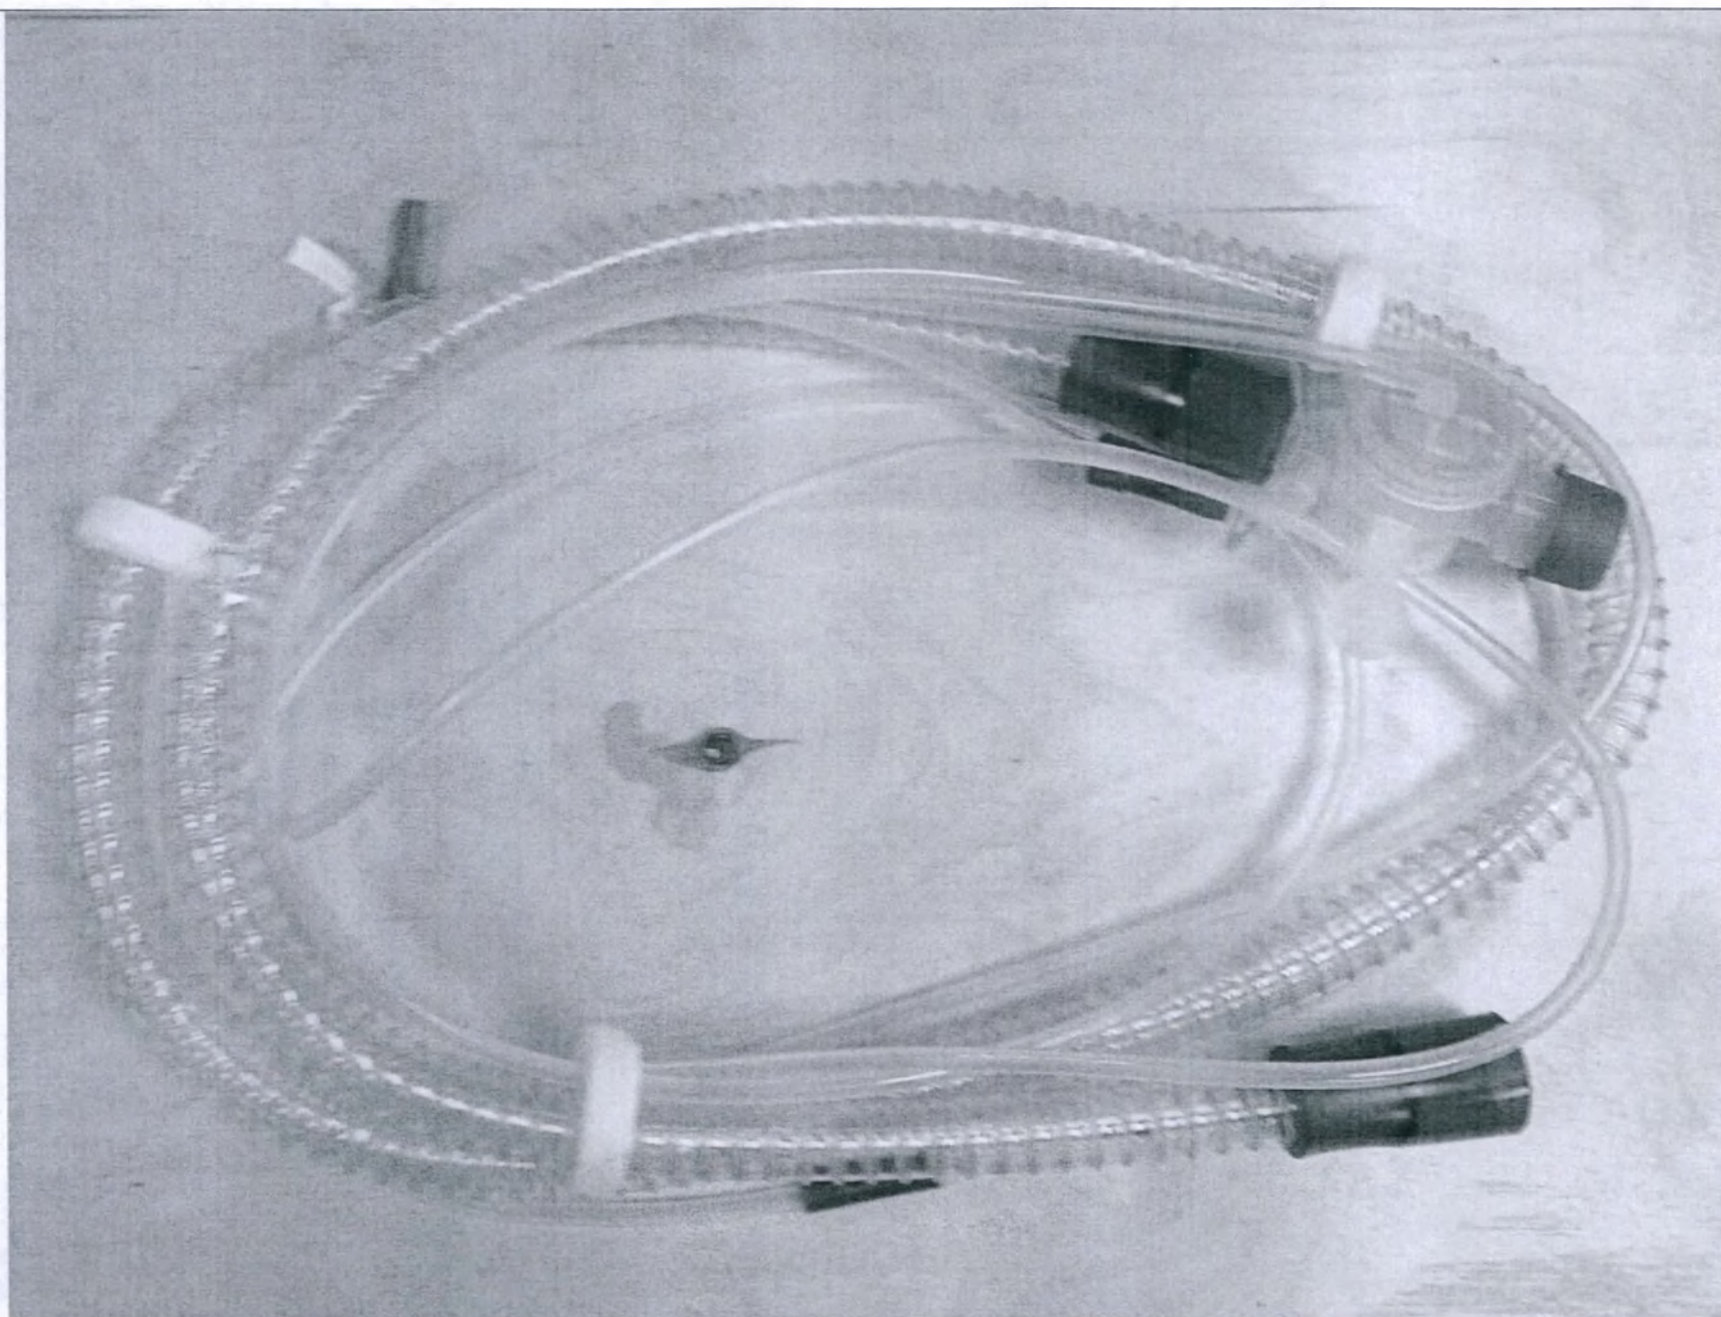

8.3. SERVOVENT Односторонняя дыхательная система SBS 15 SBU 15 ID/150 см для детей

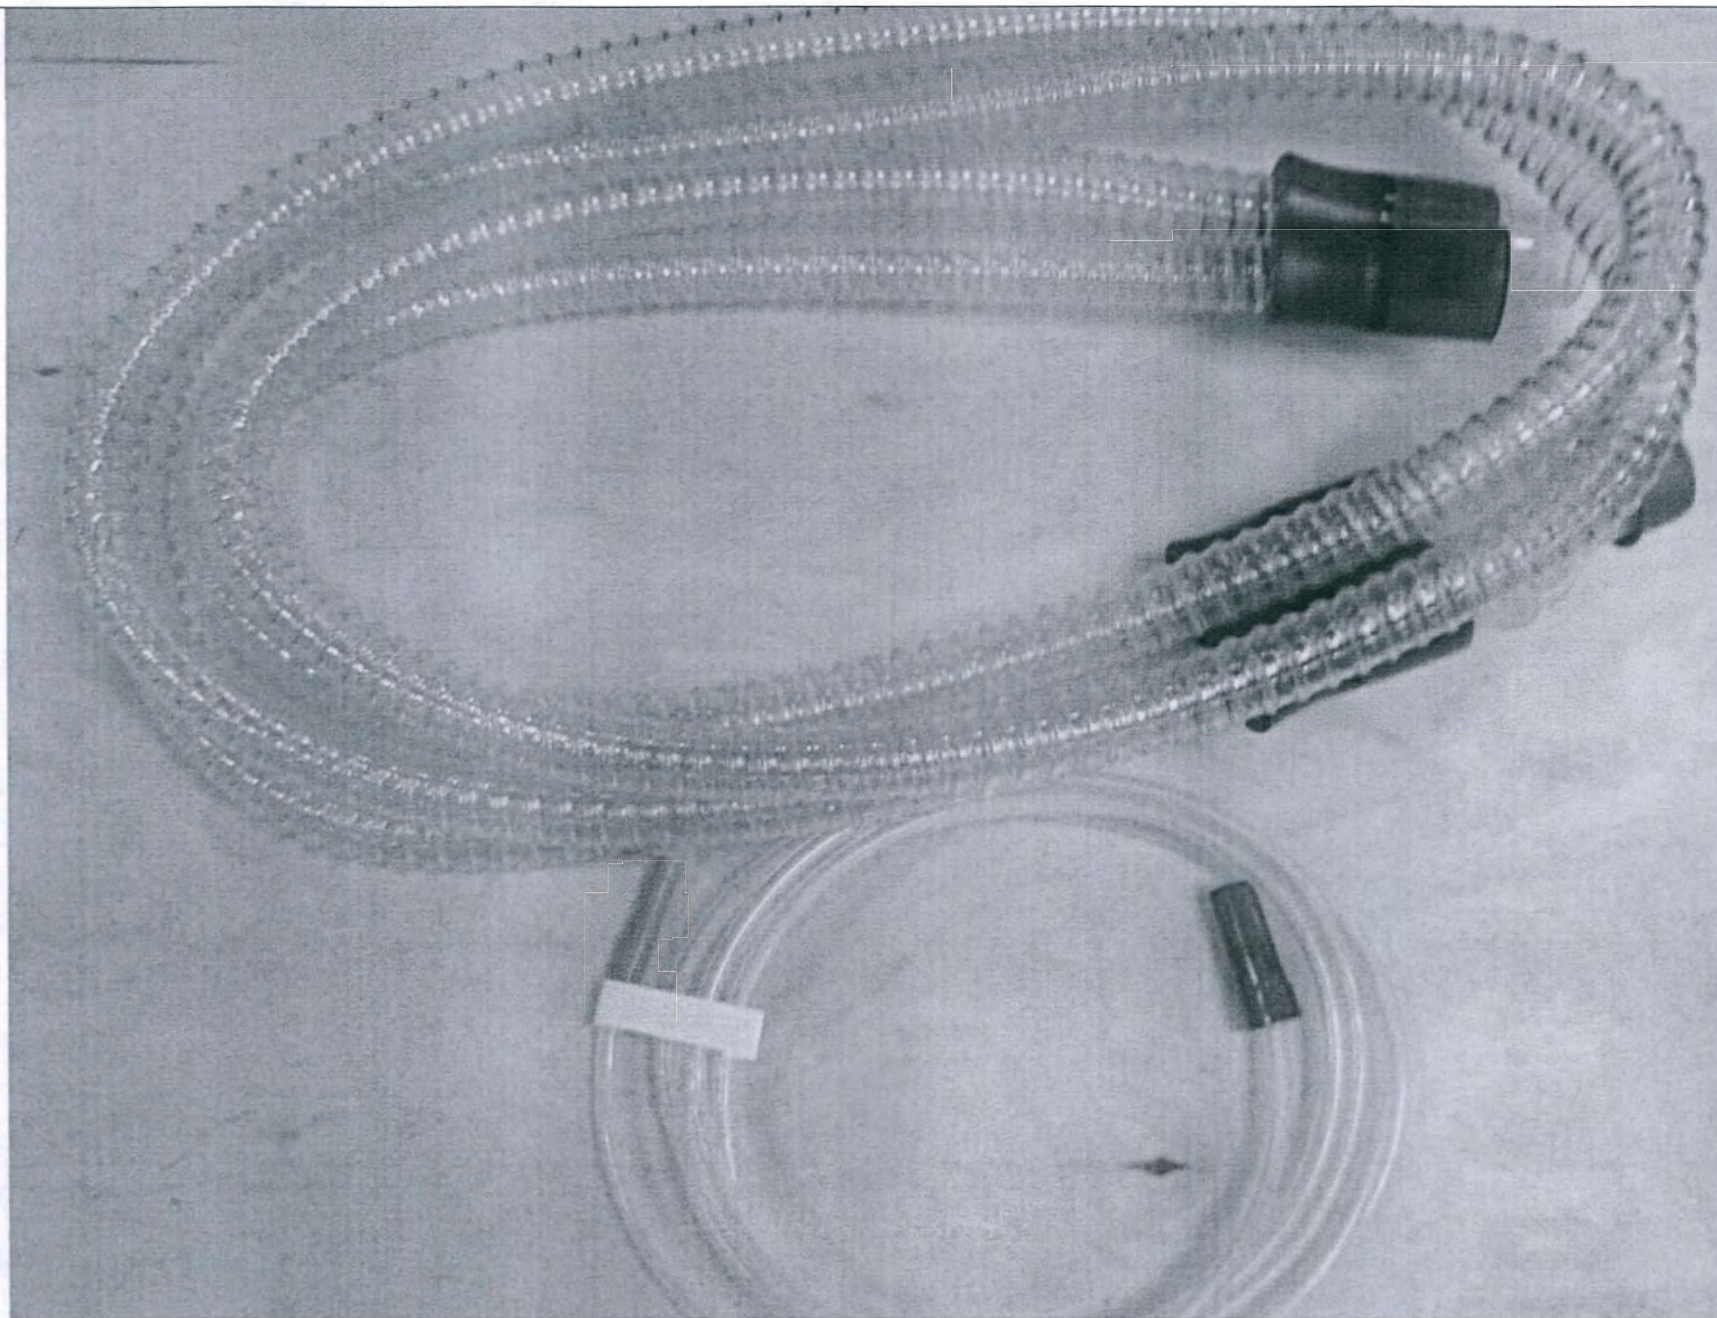

8.4. SERVOVENT Двухканальная дыхательная система DBS 15 SBU 15 ID/150 см для детей


Адаптер датчика O2



8.5. Адаптер датчика O2




8.6. Кабель датчика O₂ с винтовым разъемом

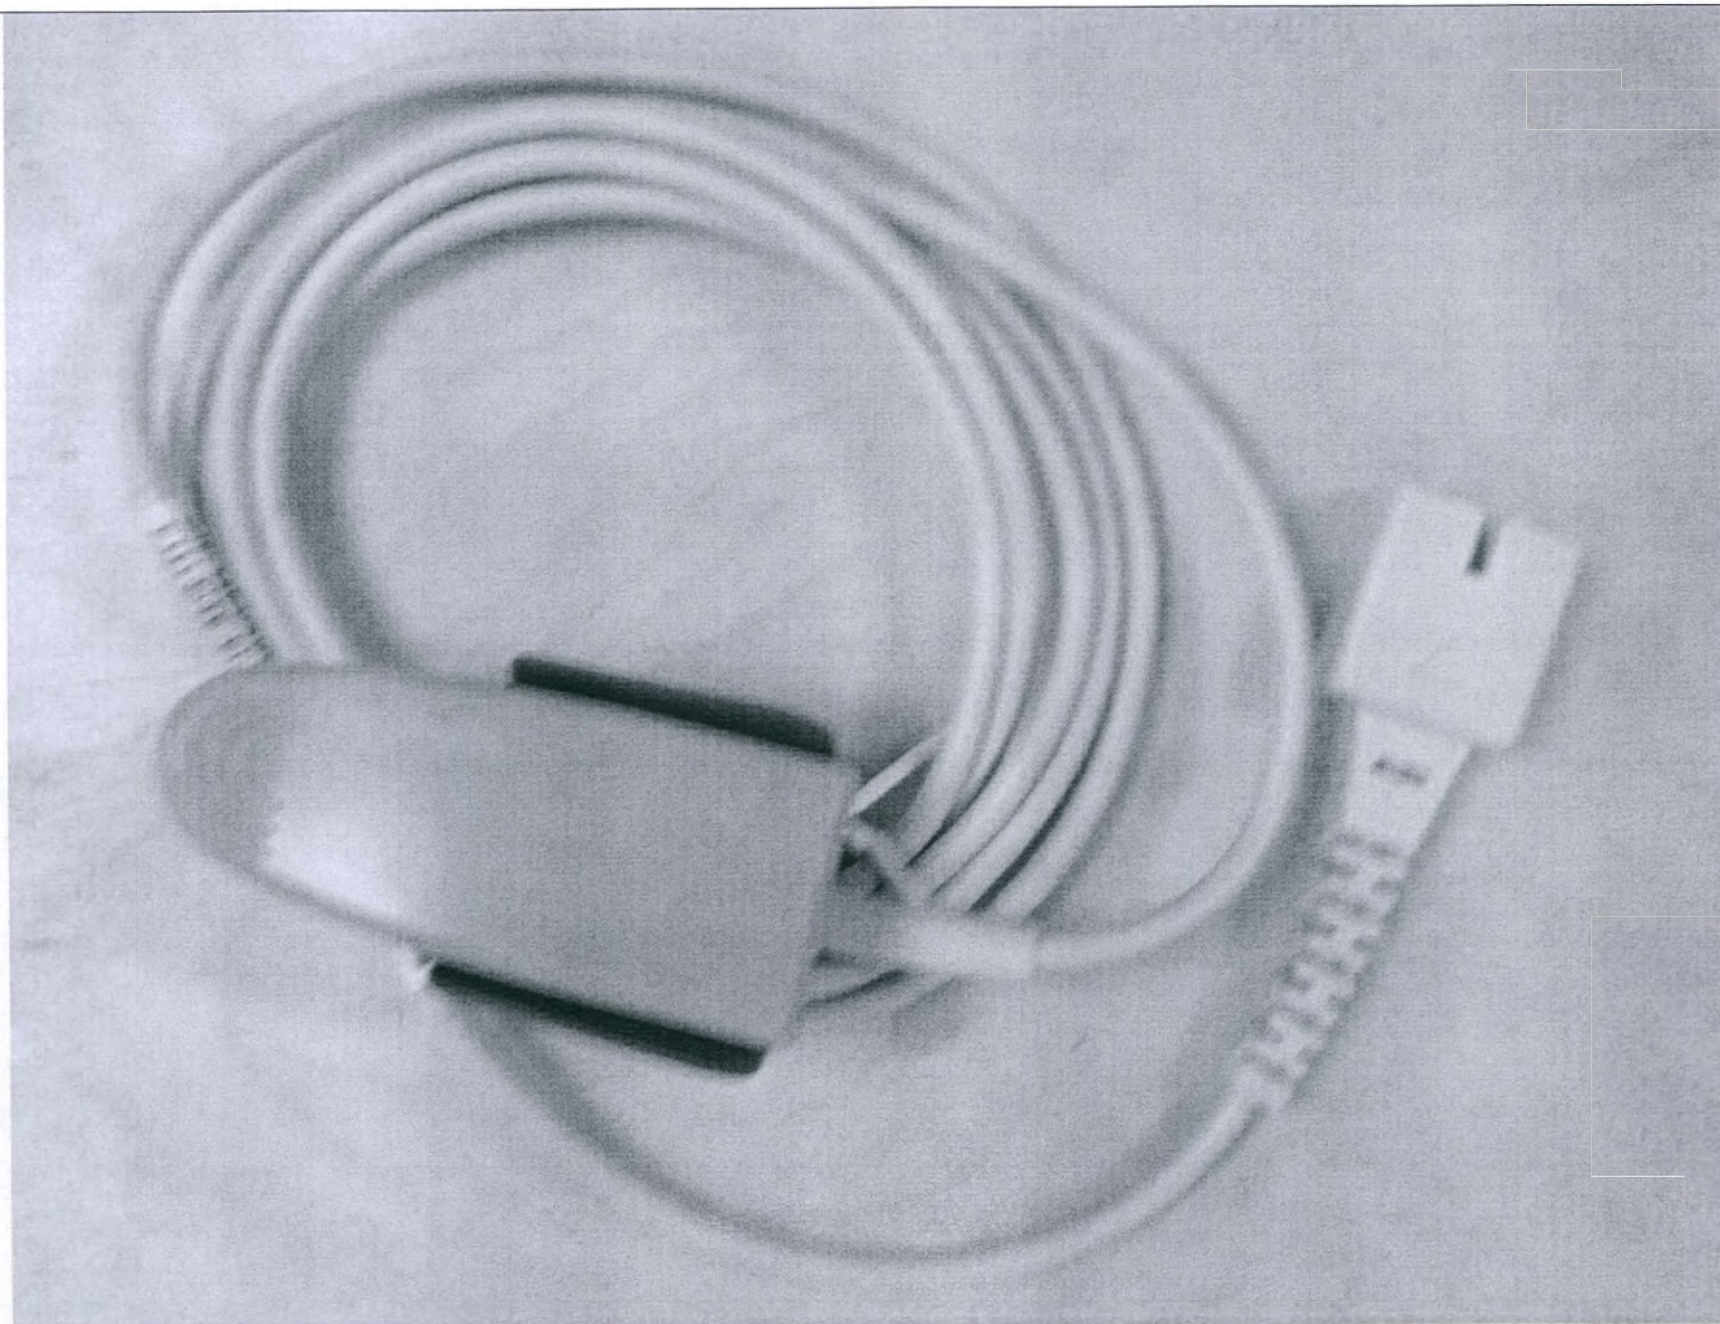


8.7. SpO₂ датчик-зажим на палец с кабелем 2 м




8.8. Тестовое легкое

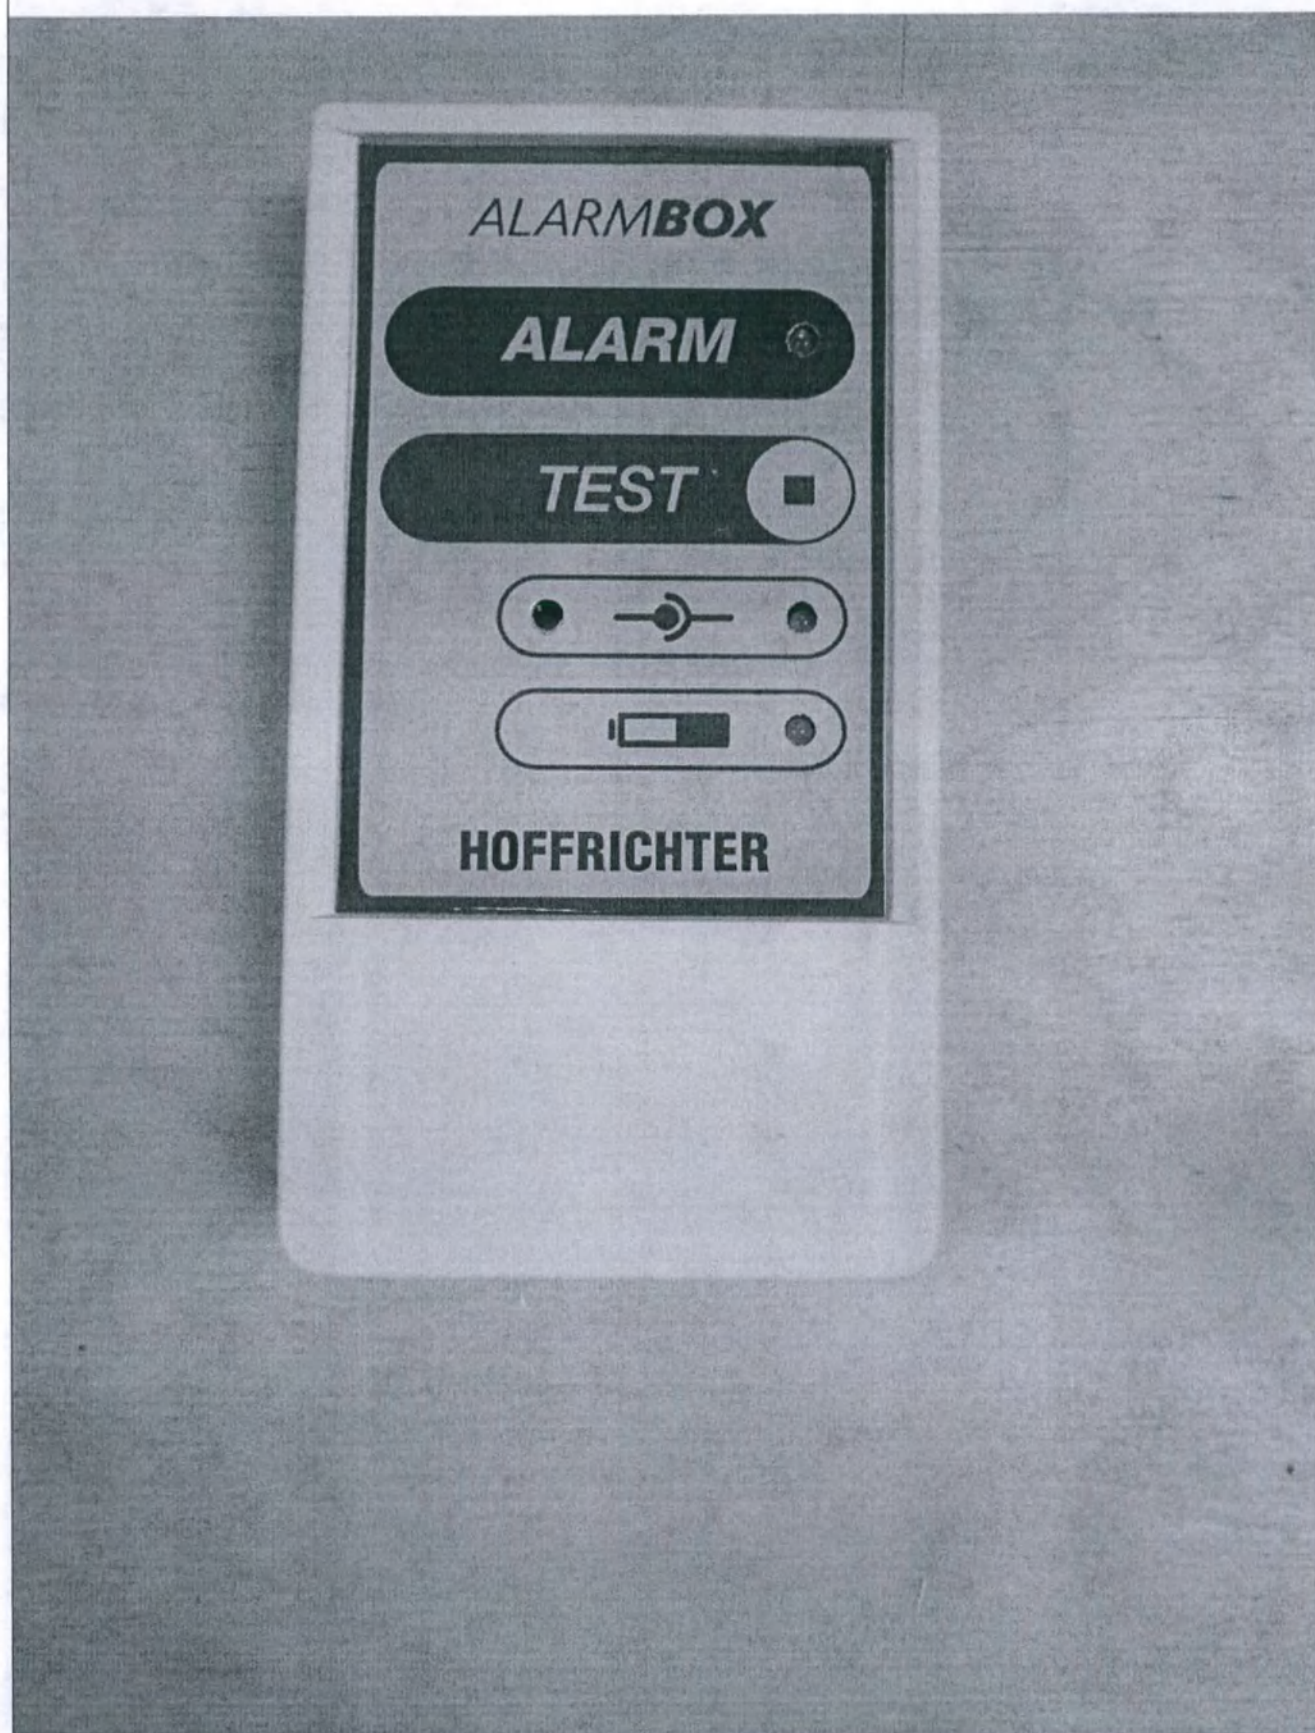


8.9. Выносной будильник

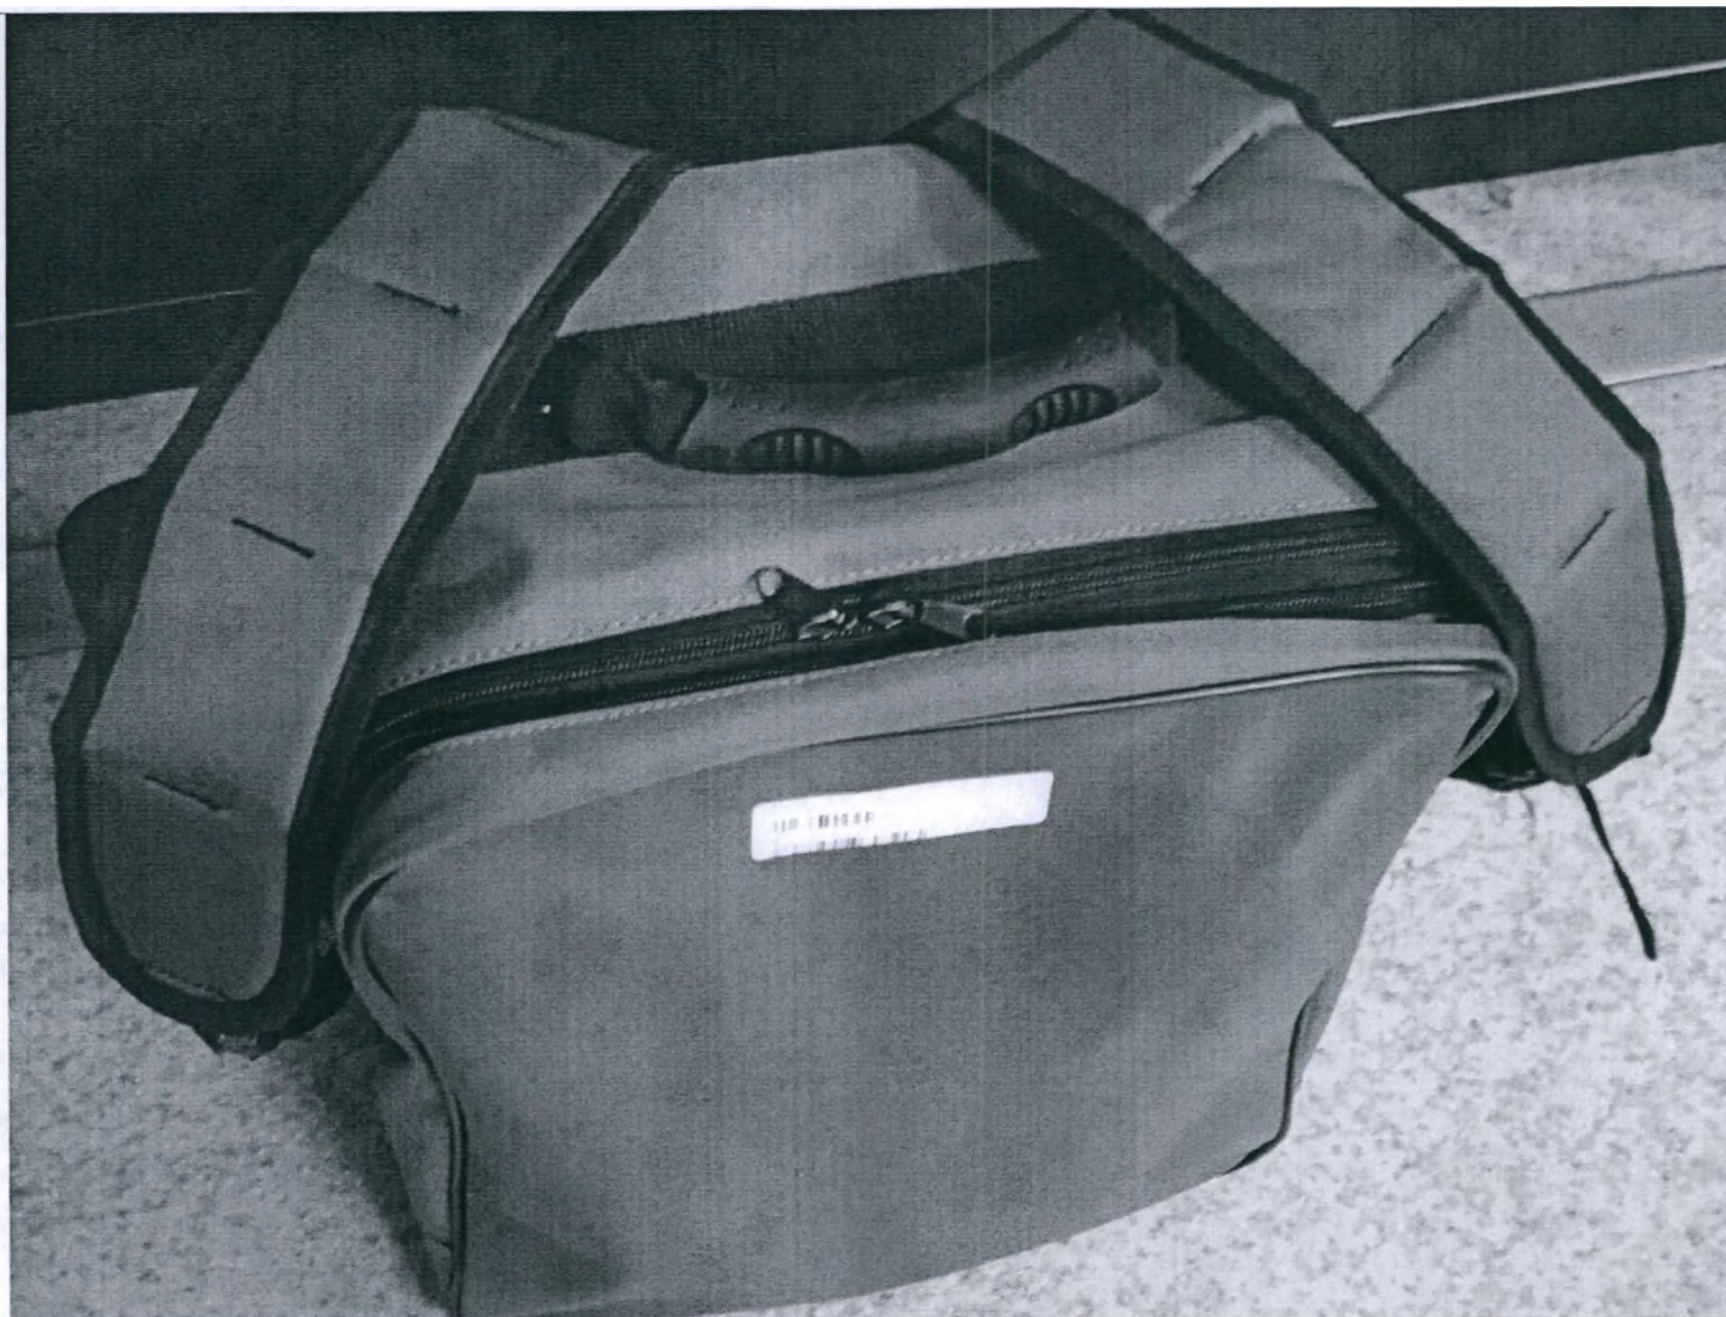


8.10. Чехол для переносок

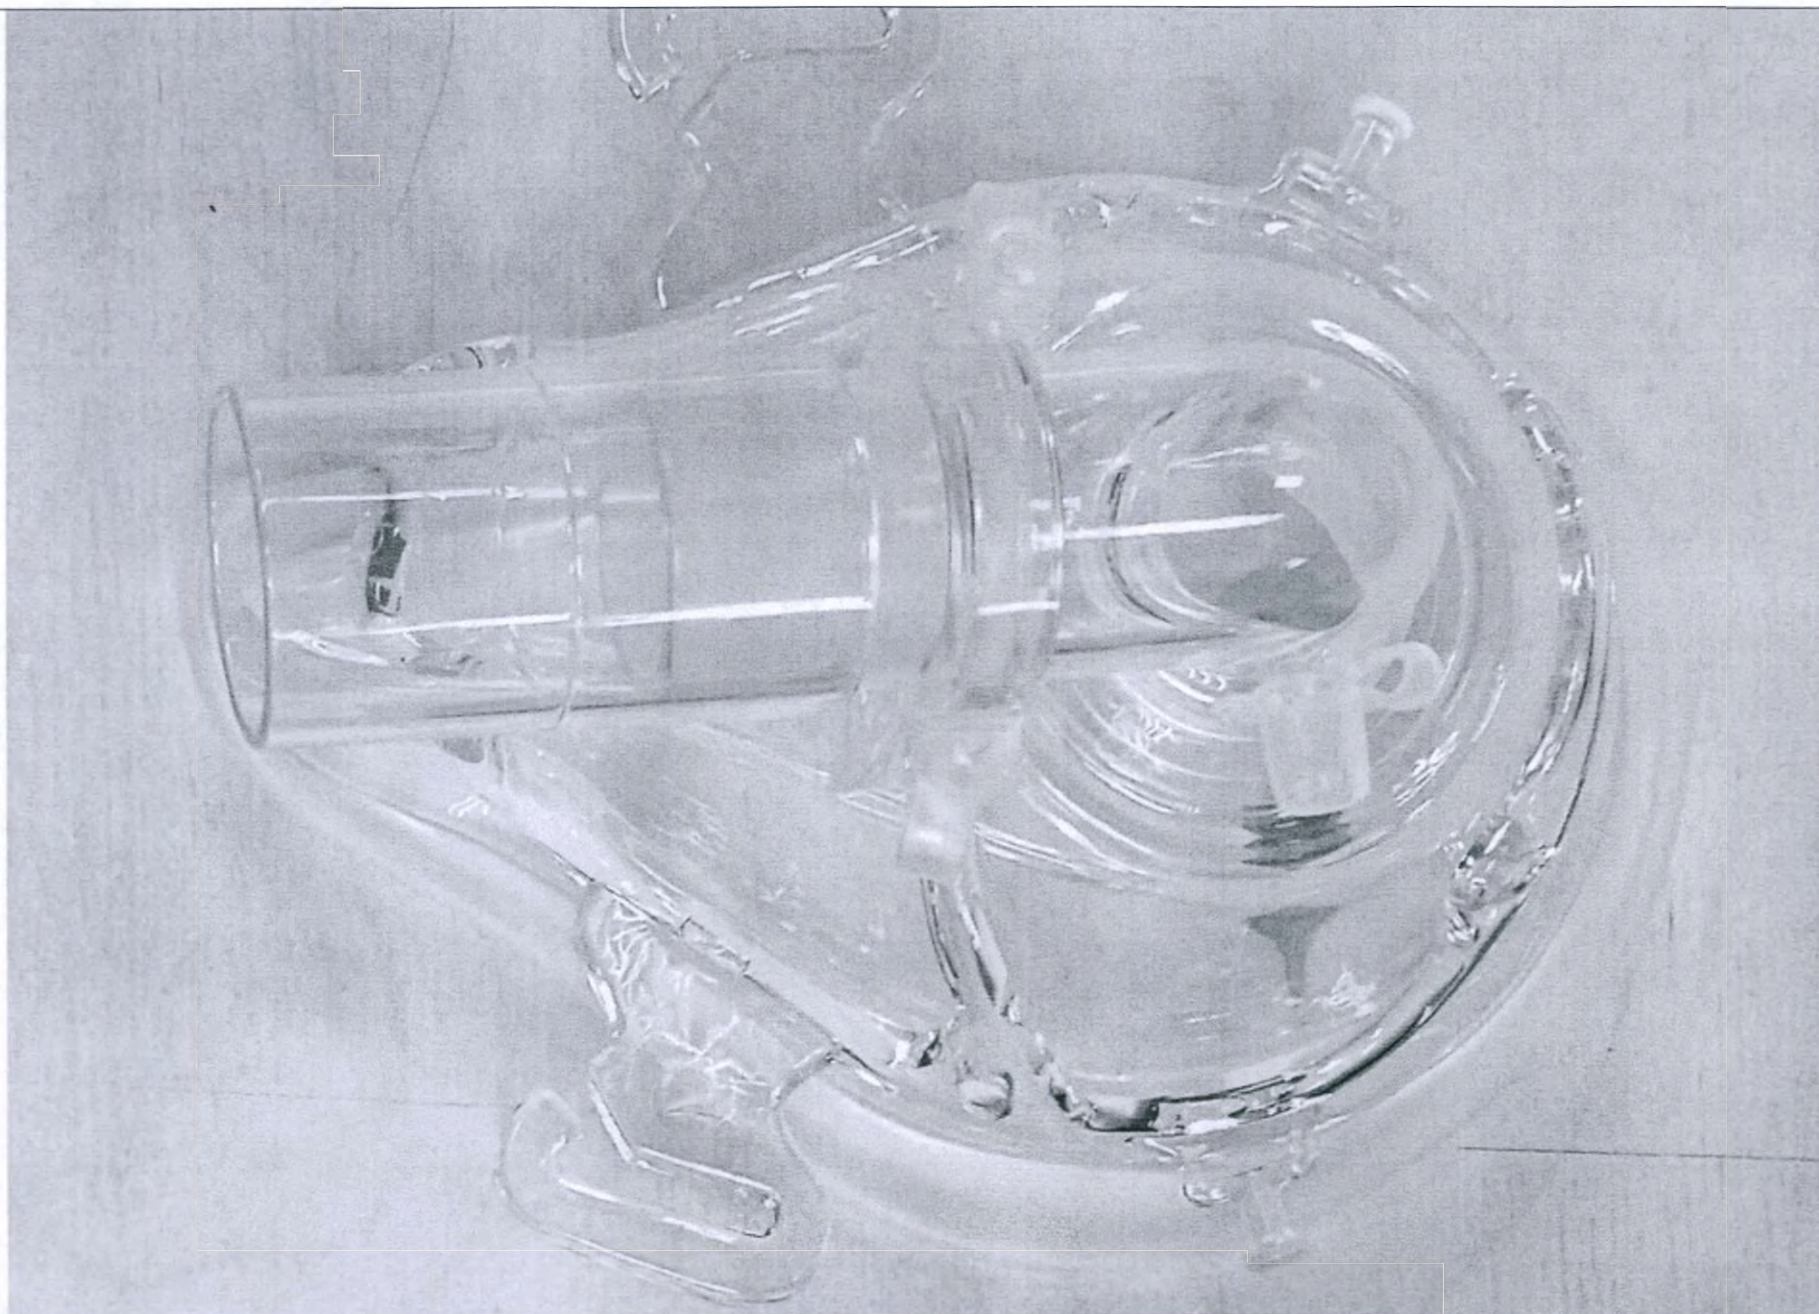


8.11. Маска, модели: 00003461, 00003442, 00003438, 00003462, 00003439

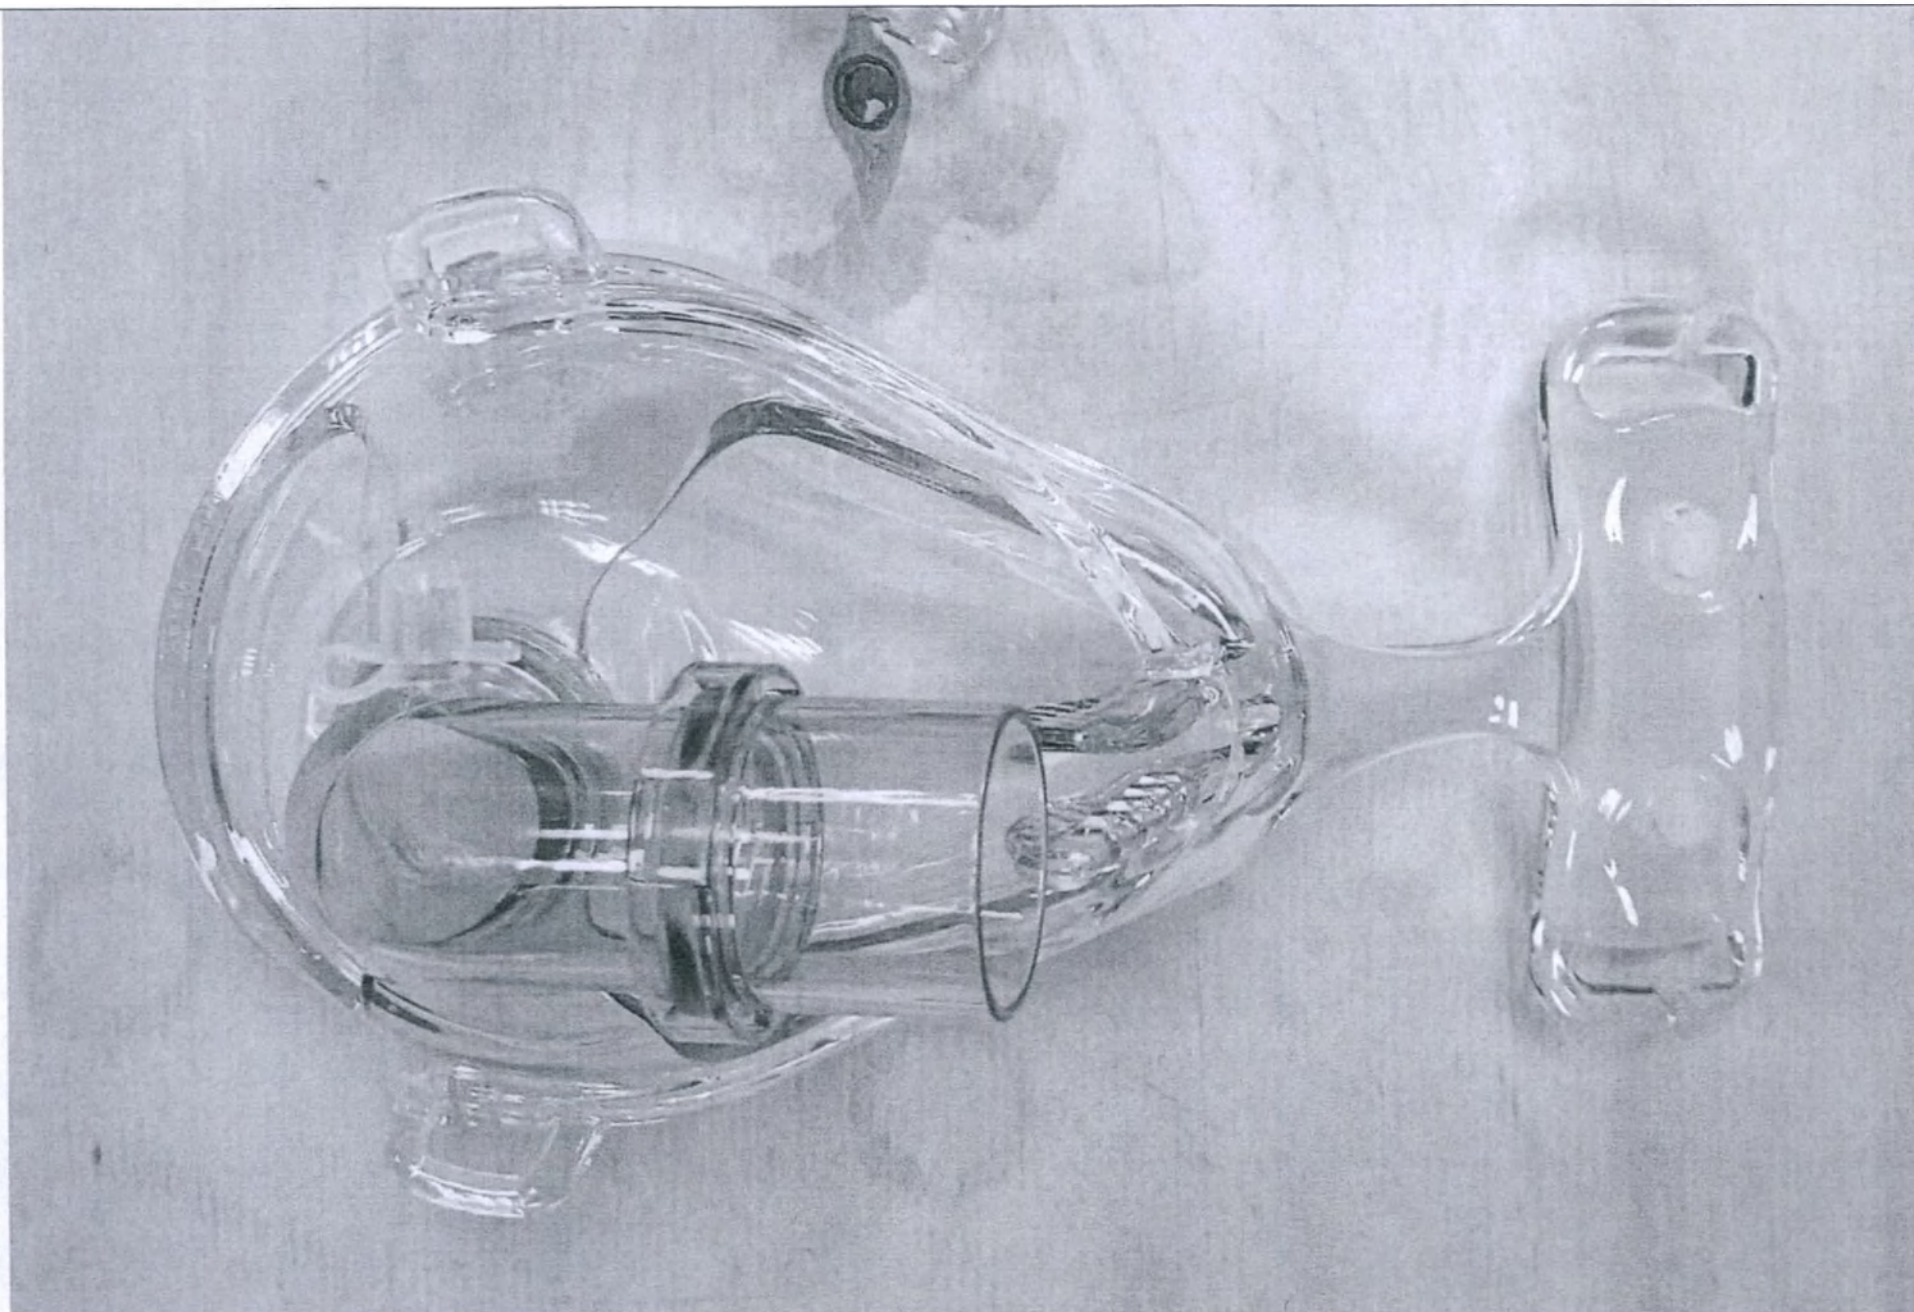

8.11. Маска, модели: 00003489, 00003490, 00003491

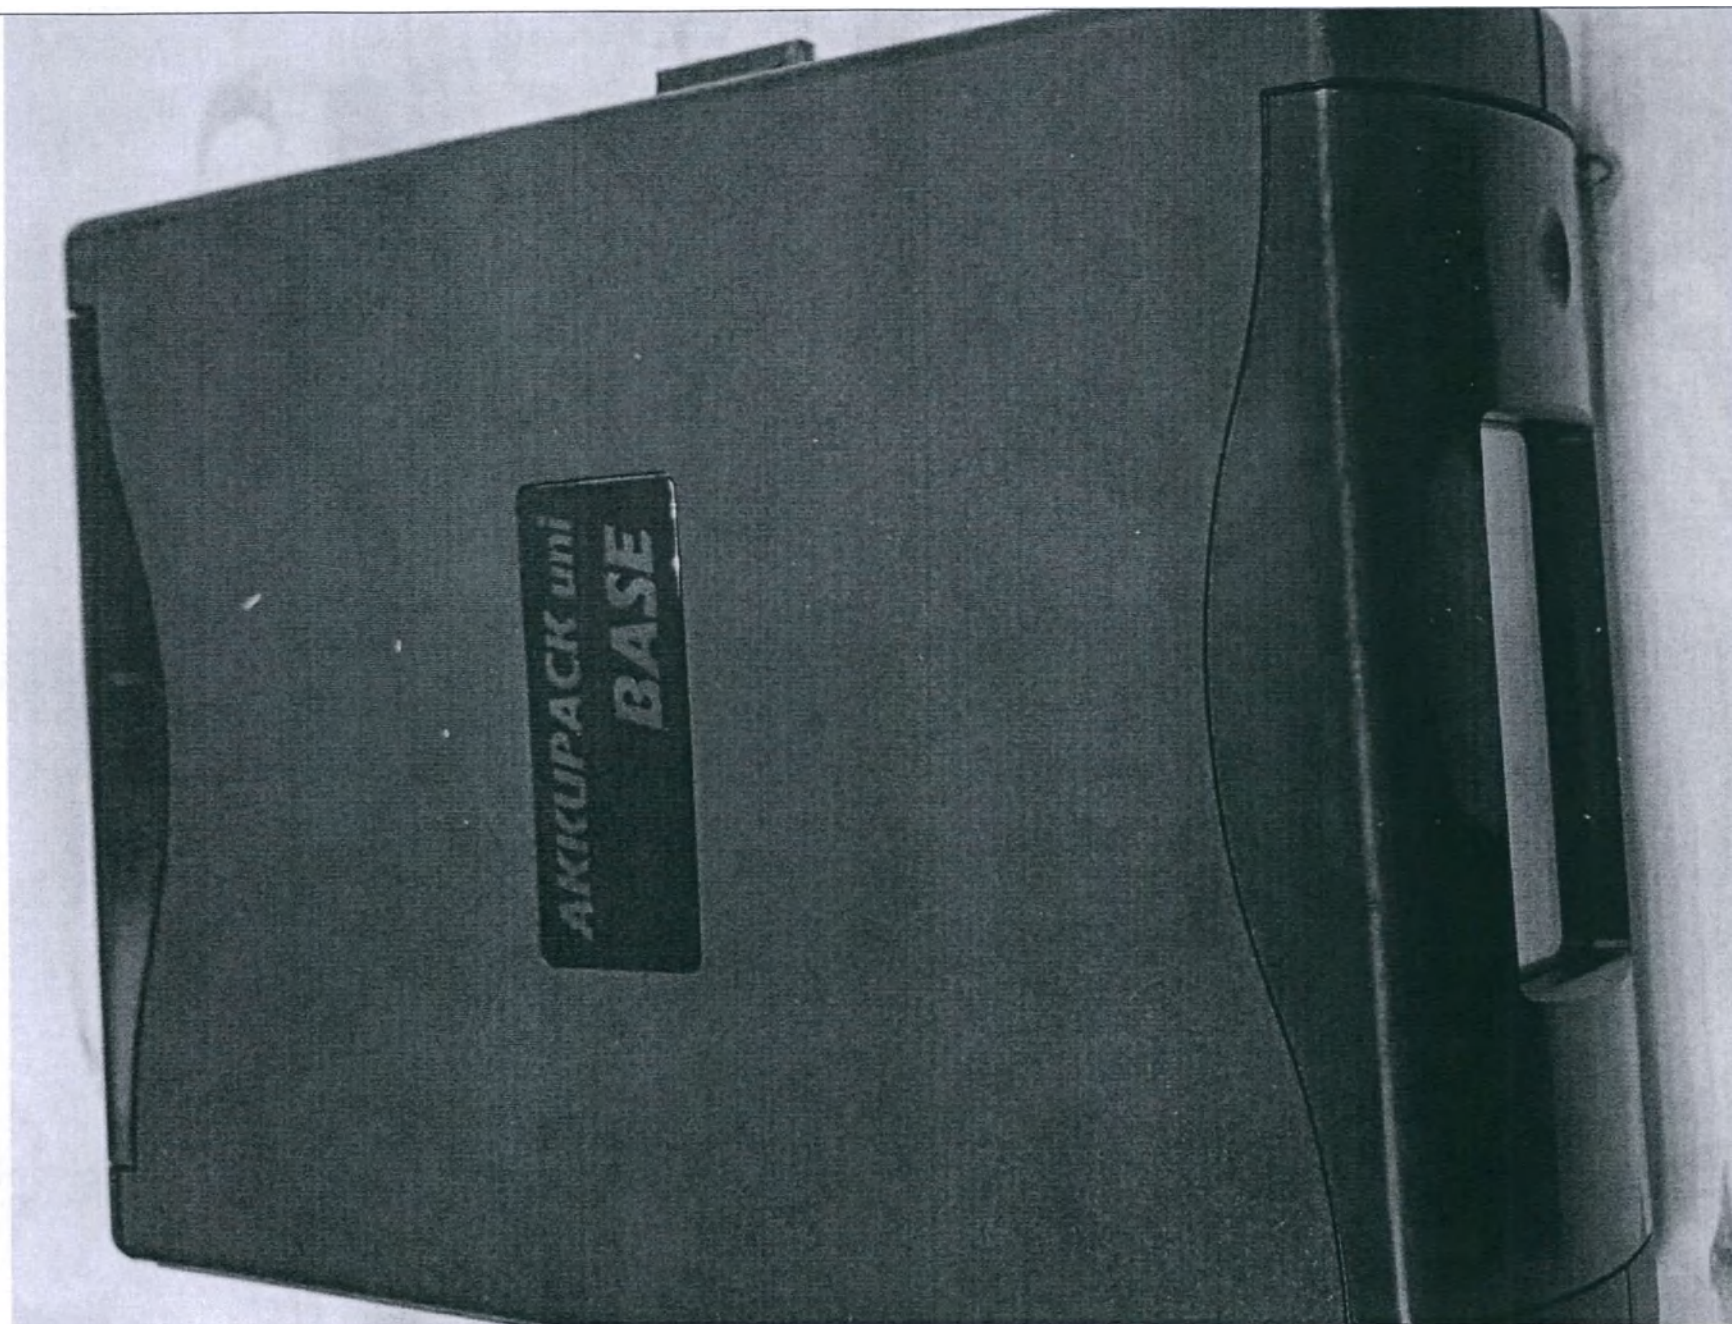

8.12. Блок питания AKKUPACK uni BASE

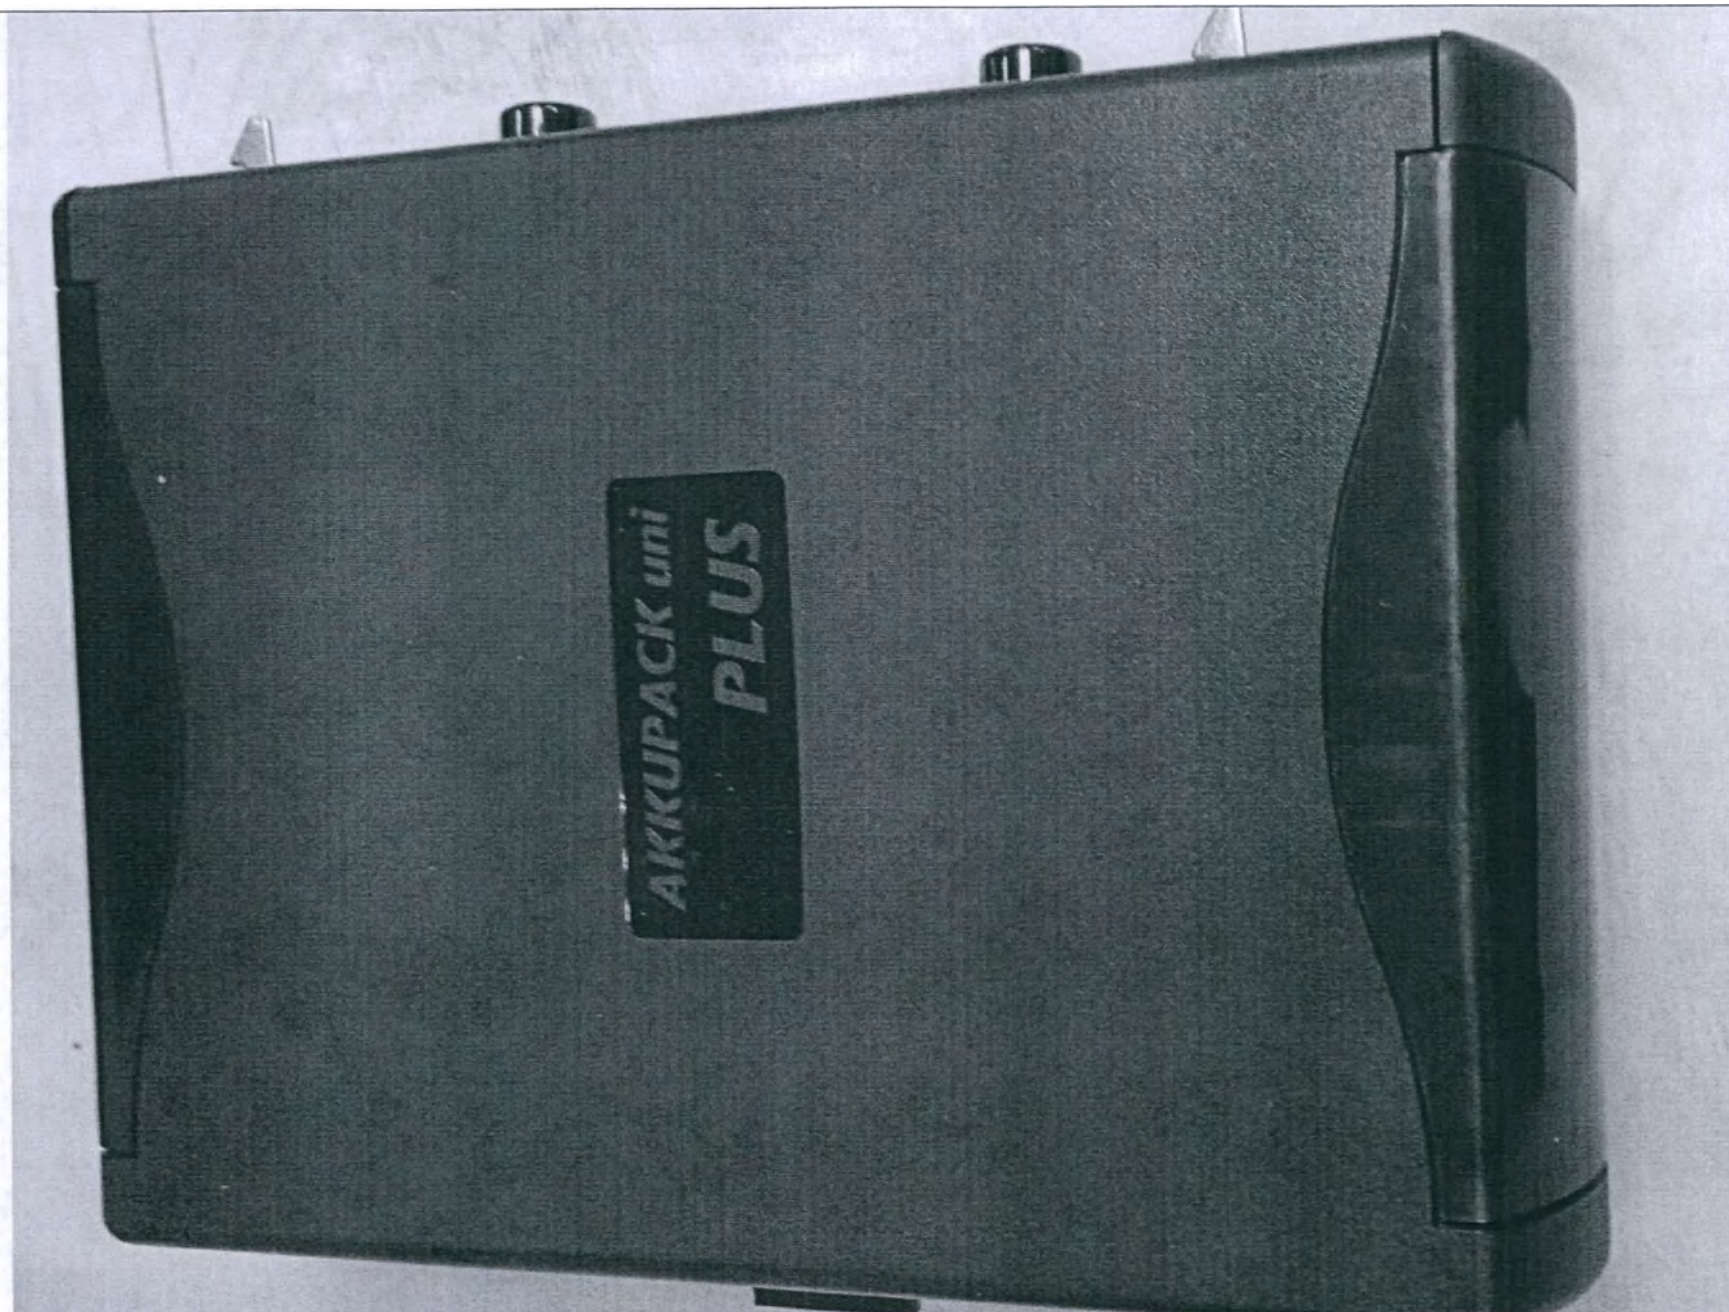

8.13. Блок питания AKKUPACK uni PLUS


Дыхательный контур аппарата ИВЛ с измерительной трубкой давления и контрольной трубкой SBS 22 SBU/180 см



8.14. Дыхательный контур аппарата ИВЛ с измерительной трубкой давления и контрольной трубкой SBS 22 SBU/180 см



8.15. Адаптер прямого соединения FiO₂ (Комплект для измерения FiO₂, состоящий из FiO₂, датчика, Т-адаптера, адаптера датчика FiO₂, соединительной линии FiO₂-датчик с винтовым соединением)

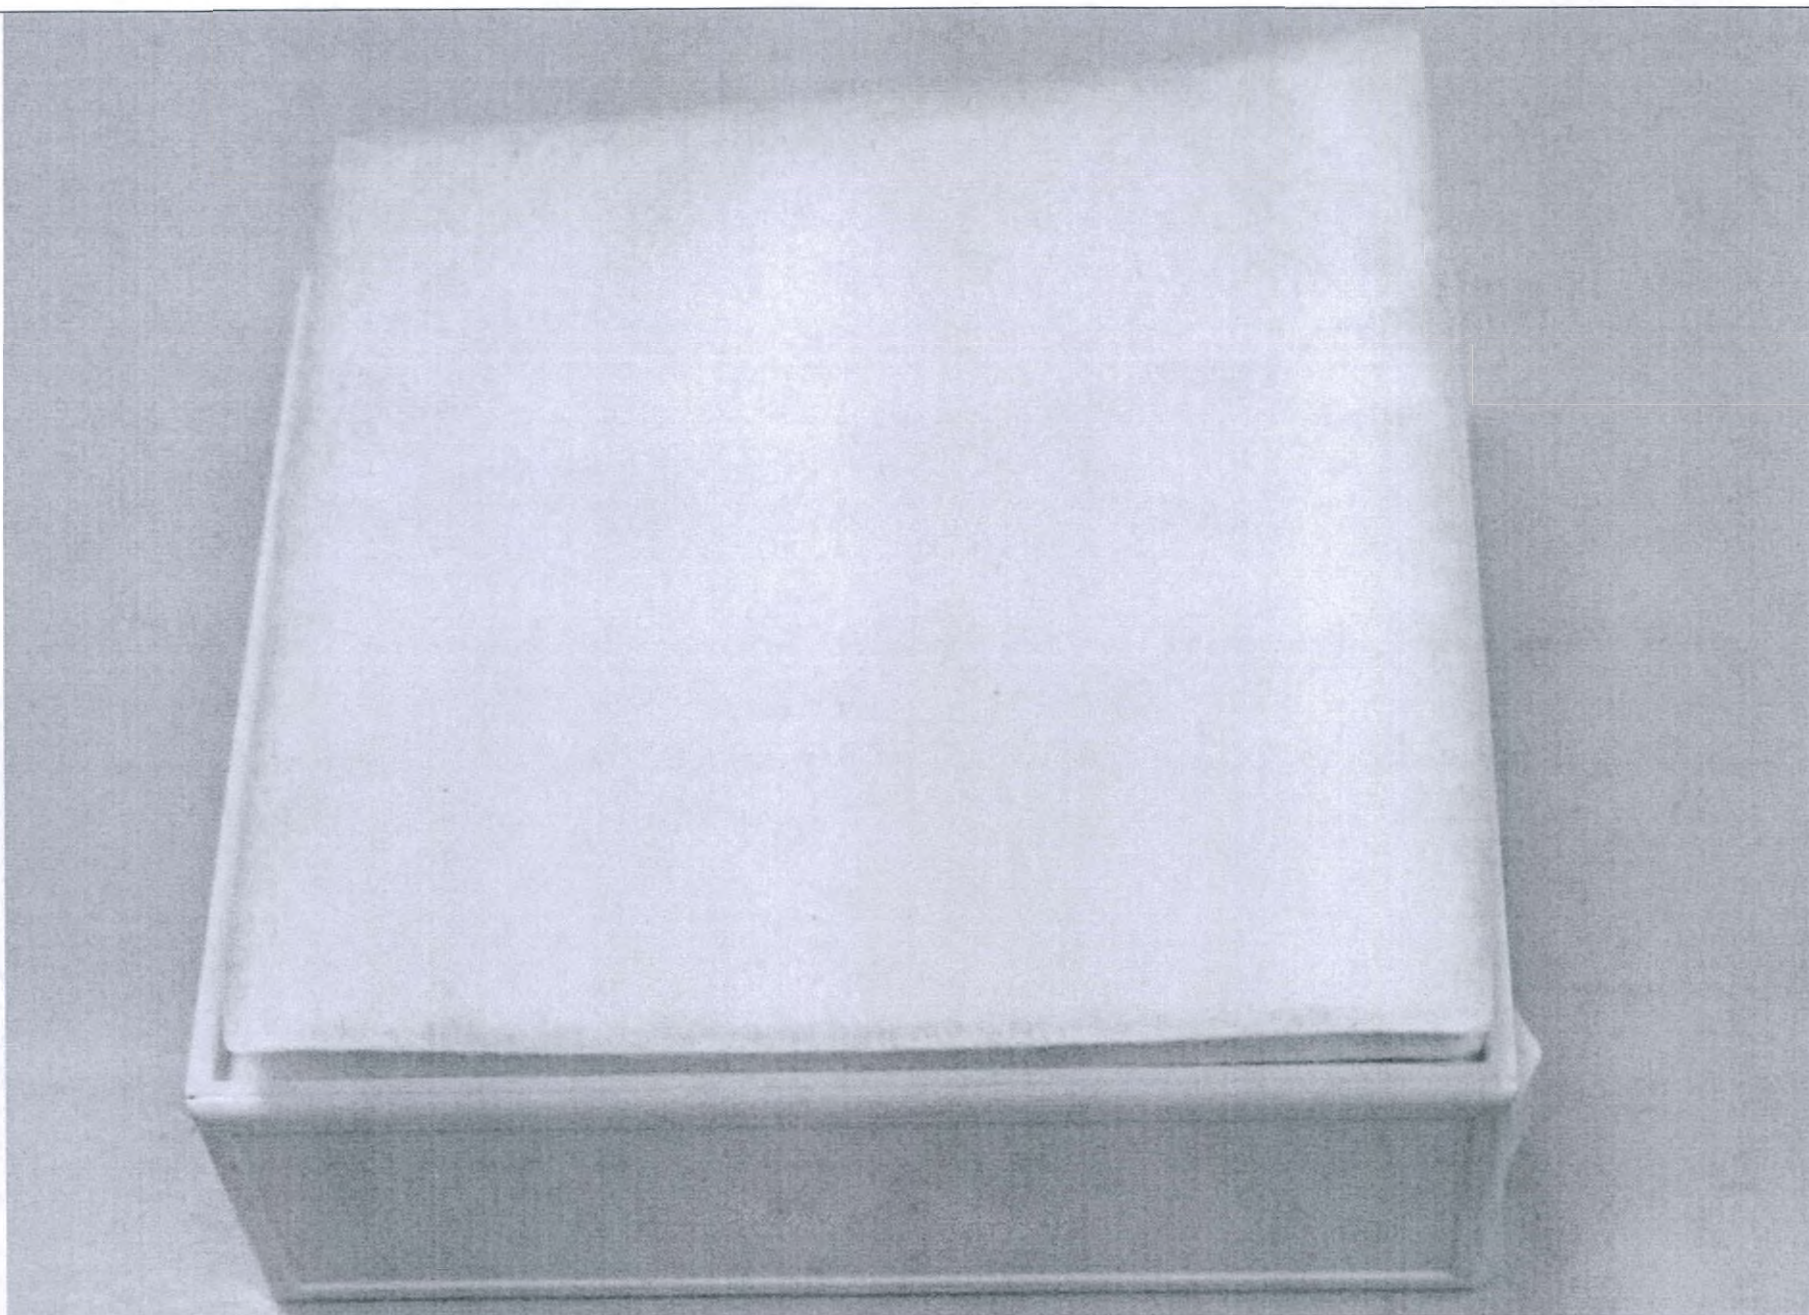

8.16. Запасной фильтр тонкой очистки, 1 упаковка (5 шт.)

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

110 л.

Генеральный директор ООО «МЕДИКА ТРЕЙД»

Колышкин М.В.

