


Внешний вид

Набора реагентов для определения концентрации холестерина липопротеинов низкой плотности прямым методом в сыворотке и плазме крови
(ХОЛЕСТЕРИН ЛПНП (прямой метод) ДДС) по ТУ 21.20.23.110-043-48813770-2021


Вариант 1, Комплектация 1 (1)

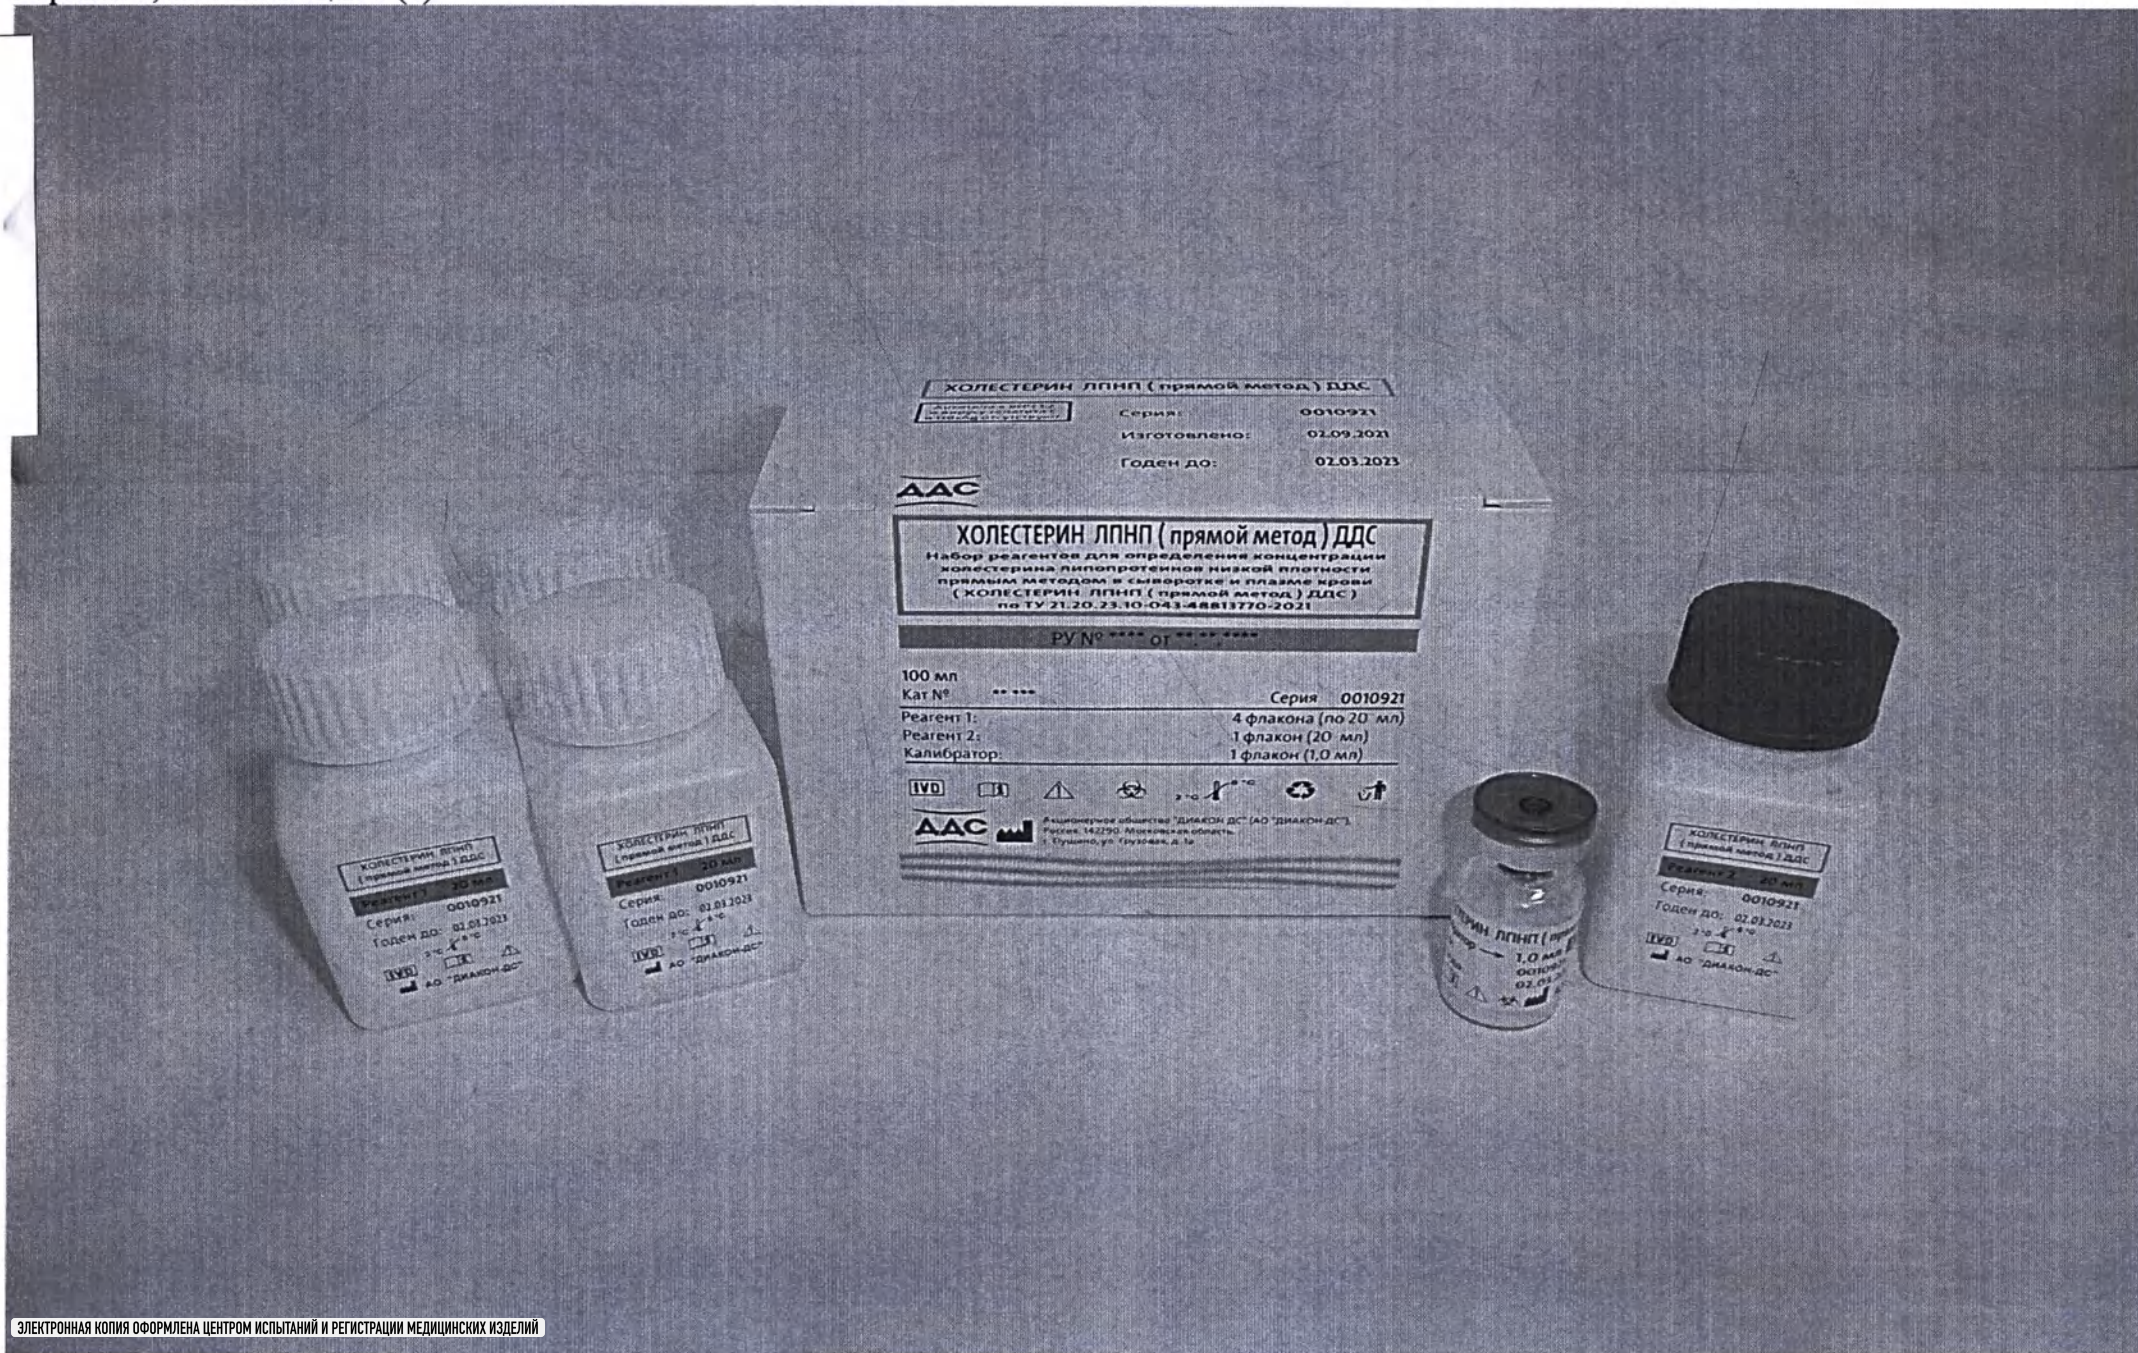

Внешний вид

Набора реагентов для определения концентрации холестерина липопротеинов низкой плотности прямым методом в сыворотке и плазме крови (ХОЛЕСТЕРИН ЛПНП (прямой метод) ДДС) по ТУ 21.20.23.110-043-48813770-2021


вариант 1, Комплектация 1 (2)

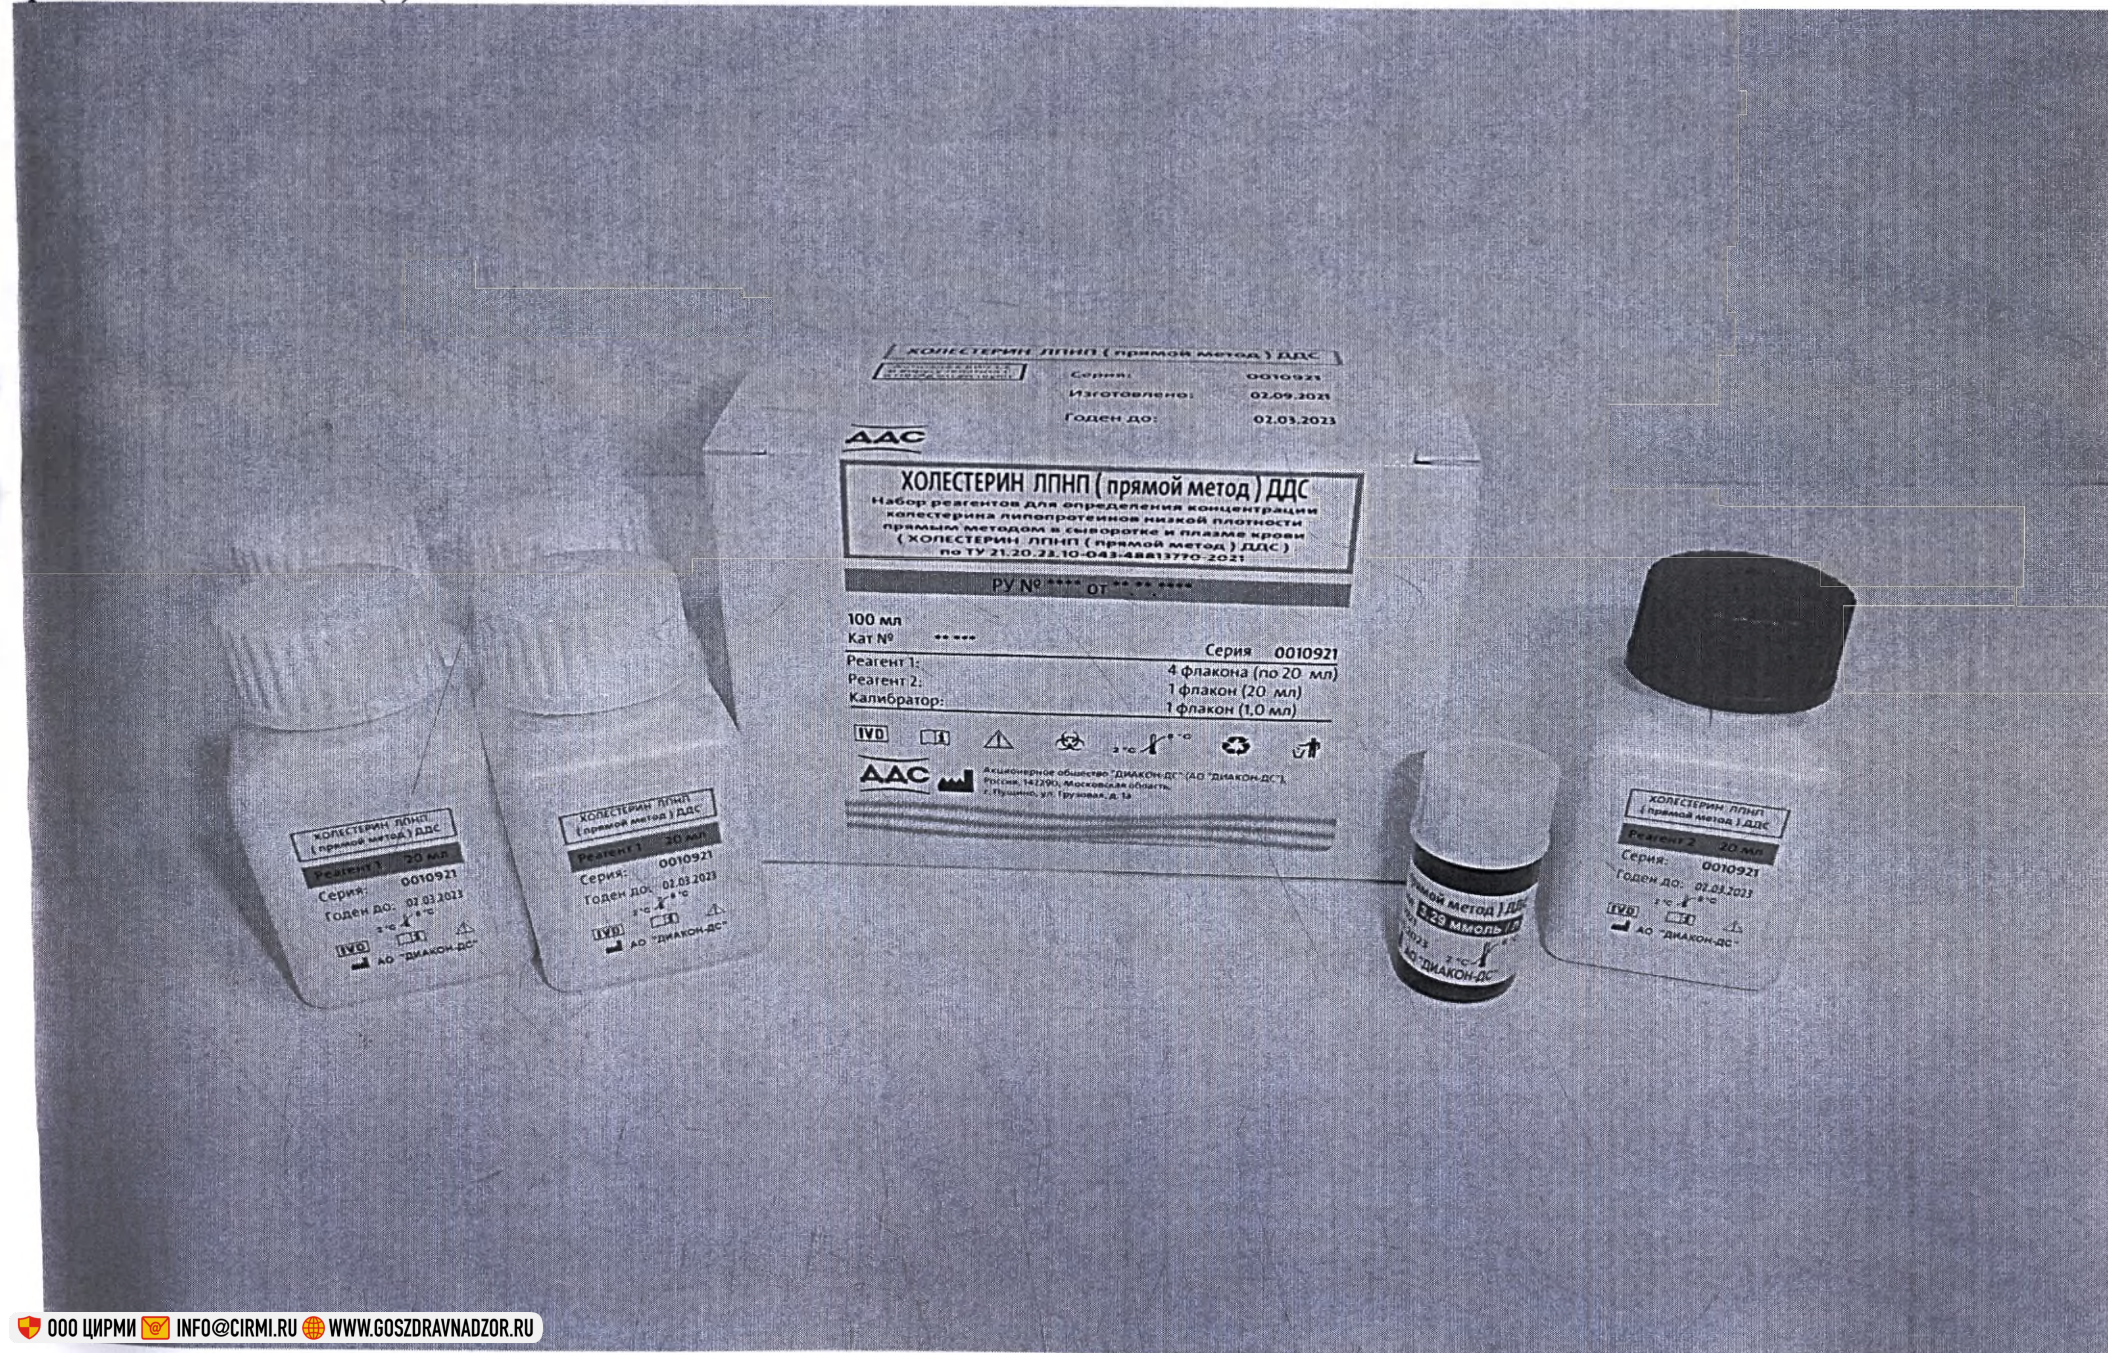

Внешний вид

Набора реагентов для определения концентрации холестерина липопротеинов низкой плотности прямым методом в сыворотке и плазме крови (ХОЛЕСТЕРИН ЛПНП (прямой метод) ДДС) по ТУ 21.20.23.110-043-48813770-2021


вариант 1, Комплектация 2 (1)

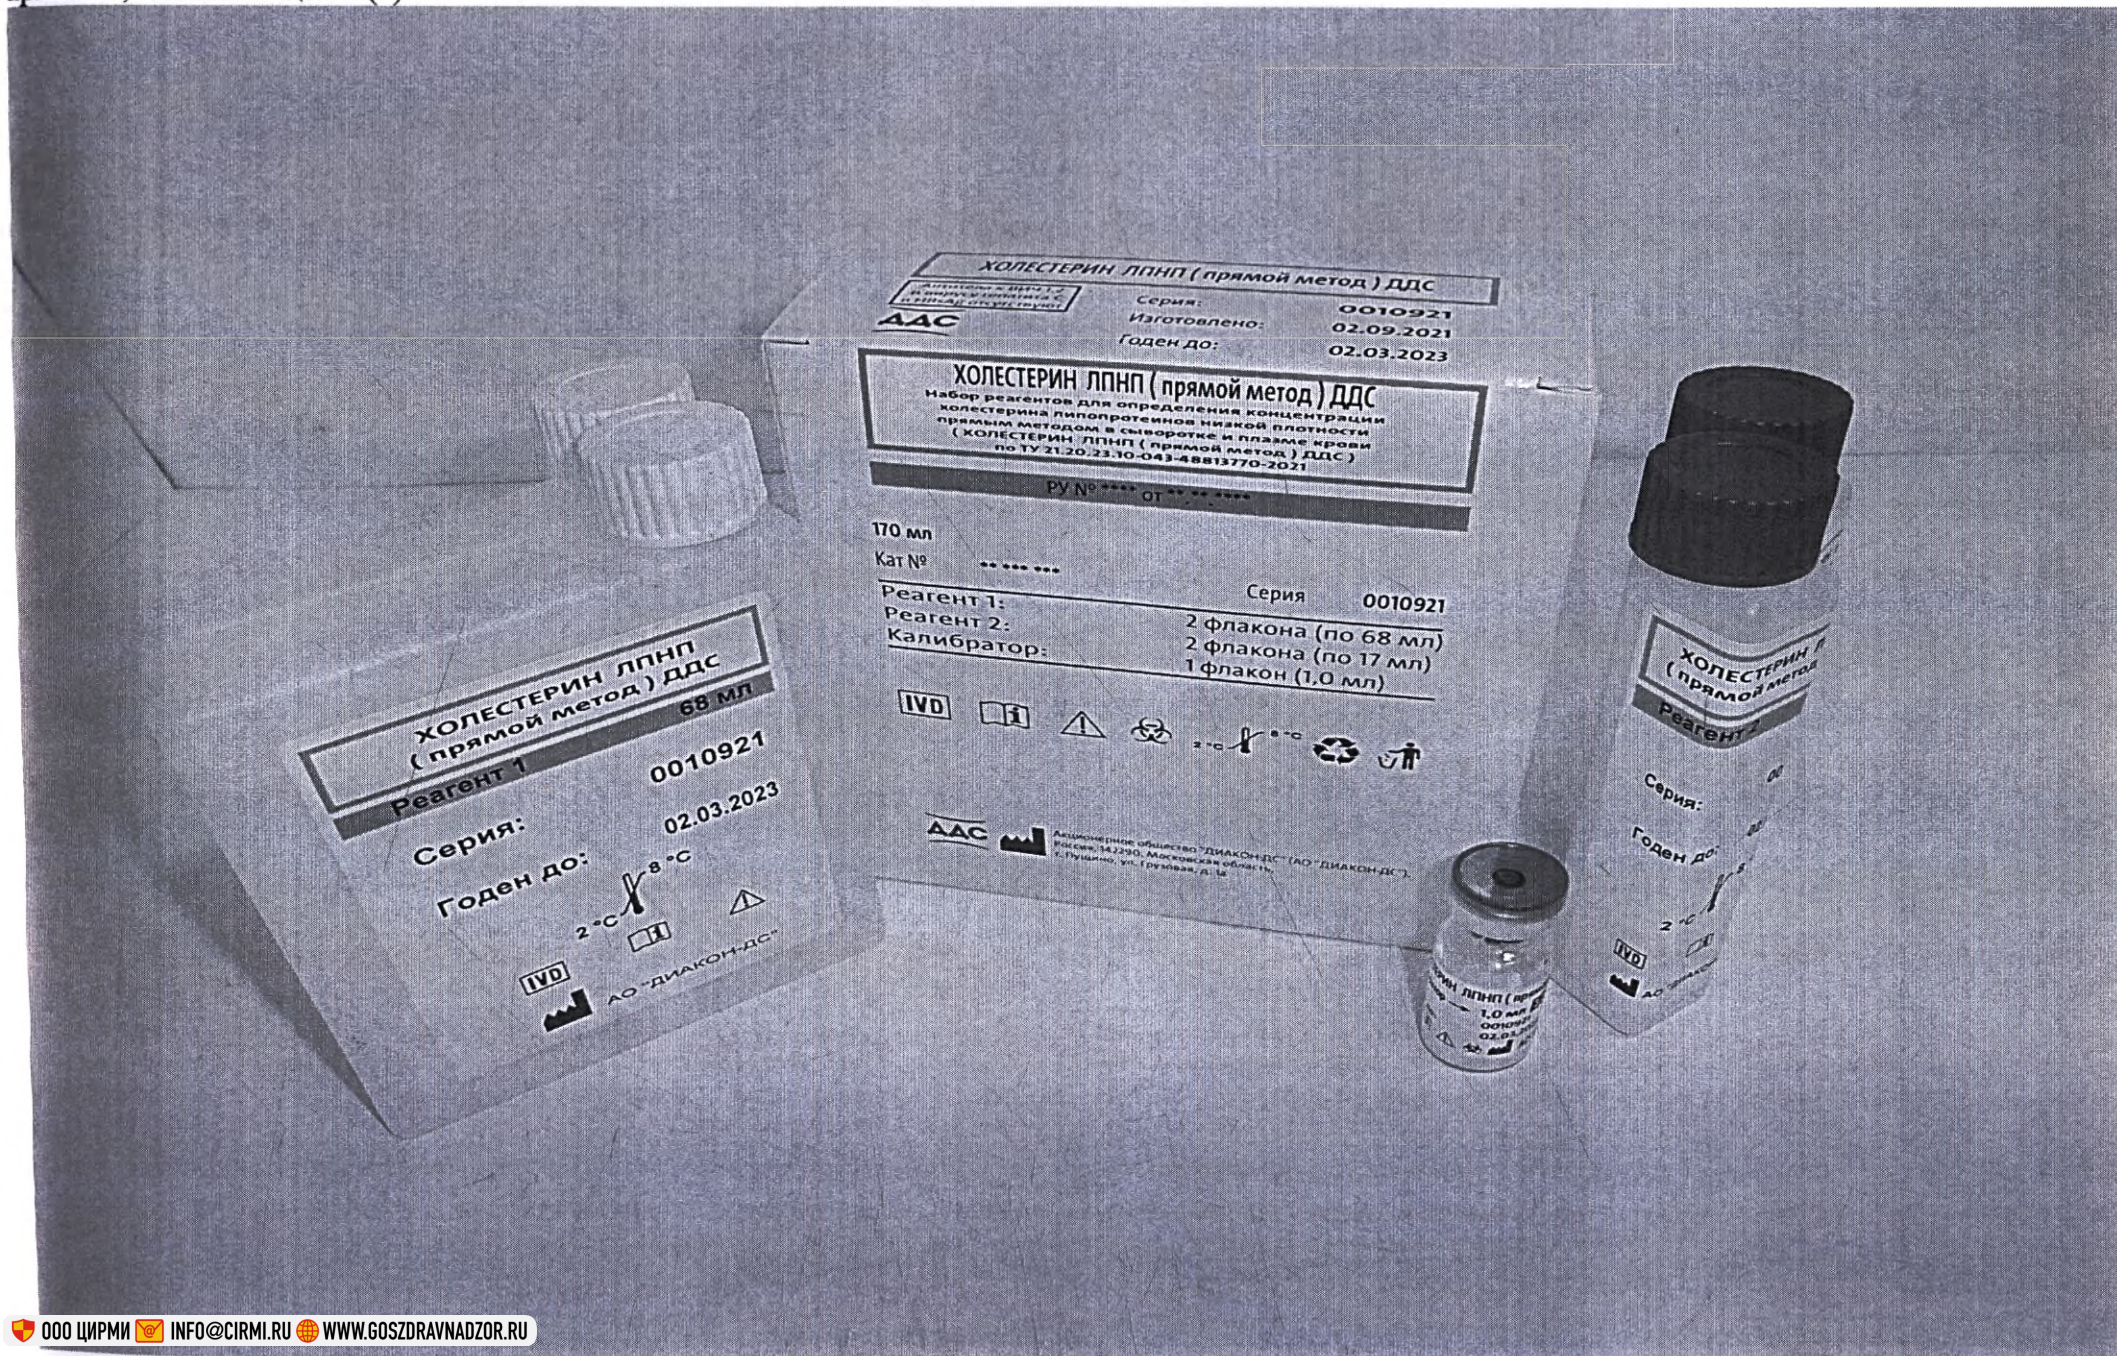

Внешний вид

Набора реагентов для определения концентрации холестерина липопротеинов низкой плотности прямым методом в сыворотке и плазме крови (ХОЛЕСТЕРИН ЛПНП (прямой метод) ДДС) по ТУ 21.20.23.110-043-48813770-2021


вариант 1, Комплектация 2 (2)

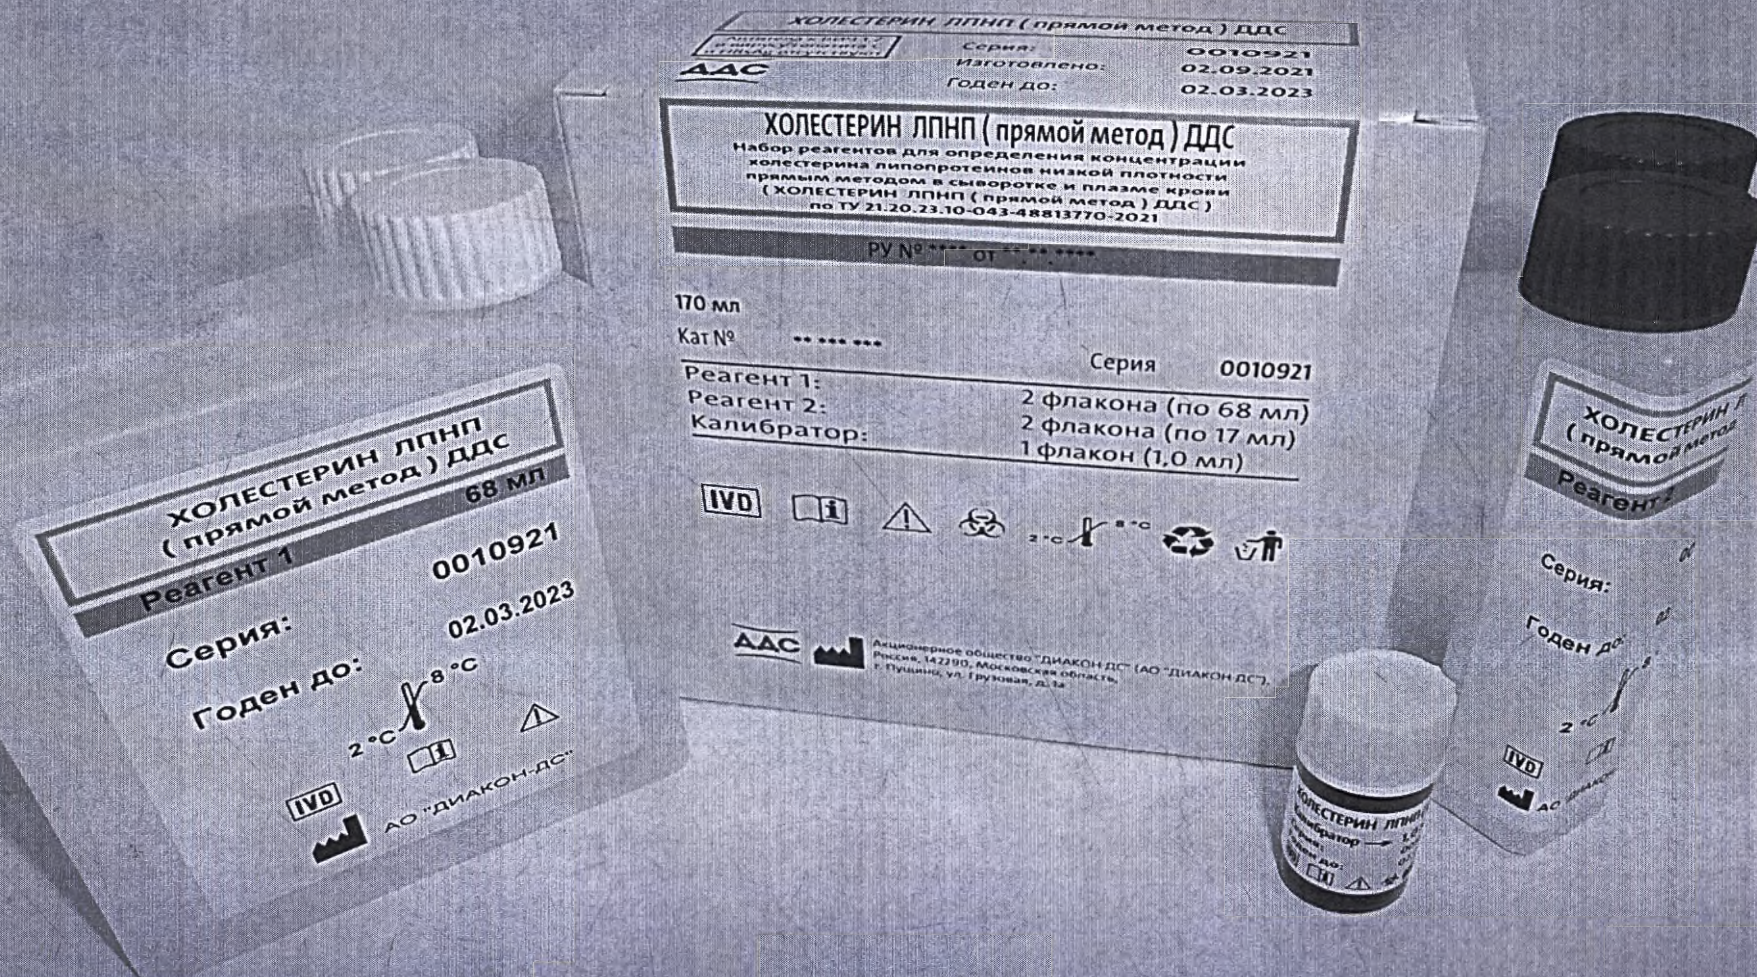

Внешний вид

Набора реагентов для определения концентрации холестерина липопротеинов низкой плотности прямым методом в сыворотке и плазме крови (ХОЛЕСТЕРИН ЛПНП (прямой метод) ДДС) по ТУ 21.20.23.110-043-48813770-2021


вариант 1, Комплектация 3 (1)

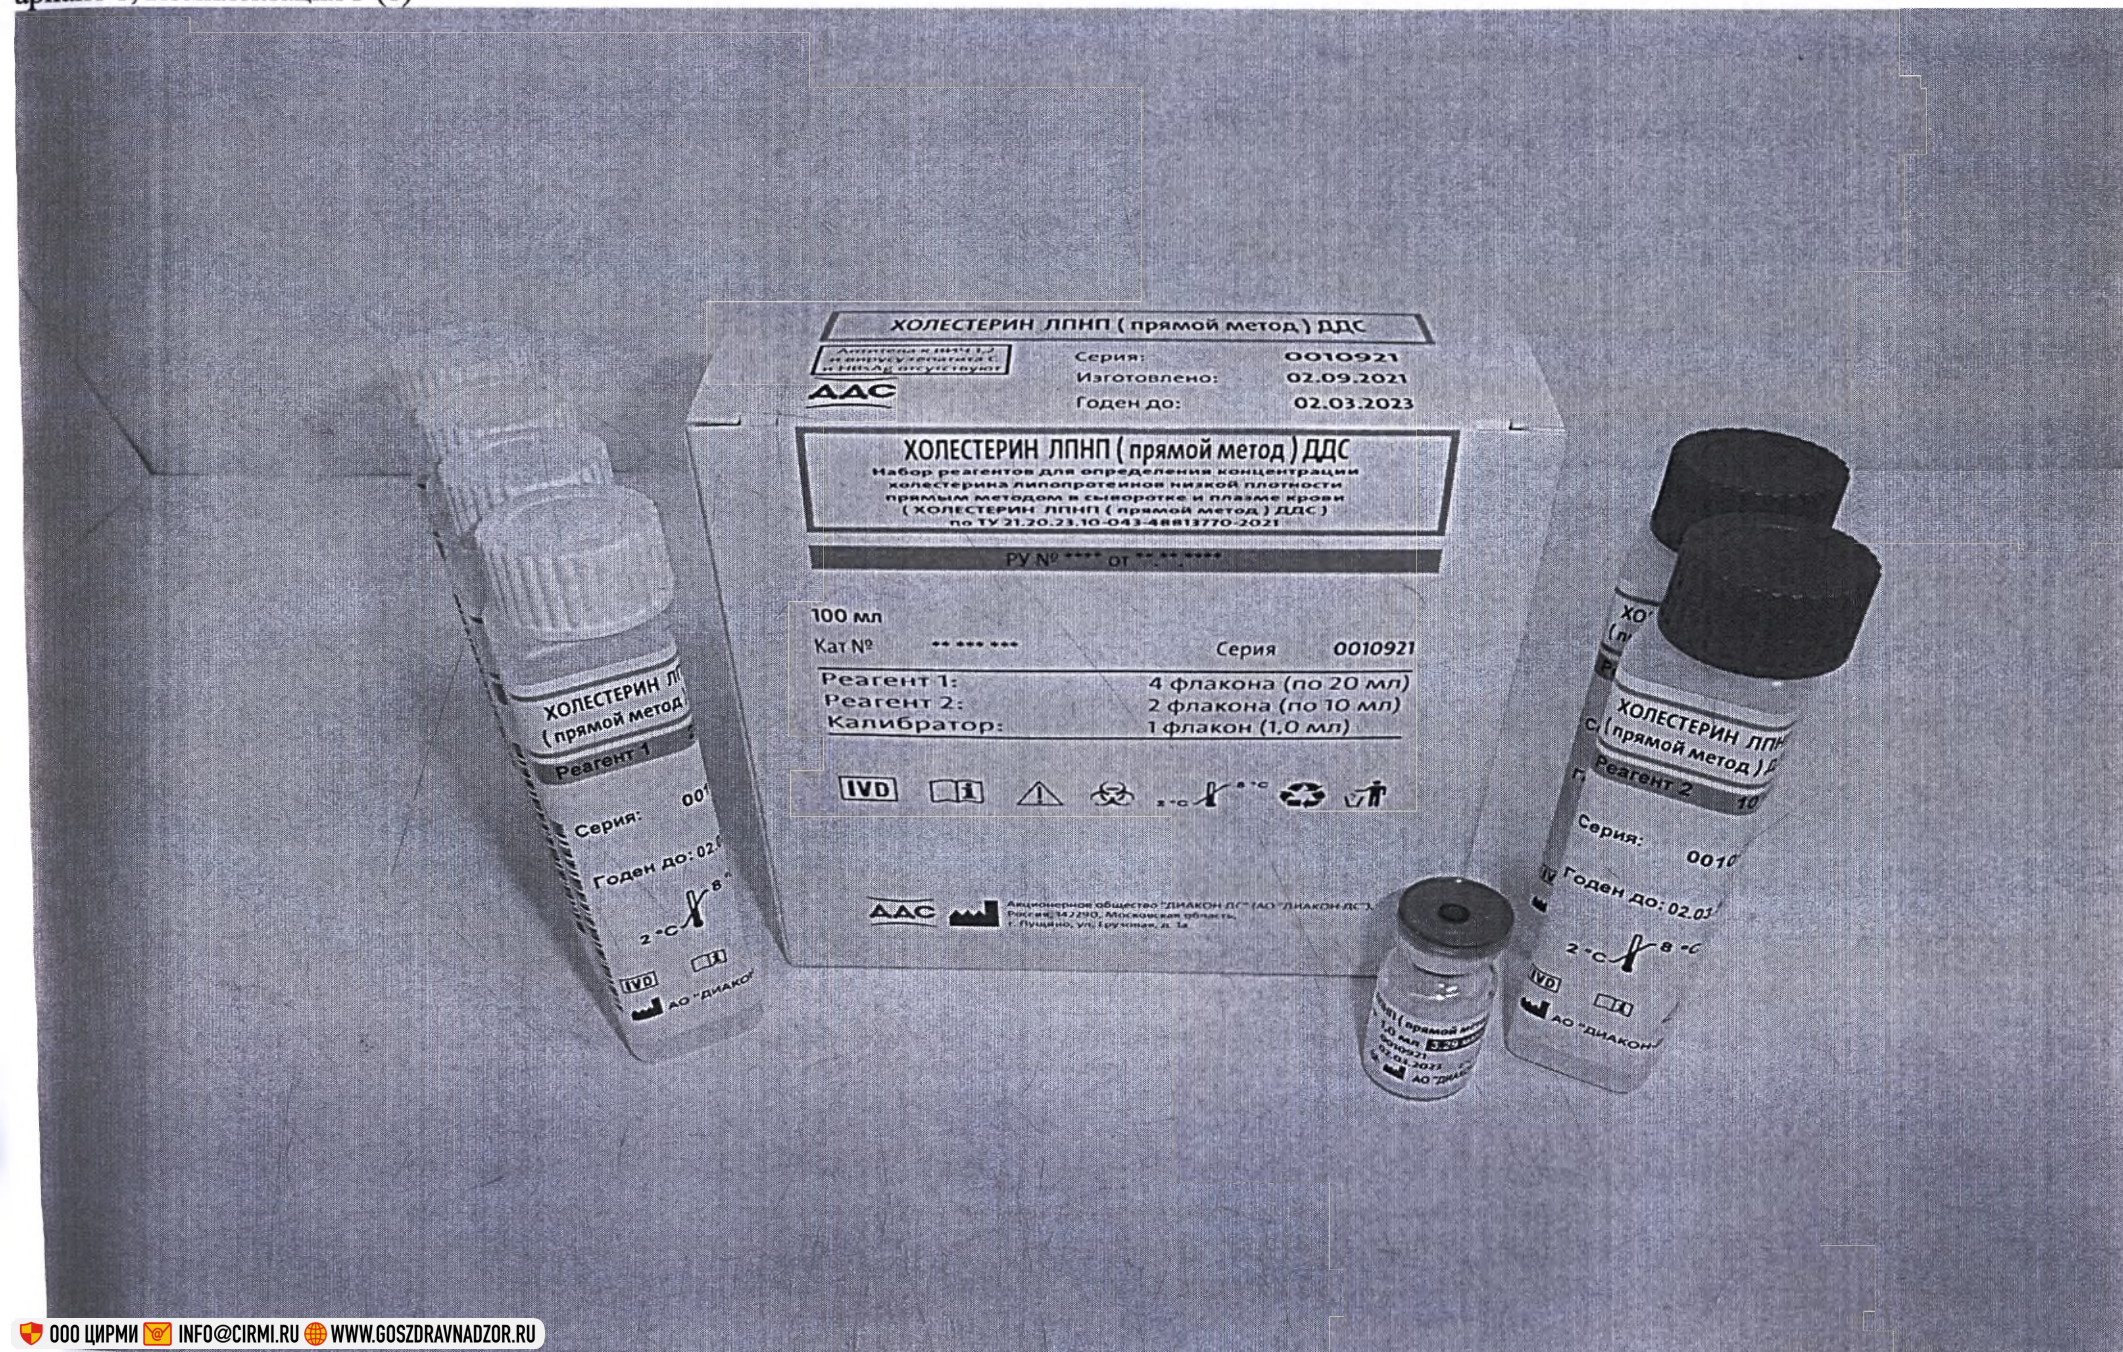

Внешний вид

Набора реагентов для определения концентрации холестерина липопротеинов низкой плотности прямым методом в сыворотке и плазме крови (ХОЛЕСТЕРИН ЛПНП (прямой метод) ДДС) по ТУ 21.20.23.110-043-48813770-2021


вариант 1, Комплектация 3 (2)

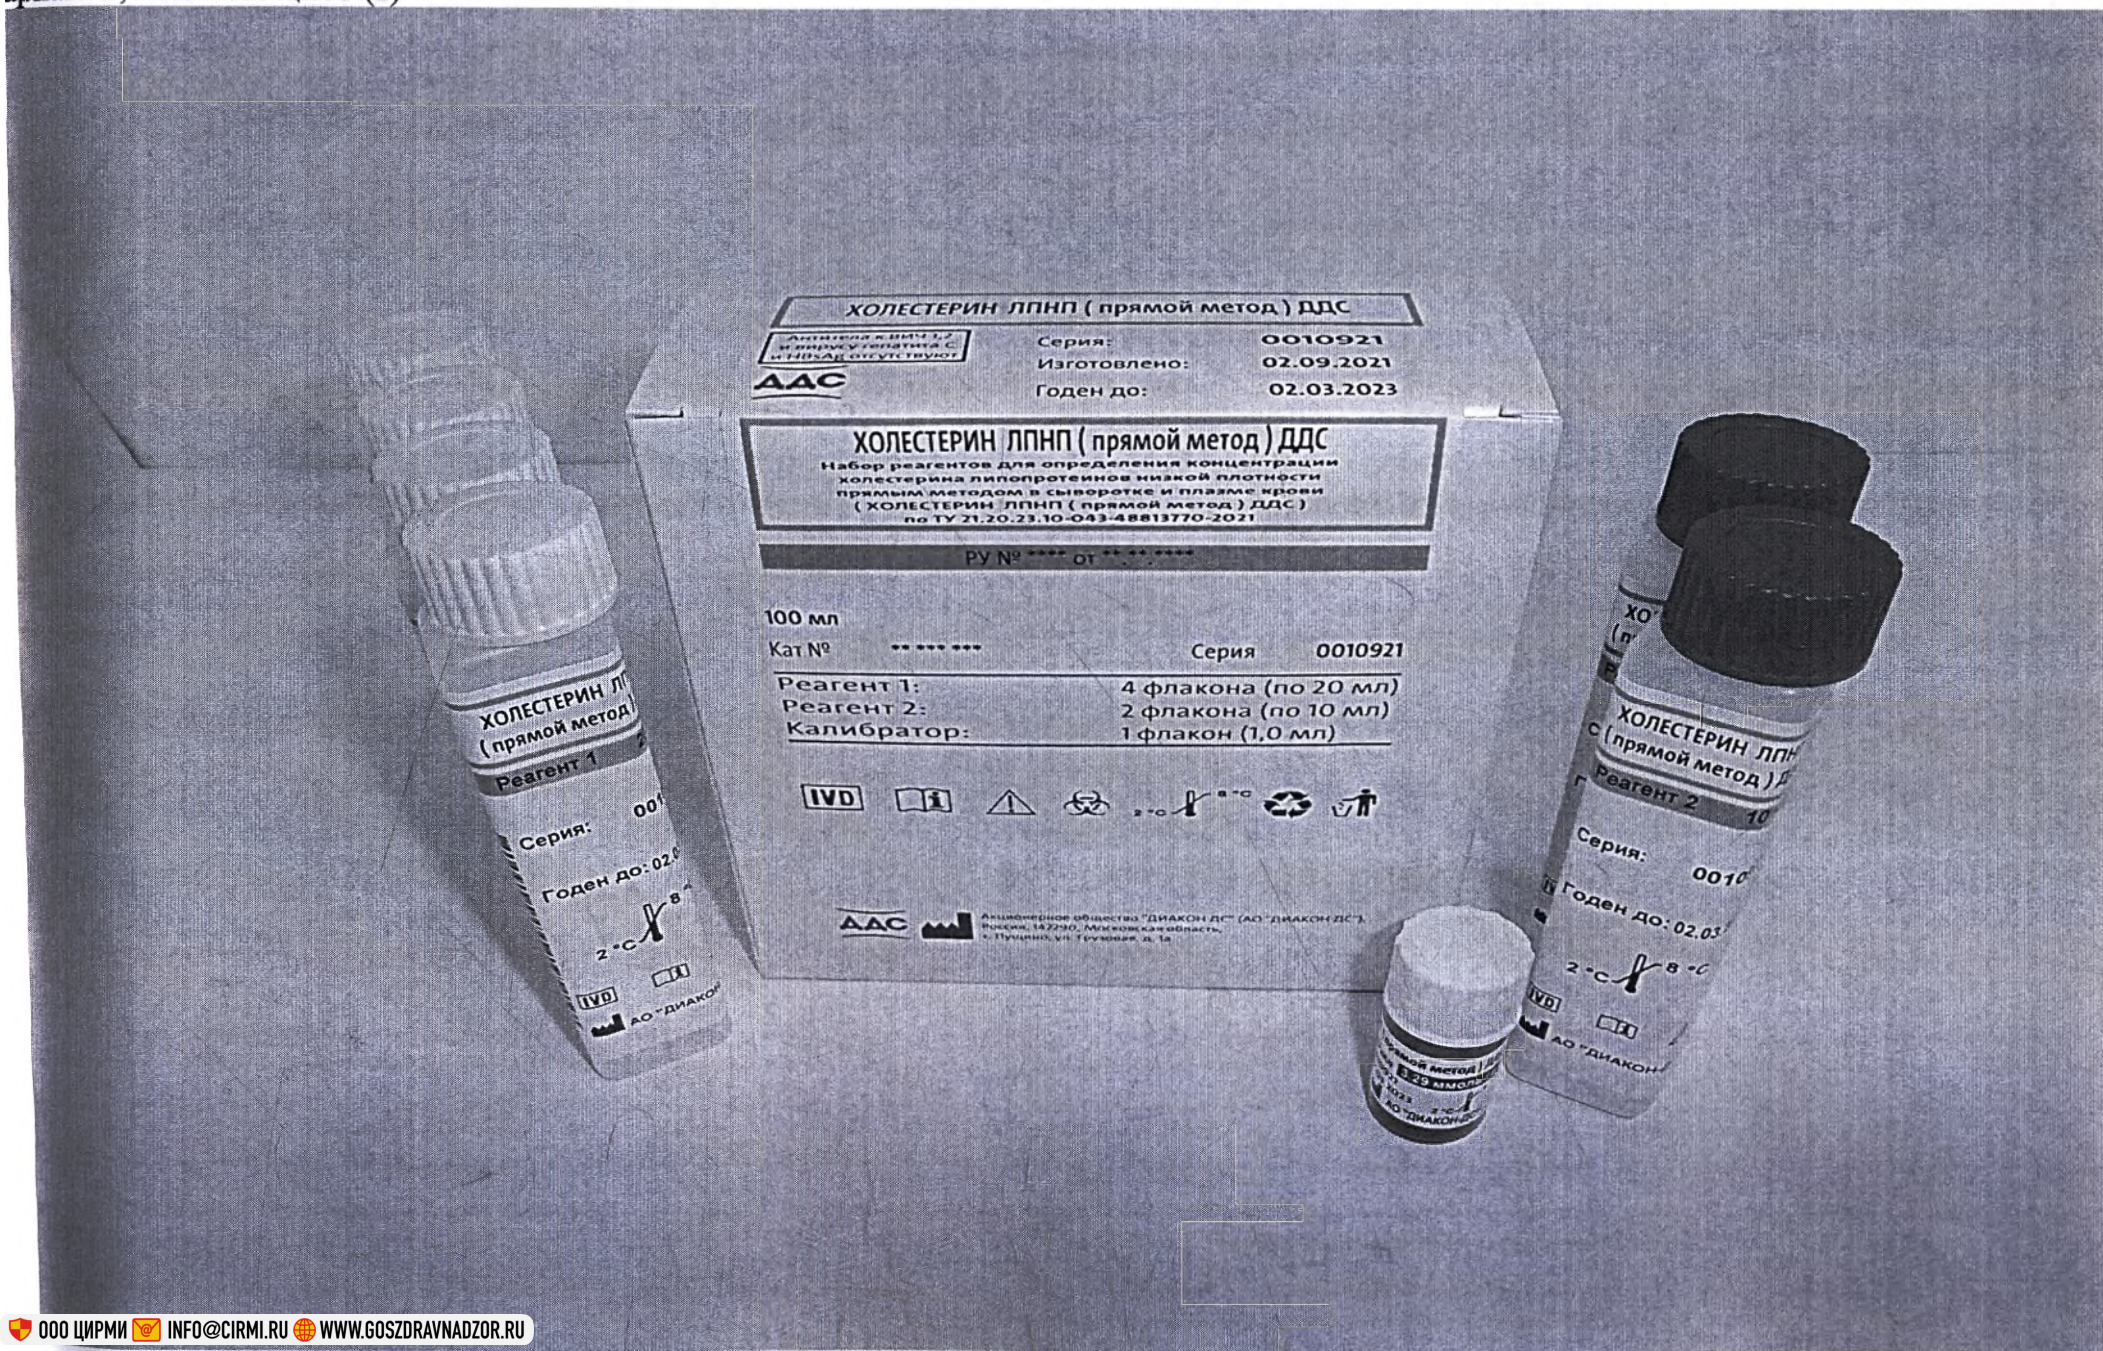

Внешний вид

Набора реагентов для определения концентрации холестерина липопротеинов низкой плотности прямым методом в сыворотке и плазме крови (ХОЛЕСТЕРИН ЛПНП (прямой метод) ДДС) по ТУ 21.20.23.110-043-48813770-2021


вариант 1, Комплектация 4 (1)

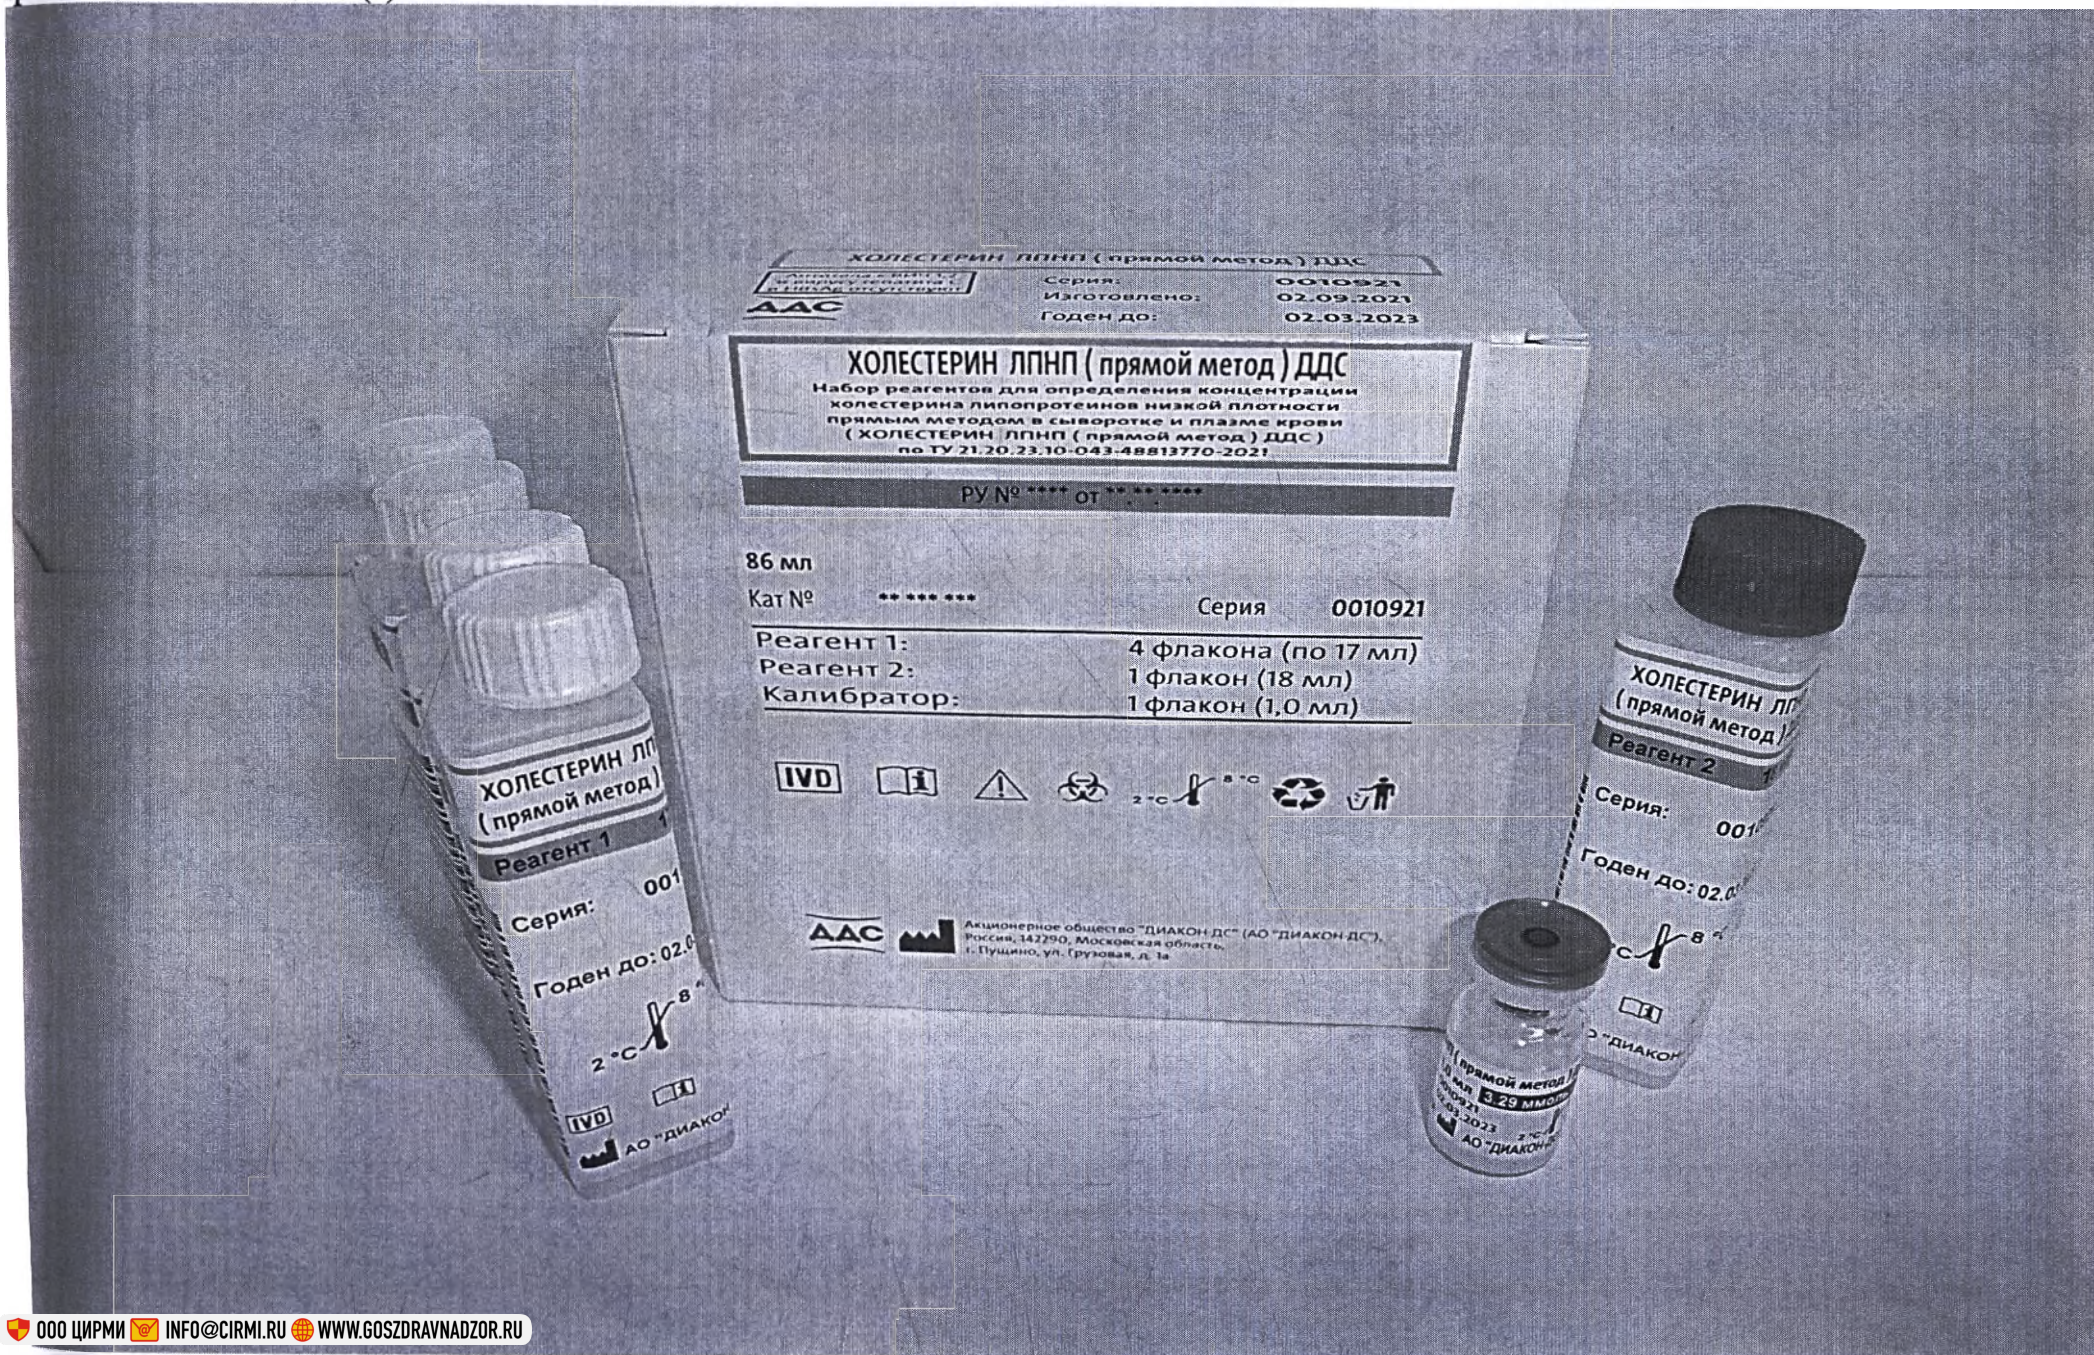

Внешний вид

Набора реагентов для определения концентрации холестерина липопротеинов низкой плотности прямым методом в сыворотке и плазме крови (ХОЛЕСТЕРИН ЛПНП (прямой метод) ДДС) по ТУ 21.20.23.110-043-48813770-2021

вариант 1, Комплектация 4 (2)

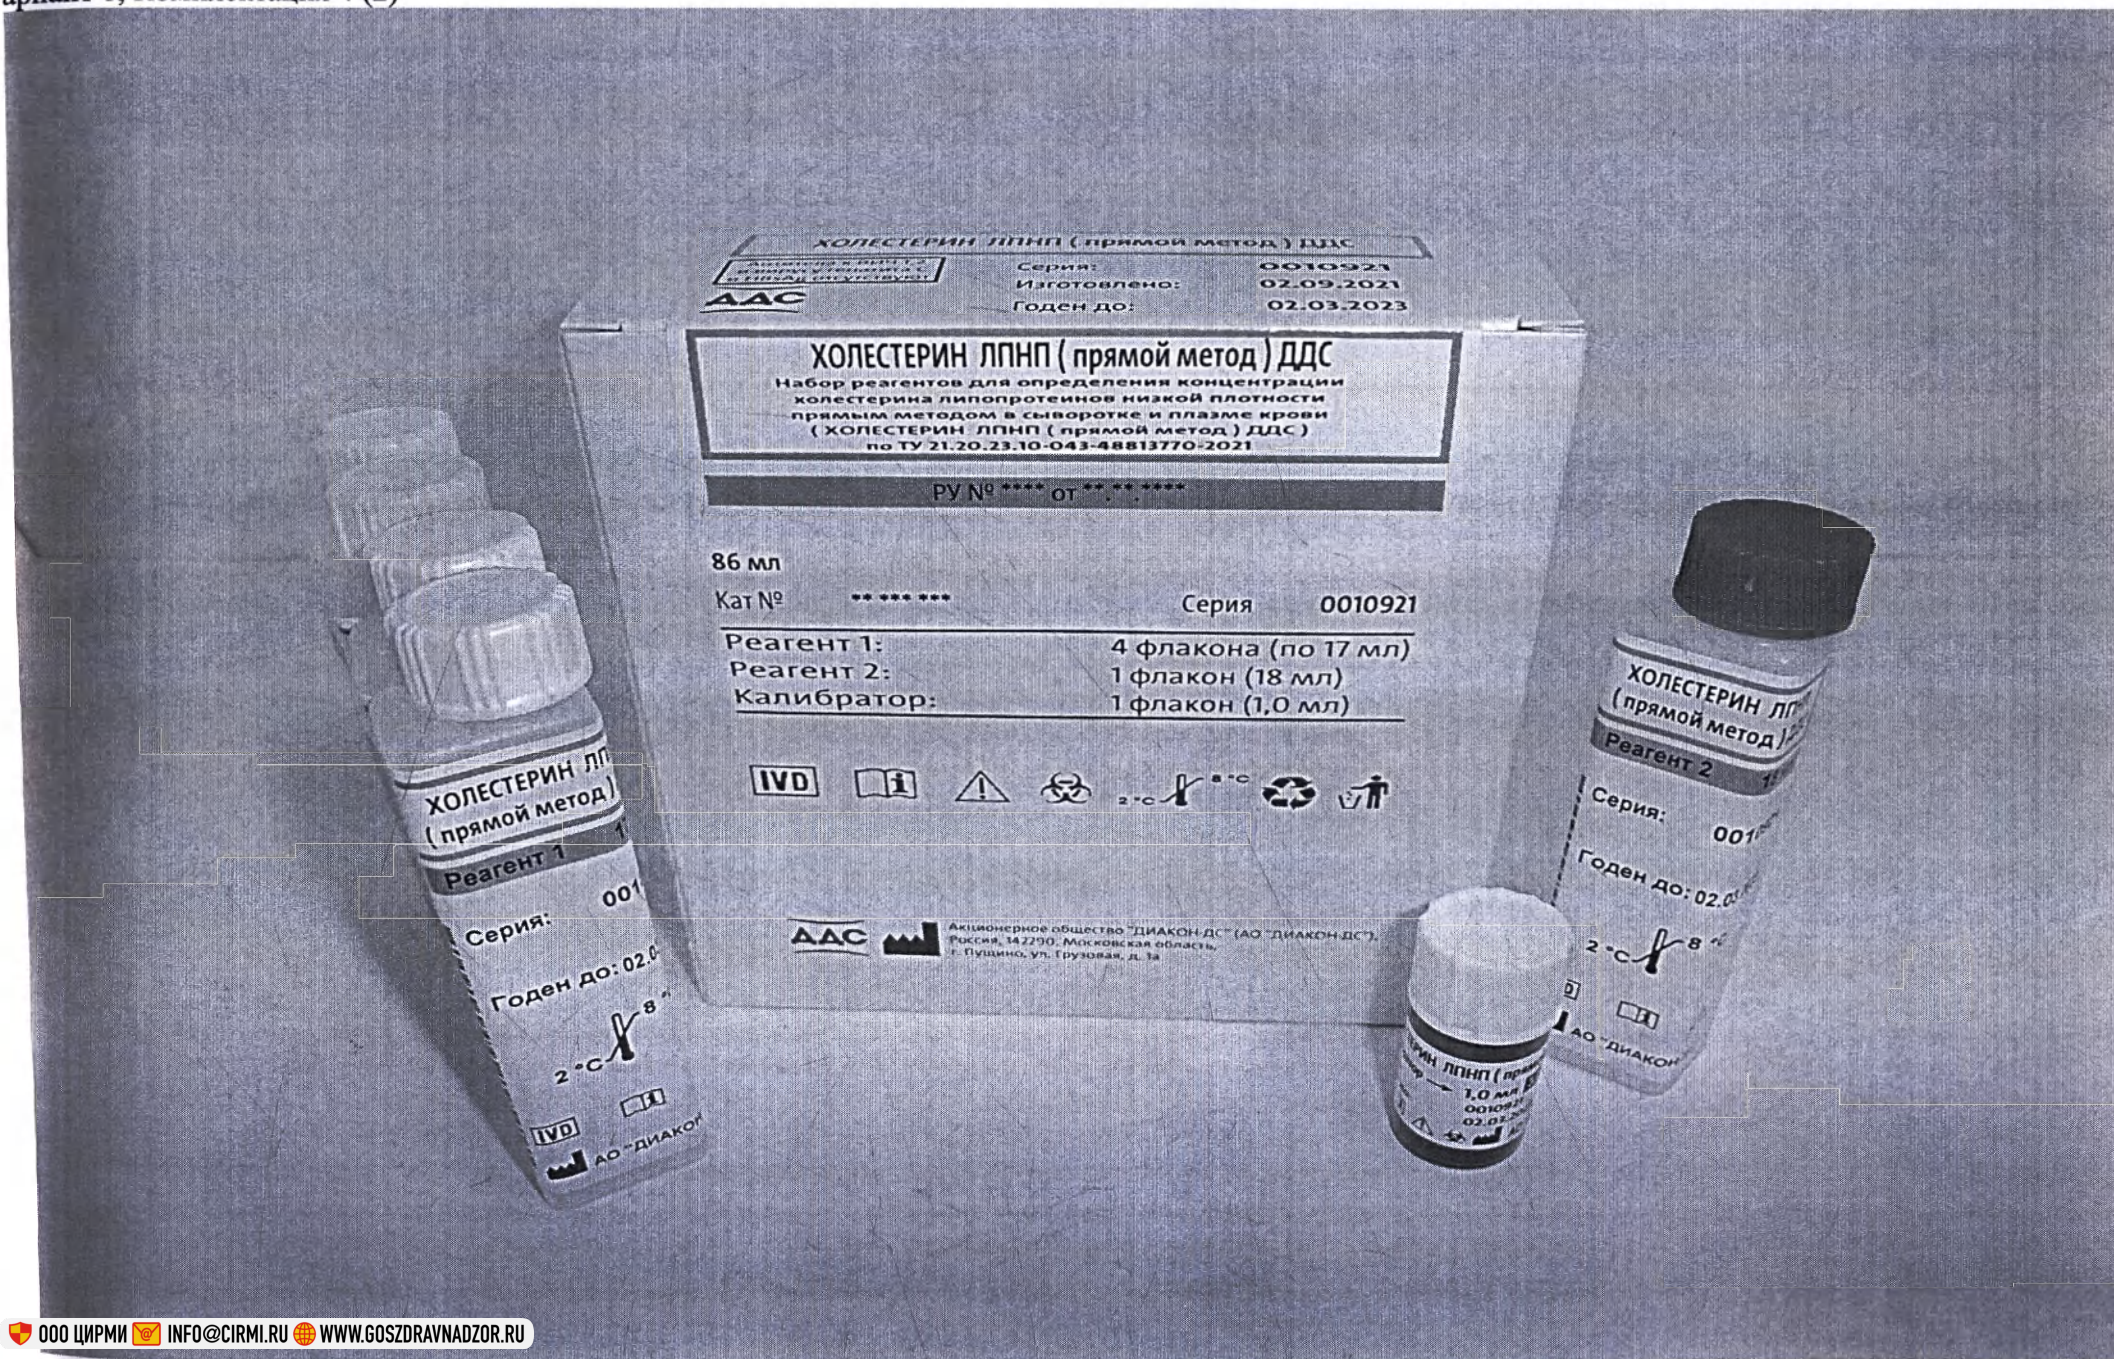

Внешний вид

Набора реагентов для определения концентрации холестерина липопротеинов низкой плотности прямым методом в сыворотке и плазме крови (ХОЛЕСТЕРИН ЛПНП (прямой метод) ДДС) по ТУ 21.20.23.110-043-48813770-2021

ХОЛЕСТЕРИН ЛПНП (прямой метод) ДДС
 Актинол «ВМН-1,2» и вытеснитель «С» и «Н» отсутствуют
 Серия: 0010921
 Изготовлено: 02.09.2021
 Годен до: 02.03.2023

ХОЛЕСТЕРИН ЛПНП (прямой метод) ДДС
 Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеинов низкой плотности прямым методом в сыворотке и плазме крови (ХОЛЕСТЕРИН ЛПНП (прямой метод) ДДС) по ТУ 21.20.23.10-043-48813770-2021

ПУ № **** ОТ ****

156 мл
 Кат № **** Серия 0010921

Реагент 1:	4 флакона (по 31 мл)
Реагент 2:	2 флакона (по 16 мл)
Калибратор:	1 флакон (1,0 мл)

IVD 1 ⚠ ⚠ 2°C 8°C ♻️

АО «ДИАКОН-ДС»
 Акционерное общество «ДИАКОН-ДС» (АО «ДИАКОН-ДС»),
 Россия, 142290, Московская область,
 г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1а

ХОЛЕСТЕРИН ЛПНП (прямой метод) ДДС
 Реагент 1 31 мл
 Серия: 0010921
 Годен до: 02.03.2023
 2°C 8°C
 IVD 1 ⚠
 АО «ДИАКОН-ДС»


ХОЛЕСТЕРИН ЛПНП (прямой метод) ДДС
 Реагент 2 16 мл
 Серия: 0010921
 Годен до: 02.03.2023
 2°C 8°C
 IVD 1 ⚠
 АО «ДИАКОН-ДС»

ХОЛЕСТЕРИН ЛПНП (прямой метод) ДДС
 Калибратор 1,0 мл
 Серия: 0010921
 Годен до: 02.03.2023
 2°C 8°C
 IVD 1 ⚠
 АО «ДИАКОН-ДС»

Внешний вид

Набора реагентов для определения концентрации холестерина липопротеинов низкой плотности прямым методом в сыворотке и плазме крови
(ХОЛЕСТЕРИН ЛПНП (прямой метод) ДДС) по ТУ 21.20.23.110-043-48813770-2021


вариант 1, Комплектация 5 (2)

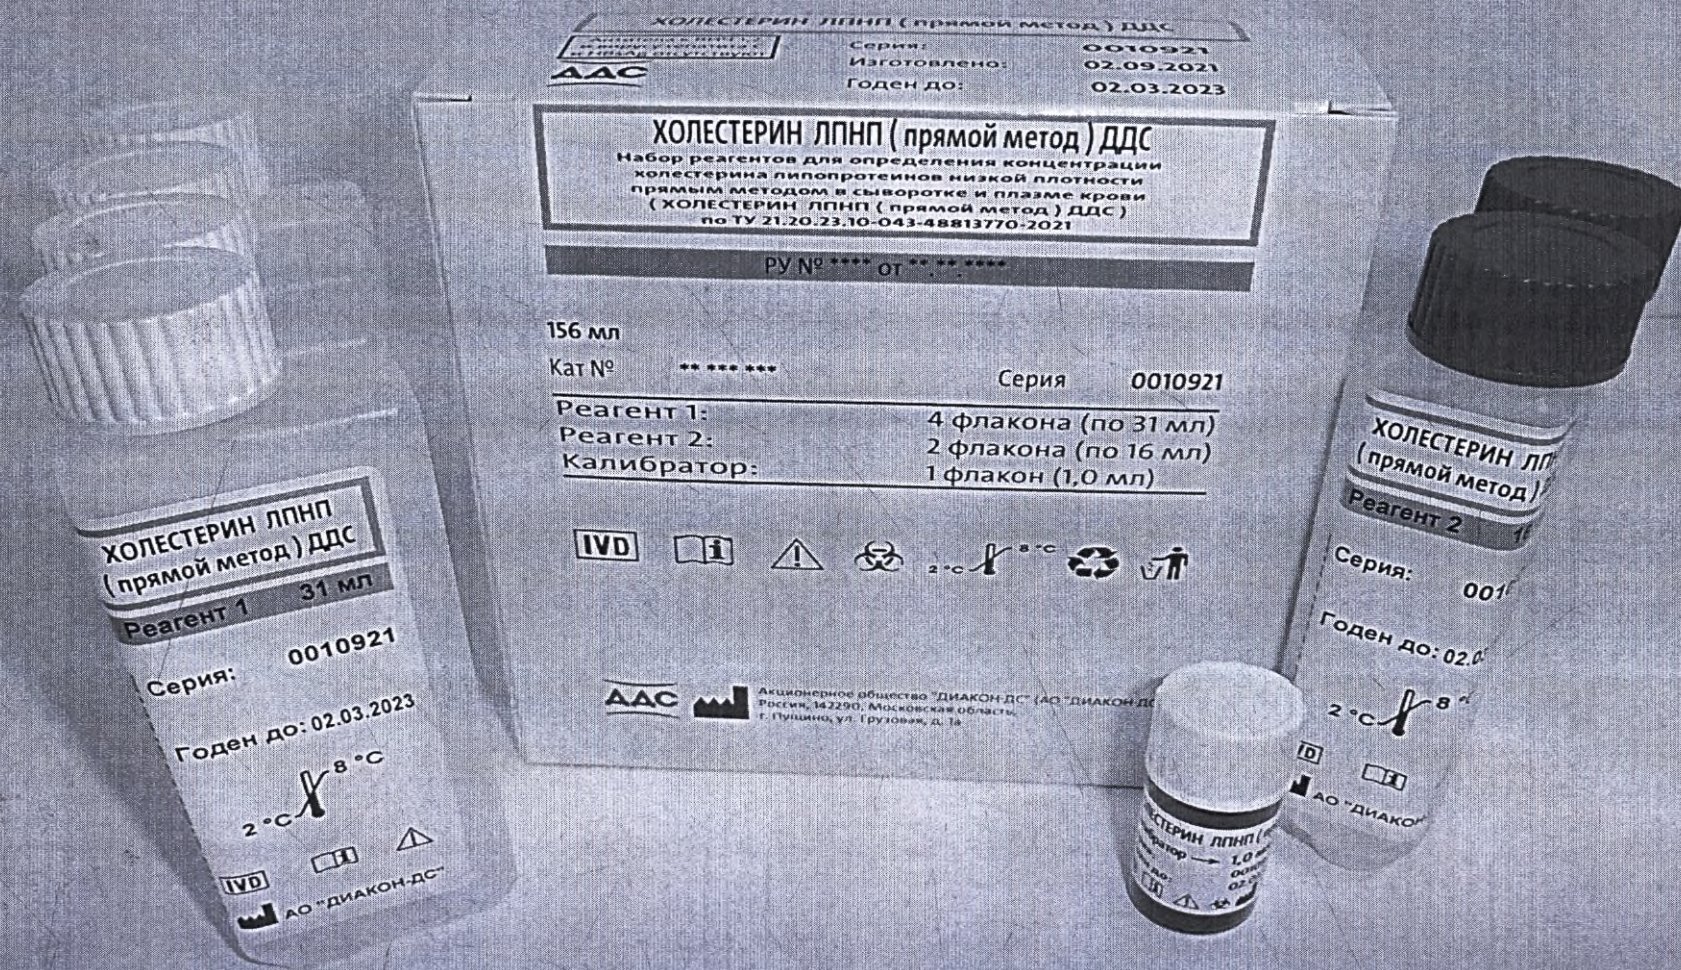

Внешний вид

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеинов низкой плотности прямым методом в сыворотке и плазме крови
(ХОЛЕСТЕРИН ЛПНП (прямой метод) ДДС) по ТУ 21.20.23.110-043-48813770-2021

Вариант 1, Комплектация 6 (1)

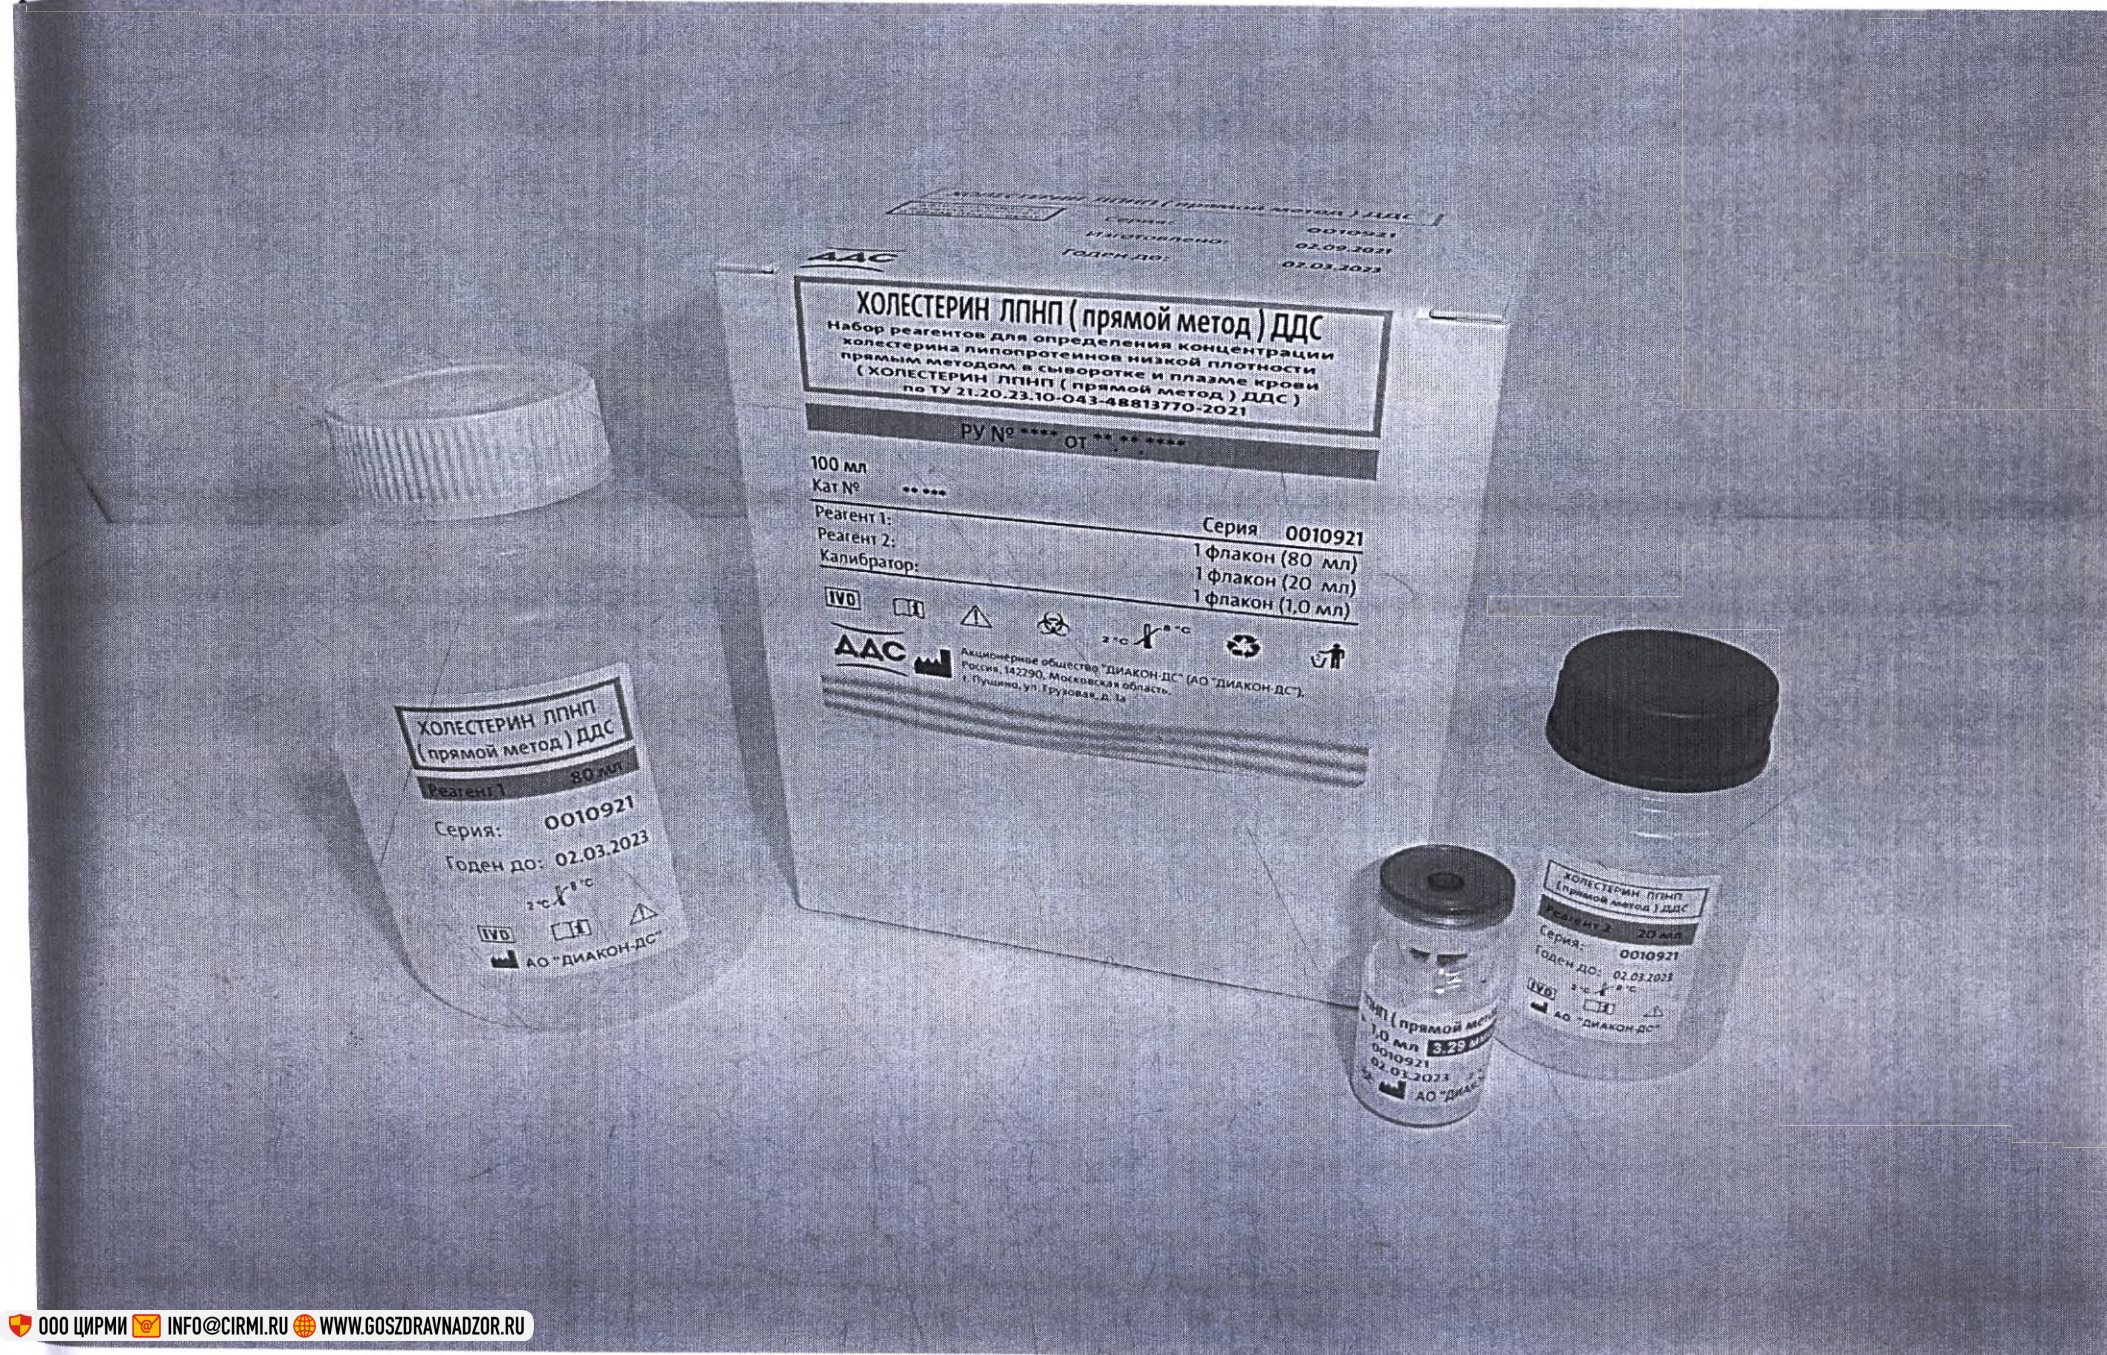

Внешний вид

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеинов низкой плотности прямым методом в сыворотке и плазме крови (ХОЛЕСТЕРИН ЛПНП (прямой метод) ДДС) по ТУ 21.20.23.110-043-48813770-2021



Вариант 1, Комплектация 6 (2)



Внешний вид

бора реагентов для определения концентрации холестерина липопротеинов низкой плотности прямым методом в сыворотке и плазме крови
(ХОЛЕСТЕРИН ЛПНП (прямой метод) ДДС) по ТУ 21.20.23.110-043-48813770-2021


иант 1, Комплектация 7 (1)

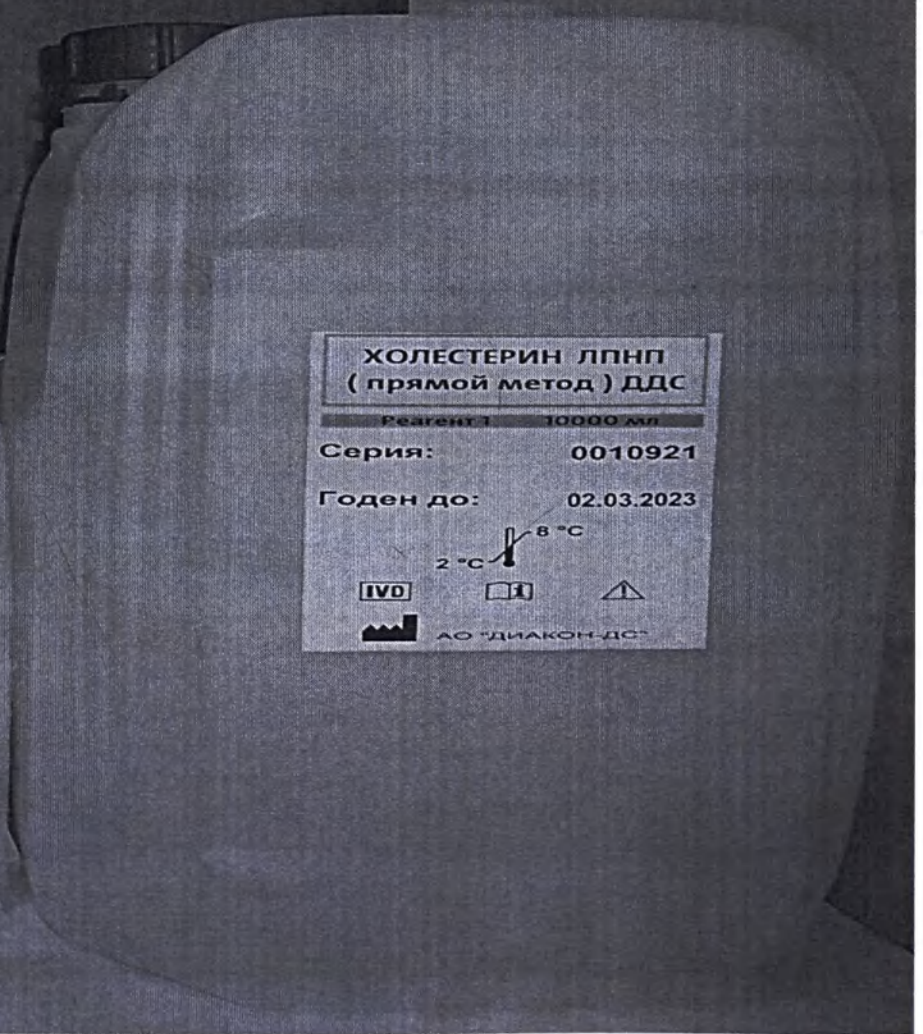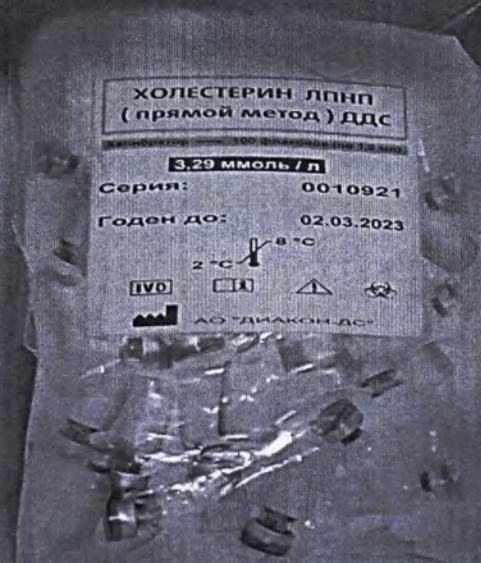

Внешний вид

набора реагентов для определения концентрации холестерина липопротеинов низкой плотности прямым методом в сыворотке и плазме крови
(ХОЛЕСТЕРИН ЛПНП (прямой метод) ДДС) по ТУ 21.20.23.110-043-48813770-2021


изм. 1, Комплектация 7 (2)

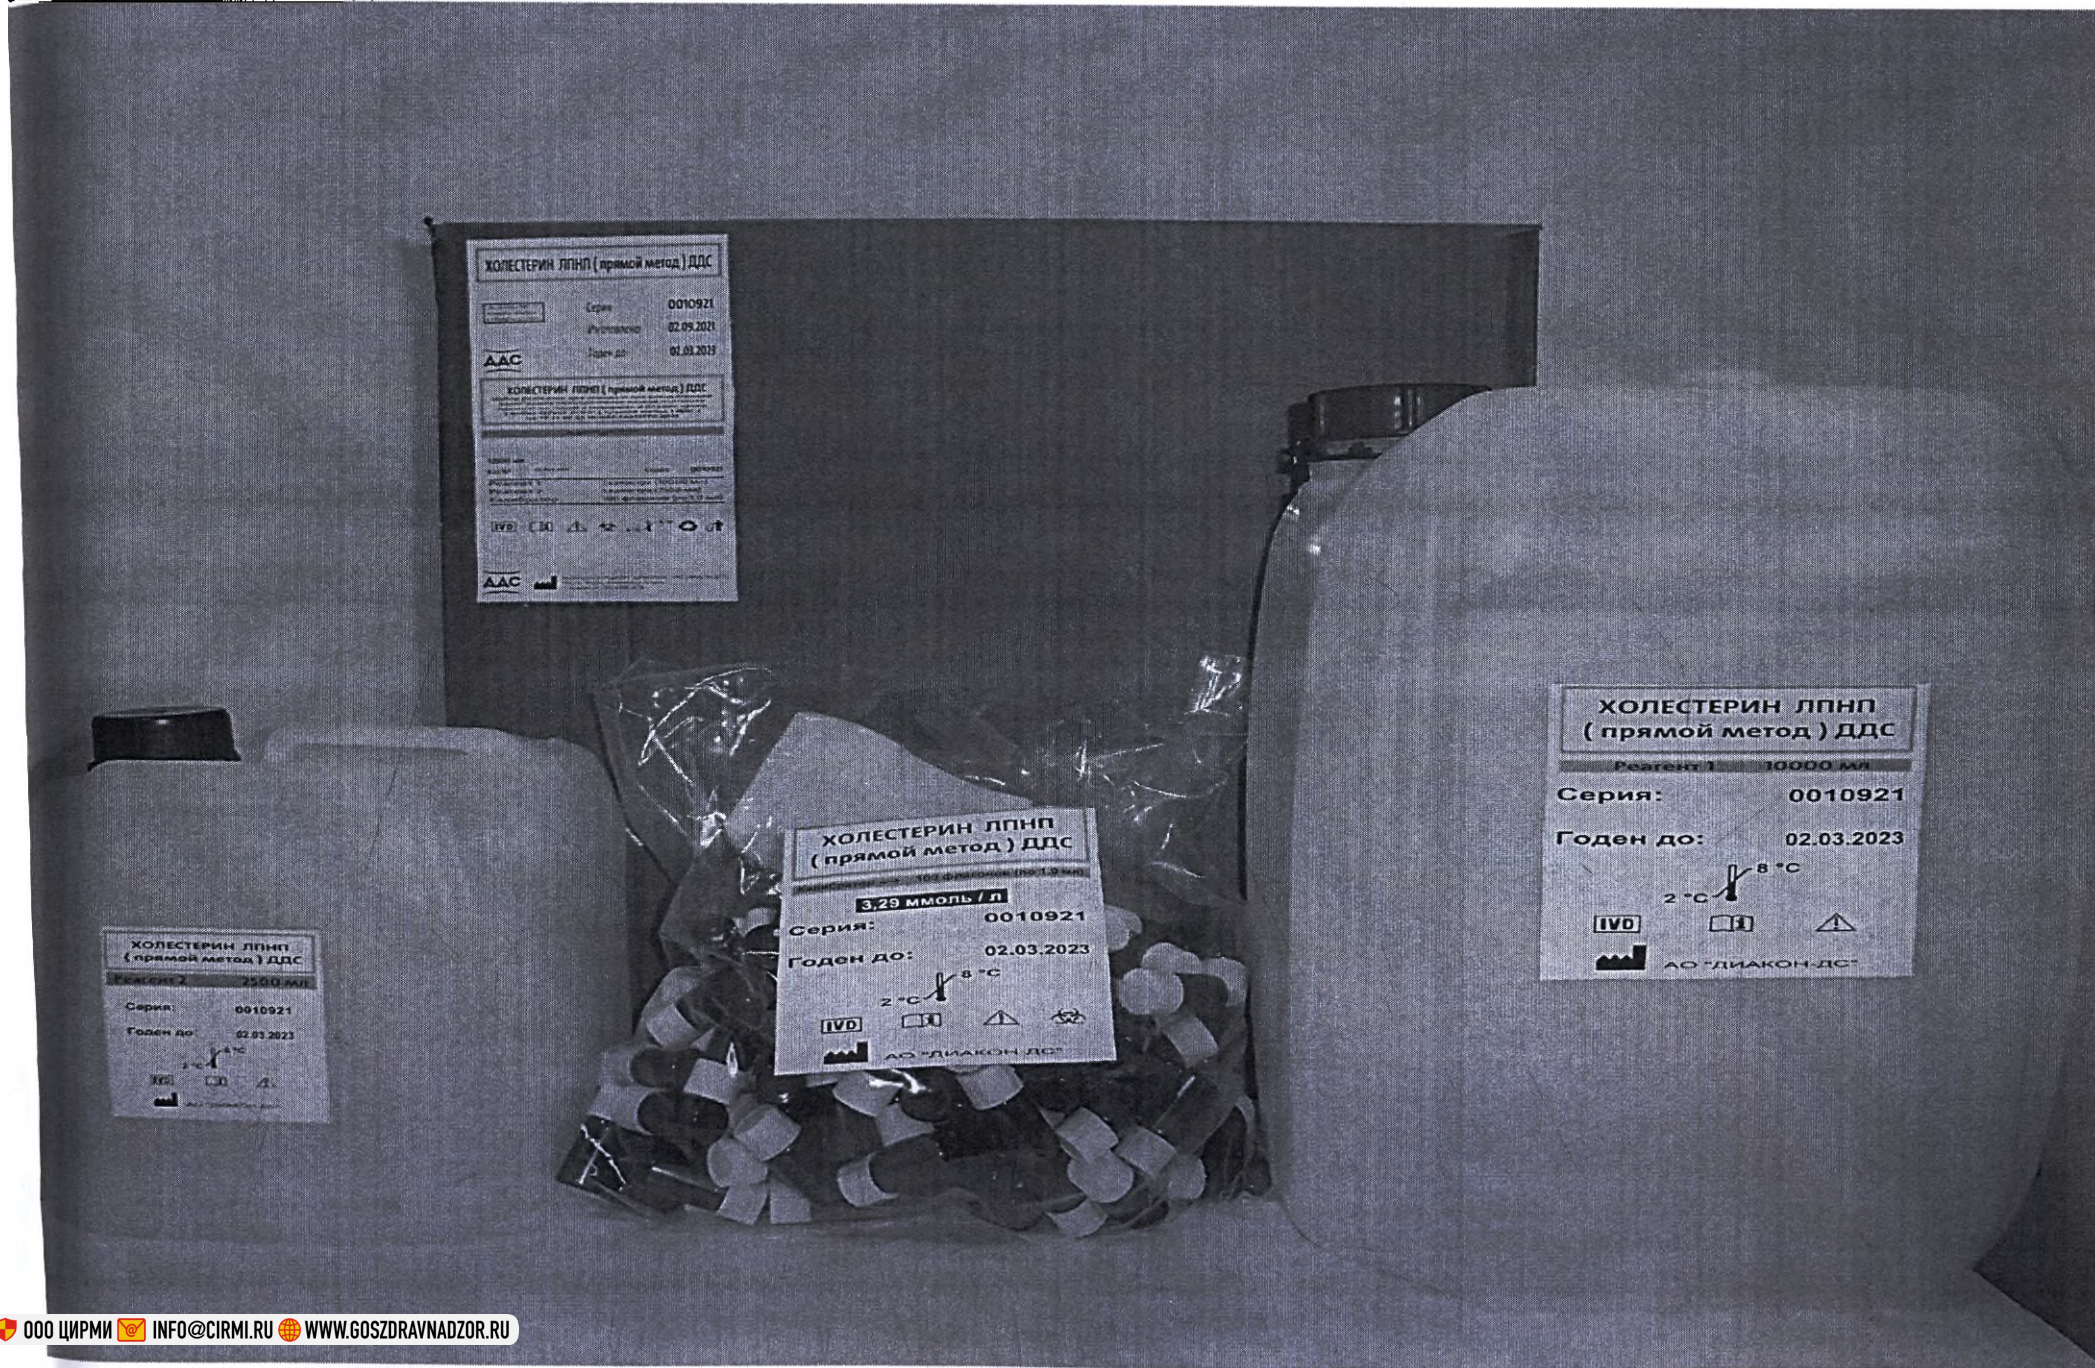

Внешний вид

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеинов низкой плотности прямым методом в сыворотке и плазме крови (ХОЛЕСТЕРИН ЛПНП (прямой метод) ДДС) по ТУ 21.20.23.110-043-48813770-2021


Вариант 2, Комплектация 1

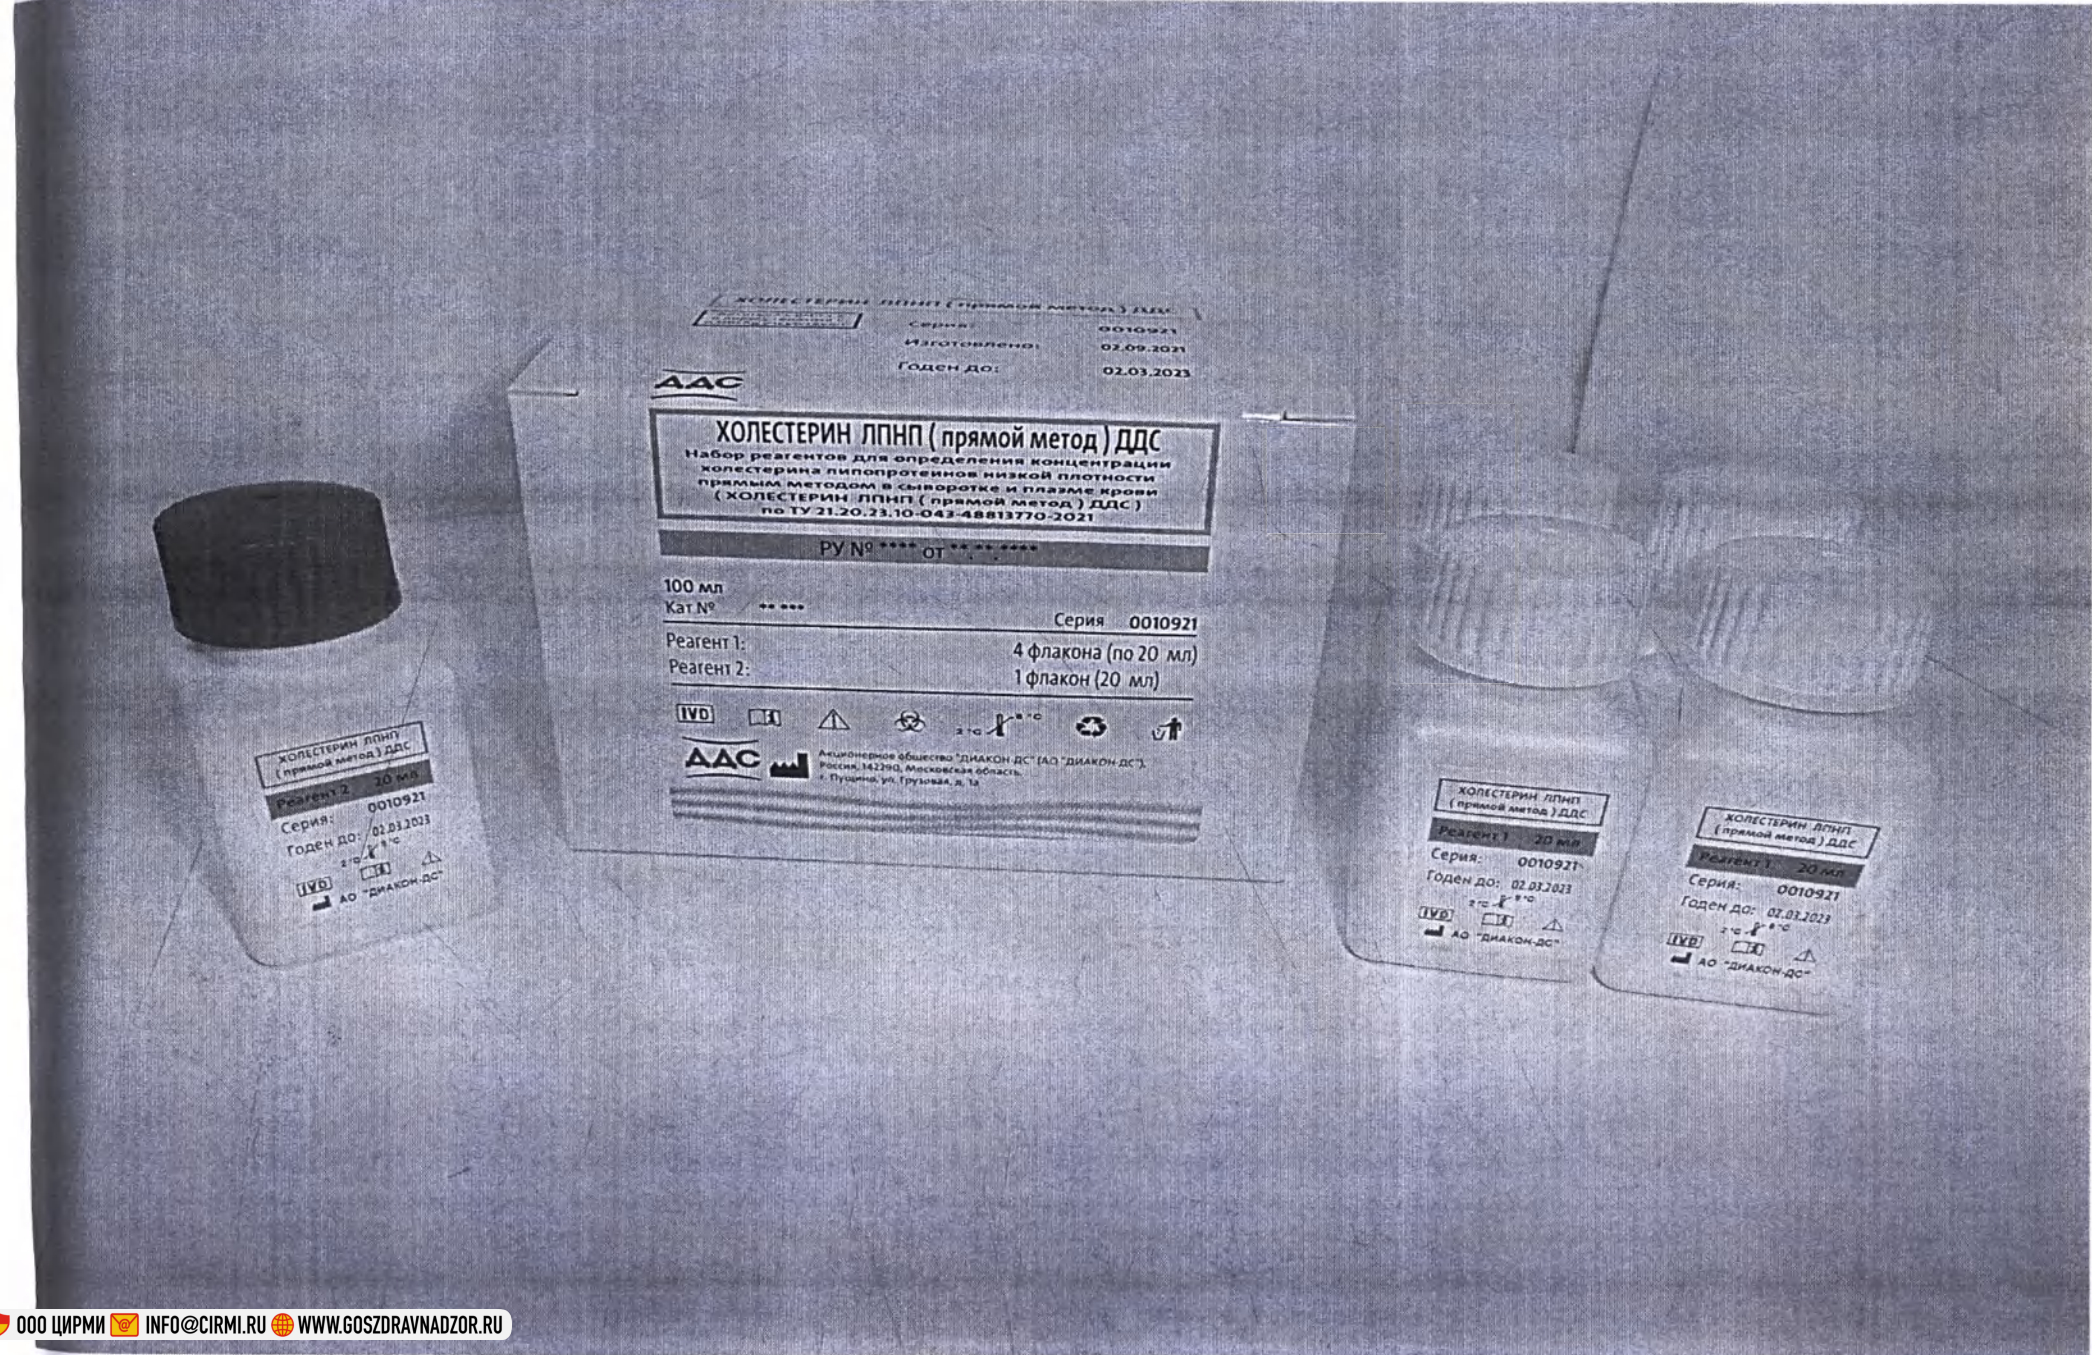

Внешний вид

набора реагентов для определения концентрации холестерина липопротеинов низкой плотности прямым методом в сыворотке и плазме крови
(ХОЛЕСТЕРИН ЛПНП (прямой метод) ДДС) по ТУ 21.20.23.110-043-48813770-2021


вариант 2, Комплектация 2

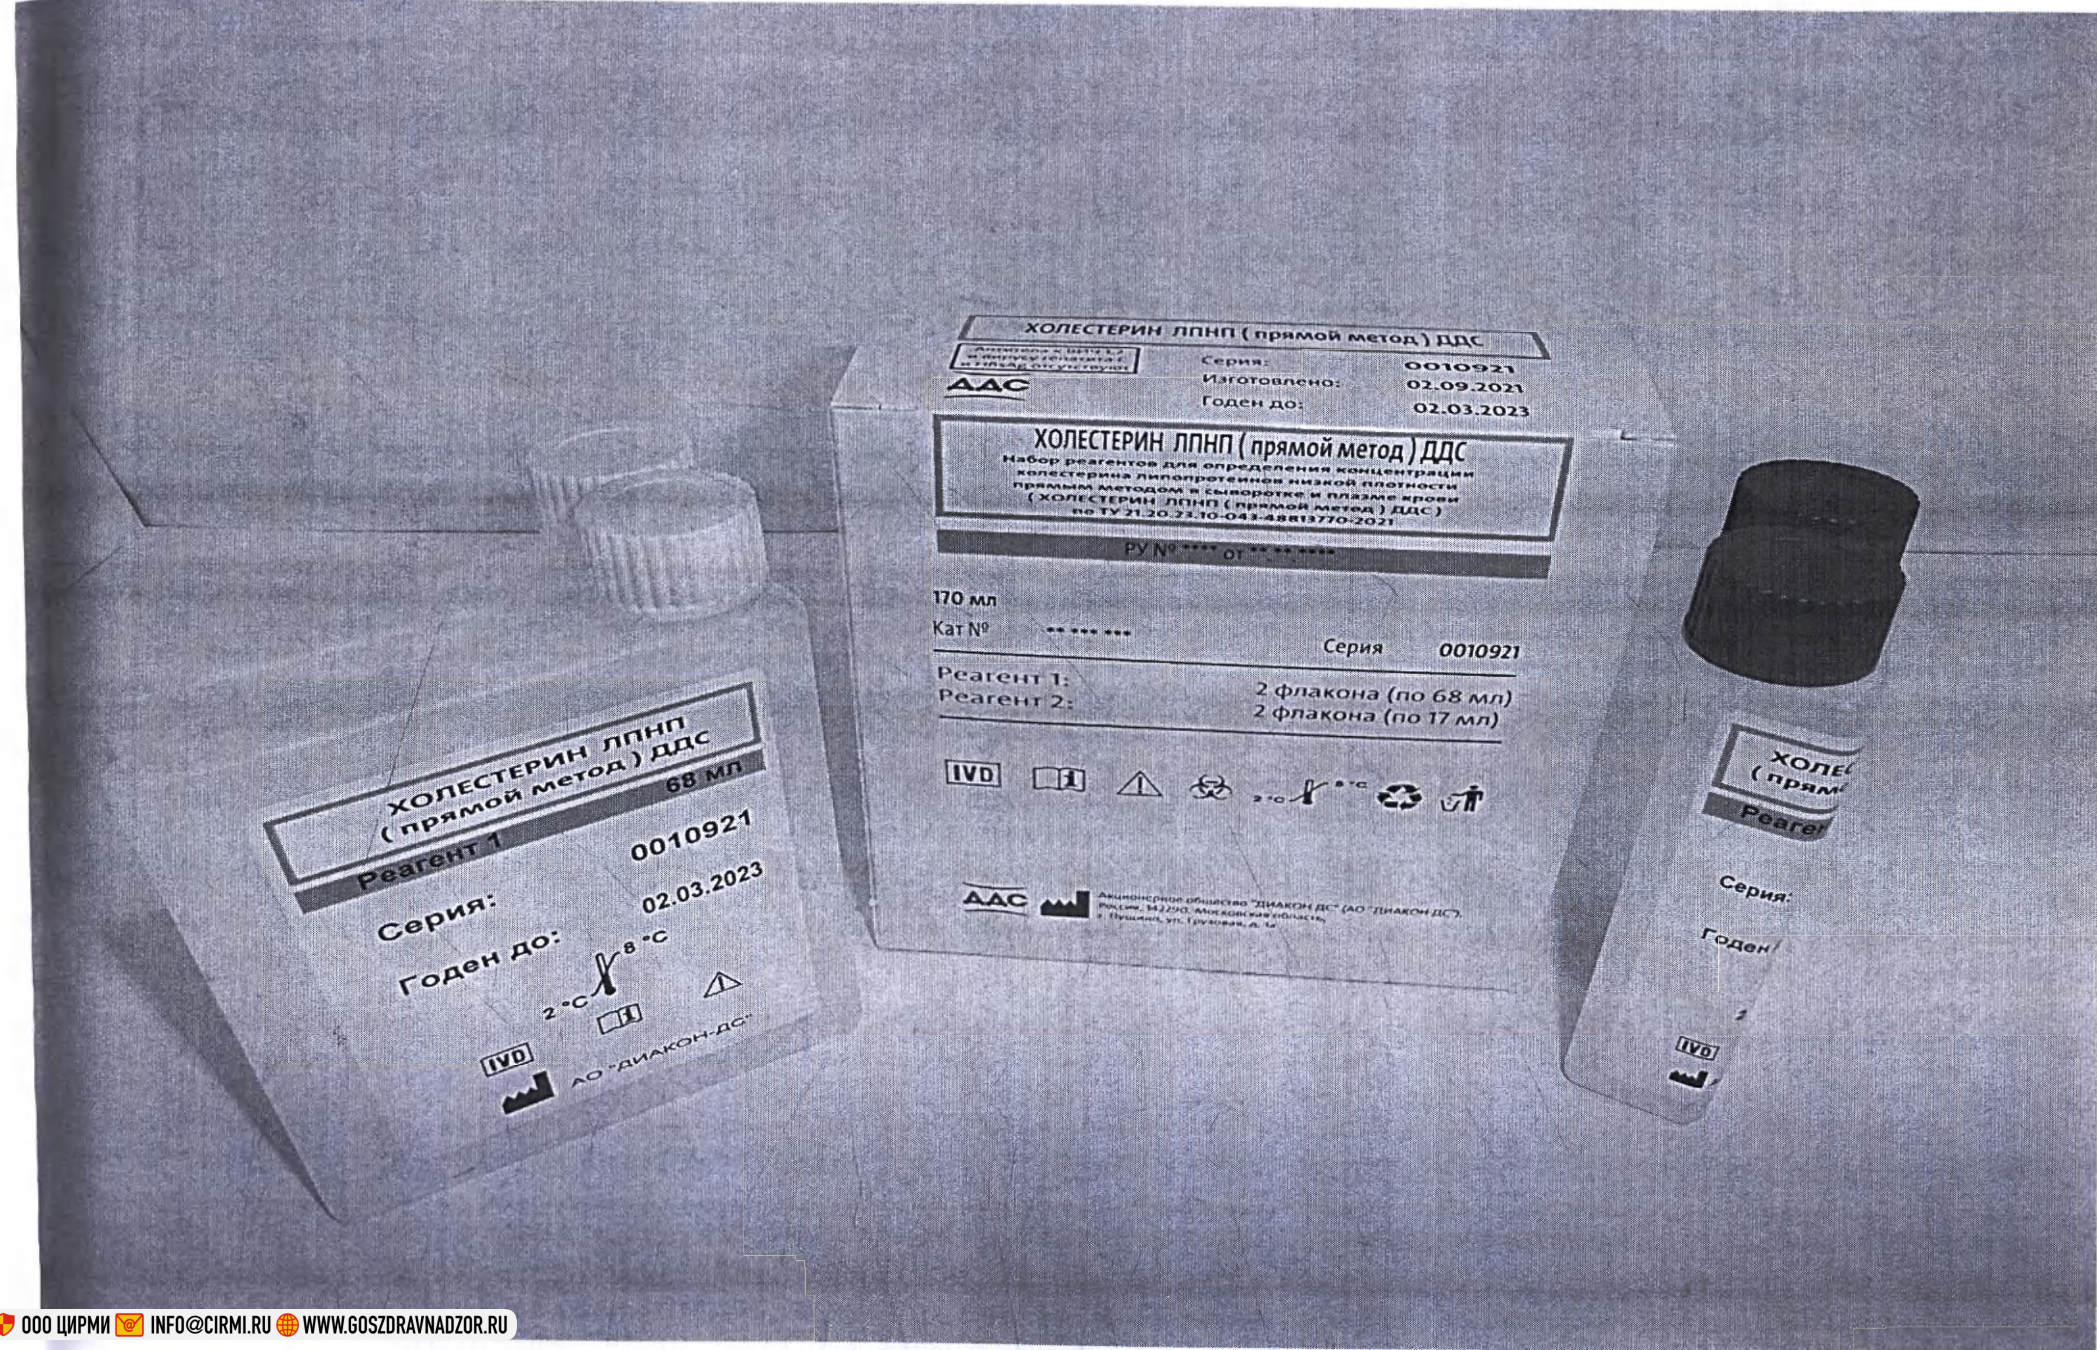

Внешний вид

Лаборатория реантентов для определения концентрации холестерина липопротеинов низкой плотности прямым методом в сыворотке и плазме крови (ХОЛЕСТЕРИН ЛПНП (прямой метод) ДДС) по ТУ 21.20.23.110-043-48813770-2021


риант 2, Комплектация 3

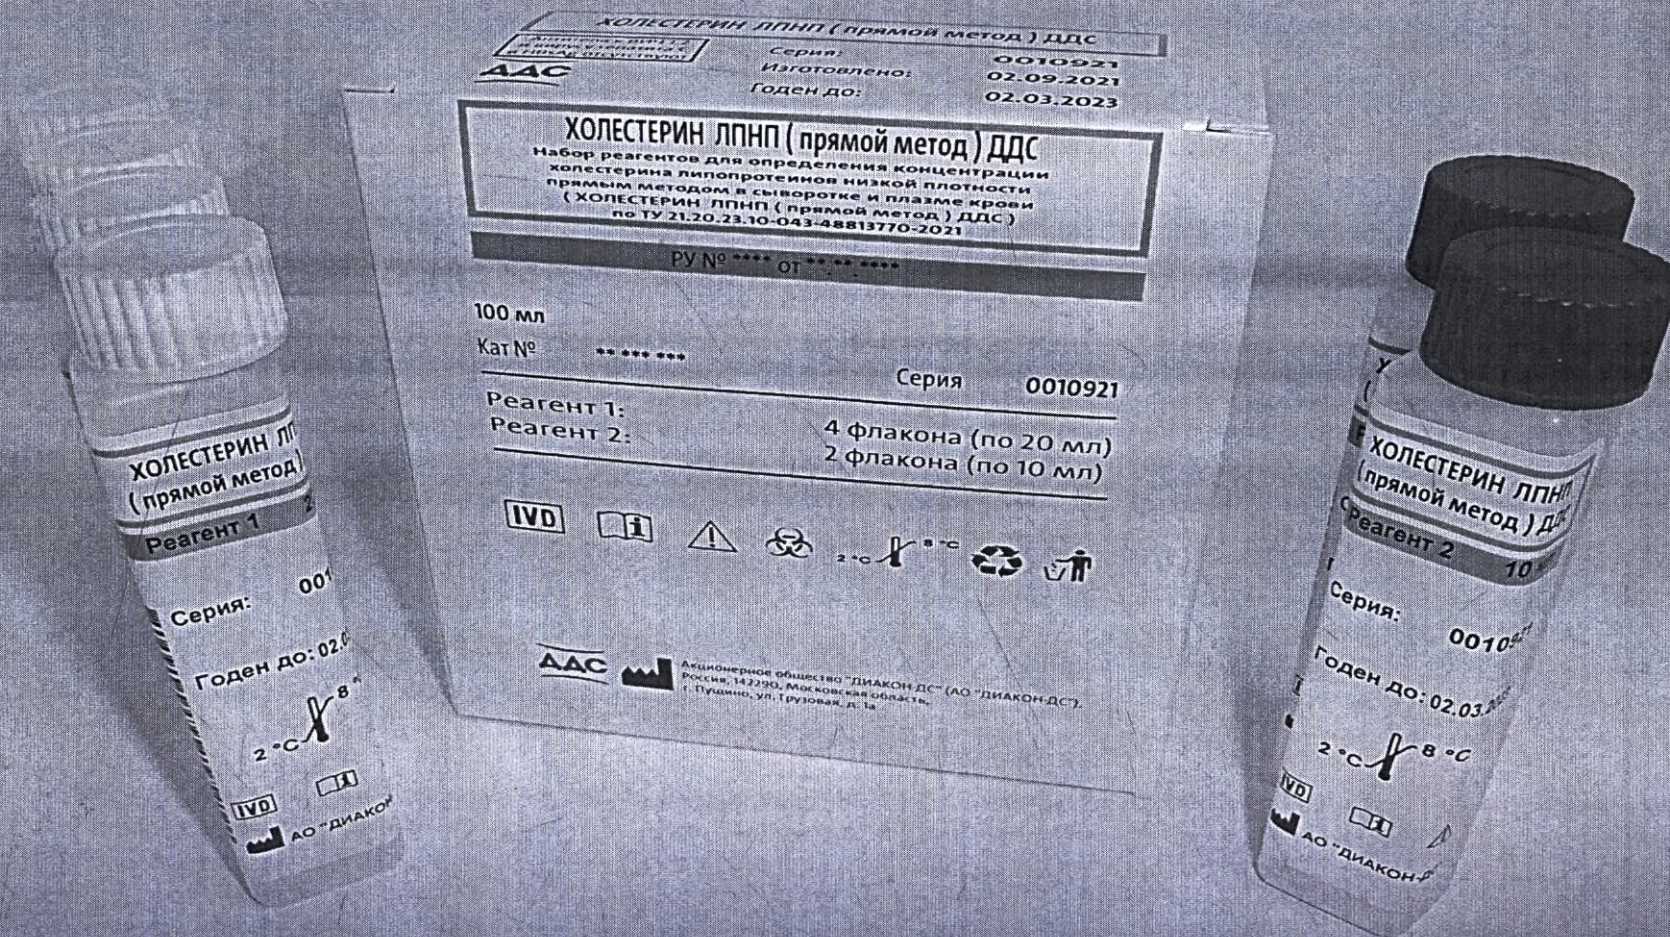

Внешний вид

набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеинов низкой плотности прямым методом в сыворотке и плазме крови
(ХОЛЕСТЕРИН ЛПНП (прямой метод) ДДС) по ТУ 21.20.23.110-043-48813770-2021


набор 2, Комплектация 4

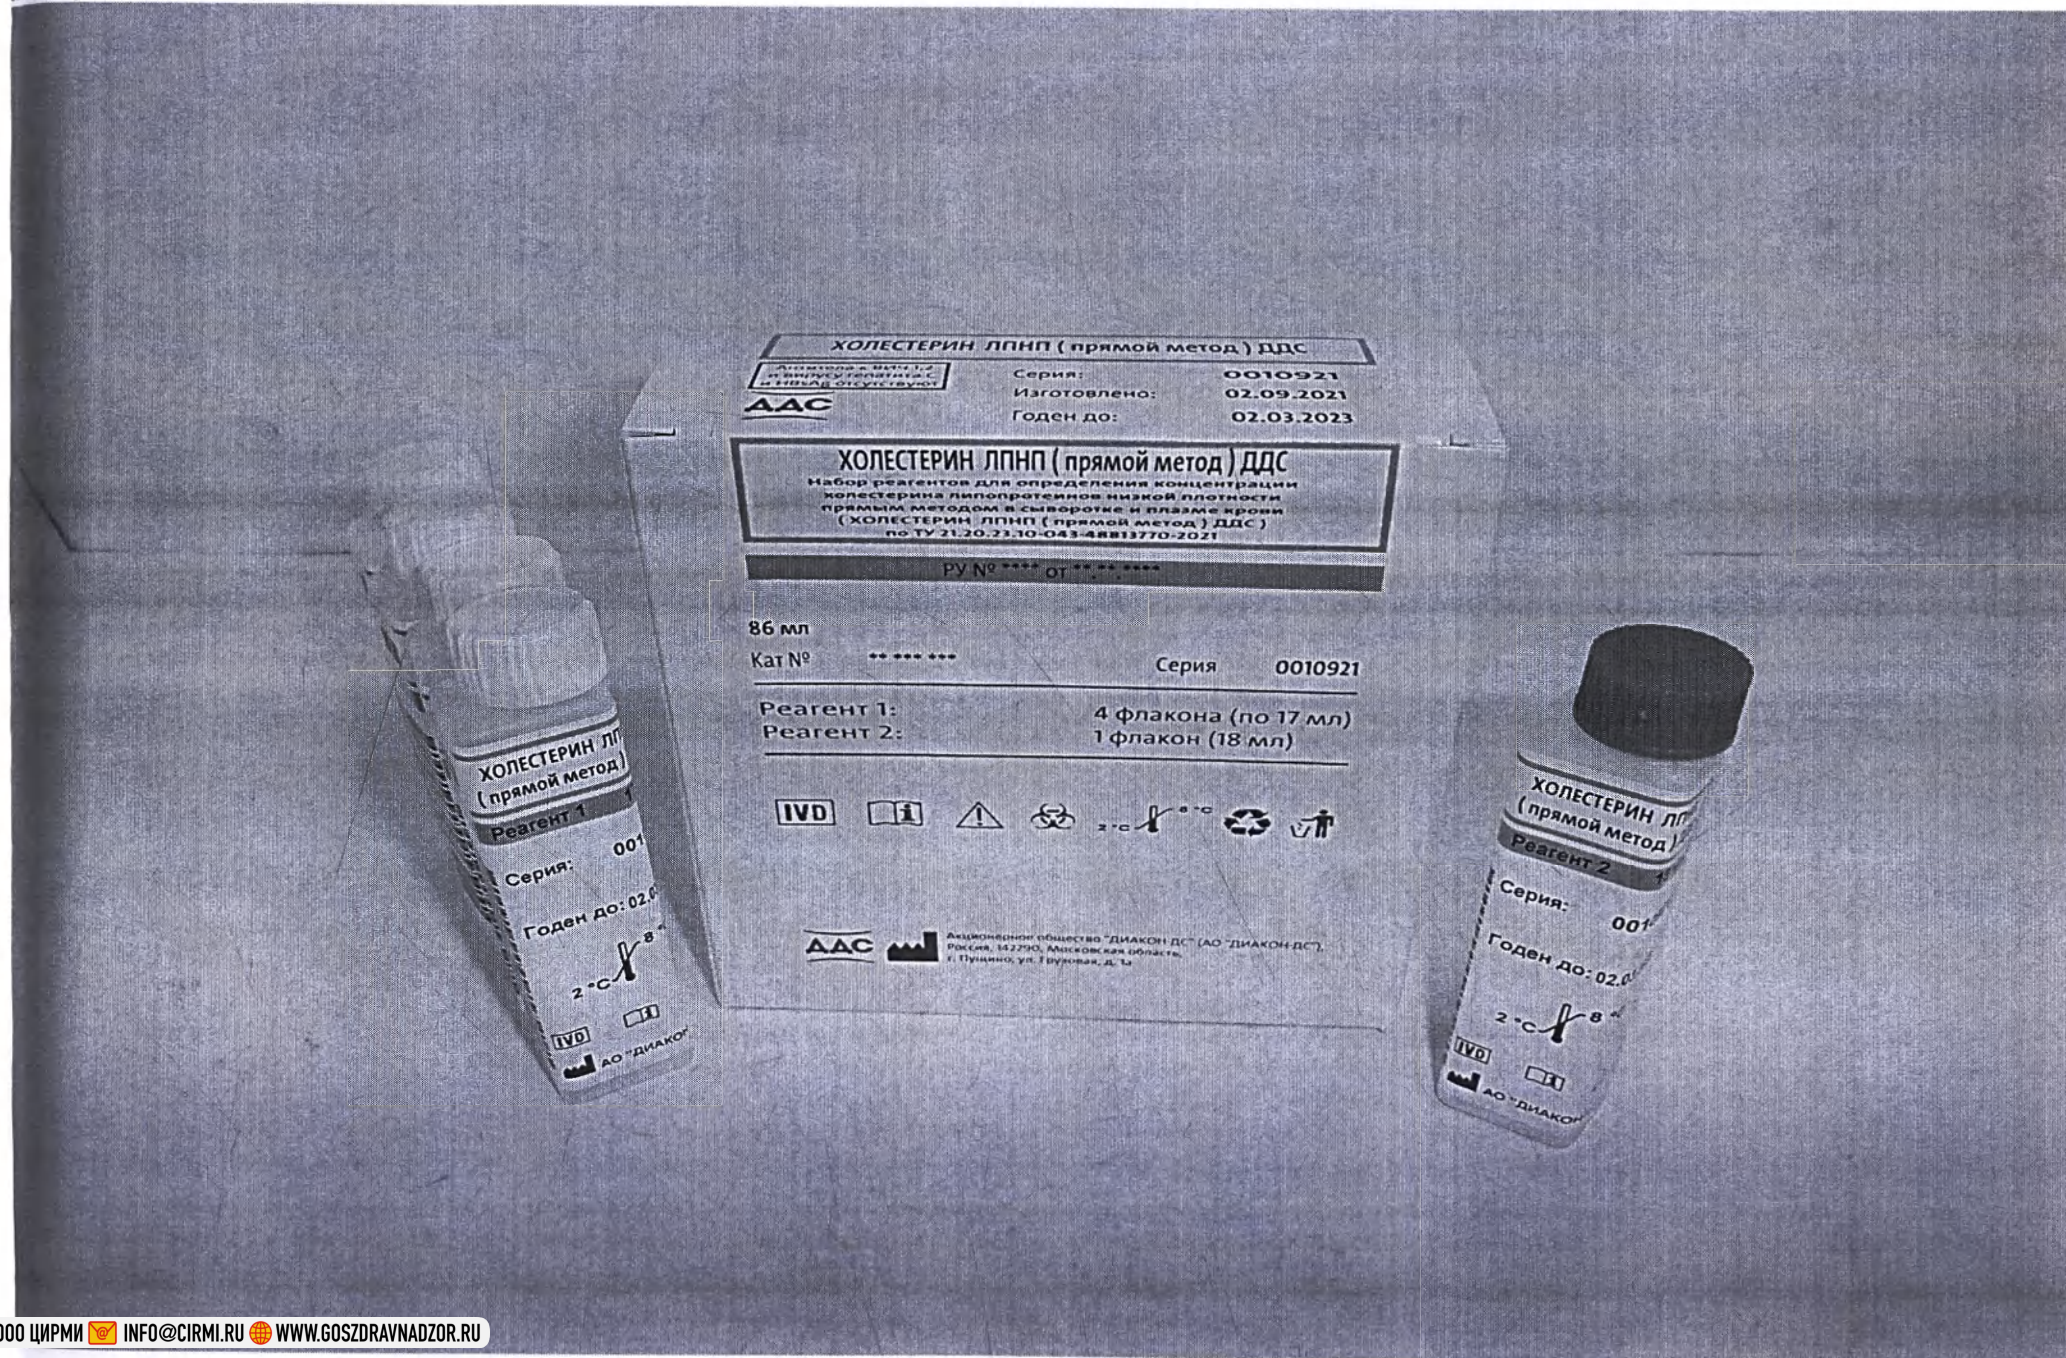

Внешний вид


бора реагентов для определения концентрации холестерина липопротеинов низкой плотности прямым методом в сыворотке и плазме крови
(ХОЛЕСТЕРИН ЛПНП (прямой метод) ДДС) по ТУ 21.20.23.110-043-48813770-2021

тант 2, Комплектация 5

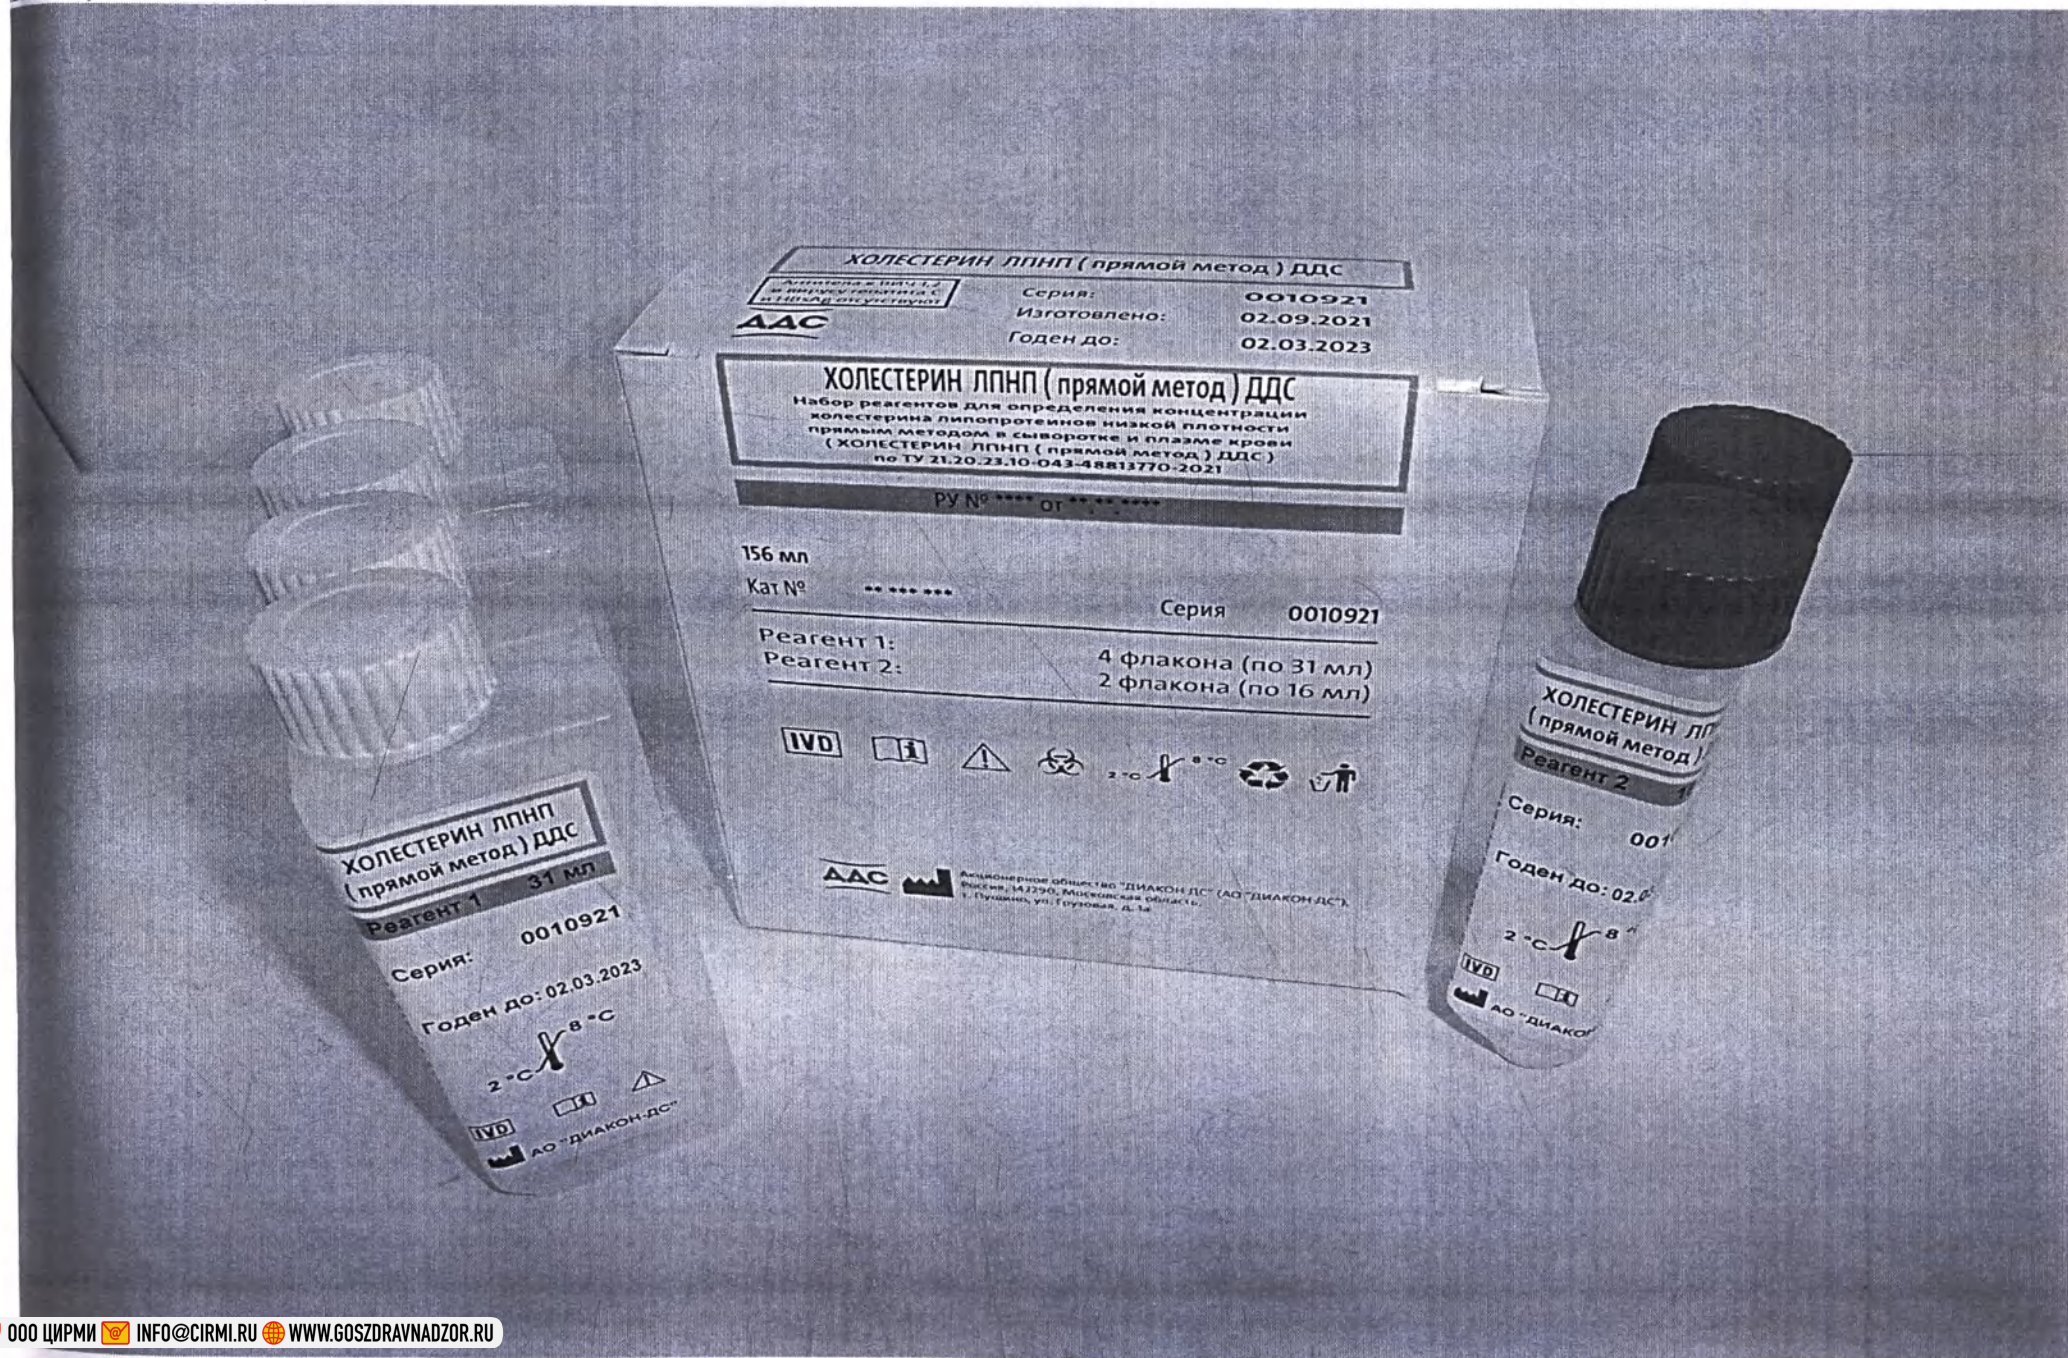

Внешний вид


Набора реагентов для определения концентрации холестерина липопротеинов низкой плотности прямым методом в сыворотке и плазме крови
(ХОЛЕСТЕРИН ЛПНП (прямой метод) ДДС) по ТУ 21.20.23.110-043-48813770-2021
Вариант 2, Комплектация 6

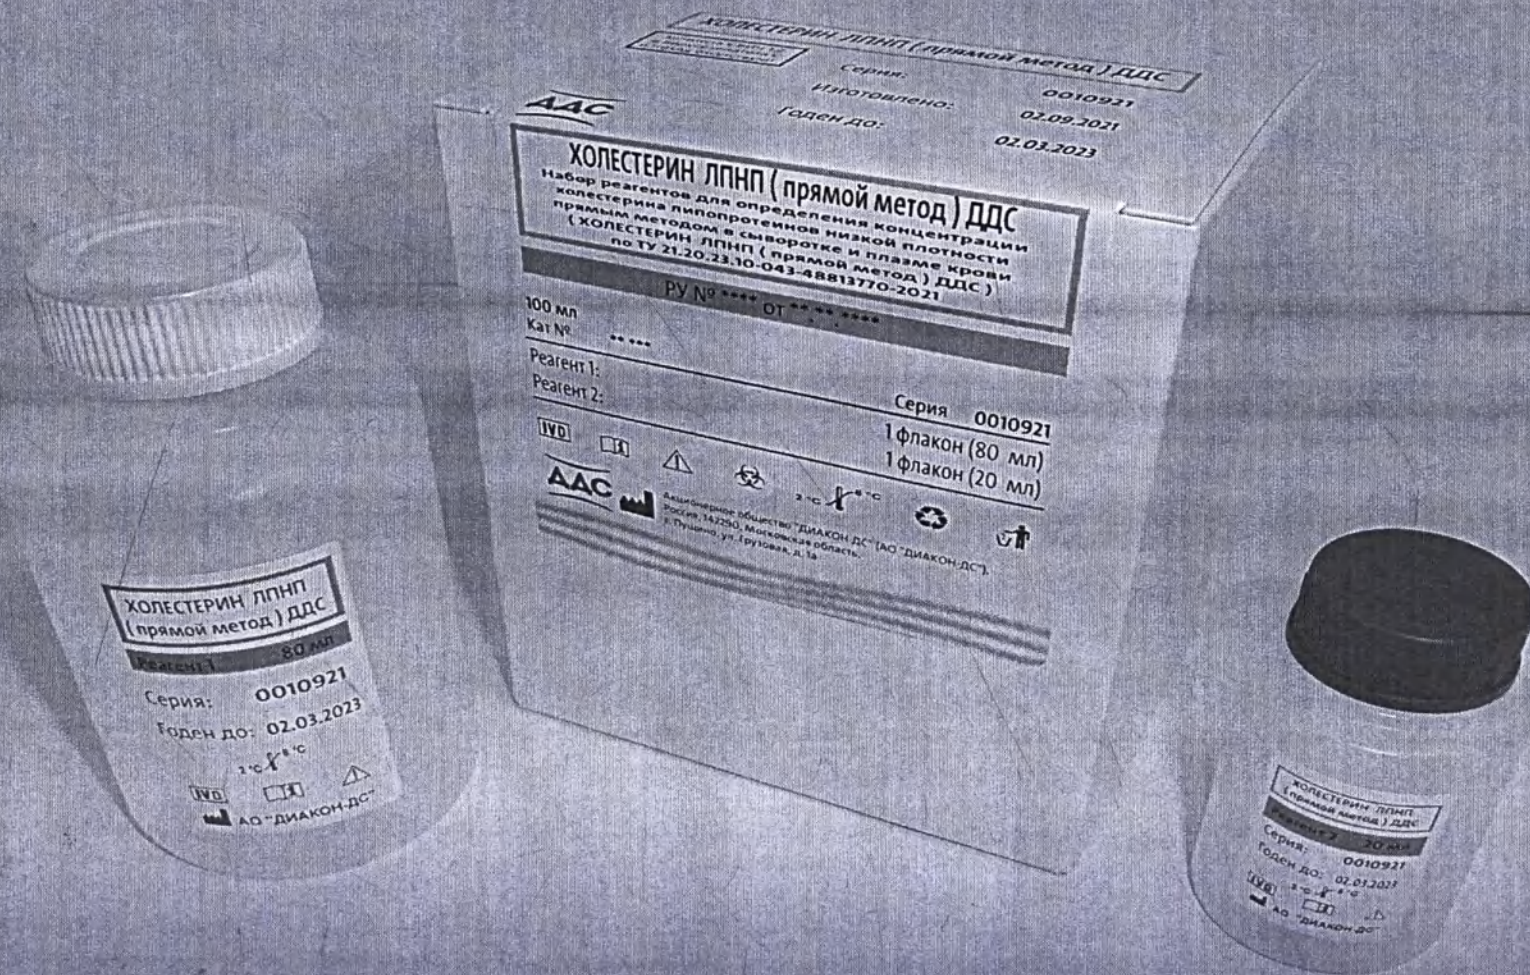

Внешний вид

Набора реагентов для определения концентрации холестерина липопротеинов низкой плотности прямым методом в сыворотке и плазме крови
(ХОЛЕСТЕРИН ЛПНП (прямой метод) ДДС) по ТУ 21.20.23.110-043-48813770-2021


Вариант 2, Комплектация 7

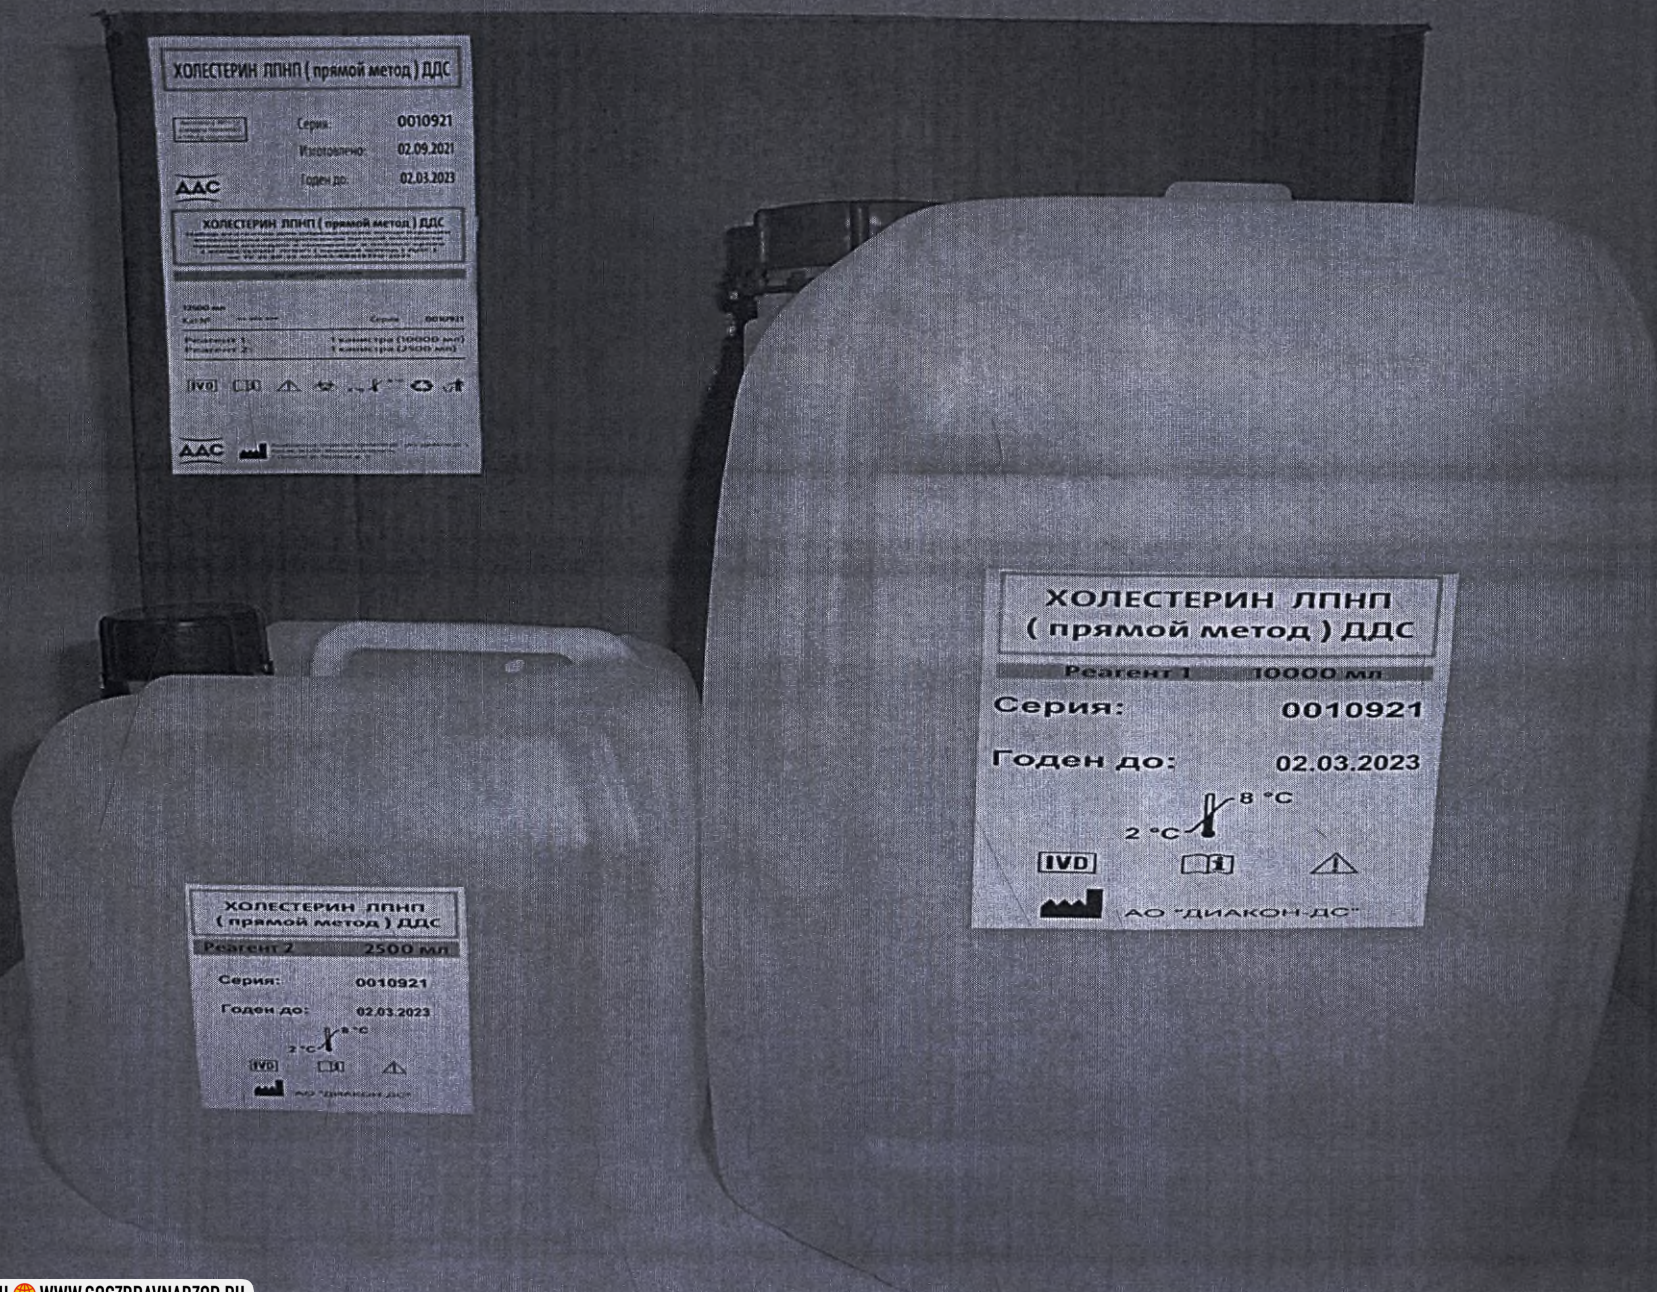

Внешний вид

Набора реагентов для определения концентрации холестерина липопротеинов низкой плотности прямым методом в сыворотке и плазме крови
(ХОЛЕСТЕРИН ЛПНП (прямой метод) ДДС) по ТУ 21.20.23.110-043-48813770-2021


Вариант 3, Комплектация 1 (1)

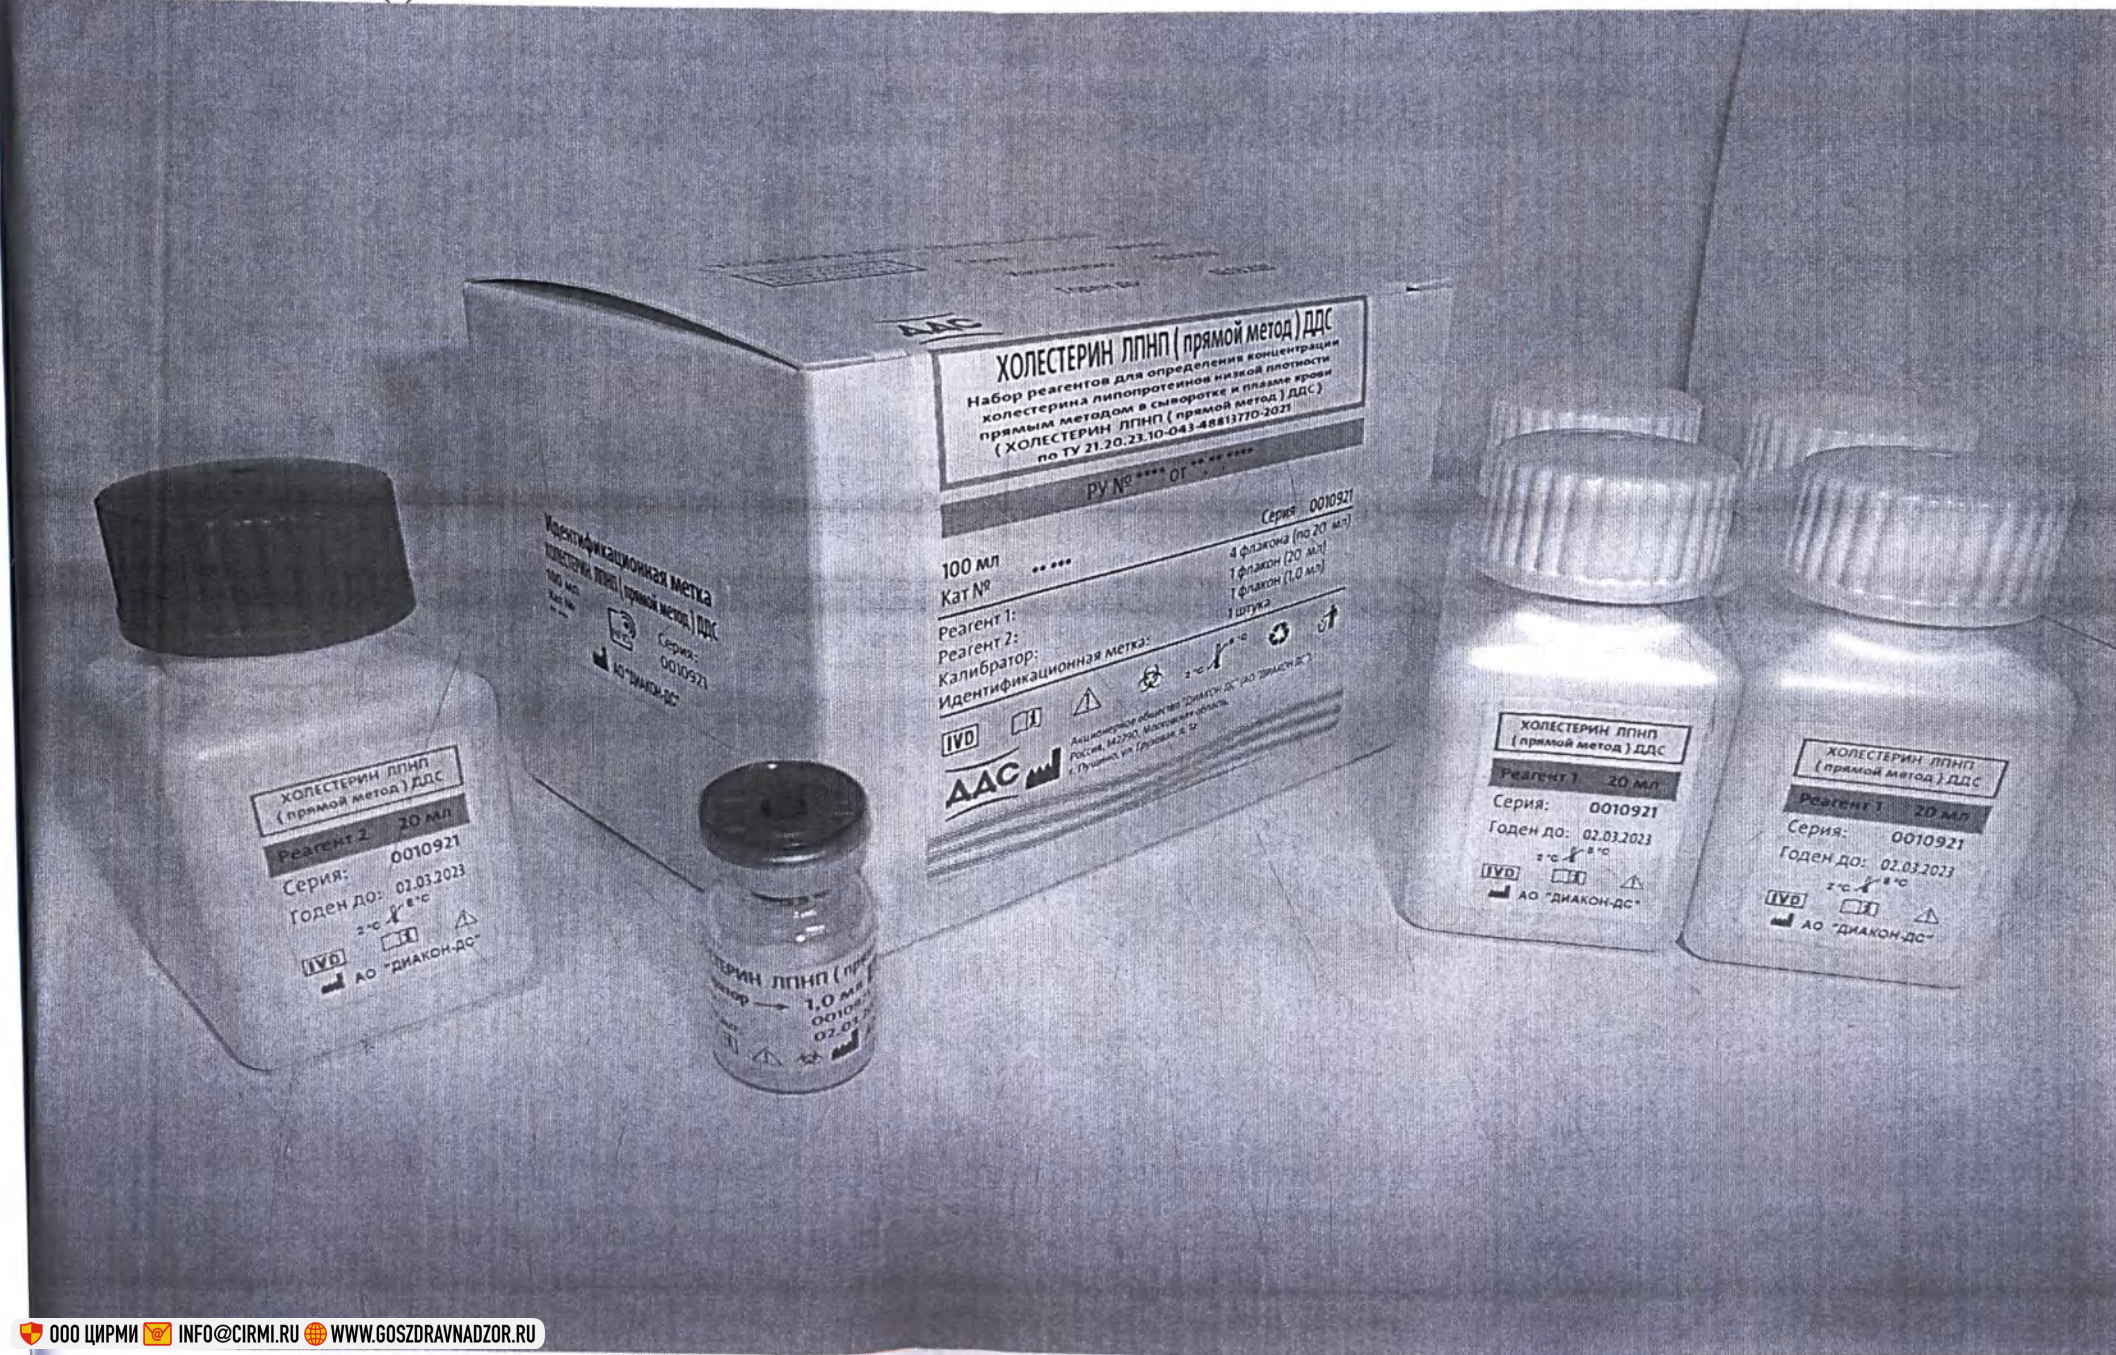

Внешний вид

Набора реагентов для определения концентрации холестерина липопротеинов низкой плотности прямым методом в сыворотке и плазме крови
(ХОЛЕСТЕРИН ЛПНП (прямой метод) ДДС) по ТУ 21.20.23.110-043-48813770-2021


Вариант 3, Комплектация 1 (1)

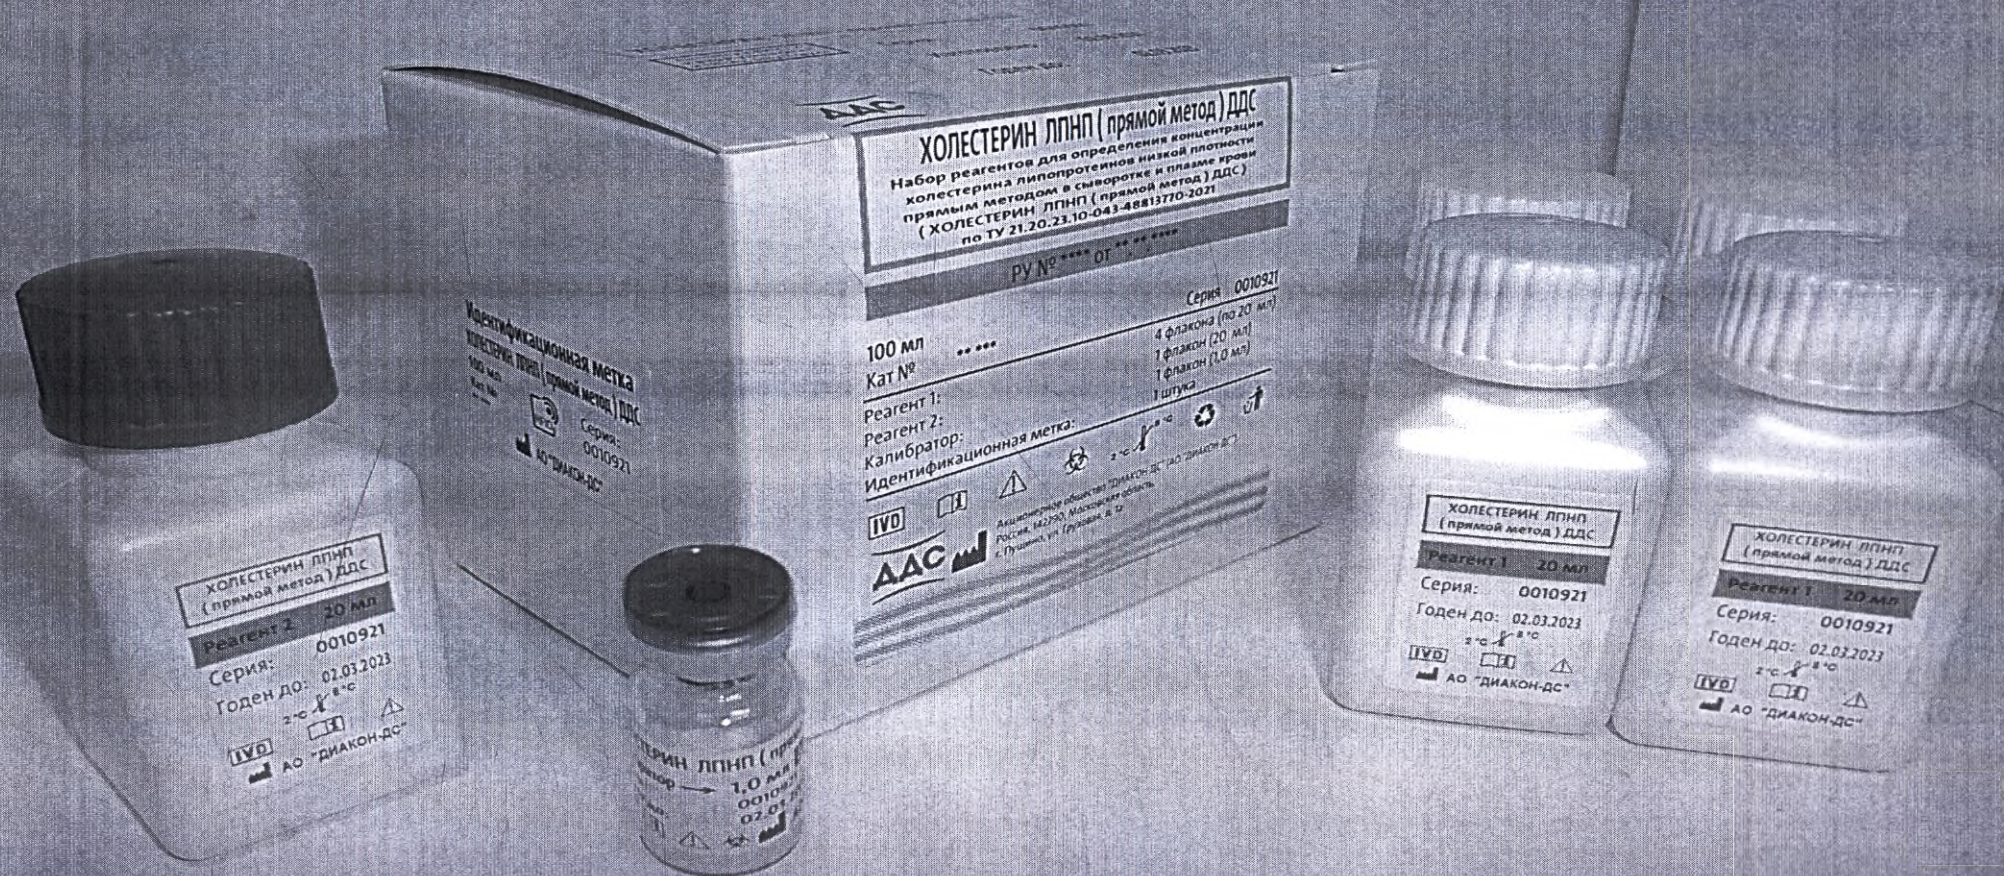

Внешний вид

Набора реагентов для определения концентрации холестерина липопротеинов низкой плотности прямым методом в сыворотке и плазме крови (ХОЛЕСТЕРИН ЛПНП (прямой метод) ДДС) по ТУ 21.20.23.110-043-48813770-2021


Вариант 3, Комплектация 1 (2)

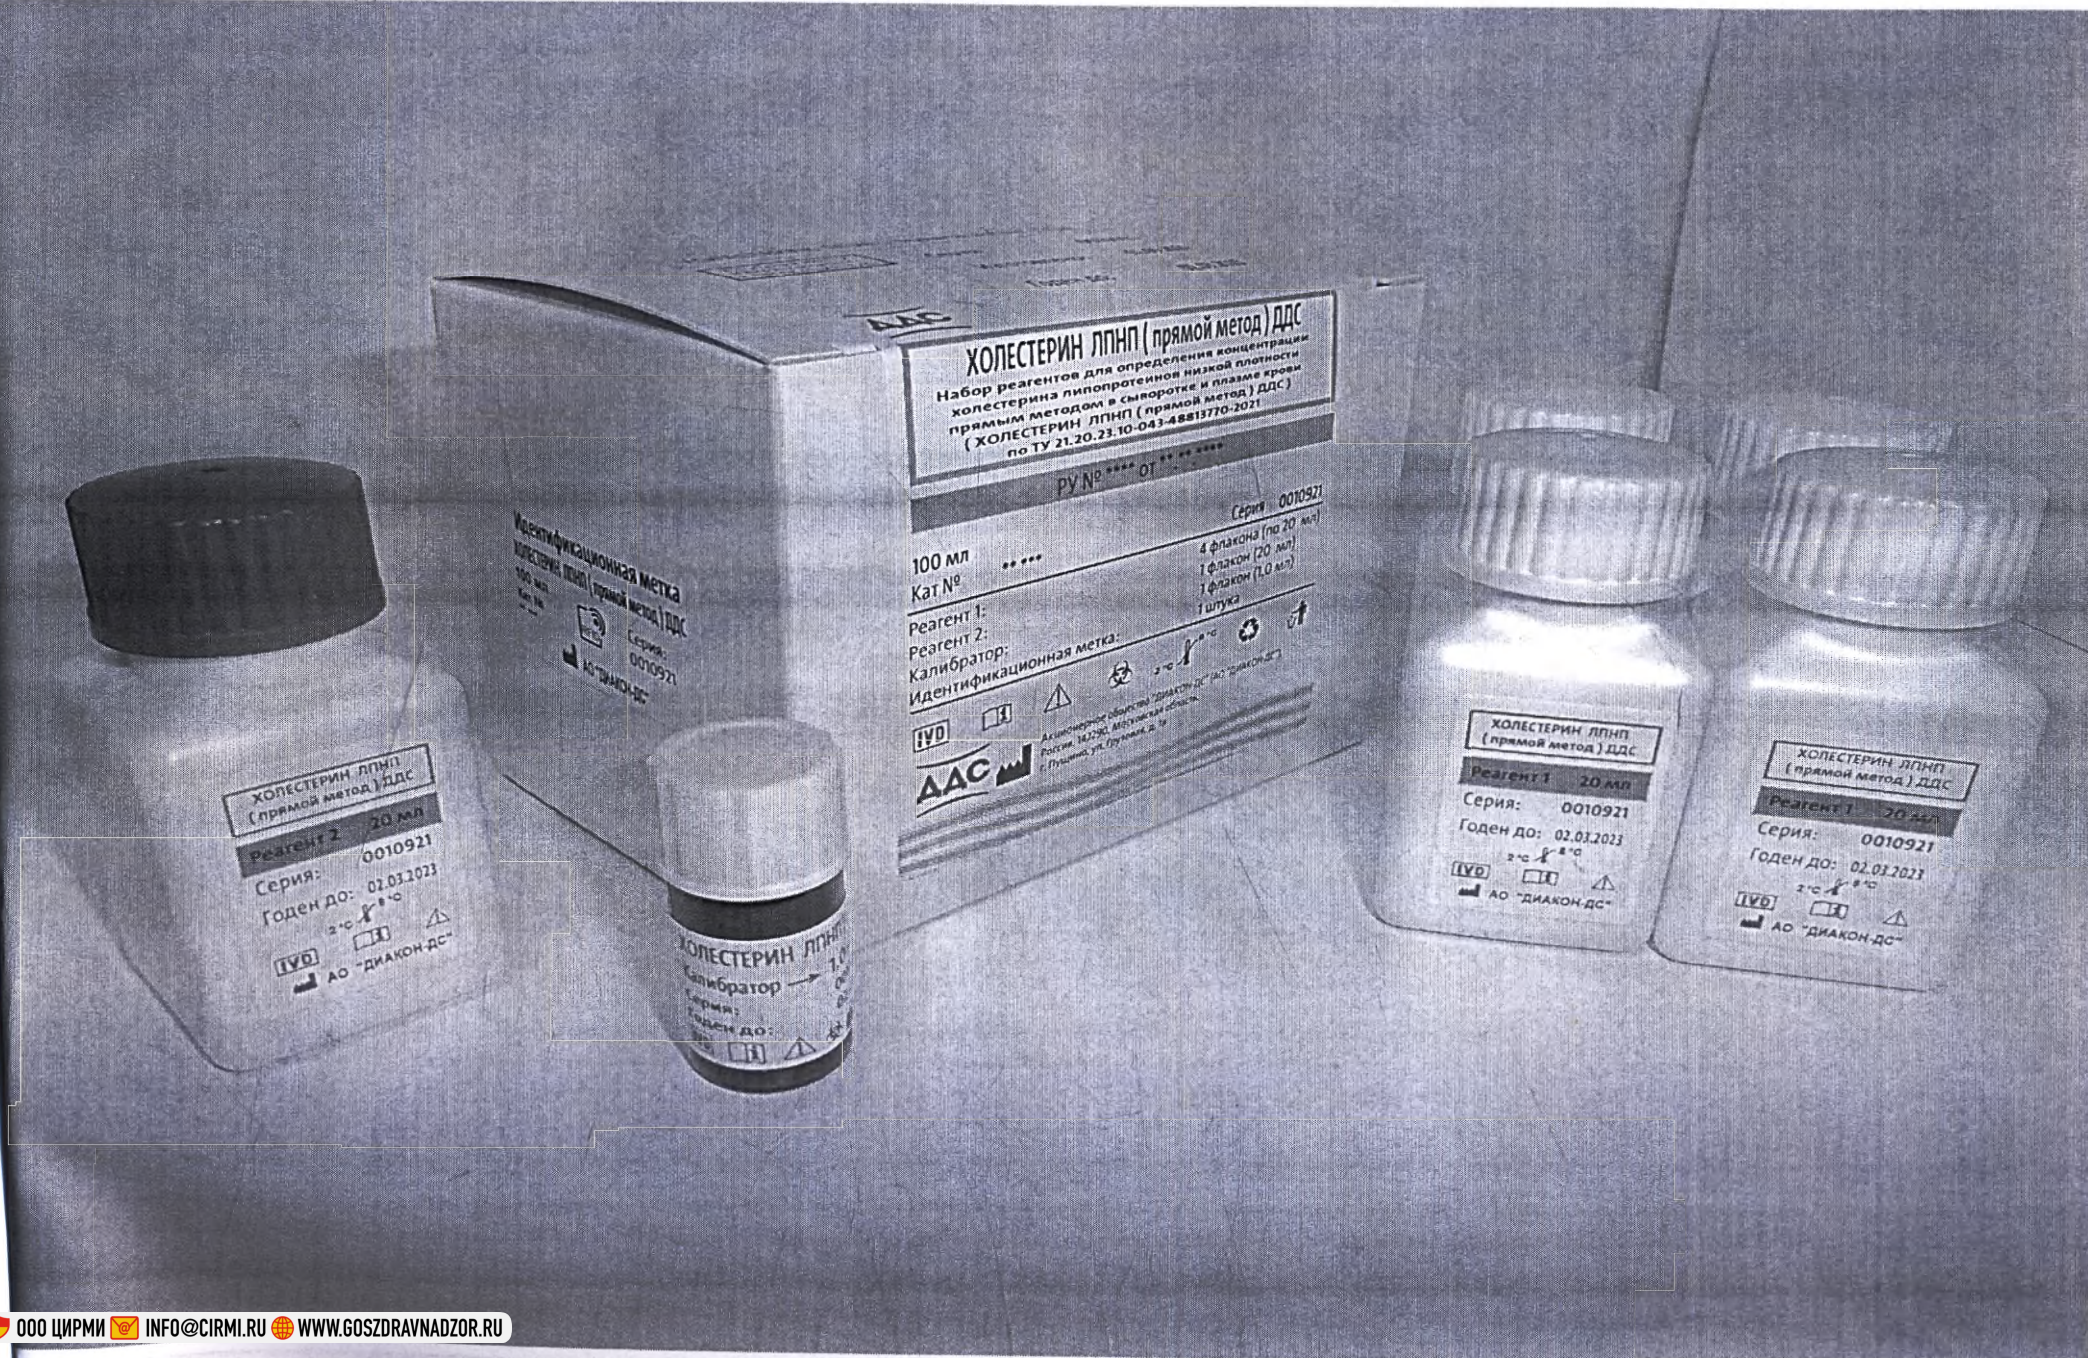

Внешний вид

Набора реагентов для определения концентрации холестерина липопротеинов низкой плотности прямым методом в сыворотке и плазме крови
(ХОЛЕСТЕРИН ЛПНП (прямой метод) ДДС) по ТУ 21.20.23.110-043-48813770-2021


Вариант 4, Комплектация 1

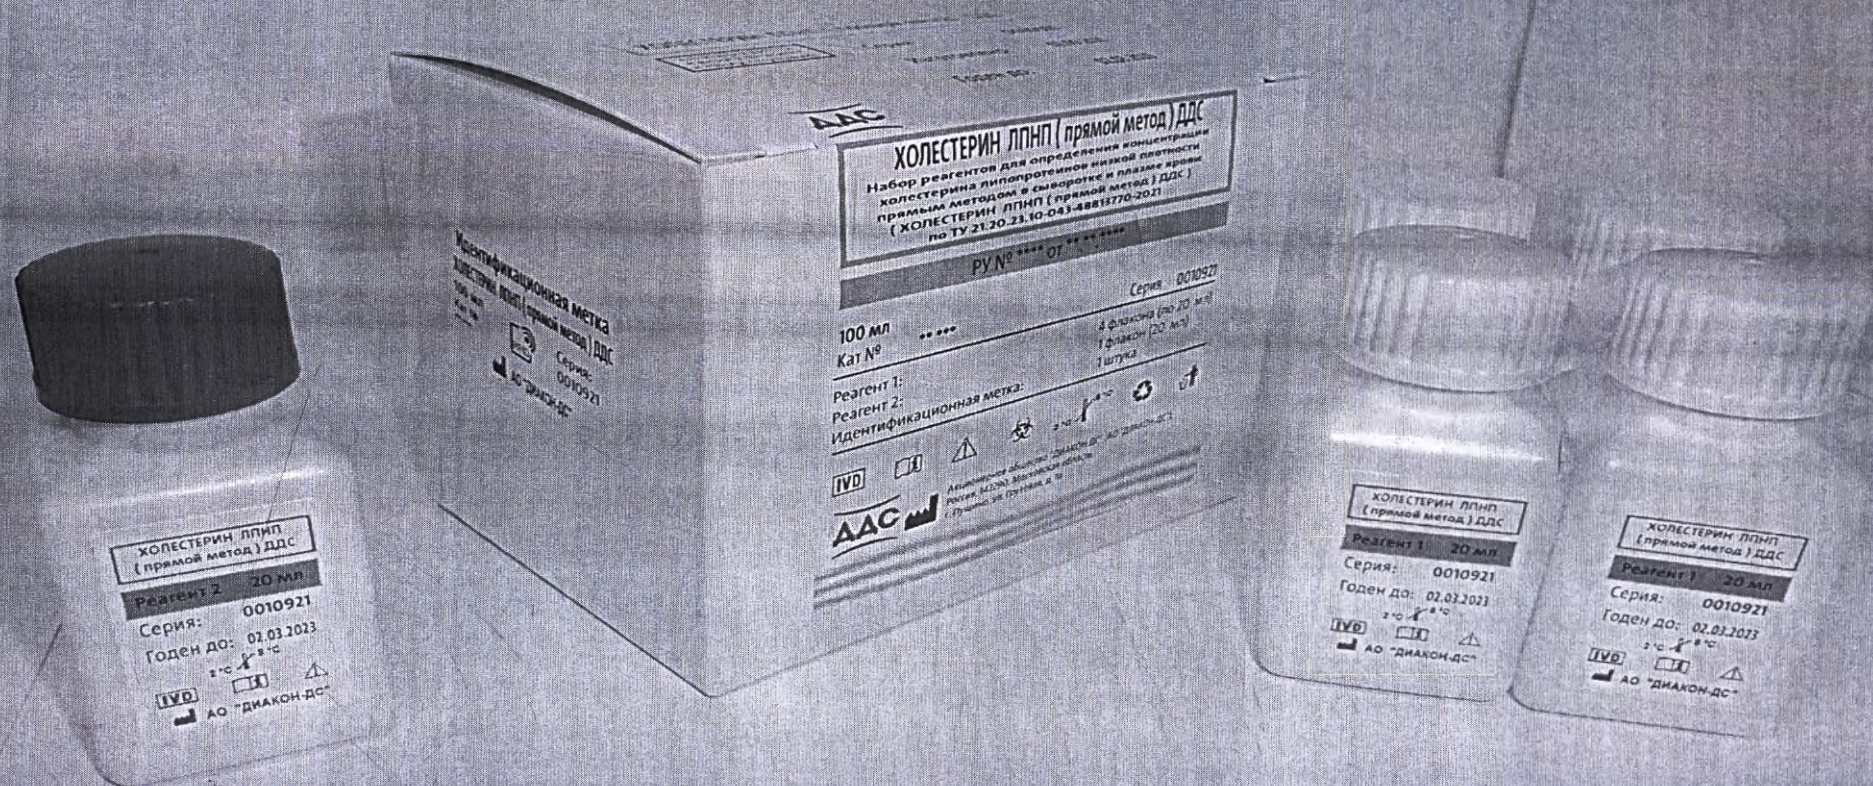

Внешний вид

Набора реагентов для определения концентрации холестерина липопротеинов низкой плотности прямым методом в сыворотке и плазме крови
(ХОЛЕСТЕРИН ЛПНП (прямой метод) ДДС) по ТУ 21.20.23.110-043-48813770-2021

Вариант 4, Комплектация 1

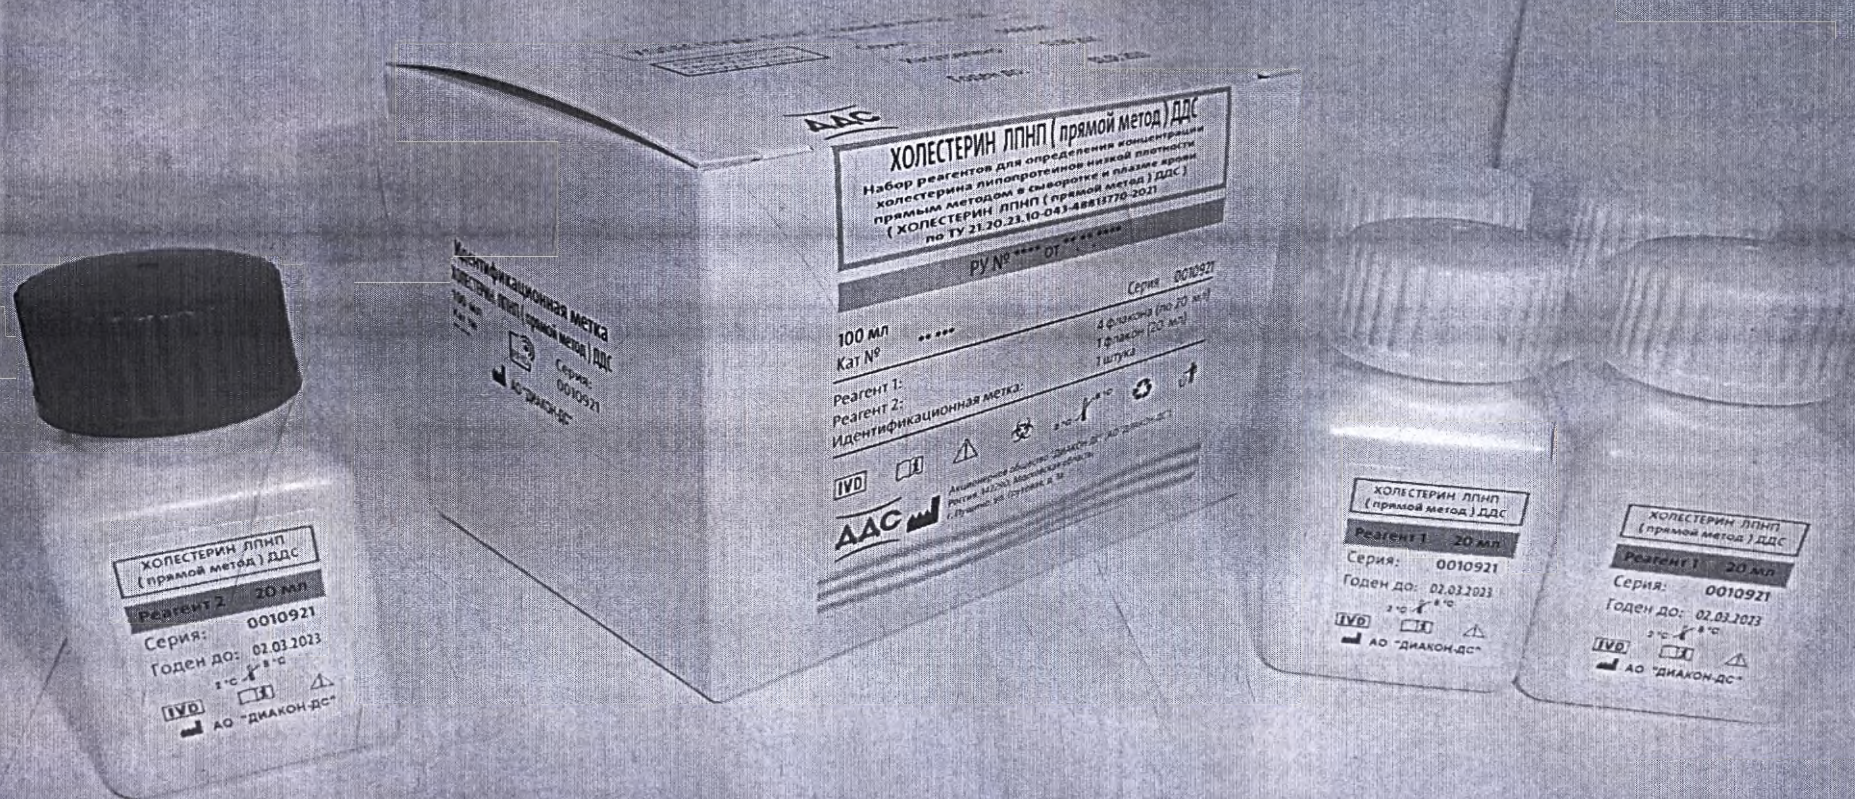



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 24

Генеральный директор
АО «ДИАКОН-ДС»

Т.Ю. Корзун