

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Миндрей Медикал Рус»

Сюнь Вэй Сюнь Вэй



«22» декабря 2021 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов для количественного определения антител IgG к RBD-домену S-белка коронавируса тяжелого острого респираторного синдрома-2 иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro

Макет русскоязычной маркировки

Набор реагентов для количественного определения антител IgG к штамму SARS-CoV-2 коронавируса иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro

Производитель:

Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.

Здание "Миндрей", Кеджи 12 Роуд Саут, Промышленный парк высоких технологий, Наньшань, 518057 Шэньчжэнь, Китайская Народная Республика

Страна происхождения:

Китай

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «Миндрей Медикал Рус», Россия, 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д.16, стр.5, антресоль 4, помещение I, ком.7, 11А

Тел. +7 (499) 553-60-36

Регистрационное удостоверение №

от

ТОЛЬКО ДЛЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ПРИМЕНЕНИЯ

АНТИТЕЛА К ВИЧ 1, 2; ВИРУСУ ГЕПАТИТА С; HBsAg ОТСУТСТВУЮТ



mindray

SARS-CoV-2 S-RBD IgG (CLIA)

**Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2
S-RBD IgG (CLIA)**

2 × 50 tests (calibrators included)


Contents: Ra: 2 × 3.8 mL; Rb: 2 × 3.5 mL; Rc: 2 × 3.5 mL; Rd: 2 × 5.3 mL
C0: 0.6 mL; C1: 0.5 mL; C2: 0.5 mL




SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, 518057 P.R. China

Tel: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582680 www.mindray.com




Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



mindray

SARS-CoV-2 S-RBD IgG (CLIA)



**Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2
S-RBD IgG (CLIA)**

2 × 50 tests (calibrators included)

REF SARS-CoV-2 S-RBD IgG121



P/N: 105-020773-00

1LJ202105020000309

LOT 2021050200



2021-12-20

047-036588-00 (1.0)

Маркировка, наносимая на внешнюю упаковку МИ, вариант исполнения 1




SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China


Tel: +86 755 81888998 Fax: +86 755 26582680

Website: <http://www.mindray.com>


Маркировка, наносимая на внешнюю упаковку МИ, вариант исполнения 1

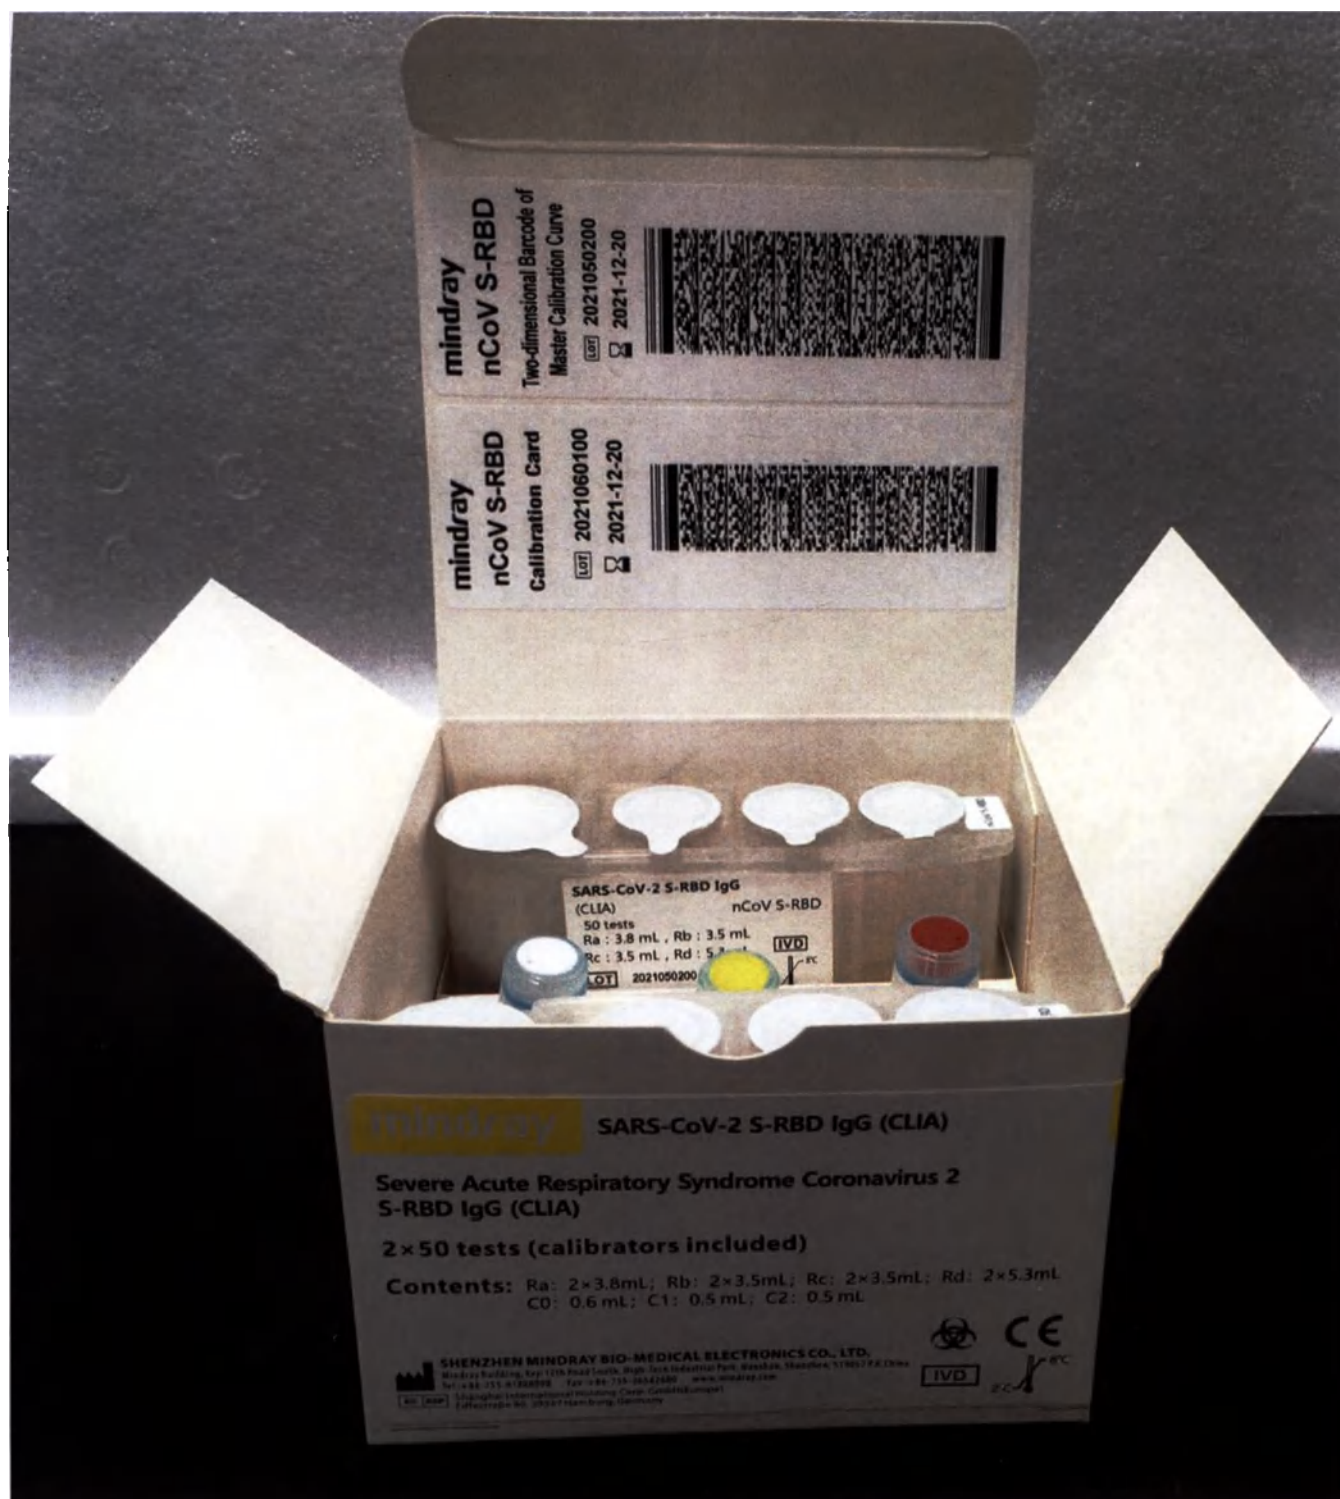


Маркировка, наносимая на внутреннюю упаковку кассеты с реагентами МИ,
вариант исполнения 1

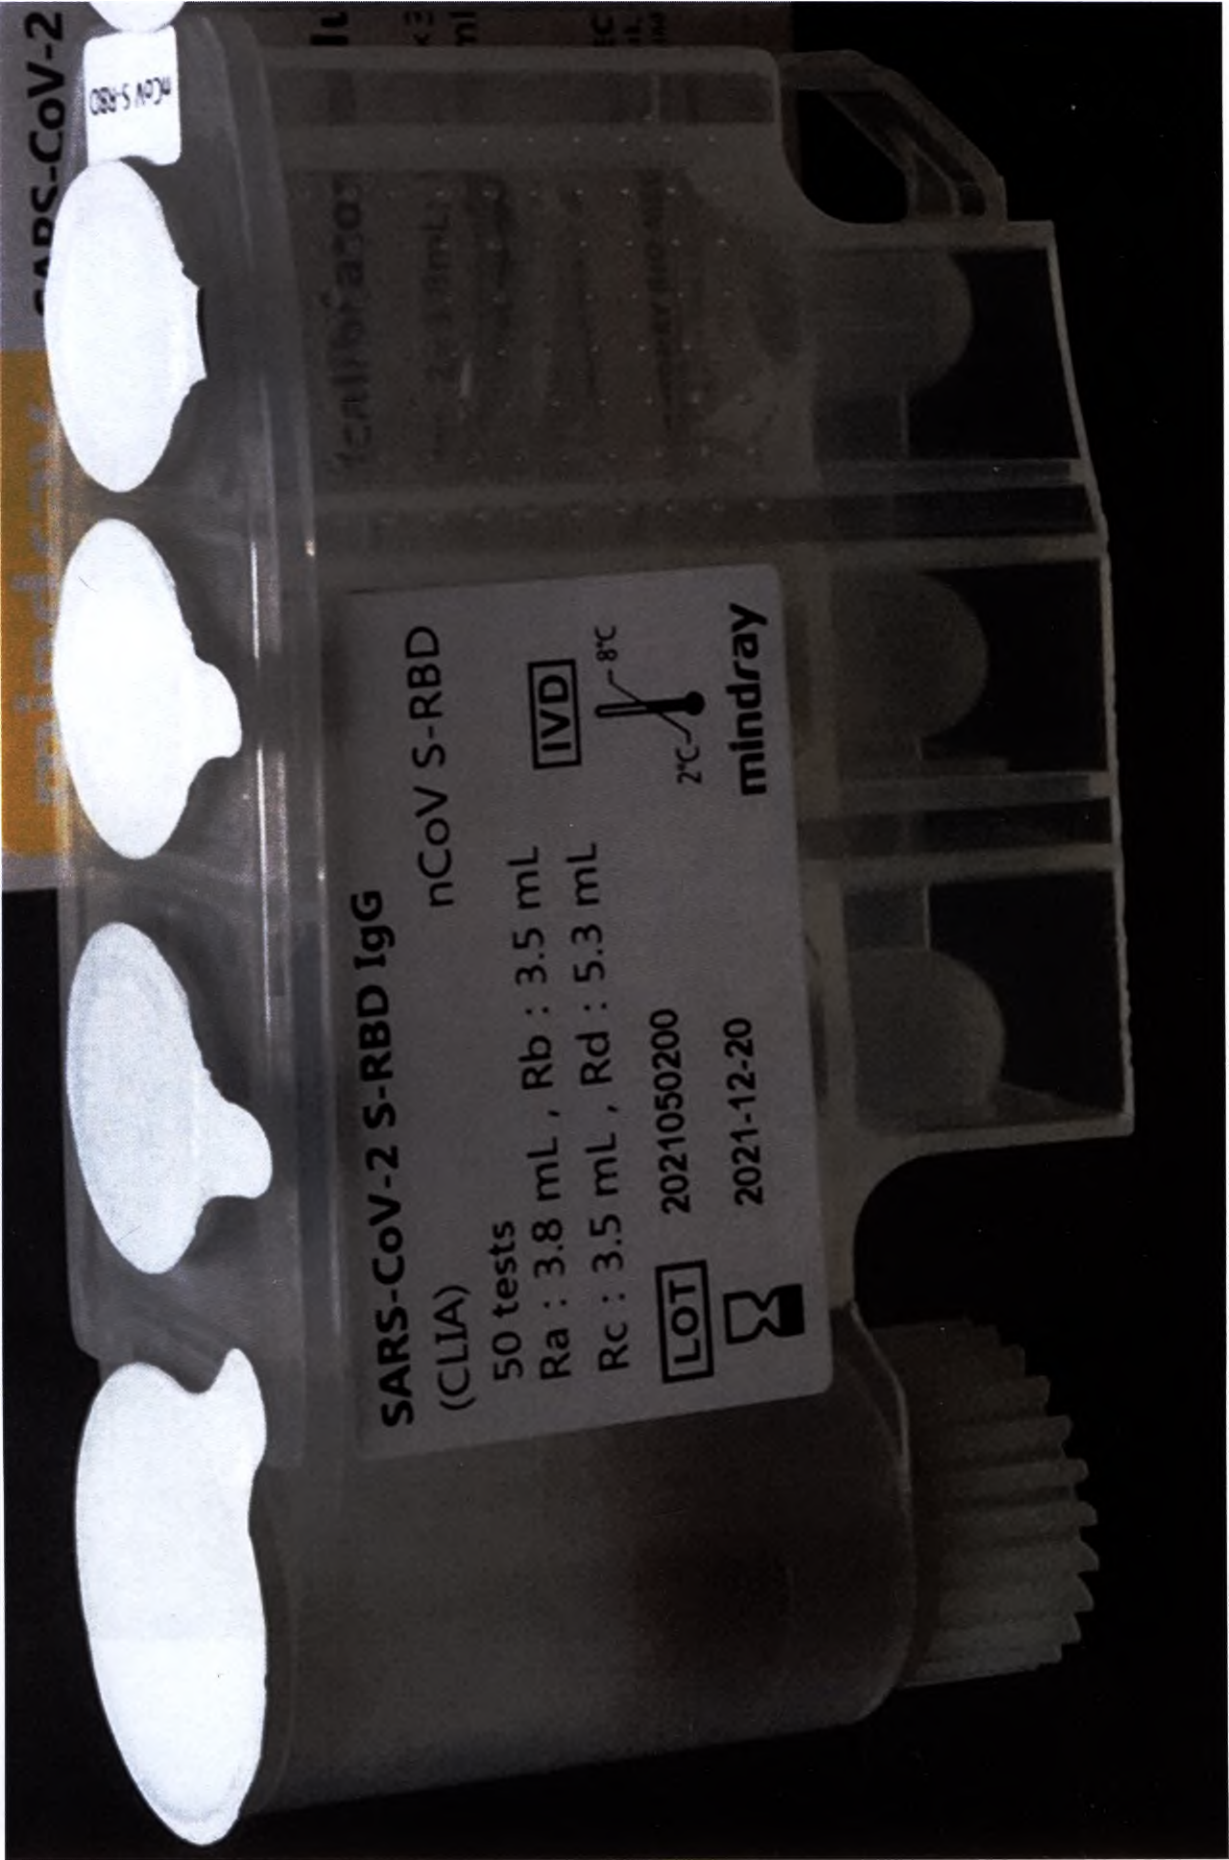


Маркировка, наносимая на внутреннюю упаковку «Калибратор SARS-CoV-2 S-RBD IgG (C0)», вариант исполнения 1

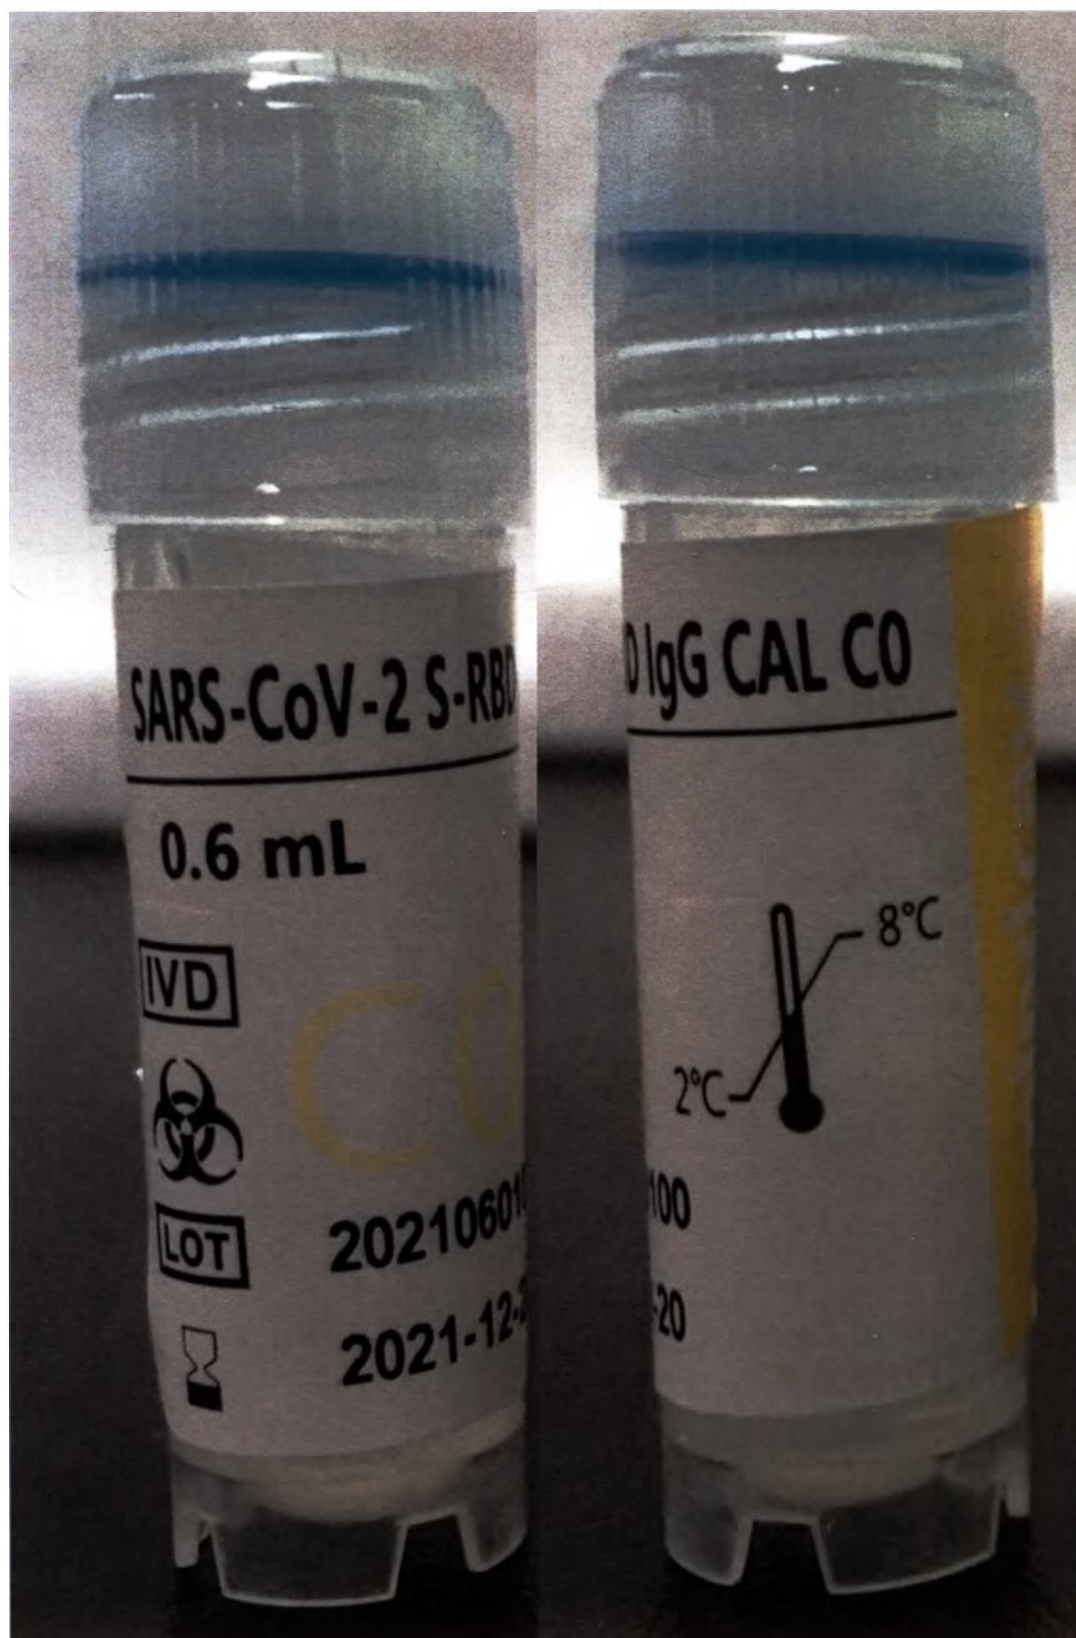

Маркировка, наносимая на внутреннюю упаковку «Калибратор SARS-CoV-2 S-RBD IgG (C1)», вариант исполнения 1

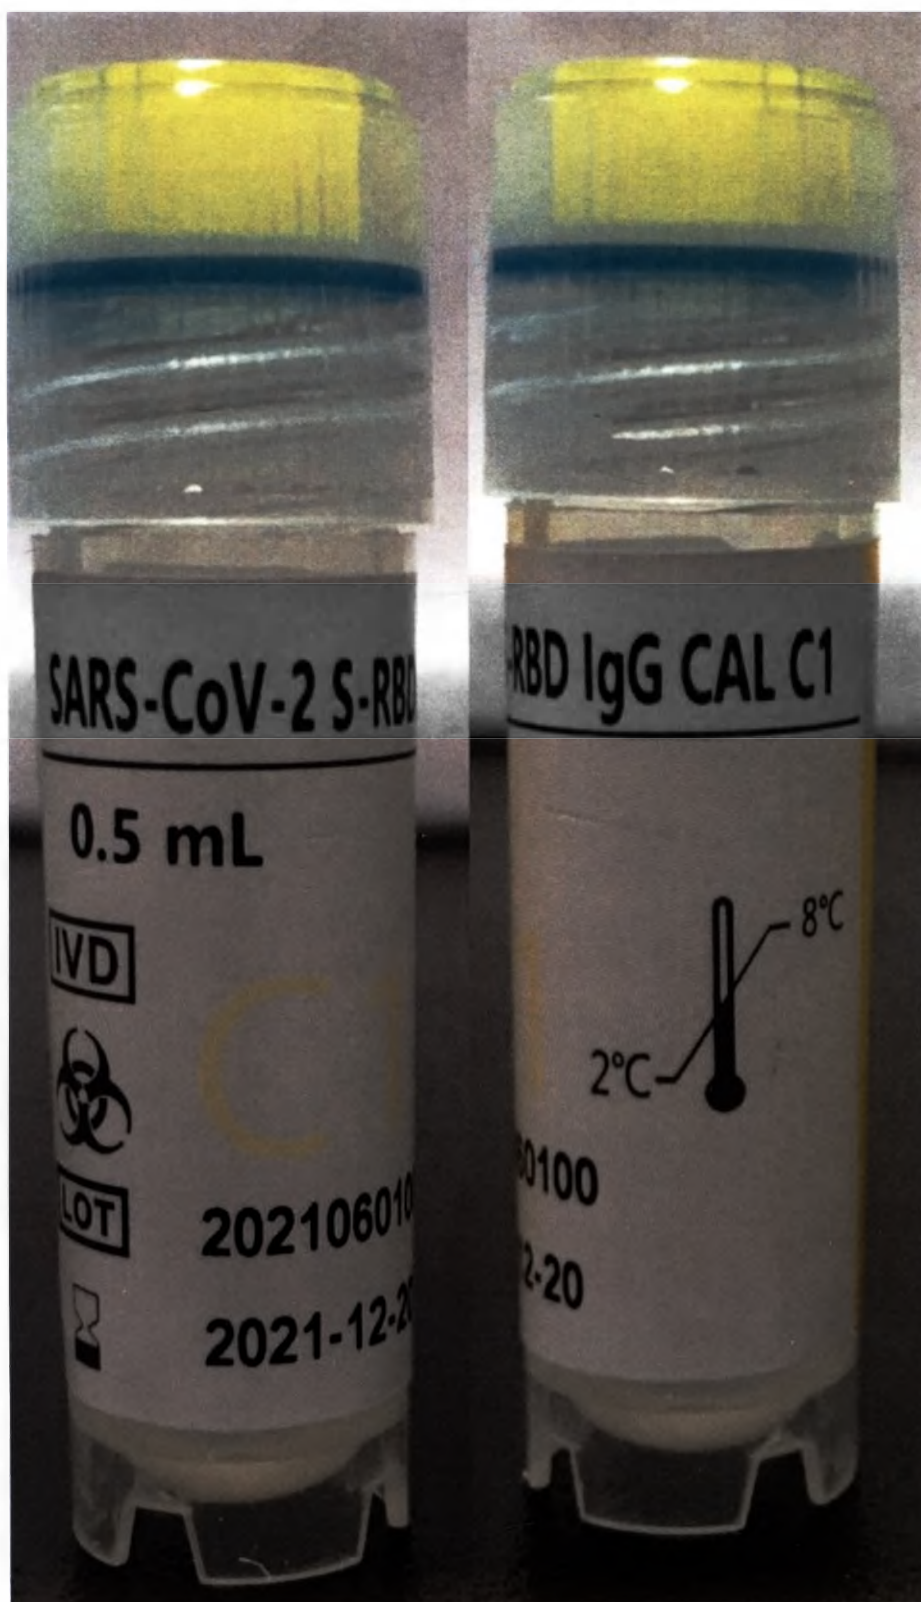

Маркировка, наносимая на внутреннюю упаковку «Калибратор SARS-CoV-2 S-RBD IgG (C2)», вариант исполнения 1

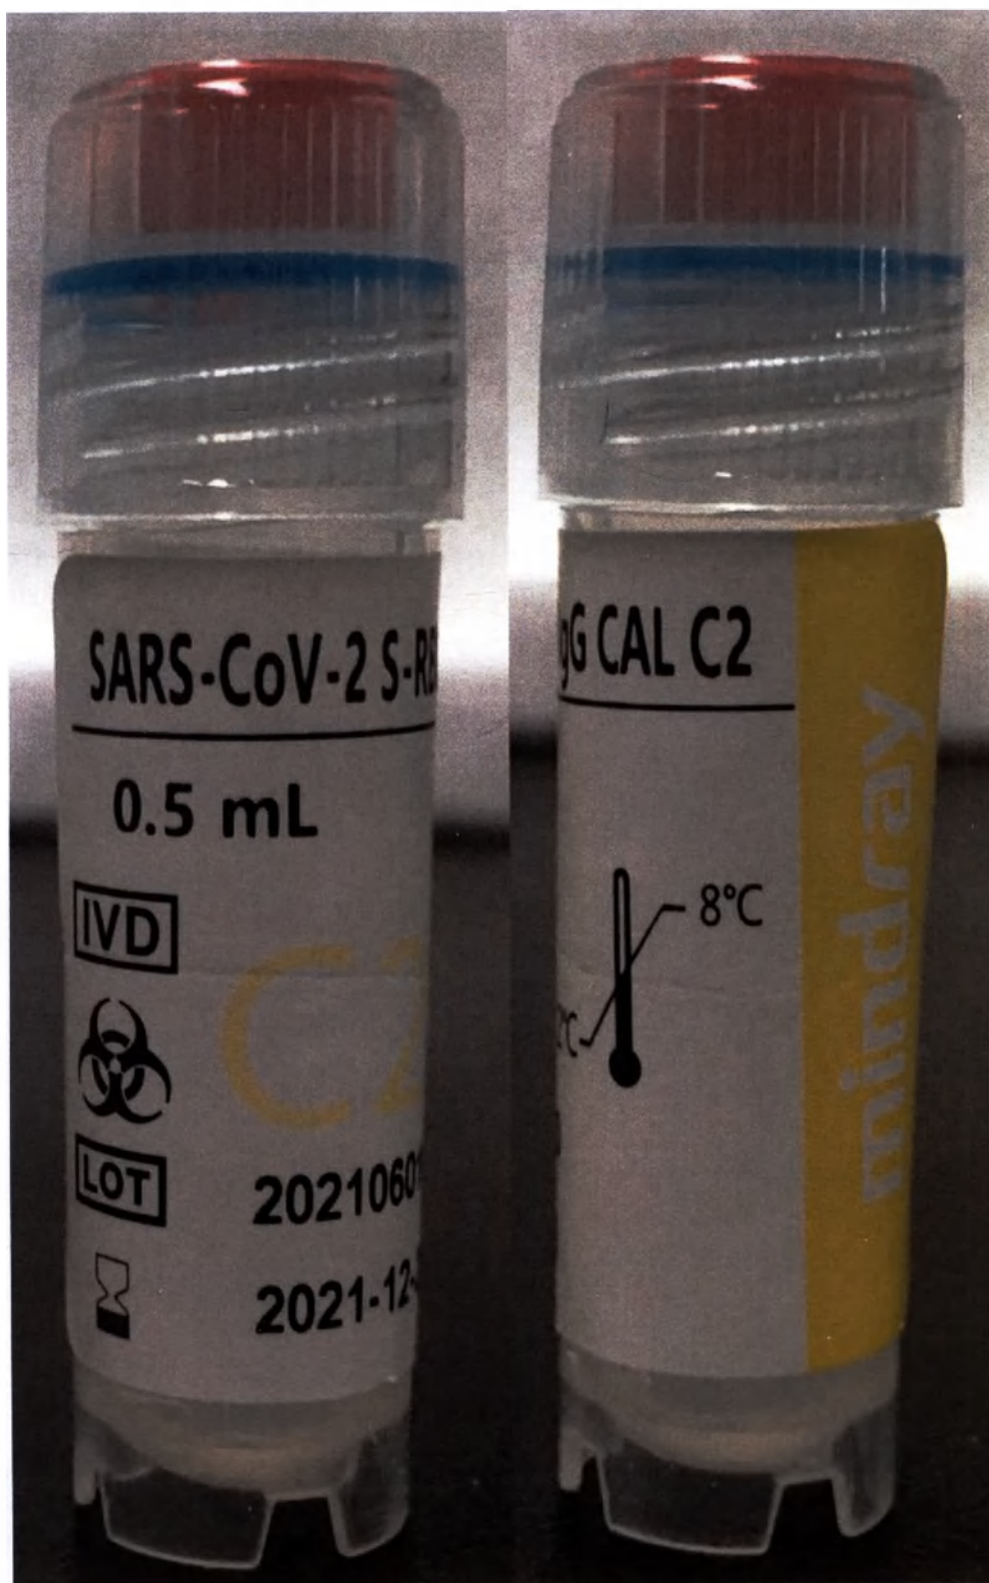

mindray

SARS-CoV-2 S-RBD IgG (CLIA)

**Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2
S-RBD IgG (CLIA)**

2×100 tests (calibrators included)

Contents: Ra: 2×6.6mL; Rb: 2×6.3mL; Rc: 2×6.3mL; Rd: 2×9.8mL
C0: 0.6 mL; C1: 0.5 mL; C2: 0.5 mL





SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, 518057 P.R. China
Tel: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582680 www.mindray.com



Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



mindray

SARS-CoV-2 S-RBD IgG (CLIA)



**Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2
S-RBD IgG (CLIA)**

2×100 tests (calibrators included)

REF SARS-CoV-2 S-RBD IgG122



1LK202105010000096

P/N: 105-020774-00


LOT **2021050100**



2021-11-18


047-036589-00 (1.0)

Маркировка, наносимая на внешнюю упаковку МИ, вариант исполнения 2




SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China
Tel: +86 755 81888998 Fax: +86 755 26582680
Website: <http://www.mindray.com>

Маркировка, наносимая на внешнюю упаковку МИ, вариант исполнения 2

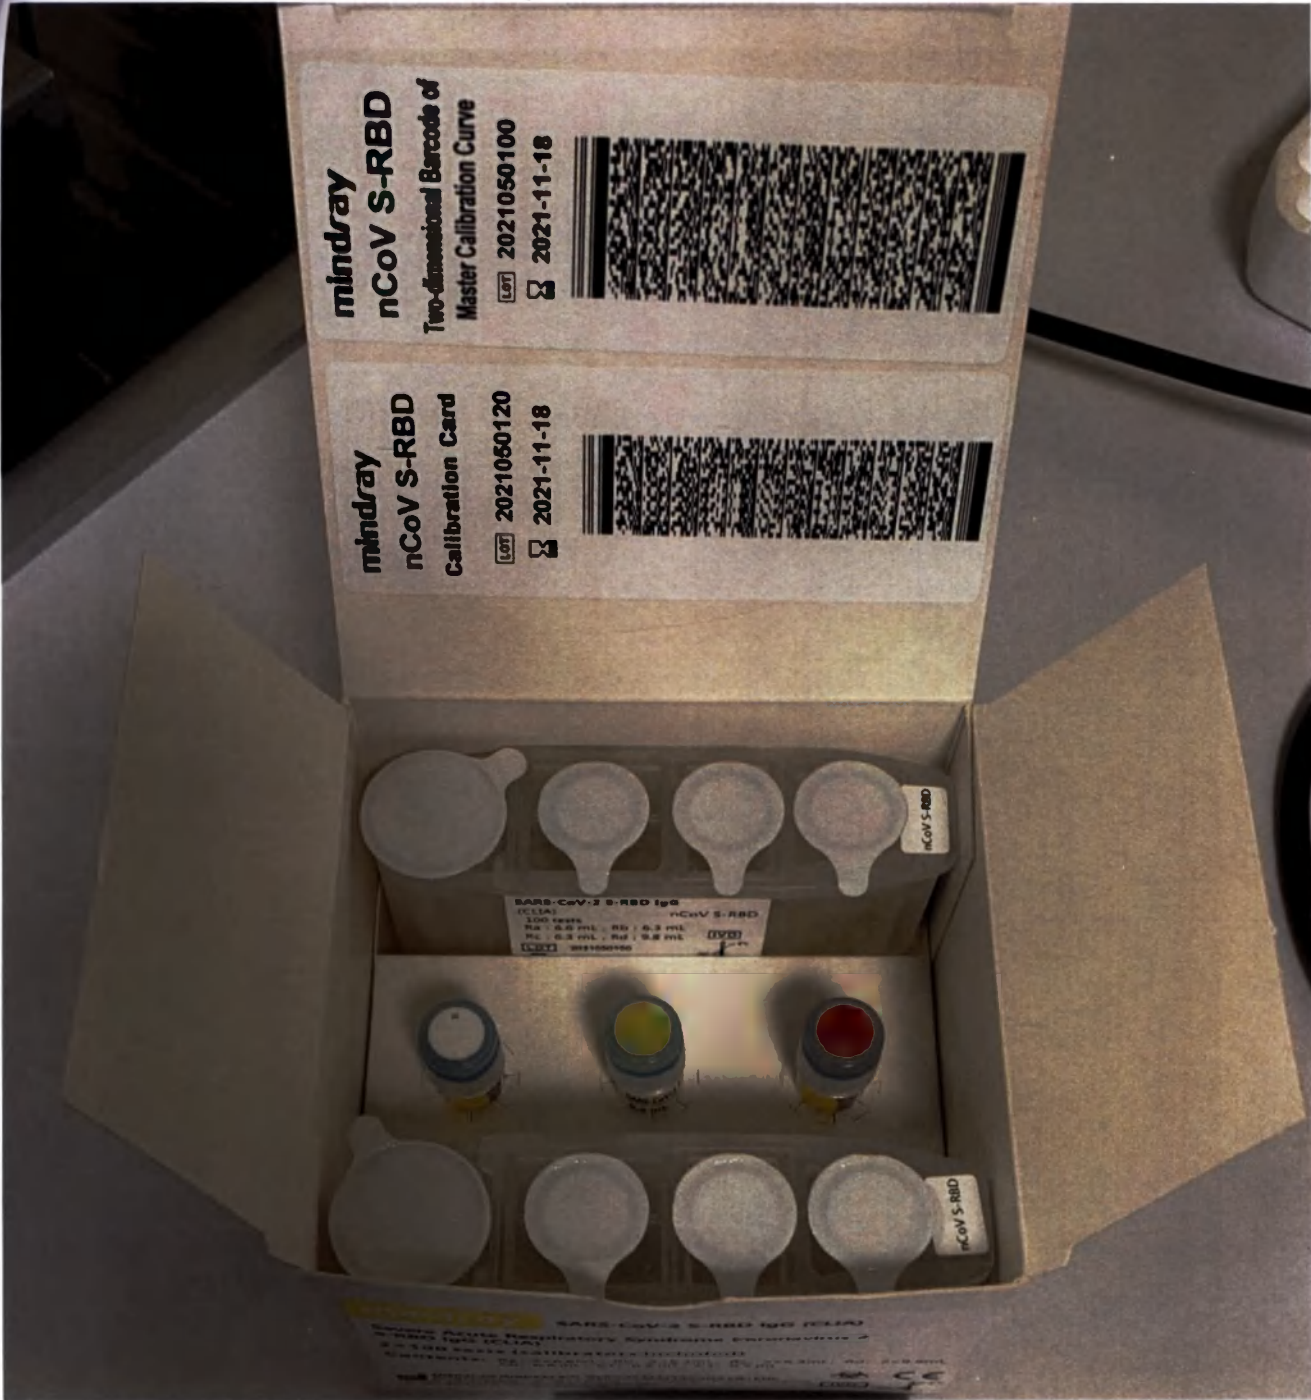

Маркировка, наносимая на внутреннюю упаковку кассеты с реагентами МИ,
вариант исполнения 2

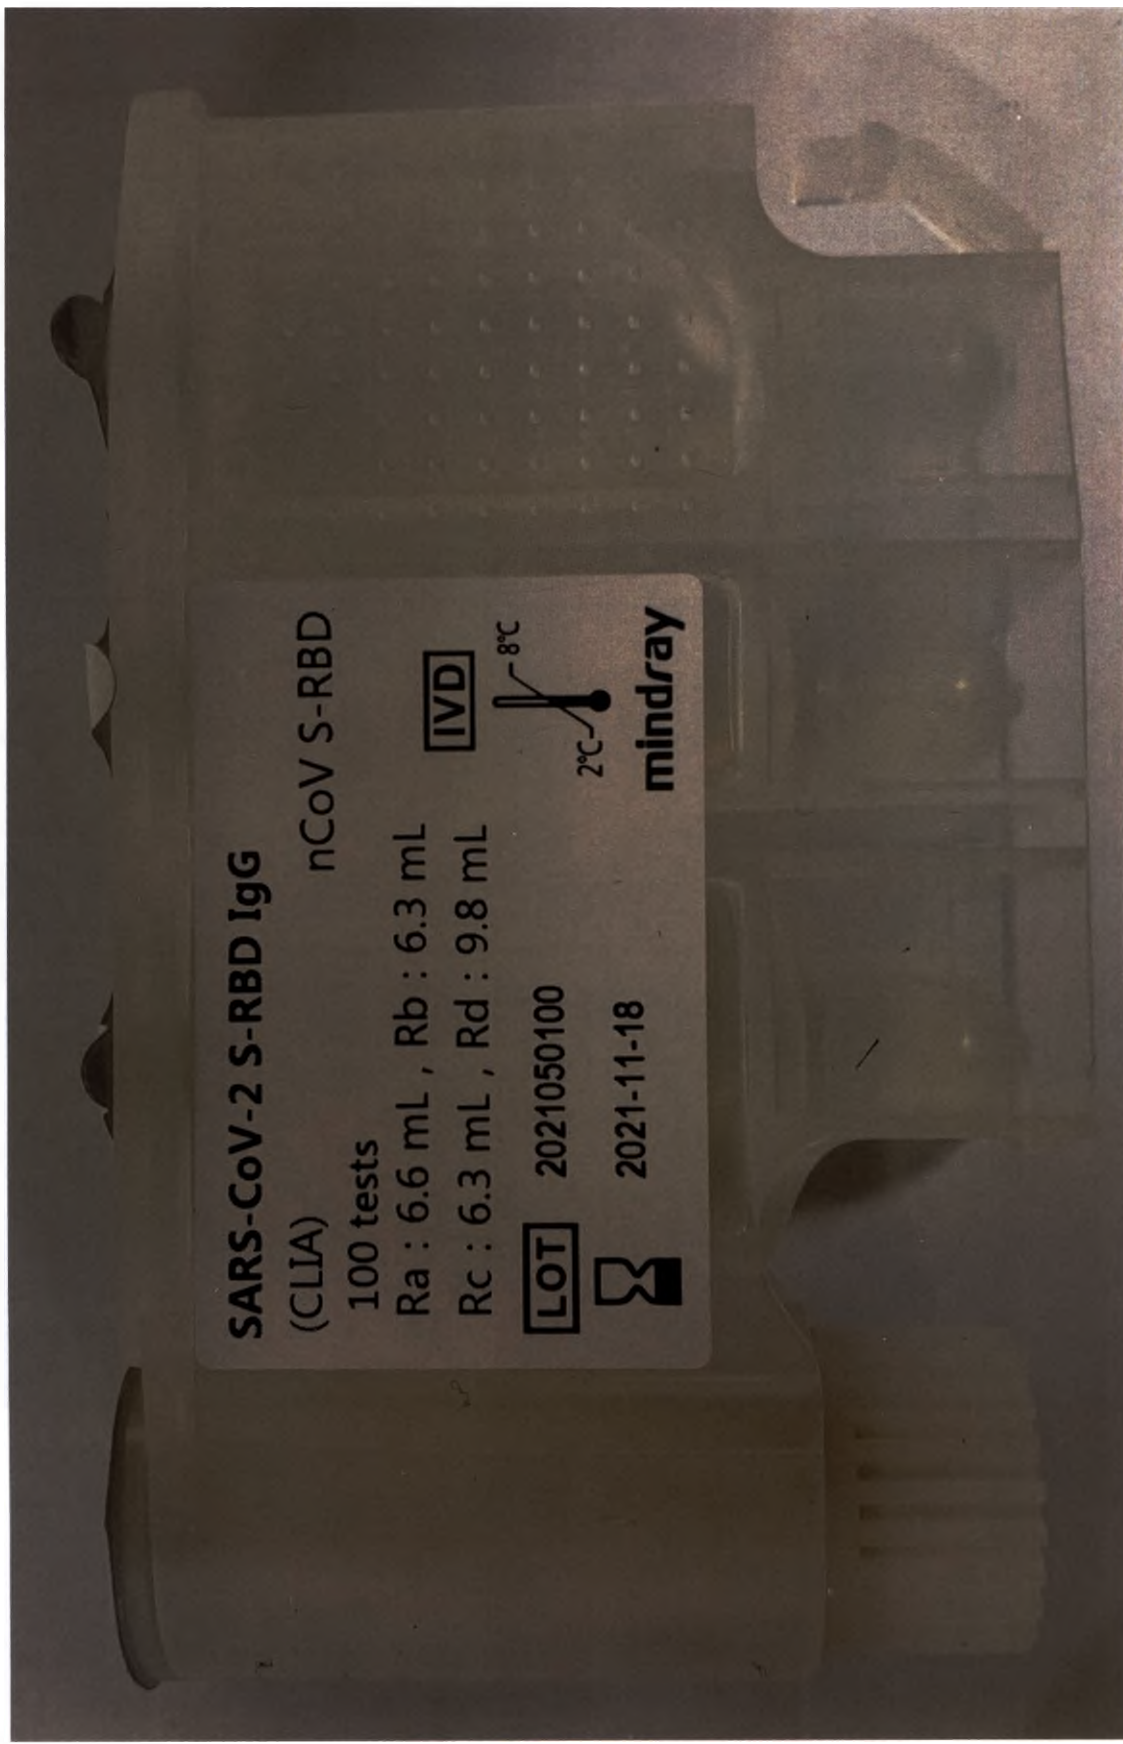

SARS-CoV-2 S-RBD IgG

(CLIA)

100 tests

Ra : 6.6 mL , Rb : 6.3 mL

Rc : 6.3 mL , Rd : 9.8 mL

LOT


2021050100



2021-11-18

nCoV S-RBD

IVD



mindray

маркировка, наносимая на внутреннюю упаковку «Калибратор SARS-CoV-2 S-RBD IgG (C0)», вариант исполнения 2



Маркировка, наносимая на внутреннюю упаковку «Калибратор SARS-CoV-2 S-RBD IgG (C1)», вариант исполнения 2



Маркировка, наносимая на внутреннюю упаковку «Калибратор SARS-CoV-2 S-RBD IgG (C2)», вариант исполнения 2



прошнуро вена
и скреплено
Сосоев итаю
18 листов

