

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Миндрей Медикал Рус»
Сюн Вэй



«23» июня 2022 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Автозагрузчик SPL 2000 (Sample Processing System SPL 2000) для объединения анализаторов автоматических биохимических BS-2000 и анализаторов автоматических иммунохемилюминесцентных CL-6000i

Макет русскоязычной маркировки

«Автозагрузчик SPL 2000 (Sample Processing System SPL 2000) для объединения анализаторов автоматических биохимических BS-2000 и анализаторов автоматических иммунохемилюминесцентных CL-6000i».

Производитель: Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.
Здание "Миндрей", Кеджи 12 Роуд Саут, Промышленный парк
высоких технологий, Наньшань, 518057 Шэньчжэнь, Китайская
Народная Республика

**Страна
происхождения:** Китай




**Уполномоченный
представитель в РФ:** ООО «Миндрей Медикал Рус», Россия, 129090, г. Москва,
Олимпийский проспект, д.16, стр.5, антресоль 4, помещение I, ком.7,
11А

**Регистрационное
удостоверение** № от

Кабель питания




Держатель штативов

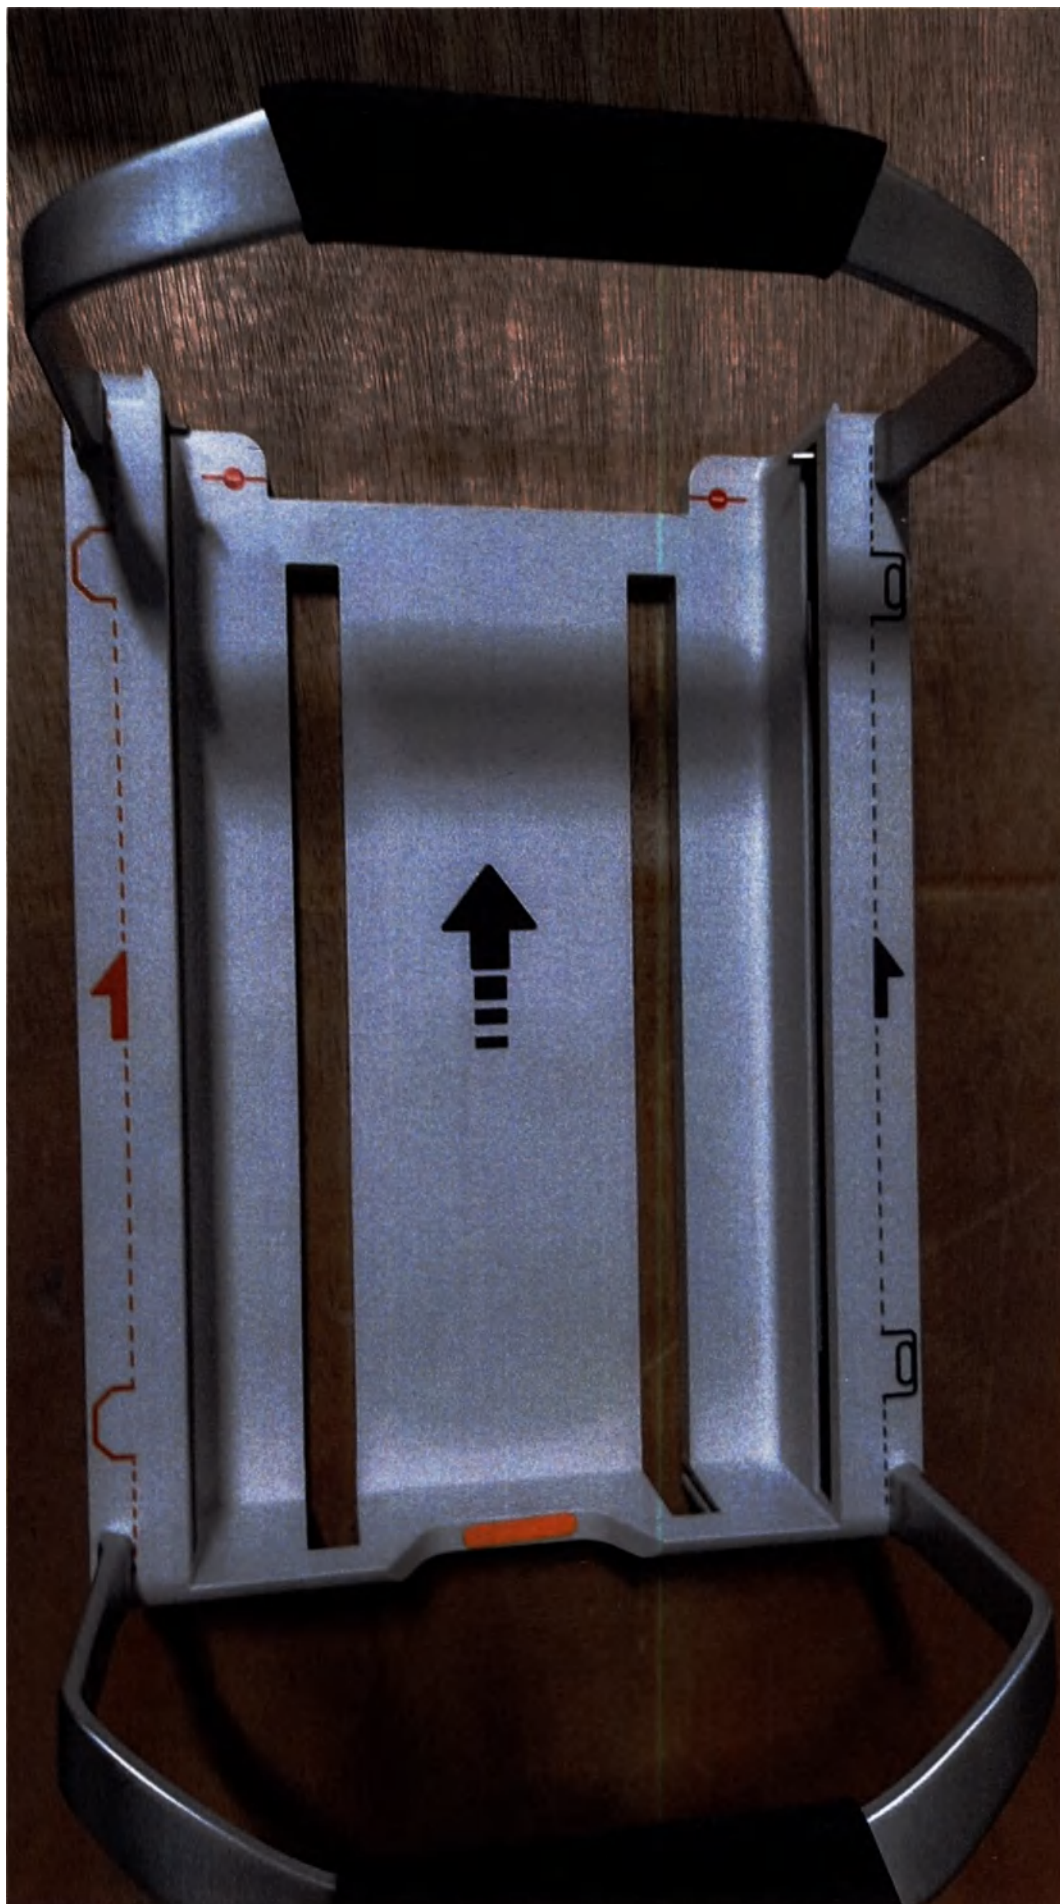

Крышка держателя штативов



Диск с программным обеспечением

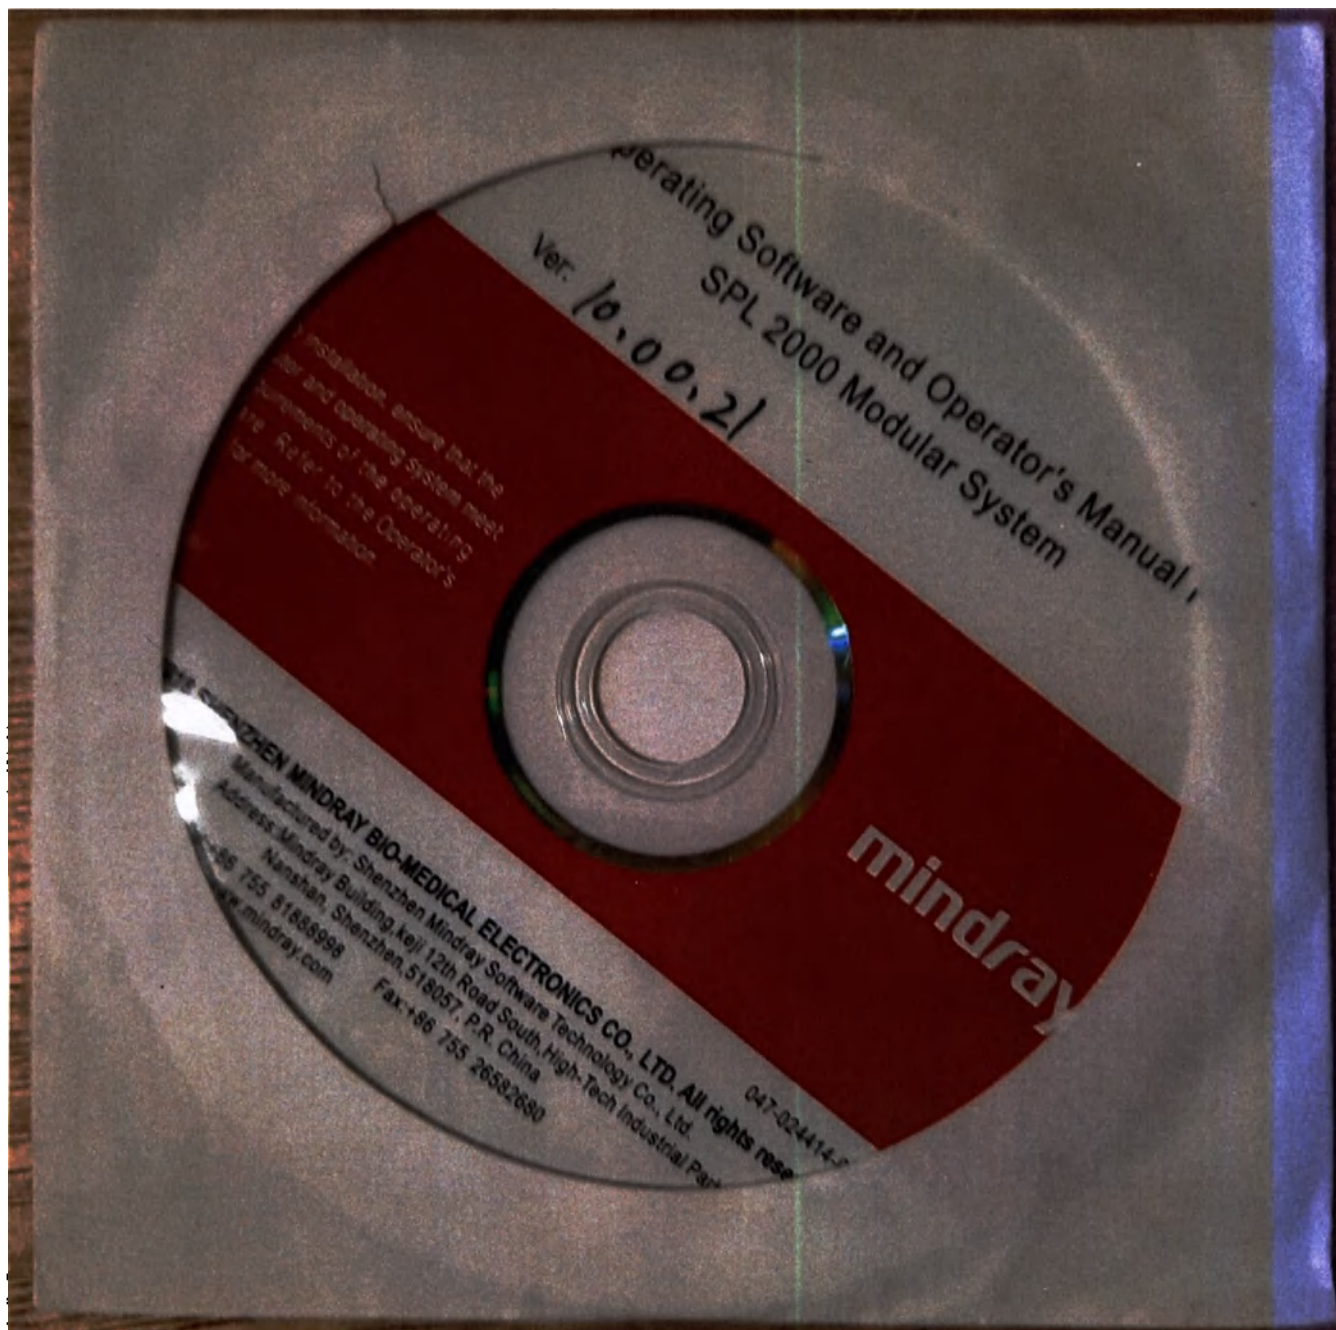

Наклейки для держателя штативов



Автозагрузчик SPL 2000 (Sample Processing System SPL 2000) для объединения анализаторов автоматических биохимических BS-2000 и анализаторов автоматических иммунохемилюминесцентных CL-6000i, вид спереди



Автозагрузчик SPL 2000 (Sample Processing System SPL 2000) для объединения анализаторов автоматических биохимических BS-2000 и анализаторов автоматических иммунохемилюминесцентных CL-6000i.



Автозагрузчик SPL 2000 (Sample Processing System SPL 2000) для объединения анализаторов автоматических биохимических BS-2000 и анализаторов автоматических иммунохемилюминесцентных CL-6000i, вид сбоку



Автозагрузчик SPL 2000 (Sample Processing System SPL 2000) для объединения анализаторов автоматических биохимических BS-2000 и анализаторов автоматических иммунохемилюминесцентных CL-6000i, вид сверху с закрытой верхней крышкой.



Автозагрузчик SPL 2000 (Sample Processing System SPL 2000) для объединения анализаторов автоматических биохимических BS-2000 и анализаторов автоматических иммунохемилюминесцентных CL-6000i, вид сверху со снятой верхней крышкой.



Маркировка МИ «Автозагрузчик SPL 2000 (Sample Processing System SPL 2000) для объединения анализаторов автоматических биохимических BS-2000 и анализаторов автоматических иммунохемилюминесцентных CL-6000i»

EAC

mindray

Sample Processing System

Model: SPL 2000

SN



BF6-17000648T



2021-07-12

220-240V ~ 50Hz 800VA

220/230V ~ 60Hz 800VA

Made In China

IVD



047-023005-00(1 0)



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial

Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)

Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



(01)06903053004237

(11)210712

(21)BF6-17000648T


Маркировка, наносимая на панель управления питанием МИ «Автозагрузчик SPL 2000 (Sample Processing System SPL 2000) для объединения анализаторов автоматических биохимических BS-2000 и анализаторов автоматических иммунохемилюминесцентных CL-6000i». Панель управления питанием МИ, находится на задней стенке изделия.



Маркировка, наносимая на панель подключения МИ «Автозагрузчик SPL 2000 (Sample Processing System SPL 2000) для объединения анализаторов автоматических биохимических BS-2000 и анализаторов автоматических иммунохемилюминесцентных CL-6000i» к рабочей станции (персональный компьютер). Панель подключения МИ к рабочей станции находится на задней стенке Автозагрузчика SPL 2000.




Маркировка, наносимая на корпус Автозагрузчика SPL 2000, над технологическим отверстием, для вывода кабеля питания. Технологическое отверстие, для вывода кабеля питания, находится на задней стенке Автозагрузчика SPL 2000.

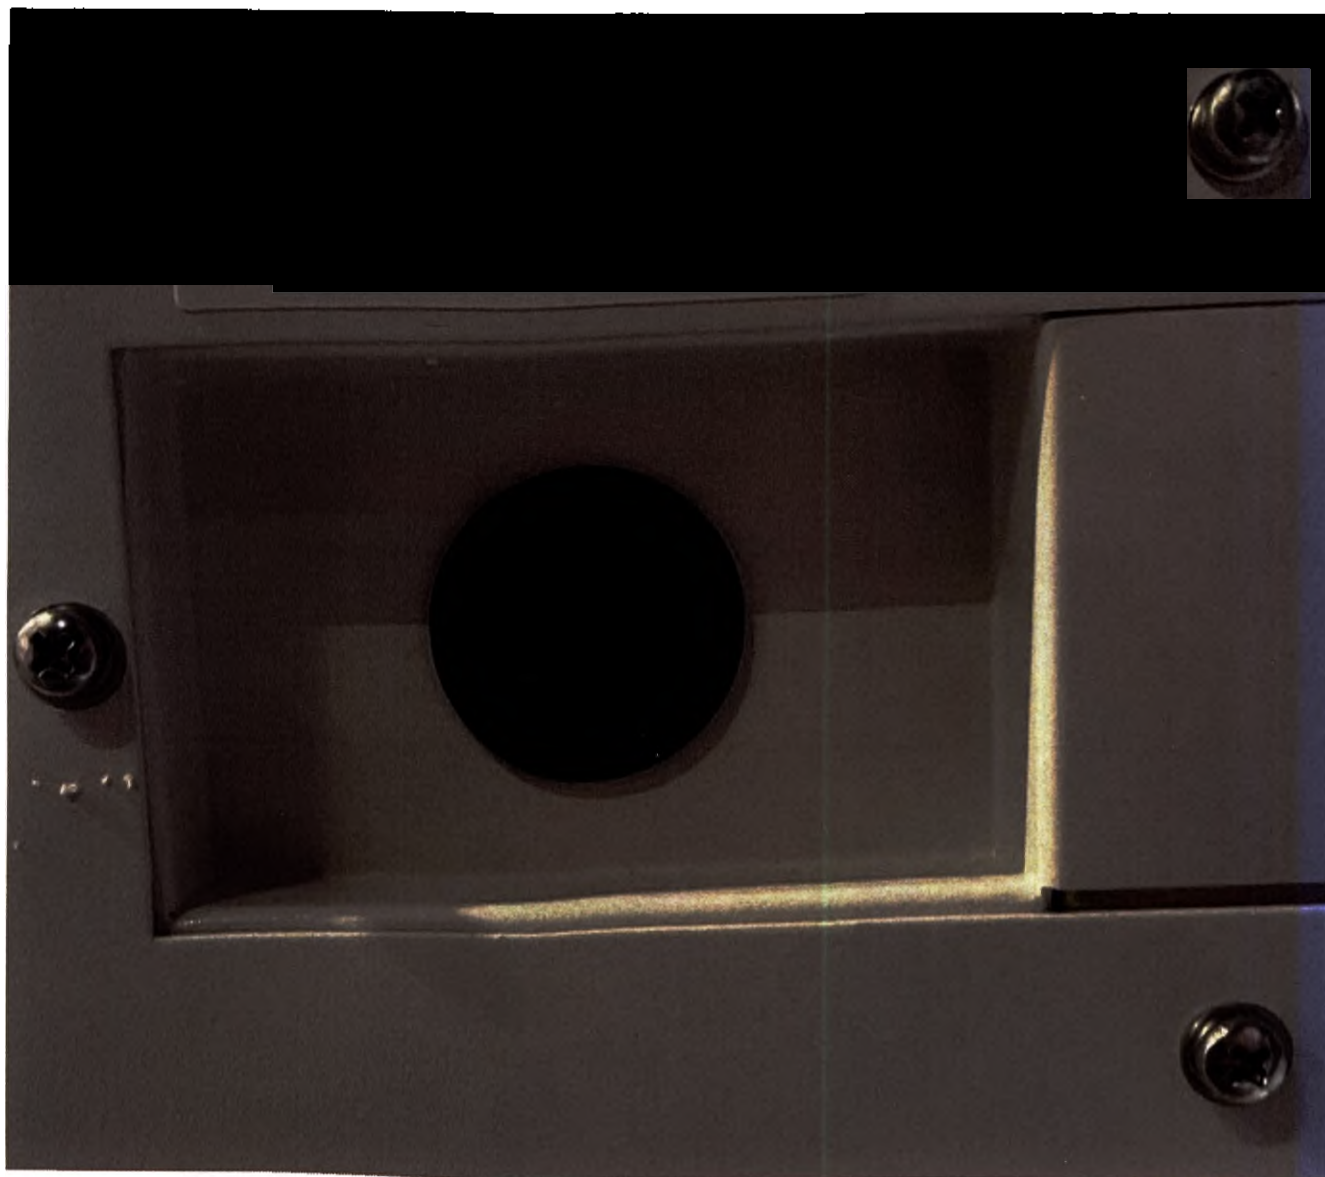

Маркировка символа «Электрическое заземление», наносимая на внутреннюю часть корпуса Автозагрузчика SPL 2000, находящаяся, за технологическим отверстием для вывода кабеля питания.



Маркировка и общий вид верхней крышки.

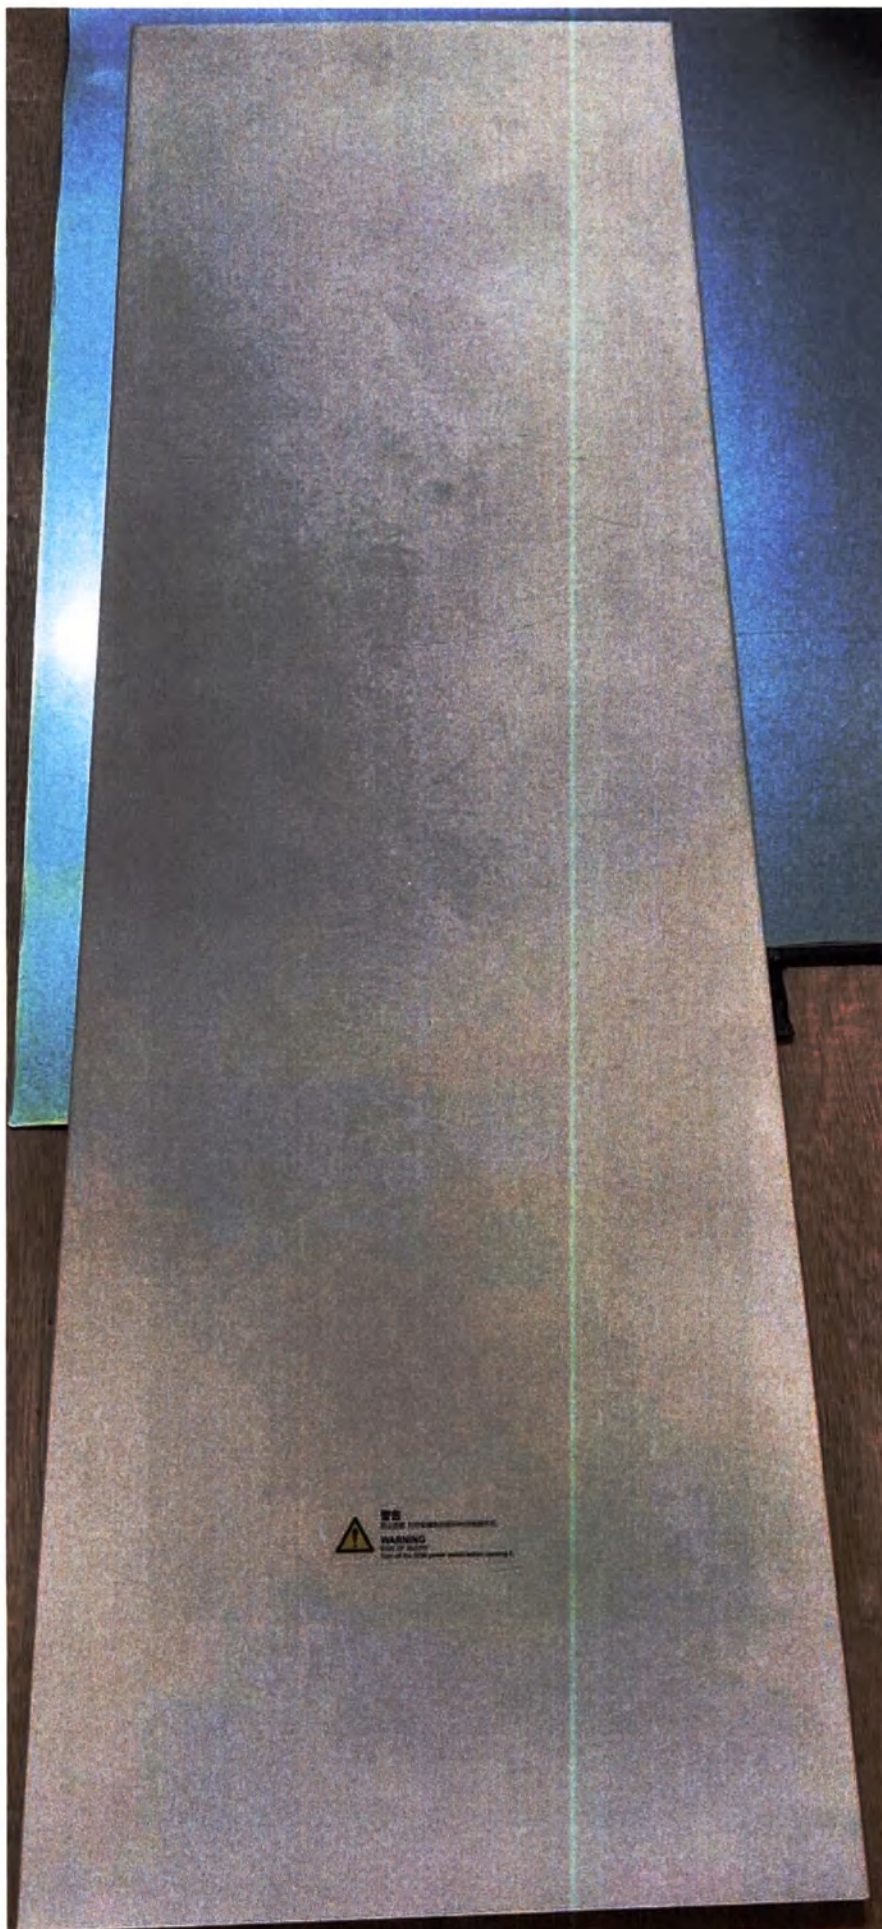



警告

防止伤害 打开前请先关闭SDM主电源开关.

WARNING

RISK OF INJURY

Turn off the SDM power switch before opening it .


Маркировка, наносимая, на корпус Автозагрузчика SPL 2000, под верхней крышкой Автозагрузчика SPL 2000.



Маркировка, наносимая на каретку для штативов. Каретка для штативов находится, под верхней крышкой и не доступна пользователю в ходе эксплуатации МИ.



Маркировка, наносимая на панель управления МИ Автозагрузчик SPL 2000.

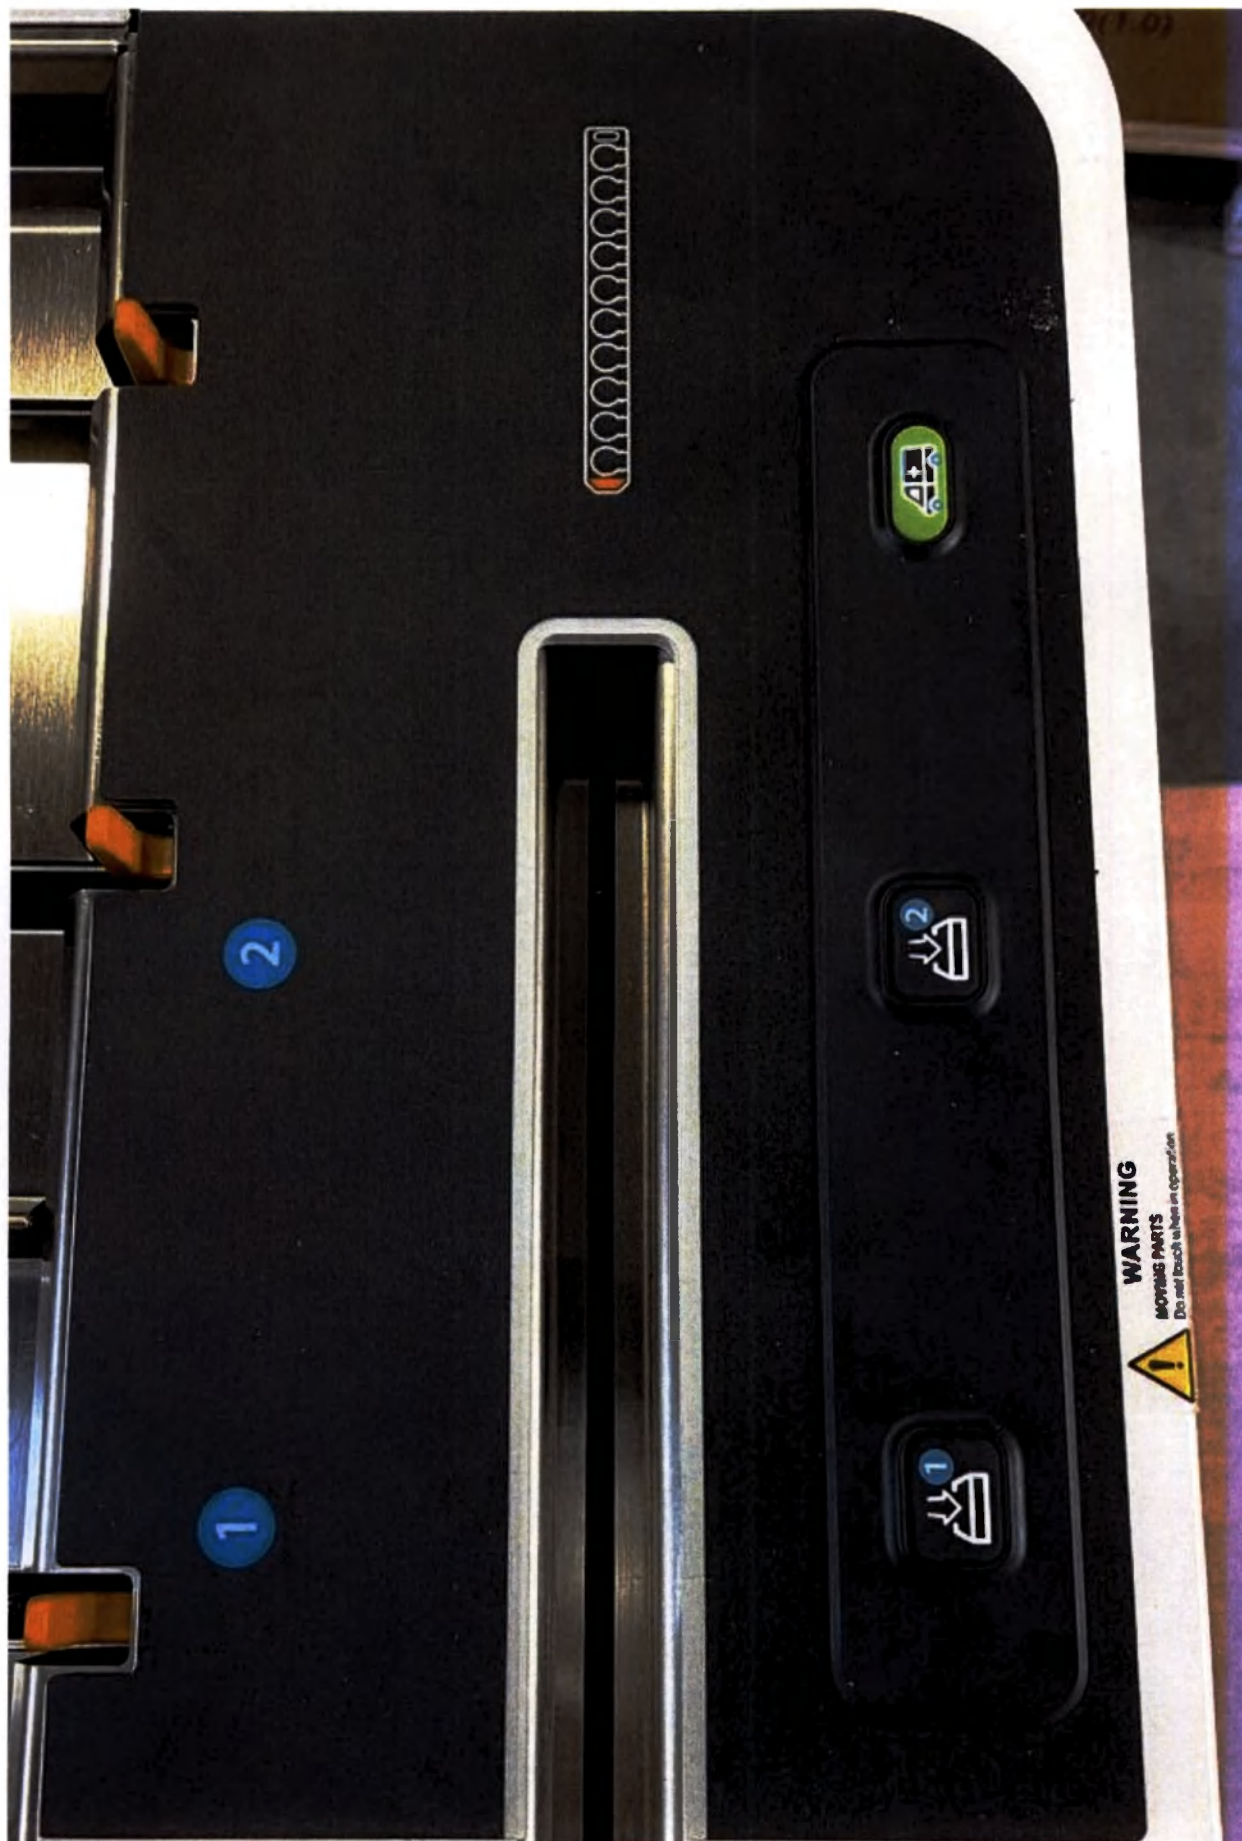

Маркировка, наносимая на защитный кожух транспортной ленты, перед зоной хранения штативов МИ «Автозагрузчик SPL 2000».



Маркировка, наносимая на считыватель штрих кодов МИ Автозагрузчик SPL 2000.



Маркировка, наносимая на блок питания МИ Автозагрузчик SPL 2000. Данная маркировка находится, под защитным кожухом (корпус Автозагрузчика SPL 2000), во внутреннем пространстве МИ



