

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН»



Фомина Н.В.

2021 г.

Фотографические изображения медицинского изделия:

Набор реагентов «ЭТА Гемоглобин» для качественного обнаружения гемоглобина (скрытая кровь) в кале человека методом иммунохроматографии по ТУ 21.20.23-004-18023326-2020




Набор реагентов «ЭТА Гемоглобин (Скрытая кровь 50)» для качественного обнаружения гемоглобина (скрытая кровь) в кале человека методом иммунохроматографии по ТУ 21.20.23-004-18023326-2020 в составе: Экспресс-тест «ЭТА Гемоглобин (Скрытая кровь 50)» для качественного обнаружения гемоглобина (скрытая кровь) в кале человека методом иммунохроматографии - 5 шт., Флакон-пробирка с буфером - 5 шт., Этикетка на клеевой основе – 5 шт.



Набор реагентов «ЭТА Гемоглобин (Скрытая кровь 50)» для качественного обнаружения гемоглобина (скрытая кровь) в кале человека методом иммунохроматографии по ТУ 21.20.23-004-18023326-2020 в составе: Экспресс-тест «ЭТА Гемоглобин (Скрытая кровь 50)» для качественного обнаружения гемоглобина (скрытая кровь) в кале человека методом иммунохроматографии - 10 шт., Флакон-пробирка с буфером - 10 шт., Этикетка на клеевой основе – 10 шт.



Набор реагентов «ЭТА Гемоглобин (Скрытая кровь 50)» для качественного обнаружения гемоглобина (скрытая кровь) в кале человека методом иммунохроматографии по ТУ 21.20.23-004-18023326-2020 в составе: Экспресс-тест «ЭТА Гемоглобин (Скрытая кровь 50)» для качественного обнаружения гемоглобина (скрытая кровь) в кале человека методом иммунохроматографии - 1 шт., Флакон-пробирка с буфером - 1 шт., Этикетка на клеевой основе – 1 шт.;

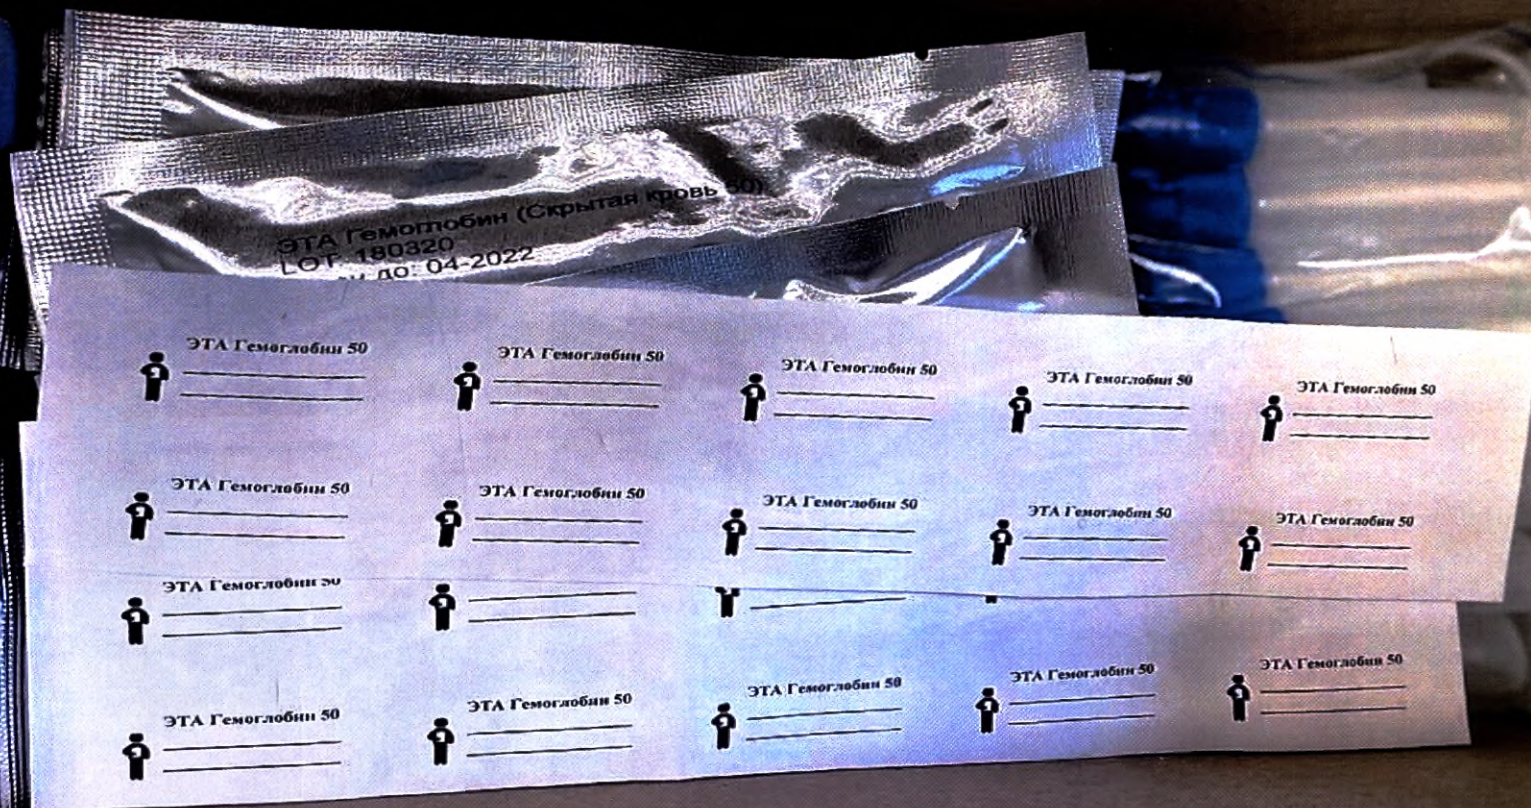

Набор реагентов «ЭТА Гемоглобин (Скрытая кровь 50)» для качественного обнаружения гемоглобина (скрытая кровь) в кале человека методом иммунохроматографии по ТУ 21.20.23-004-18023326-2020 в составе: Экспресс-тест «ЭТА Гемоглобин (Скрытая кровь 50)» для качественного обнаружения гемоглобина (скрытая кровь) в кале человека методом иммунохроматографии - 25 шт., Флакон-пробирка с буфером - 25 шт., Этикетка на клеевой основе – 25 шт.;



Набор реагентов «ЭТА Гемоглобин (Скрытая кровь 50)» для качественного обнаружения гемоглобина (скрытая кровь) в кале человека методом иммунохроматографии по ТУ 21.20.23-004-18023326-2020 в составе: Экспресс-тест «ЭТА Гемоглобин (Скрытая кровь 50)» для качественного обнаружения гемоглобина (скрытая кровь) в кале человека методом иммунохроматографии - 15 шт., Флакон-пробирка с буфером - 15 шт., Этикетка на клеевой основе – 15 шт.; (без упаковки)



Набор реагентов «ЭТА Гемоглобин (Скрытая кровь 50)» для качественного обнаружения гемоглобина (скрытая кровь) в кале человека методом иммунохроматографии по ТУ 21.20.23-004-18023326-2020 в составе: Экспресс-тест «ЭТА Гемоглобин (Скрытая кровь 50)» для качественного обнаружения гемоглобина (скрытая кровь) в кале человека методом иммунохроматографии - 15 шт., Флакон-пробирка с буфером - 15 шт., Этикетка на клеевой основе – 15 шт.; (без упаковки)



Набор реагентов «ЭТА Гемоглобин (Скрытая кровь 50+200)» для качественного обнаружения гемоглобина (скрытая кровь) в кале человека методом иммунохроматографии по ТУ 21.20.23-004-18023326-2020 в составе: Экспресс-тест «ЭТА Гемоглобин (Скрытая кровь 50+200)» для качественного обнаружения гемоглобина (скрытая кровь) в кале человека методом иммунохроматографии - 1 шт., Флакон-пробирка с буфером - 1 шт., Этикетка на клеевой основе – 1 шт.



Набор реагентов «ЭТА Гемоглобин (Скрытая кровь 50+200)» для качественного обнаружения гемоглобина (скрытая кровь) в кале человека методом иммунохроматографии по ТУ 21.20.23-004-18023326-2020 в составе: Экспресс-тест «ЭТА Гемоглобин (Скрытая кровь 50+200)» для качественного обнаружения гемоглобина (скрытая кровь) в кале человека методом иммунохроматографии - 5 шт., Флакон-пробирка с буфером - 5 шт., Этикетка на клеевой основе – 5 шт.




Набор реагентов «ЭТА Гемоглобин (Скрытая кровь 50+200)» для качественного обнаружения гемоглобина (скрытая кровь) в кале человека методом иммунохроматографии по ТУ 21.20.23-004-18023326-2020 в составе: Экспресс-тест «ЭТА Гемоглобин (Скрытая кровь 50+200)» для качественного обнаружения гемоглобина (скрытая кровь) в кале человека методом иммунохроматографии - 25 шт., Флакон-пробирка с буфером - 25 шт., Этикетка на клеевой основе – 25 шт.



Набор реагентов «ЭТА Гемоглобин (Скрытая кровь 50+200)» для качественного обнаружения гемоглобина (скрытая кровь) в кале человека методом иммунохроматографии по ТУ 21.20.23-004-18023326-2020 в составе: Экспресс-тест «ЭТА Гемоглобин (Скрытая кровь 50+200)» для качественного обнаружения гемоглобина (скрытая кровь) в кале человека методом иммунохроматографии - 20 шт., Флакон-пробирка с буфером - 20 шт., Этикетка на клеевой основе – 20 шт.



Набор реагентов «ЭТА Гемоглобин (Скрытая кровь 50+200)» для качественного обнаружения гемоглобина (скрытая кровь) в кале человека методом иммунохроматографии по ТУ 21.20.23-004-18023326-2020 в составе: Экспресс-тест «ЭТА Гемоглобин (Скрытая кровь 50+200)» для качественного обнаружения гемоглобина (скрытая кровь) в кале человека методом иммунохроматографии - 15 шт., Флакон-пробирка с буфером - 15 шт., Этикетка на клеевой основе - 15 шт.

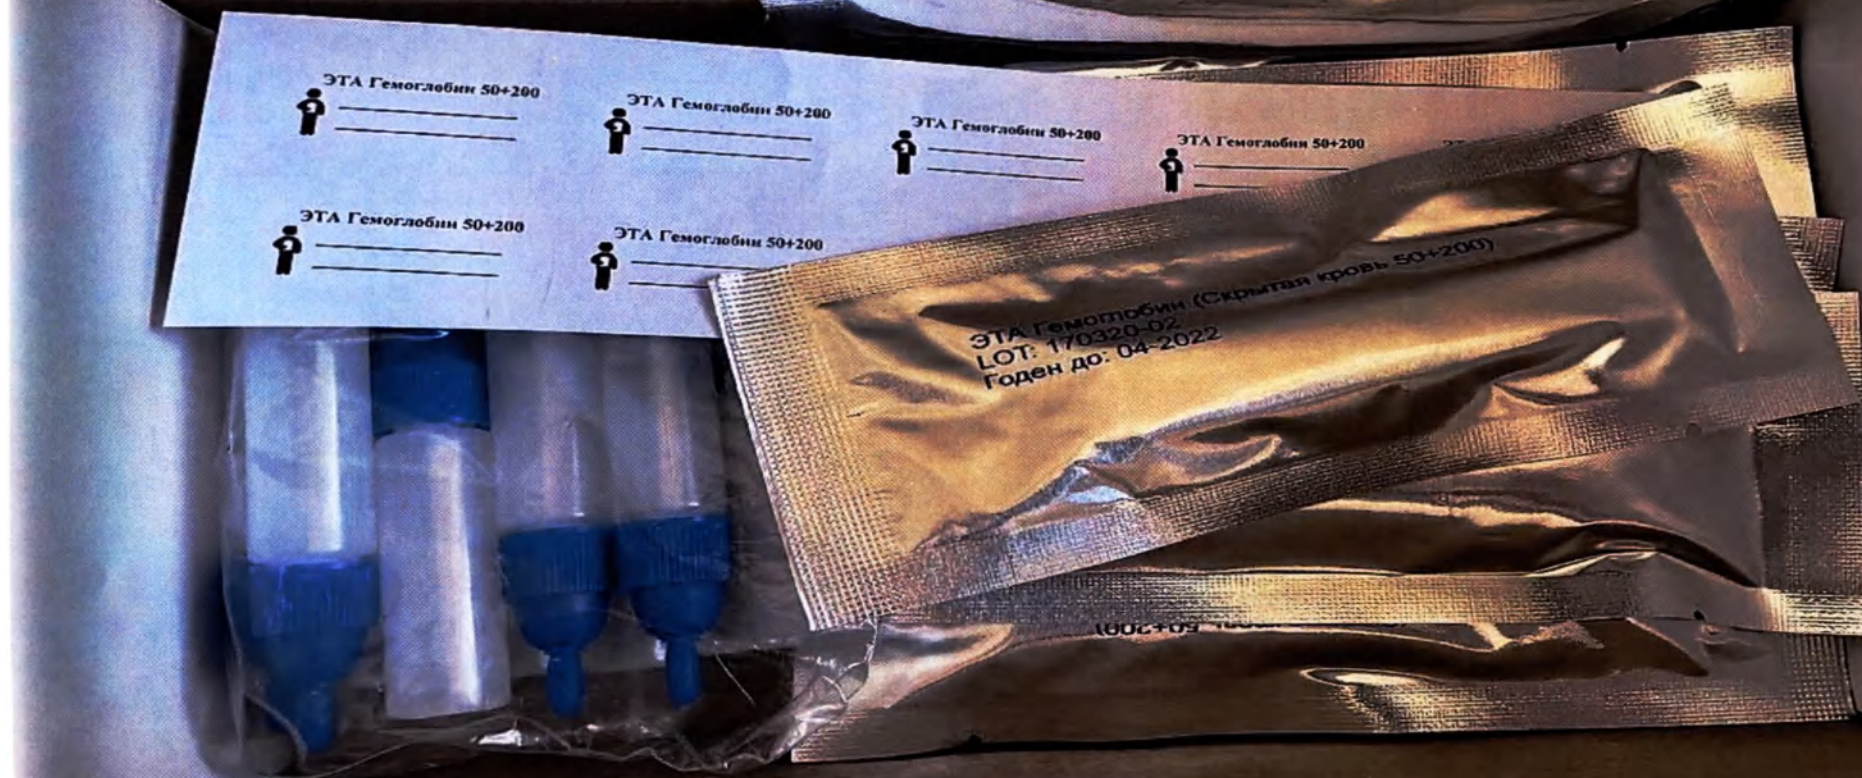

Набор реагентов «ЭТА Гемоглобин (Скрытая кровь 50+200)» для качественного обнаружения гемоглобина (скрытая кровь) в кале человека методом иммунохроматографии по ТУ 21.20.23-004-18023326-2020 в составе: Экспресс-тест «ЭТА Гемоглобин (Скрытая кровь 50+200)» для качественного обнаружения гемоглобина (скрытая кровь) в кале человека методом иммунохроматографии - 10 шт., Флакон-пробирка с буфером - 10 шт., Этикетка на клеевой основе – 10 шт.

Набор реагентов предназначен для проведения диагностики *in vitro* качественного определения белка гемоглобина концентрацией 50 нг/мл (скрытая кровь 50) и 50+200 нг/мл (скрытая кровь 50+200) в кале человека.

Комплект поставки

1. Экспресс-тест «ЭТА Гемоглобин (Скрытая кровь 50+200)» для качественного обнаружения гемоглобина (скрытая кровь) в кале человека методом иммунохроматографии – 25 шт.;
2. Флакон-пробирка с буфером – 25 шт.;
3. Этикетка на клеевой основе – 25 шт.;
4. Инструкция по применению – 1 шт.

Набор реагентов «ЭТА Гемоглобин» для качественного обнаружения гемоглобина (скрытая кровь) в кале человека методом иммунохроматографии по ТУ 21.20.23-004-18023326-2020, вариант исполнения: Набор реагентов «ЭТА Гемоглобин (Скрытая кровь 50+200)» для качественного обнаружения гемоглобина (скрытая кровь) в кале человека методом иммунохроматографии по ТУ 21.20.23-004-18023326-2020

ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН», Россия, 141983, МО,
г. Дубна, ул. Программистов, д.4, стр.2, оф.317
Тел. +7(495)204-4104; e-mail: dubna@bioworld.ru

03-2020

LOT 180320

04-2022

IVD



«Для профессионального применения»
«Только для диагностики *in vitro*»

Регистрационное удостоверение №

Маркировка упаковки медицинского изделия для вариантов исполнения 2.

Набор реагентов предназначен для проведения диагностики *in vitro* качественного определения белка гемоглобина концентрацией 50 нг/мл (скрытая кровь 50) и 50+200 нг/мл (скрытая кровь 50+200) в кале человека.

Комплект поставки

1. Экспресс-тест «ЭТА Гемоглобин (Скрытая кровь 50)» для качественного обнаружения гемоглобина (скрытая кровь) в кале человека методом иммунохроматографии – 25 шт.;
2. Флакон-пробирка с буфером – 25 шт.;
3. Этикетка на клеевой основе – 25 шт.;
4. Инструкция по применению – 1 шт.

Набор реагентов «ЭТА Гемоглобин» для качественного обнаружения гемоглобина (скрытая кровь) в кале человека методом иммунохроматографии по ТУ 21.20.23-004-18023326-2020, вариант исполнения: Набор реагентов «ЭТА Гемоглобин (Скрытая кровь 50)» для качественного обнаружения гемоглобина (скрытая кровь) в кале человека методом иммунохроматографии по ТУ 21.20.23-004-18023326-2020

ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН», Россия, 141983, МО,
г. Дубна, ул. Программистов, д.4, стр.2, оф.317
Тел. +7(495)204-4104; e-mail: dubna@bioworld.ru



03-2020




180320



04-2022



"Для профессионального применения"
"Только для диагностики *in vitro*"



Регистрационное удостоверение №

Маркировка упаковки медицинского изделия для вариантов исполнения 1.

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 15 листа(ов).

Генеральный директор
ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН»
_____ Фомина Н.В.

