

УТВЕРЖДАЮ

**Генеральный директор
ООО «Уайт Продакт»**


Немцов В.Б.
«10» декабря 2021



М.П.
«Уайт Продакт»
ИНН 9724004623
МОСКВА

**МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ПРИ ПОСТАВКЕ В РФ**

**Набор реагентов «Экспресс-тест для качественного определения антигена SARS-CoV-2 в
мазке из носоглотки человека иммунохроматографическим методом (Asan Easy Test
COVID-19 Ag)»**

**Производитель: Asan Pharmaceutical Co., Ltd., 163, Yeongcheon-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-
do, Republic of Korea (163, Йончхон, Хвасон, провинция Кёнги-до, Республика Корея)**

216.5 MM

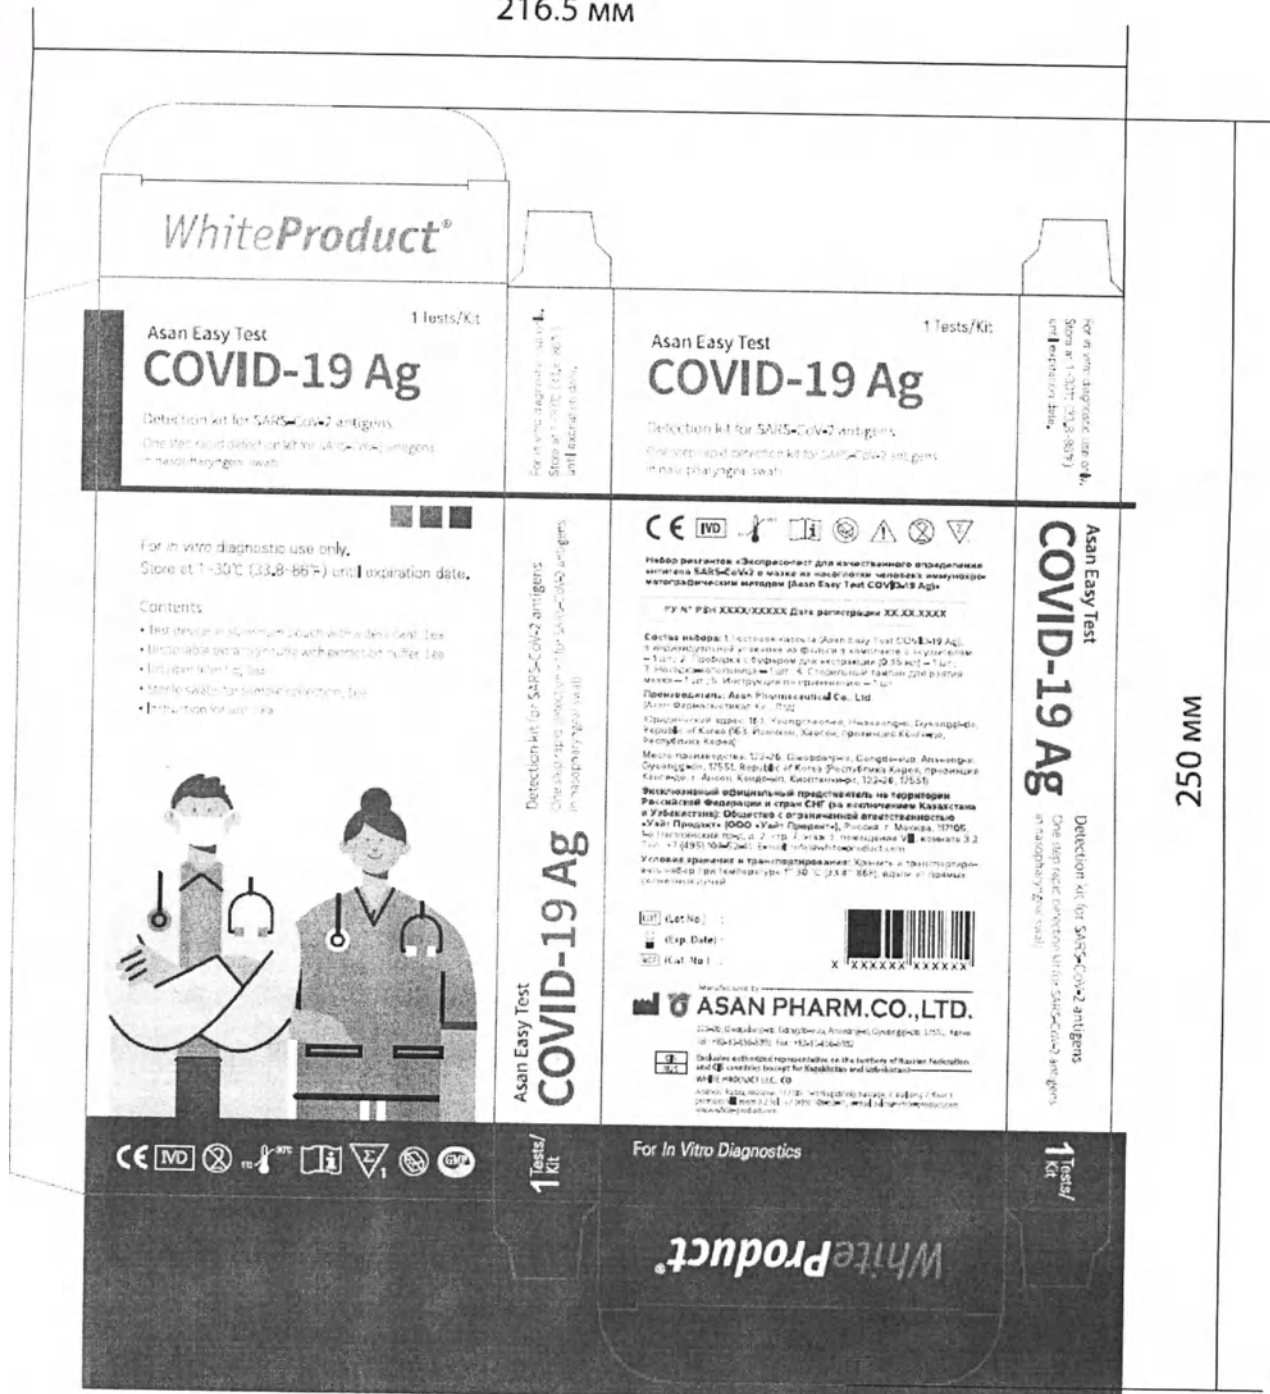


Рисунок 1. Макет маркировки на русском языке при поставке в РФ: «Набор реагентов «Экспресс-тест для качественного определения антигена SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки человека иммунохроматографическим методом (Asan Easy Test COVID-19 Ag)». Вариант исполнения 1

Asan Easy Test

COVID-19 Ag

Detection kit for SARS-CoV-2 antigens

One step rapid detection kit for SARS-CoV-2 antigens
in nasopharyngeal swab.

1 Tests/Kit

For *in vitro* diagnostic use only.
Store at 1~30°C (33.8~86°F)
until expiration date.

For *in vitro* diagnostic use only.

Store at 1~30°C (33.8~86°F) until expiration date.


Contents

- Test device in a aluminum pouch with a desiccant, 1ea
- Disposable extraction tube with extraction buffer, 1ea
- Dropper filter tip, 1ea
- Sterile swabs for sample collection, 1ea
- Instruction for use, 1ea



Detection kit for SARS-CoV-2 antigens
One step rapid detection kit for SARS-CoV-2 antigens
in nasopharyngeal swab.

Asan Easy Test
COVID-19 Ag



1 Tests/
1 Kit

Рисунок 1.1. Увеличенный текст рисунка 1



Набор реагентов «Экспресс-тест для качественного определения антигена SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки человека иммунохроматографическим методом (Asan Easy Test COVID-19 Ag)»

РУ N° РЗН XXXX/XXXXX Дата регистрации XX.XX.XXXX

Состав набора: 1. Тестовая кассета (Asan Easy Test COVID-19 Ag), в индивидуальной упаковке из фольги в комплекте с осушителем – 1 шт.; 2. Пробирка с буфером для экстракции (0,35 мл) – 1 шт.; 3. Насадка-капельница – 1 шт.; 4. Стерильный тампон для взятия мазка – 1 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.

Производитель: Asan Pharmaceutical Co., Ltd.
(Асан Фармасьютикал Ко., Лтд)

Юридический адрес: 163, Yeongcheon-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea (163, Йончхон, Хвасон, провинция Кенги-до, Республика Корея)

Место производства: 122-26, Geopdanji-ro, Gongdo-eup, Anseong-si, Gyeonggi-do, 17551, Republic of Korea (Республика Корея, провинция Кенги-до, г. Ансон, Кондо-эуп, Киоптанчи-ро, 122-26, 17551)

Эксклюзивный официальный представитель на территории Российской Федерации и стран СНГ (за исключением Казахстана и Узбекистана): Общество с ограниченной ответственностью «Уайт Продакт» (ООО «Уайт Продакт»), Россия, г. Москва, 117105, 1-й Нагатинский пр-д, д. 2, стр. 7, этаж 3, помещение VIII, комната 3.2 Тел.: +7 (495) 108-52-41. E-mail: info@white-product.com

Условия хранения и транспортирования: Хранить и транспортировать набор при температуре 1~30 °C (33.8~86F), вдали от прямых солнечных лучей.

LOT (Lot No.) :

Exp. (Exp. Date) :

REF (Cat. No.) :



Manufactured by
ASAN PHARM.CO.,LTD.

122-26, Geopdanji-ro, Gongdo-eup, Anseong-si, Gyeonggi-do, 17551, Korea
Tel: +82-31-656-5991 Fax: +82-31-656-5992



Exclusive authorized representative on the territory of Russian Federation and CIS countries (except for Kazakhstan and Uzbekistan)

WHITE PRODUCT LLC., CO

Address: Russia, Moscow, 117105, 1-st Nagatinsky passage, 2, building 7, floor 3, premises VIII, room 3.2 Tel: +7 (495) 108-52-41, e-mail: sales@white-product.com
www.white-product.com

Asan Easy Test
COVID-19 Ag

Detection kit for SARS-CoV-2 antigens
One step rapid detection kit for SARS-CoV-2 antigens
in nasopharyngeal swab.

Рисунок 1.2. Увеличенный текст рисунка 1

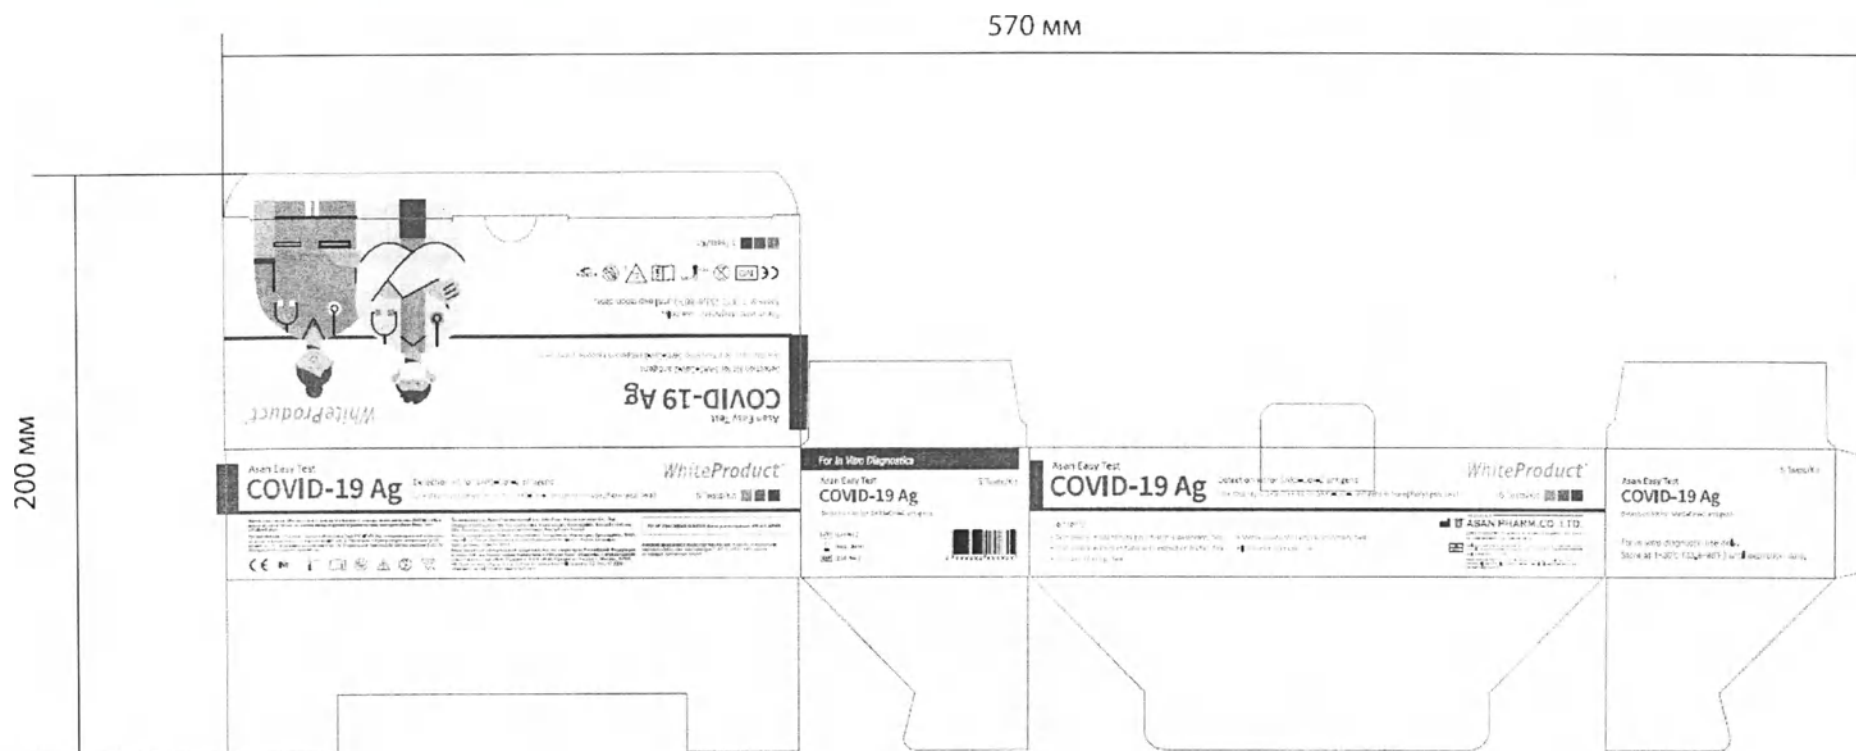


Рисунок 2. Макет маркировки на русском языке при поставке в РФ: «Набор реагентов «Экспресс-тест для качественного определения антигена SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки человека иммунохроматографическим методом (Asan Easy Test COVID-19 Ag)». Вариант исполнения 2

Asan Easy Test

COVID-19 Ag

Detection kit for SARS-CoV-2 antigens

One step rapid detection kit for SARS-CoV-2 antigens in nasopharyngeal swab.

WhiteProduct®

5 Tests/Kit

Набор реагентов «Экспресс-тест для качественного определения антигена SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки человека иммунохроматографическим методом (Asan Easy Test COVID-19 Ag)»

Состав набора: 1. Тестовая кассета (Asan Easy Test COVID-19 Ag), в индивидуальной упаковке из фольги в комплекте с осушителем – 5 шт., 2. Пробирка с буфером для экстракции (0,35 мл) – 5 шт., 3. Насадка-капельница – 5 шт., 4. Стерильный тампон для взятия мазка – 5 шт., 5. Инструкция по применению – 1 шт.



Производитель: Asan Pharmaceutical Co., Ltd. (Асан Фармэсьютикал Ко., Лтд)

Юридический адрес: 163, Yeongcheon-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea (163, Йончхон, Хвасон, провинция Кенгидо, Республика Корея)

Место производства: 122-26, Gyeonggi-ro, Gongdo-eup, Anseong-si, Gyeonggi-do, 17551, Republic of Korea (Республика Корея, провинция Кенгидо, г. Ансон, Кондоэп, Кيونганчино, 122-26, 17551)

Эксклюзивный официальный представитель на территории Российской Федерации и стран СНГ (за исключением Казахстана и Узбекистана): Общество с ограниченной ответственностью «Уайт Продакт» (ООО «Уайт Продакт»), Россия, г. Москва, 117105, 1-й Нагатинский грاند-д 2, стр. 7, этаж 3, помещение VIII, комната 3.2 Тел: +7 (495) 108-82-41 E-mail: info@white-product.com

РУ № РЗН XXXX/XXXXX Дата регистрации XX.XX.XXXX

Условия хранения и транспортирования: Хранить и транспортировать набор при температуре 1° 30 °C (33.8° 86F), вдали от прямых солнечных лучей.

For In Vitro Diagnostics

Asan Easy Test

COVID-19 Ag

Detection kit for SARS-CoV-2 antigens

5 Tests/Kit

5 Tests/Kit

LOT (Lot No.) :

Exp. Date) :

REF (Cat. No.) :



РУ № РЗН XXXX/XXXXX Дата регистрации XX.XX.XXXX

Условия хранения и транспортирования: Хранить и транспортировать набор при температуре 1° 30 °C (33.8° 86F), вдали от прямых солнечных лучей.

Рисунок 2.1. Увеличенный текст рисунка 2

Asan Easy Test

COVID-19 Ag

Detection kit for SARS-CoV-2 antigens

One step rapid detection kit for SARS-CoV-2 antigens in nasopharyngeal swab.

WhiteProduct®

5 Tests/Kit

Contents

- Test device in aluminum pouch with a desiccant, 5ea
- Disposable extraction tube with extraction buffer, 5ea
- Dropper filter tip, 5ea
- Sterile swabs for sample collection, 5ea
- Instruction for use, 1ea

Manufactured by
ASAN PHARM.CO.,LTD.

122-26, Gyeongsang-ro, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do 75001 Korea
Tel: +82-54-696-9991 Fax: +82-54-696-9992



Exclusive authorized representative on the territory of Russian Federation and CIS countries (except for Kazakhstan and Uzbekistan)

WHITE PRODUCT LLC, CO

Address: Russia, Moscow, 121170, ul. Lezhninskaya, 8a, building 1 floor 2
premises 40 room 32 (40/1040/32) Email: info@whiteproduct.ru
www.whiteproduct.ru

5 Tests/Kit

Asan Easy Test

COVID-19 Ag

Detection kit for SARS-CoV-2 antigens

For *in vitro* diagnostic use only.

Store at 1~30°C (33.8~86°F) until expiration date.

Рисунок 2.2. Увеличенный текст рисунка 2


Asan Easy Test
COVID-19 Ag

Detection kit for SARS-CoV-2 antigens


One step rapid detection kit for SARS-CoV-2 antigens in nasopharyngeal swab.

For *in vitro* diagnostic use only.

Store at 1~30°C (33,8~86°F) until expiration date.



5 Tests/Kit

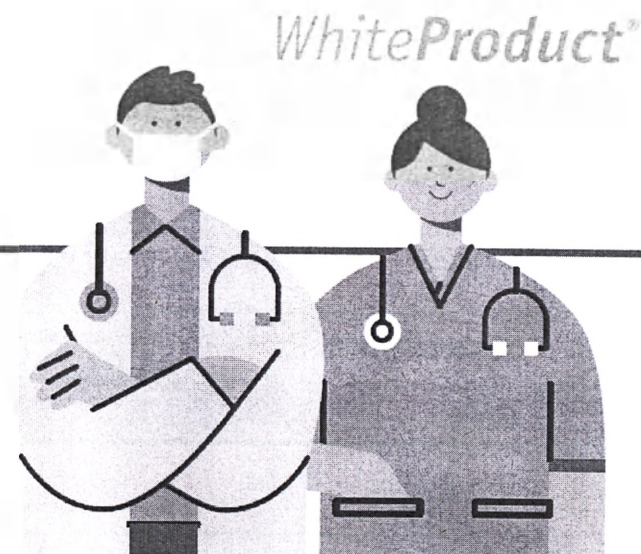

Manufactured by
 **ASAN PHARM.CO.,LTD.**

122-26, Gieopdanji-ro, Gongdo-eup, Anseong-si, Gyeonggi-do, 17551, Korea
Tel: +82-31-656-5991 Fax: +82-31-656-5992



Exclusive authorized representative on the territory of Russian Federation and CIS countries (except for Kazakhstan and Uzbekistan)

WHITE PRODUCT LLC., CO

Address: Russia, Moscow, 117105, 1-st Nagatinsky passage, 2, building 7, floor 3, premises VIII, room 3.2 Tel: +7 (495) 108-52-41, e-mail: sales@white-product.com
www.white-product.com

Рисунок 2.3. Увеличенный текст рисунка 2



Рисунок 3. Макет маркировки на русском языке при поставке в РФ: «Набор реагентов «Экспресс-тест для качественного определения антигена SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки человека иммунохроматографическим методом (Asan Easy Test COVID-19 Ag)». Вариант исполнения 3

Asan Easy Test COVID-19 Ag

Detection kit for SARS-CoV-2 antigens

One step rapid detection kit for SARS-CoV-2 antigens in nasopharyngeal swab.

WhiteProduct®

25 Tests/Kit



Набор реагентов «Экспресс-тест для качественного определения антигена SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки человека иммунохроматографическим методом (Asan Easy Test COVID-19 Ag)»

Состав набора: 1. Тестовая кассета (Asan Easy Test COVID-19 Ag), в индивидуальной упаковке из фольги в комплекте с осушителем – 25 шт.; 2. Пробирка с буфером для экстракции (0.35 мл) – 25 шт.; 3. Насадка-капельница – 25 шт.; 4. Стерильный тампон для взятия мазка – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.



Условия хранения и транспортирования: Хранить и транспортировать набор при температуре 1° 30 °C (33.8° 86F), вдали от прямых солнечных лучей.

Производитель: Asan Pharmaceutical Co., Ltd.

(Asan Фармасьютикал Ко., Лтд)

Юридический адрес: 163, Yeongcheon-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea (163, Йончхон, Хвасон, провинция Кенги-до, Республика Корея)

Место производства: 122-26, Geopdang-ro, Gongdo-eup, Anseong-si, Gyeonggi-do, 17551, Republic of Korea (Республика Корея, провинция Кенги-до, г. Ансон, Кондо-ыл, Киптанчи-ро, 122-26, 17551)

РУ № РЗН XXXX/XXXXX Дата регистрации XX.XX.XXXX

Эксклюзивный официальный представитель на территории Российской Федерации и стран СНГ (за исключением Казахстана и Узбекистана): Общество с ограниченной ответственностью «Уайт Продакт» (ООО «Уайт Продакт»), Россия, г. Москва, 11/105, 1-й Нагатинский пр-д, д. 2, стр. 7, этаж 3, помещение VIII, комната 3.2
Тел: +7 (495) 108-52-41. E-mail: info@white-product.com

Рисунок 3.1. Увеличенный текст рисунка 3

Условия хранения и транспортирования: Хранить и транспортировать набор при температуре 1~ 30 °C (33.8~ 86F), вдали от прямых солнечных лучей.

Производитель: Asan Pharmaceutical Co., Ltd.
(Асан Фармасьютикал Ко., Лтд)

Юридический адрес: 163, Yeongcheon-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea (163, Йончхон, Хвасон, провинция Кёнги-до, Республика Корея)

Место производства: 122-26, Gieopdanji-ro, Gongdo-eup, Anseong-si, Gyeonggi-do, 17551, Republic of Korea (Республика Корея, провинция Кёнги-до, г. Ансон, Кондо-ып, Киоптанчи-ро, 122-26, 17551)

РУ № РЗН XXXX/XXXXX Дата регистрации XX.XX.XXXX

Эксклюзивный официальный представитель на территории Российской Федерации и стран СНГ (за исключением Казахстана и Узбекистана): Общество с ограниченной ответственностью «Уайт Продакт» (ООО «Уайт Продакт»), Россия, г. Москва, 117105, 1-й Нагатинский пр-д, д. 2, стр. 7, этаж 3, помещение VIII, комната 3.2
Тел.: +7 (495) 108-52-41. E-mail: info@white-product.com

Набор реагентов «Экспресс-тест для качественного определения антигена SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки человека иммунохроматографическим методом (Asan Easy Test COVID-19 Ag)»

Состав набора: 1.Тестовая кассета (Asan Easy Test COVID-19 Ag), в индивидуальной упаковке из фольги в комплекте с осушителем – 25 шт.; 2. Пробирка с буфером для экстракции (0,35 мл) – 25 шт.; 3. Насадка-капельница – 25 шт.; 4. Стерильный тампон для взятия мазка – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.



Рисунок 3.2. Увеличенный текст рисунка 3

For In Vitro Diagnostics

Asan Easy Test

COVID-19 Ag

Detection kit for SARS-CoV-2 antigens

25 Tests/Kit

LOT (Lot No.) :

(Exp. Date) :

REF (Cat. No.) :



Asan Easy Test

COVID-19 Ag

Detection kit for SARS-CoV-2 antigens

One step rapid detection kit for SARS-CoV-2 antigens in nasopharyngeal swab.

25 Tests/Kit



Asan Easy Test

COVID-19 Ag

Detection kit for SARS-CoV-2 antigens

Contents

- Test device in aluminum pouch with a desiccant, 25ea
- Disposable extraction tube with extraction buffer, 25ea
- Dropper filter tip, 25ea
- Sterile swabs for sample collection, 25ea
- Instruction for use, 1ea

WhiteProduct[®]

For in vitro diagnostic use only.

Store at 1~30°C (33.8~86°F) until expiration date.

Manufactured by
ASAN PHARM.CO.,LTD.
123-26, Gyeongnam-ro, Gyeongju-si, Gyeonggi-do, 77531, Korea
Tel: +82(43)436-5951 Fax: +82(43)436-5992

Рисунок 3.3. Увеличенный текст рисунка 3

WhiteProduct®

Asan Easy Test

COVID-19 Ag

Detection kit for SARS-CoV-2 antigens


One step rapid detection kit for SARS-CoV-2 antigens in nasopharyngeal swab.

25 Tests/Kit



For *in vitro* diagnostic use only.

Store at 1~30°C (33.8~86°F) until expiration date.



Manufactured by **ASAN PHARM.CO.,LTD.**

122-26, Gieopdanji-ro, Gongdo-eup, Anseong-si, Gyeonggi-do, 17551, Korea
Tel.: +82-31-656-5991 Fax: +82-31-656-5992

CIS
RUS Exclusive authorized representative on the territory of Russian Federation
and CIS countries (except for Kazakhstan and Uzbekistan)

WHITE PRODUCT LLC, CO

Address: Russia, Moscow, 117105, 1-st Nagatinsky passage, 2, building 7, floor 3,
premises VII, room 3.2 Tel.: +7 (495) 108-52-41, e-mail: sales@white-product.com
www.white-product.com

Manufactured by **ASAN PHARM.CO.,LTD.**

122-26, Gieopdanji-ro, Gongdo-eup, Anseong-si, Gyeonggi-do, 17551, Korea
Tel.: +82-31-656-5991 Fax: +82-31-656-5992

CIS
RUS Exclusive authorized representative on the territory of Russian Federation
and CIS countries (except for Kazakhstan and Uzbekistan)

WHITE PRODUCT LLC, CO

Address: Russia, Moscow, 117105, 1-st Nagatinsky passage, 2, building 7, floor 3,
premises VII, room 3.2 Tel.: +7 (495) 108-52-41, e-mail: sales@white-product.com
www.white-product.com

Рисунок 3.4. Увеличенный текст рисунка 3

**Приложение
(справочное)**

Варианты исполнения медицинского изделия

Набор реагентов «Экспресс-тест для качественного определения антигена SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки человека иммунохроматографическим методом (Asan Easy Test COVID-19 Ag)», варианты исполнения:

I. Вариант исполнения 1, в составе:

1. Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги) - 1 шт.
2. Пробирка с буфером для экстракции (0.35 мл) - 1 шт.
3. Насадка с капельницей к буферу - 1 шт.
4. Стерильный тампон для взятия мазка - 1 шт.
5. Инструкция по применению – 1 шт.

II. Вариант исполнения 2, в составе:

1. Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги) - 5 шт.
2. Пробирка с буфером для экстракции (0.35 мл) - 5 шт.
3. Насадка с капельницей к буферу - 5 шт.
4. Стерильный тампон для взятия мазка - 5 шт.
5. Инструкция по применению – 1 шт.

III. Вариант исполнения 3, в составе:

1. Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги) - 25 шт.
2. Пробирка с буфером для экстракции (0.35 мл) - 25 шт.
3. Насадка с капельницей к буферу - 25 шт.
4. Стерильный тампон для взятия мазка - 25 шт.
5. Инструкция по применению – 1 шт.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

14 (Четырнадцать) ЛИСТОВ
цифрами прописью

Должность Генеральный директор

Подпись

«10» декабрь 2024 г.

М.П.



Х

УТВЕРЖДАЮ

**Генеральный директор
ООО «Уайт Продакт»**

Немцов В.Б.
«10» декабря 2021 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Набор реагентов «Экспресс-тест для качественного определения антигена SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки человека иммунохроматографическим методом (Asan Easy Test COVID-19 Ag)»

Производитель: Asan Pharmaceutical Co., Ltd., 163, Yeongcheon-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea (163, Йончхон, Хвасон, провинция Кёнги-до, Республика Корея)

Редакция 1

Набор реагентов «Экспресс-тест для качественного определения антигена SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки человека иммунохроматографическим методом (Asan Easy Test COVID-19 Ag)». Вариант исполнения 1

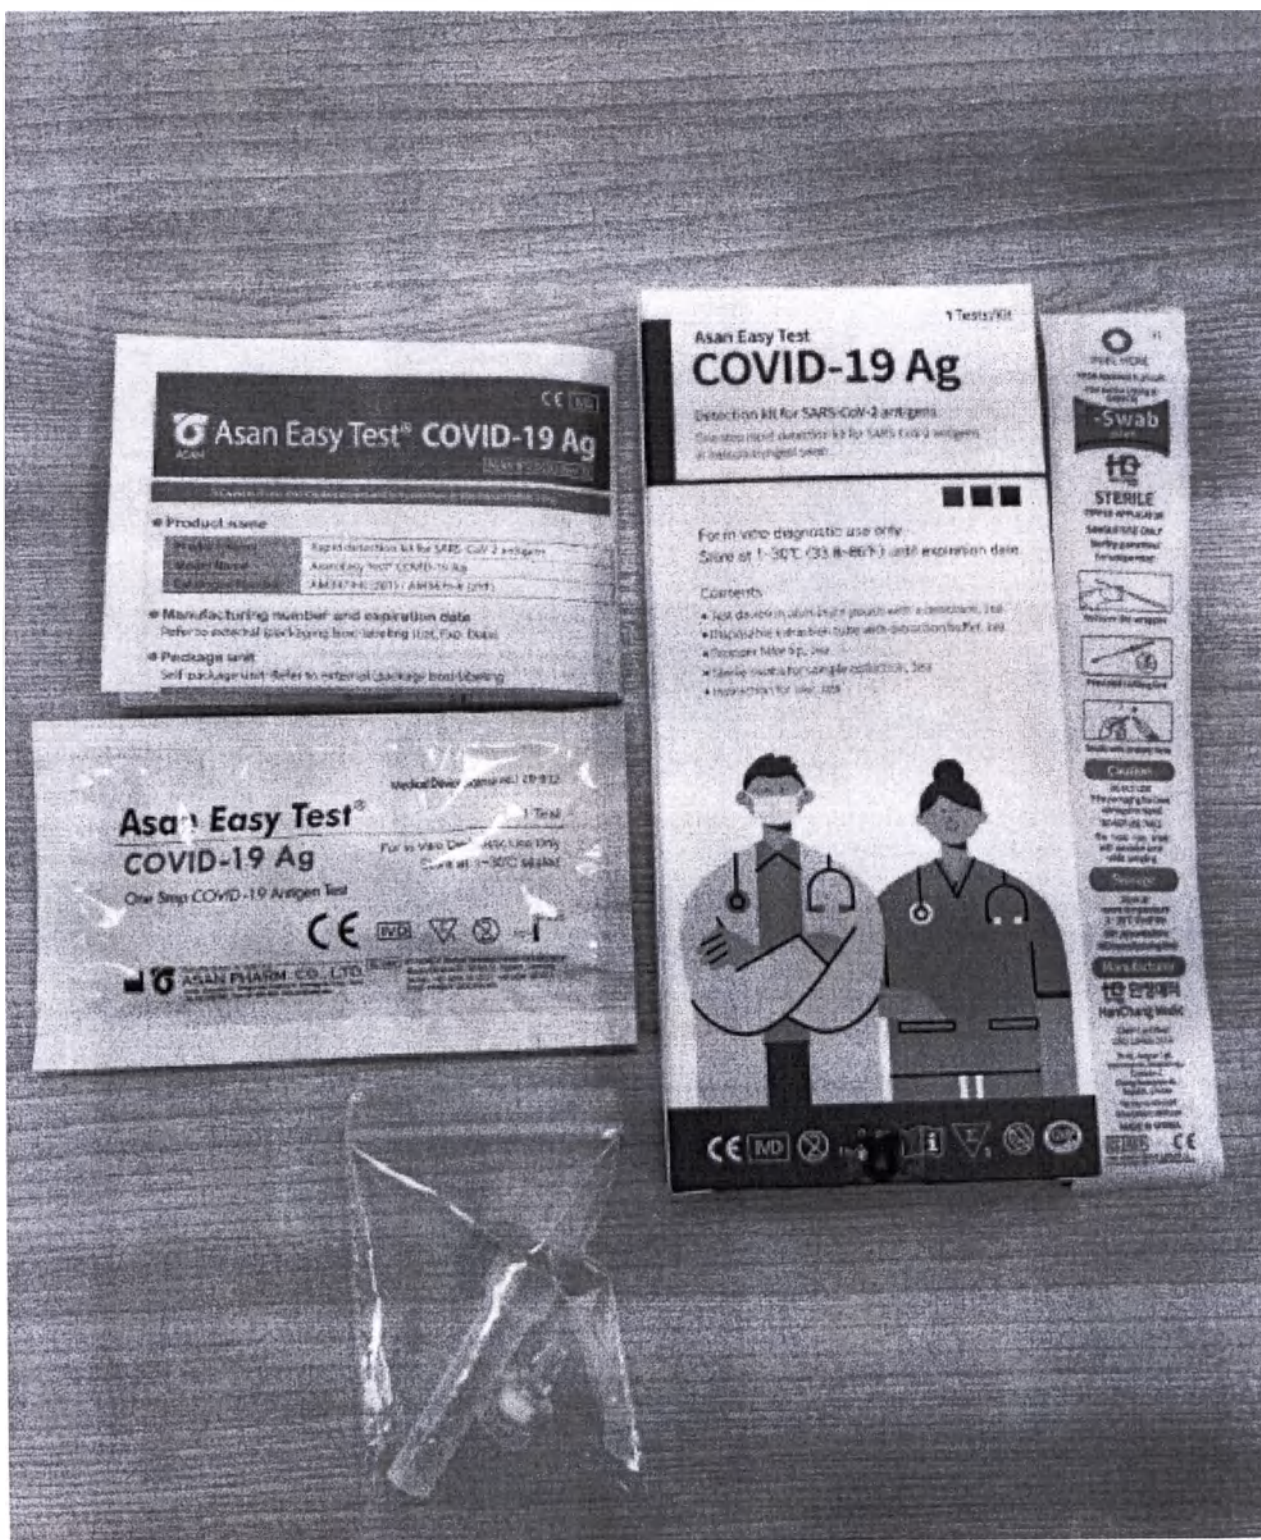


Фото 1. Общий вид изделия Набор реагентов «Экспресс-тест для качественного определения антигена SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки человека иммунохроматографическим методом (Asan Easy Test COVID-19 Ag)». Вариант исполнения 1, в составе:

1. Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги) - 1 шт.
2. Пробирка с буфером для экстракции (0.35 мл) - 1 шт.
3. Насадка с капельницей к буферу - 1 шт.
4. Стерильный тампон для взятия мазка - 1 шт.
5. Инструкция по применению – 1 шт.



Фото 2. Общий вид изделия Набор реагентов «Экспресс-тест для качественного определения антигена SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки человека иммунохроматографическим методом (Asan Easy Test COVID-19 Ag)». Вариант исполнения 1, в составе:

1. Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги) - 1 шт.
2. Пробирка с буфером для экстракции (0.35 мл) - 1 шт.
3. Насадка с капельницей к буферу - 1 шт.
4. Стерильный тампон для взятия мазка - 1 шт.
5. Инструкция по применению – 1 шт.

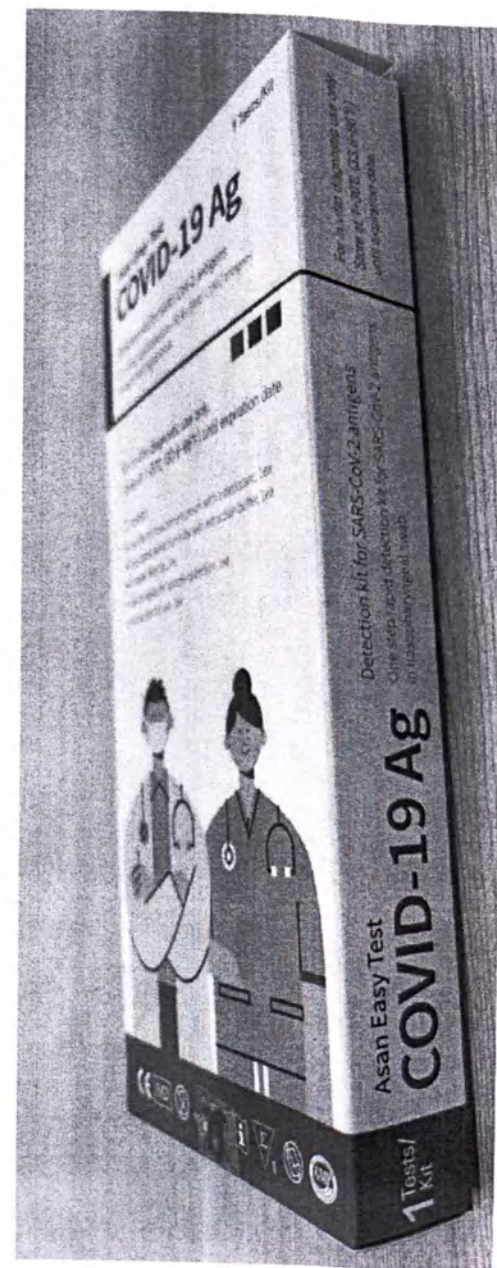
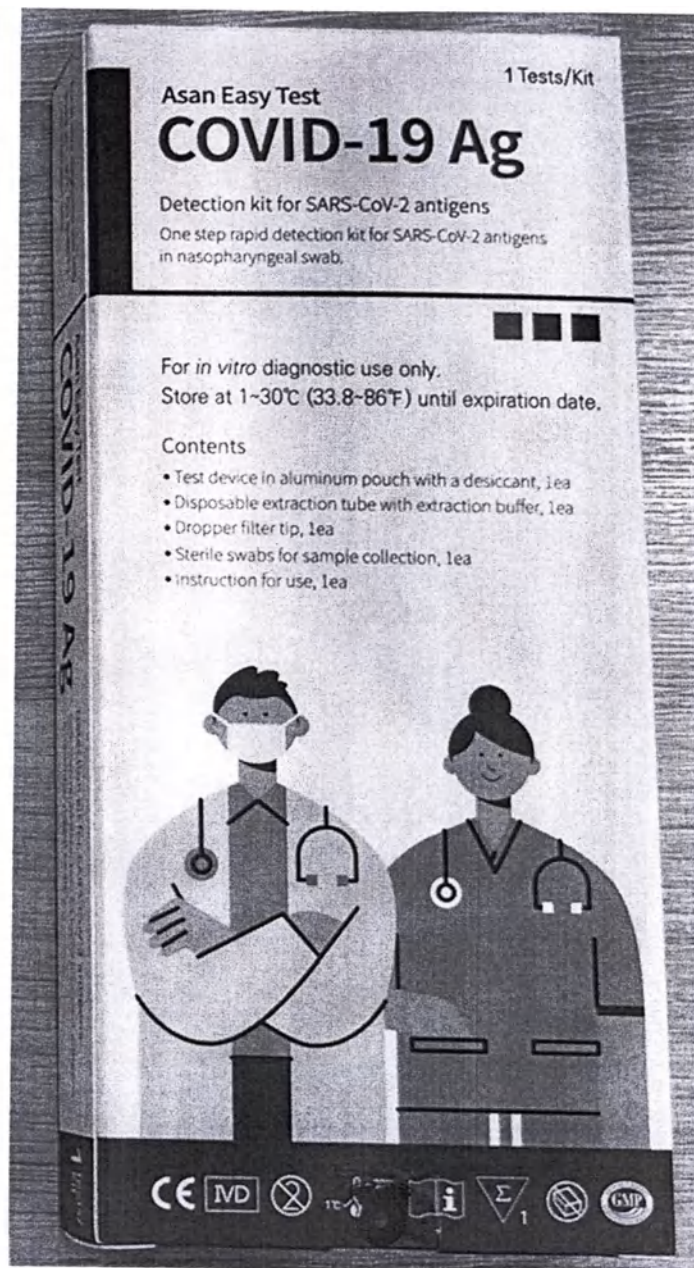
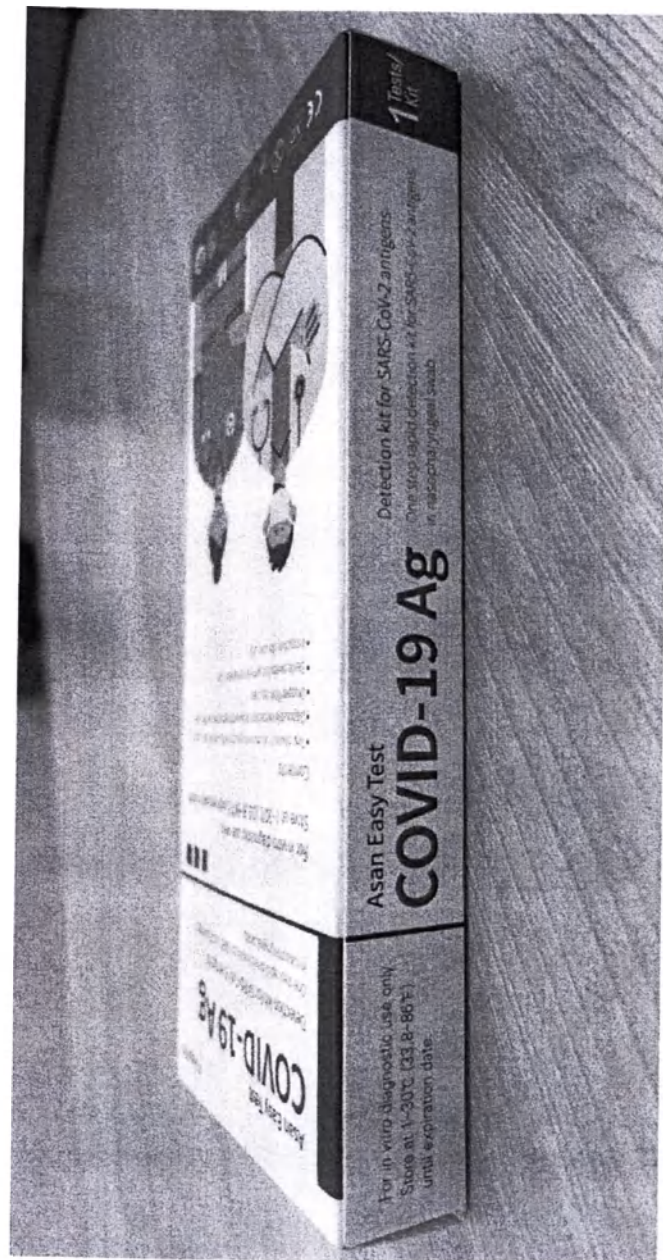


Фото 3. Общий вид потребительской упаковки



Фото 4. Общий вид изделий в индивидуальной упаковке:
1. Пробирка с буфером для экстракции (0.35 мл) - 1 шт.
2. Насадка с капельницей к буферу - 1 шт.

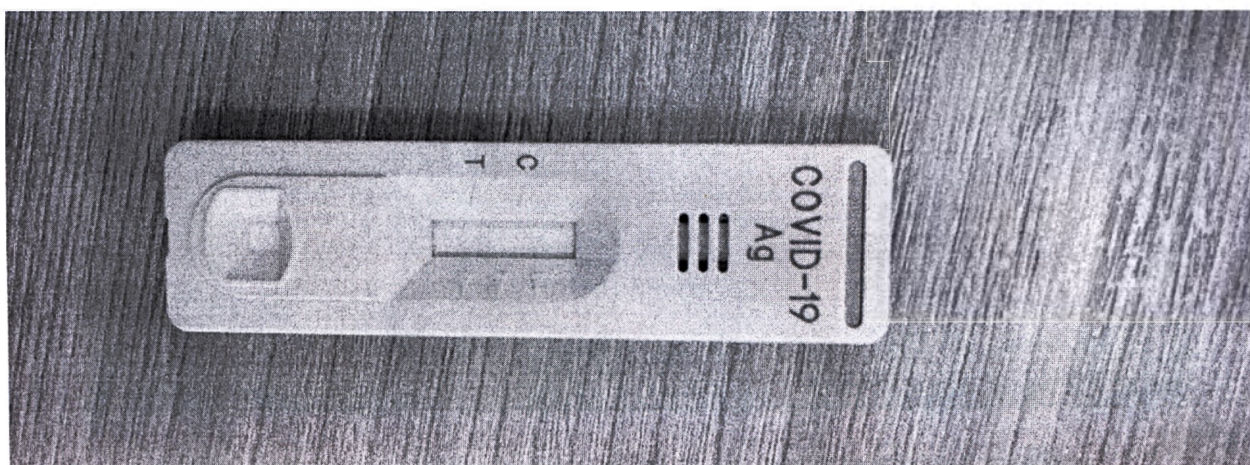
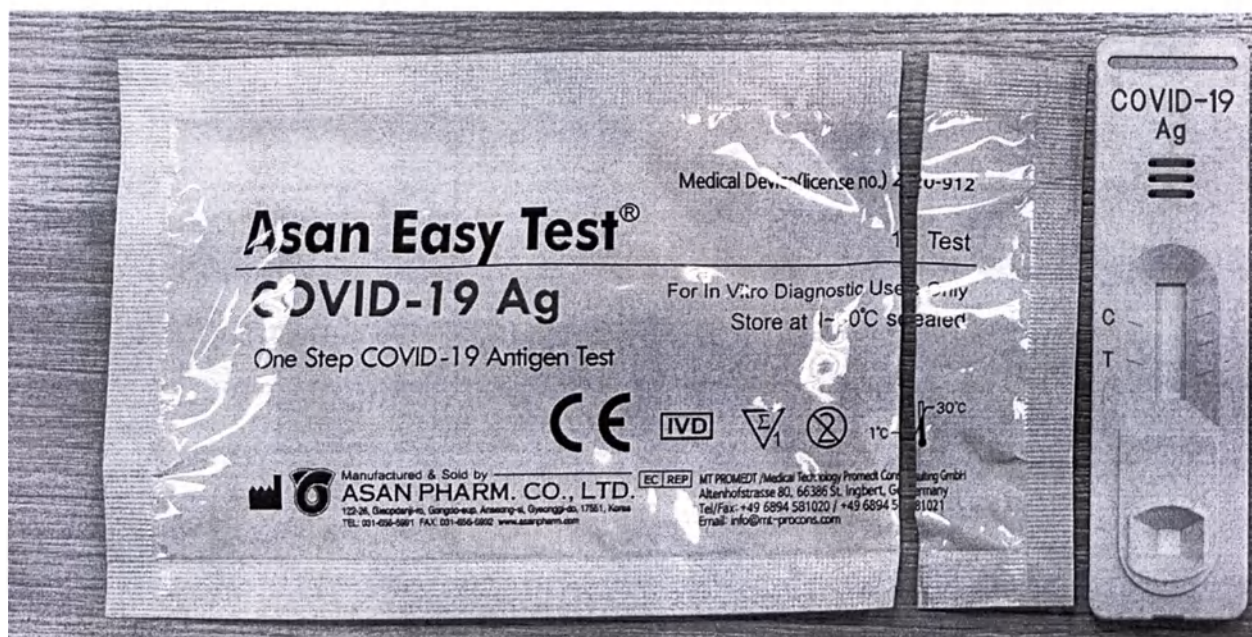
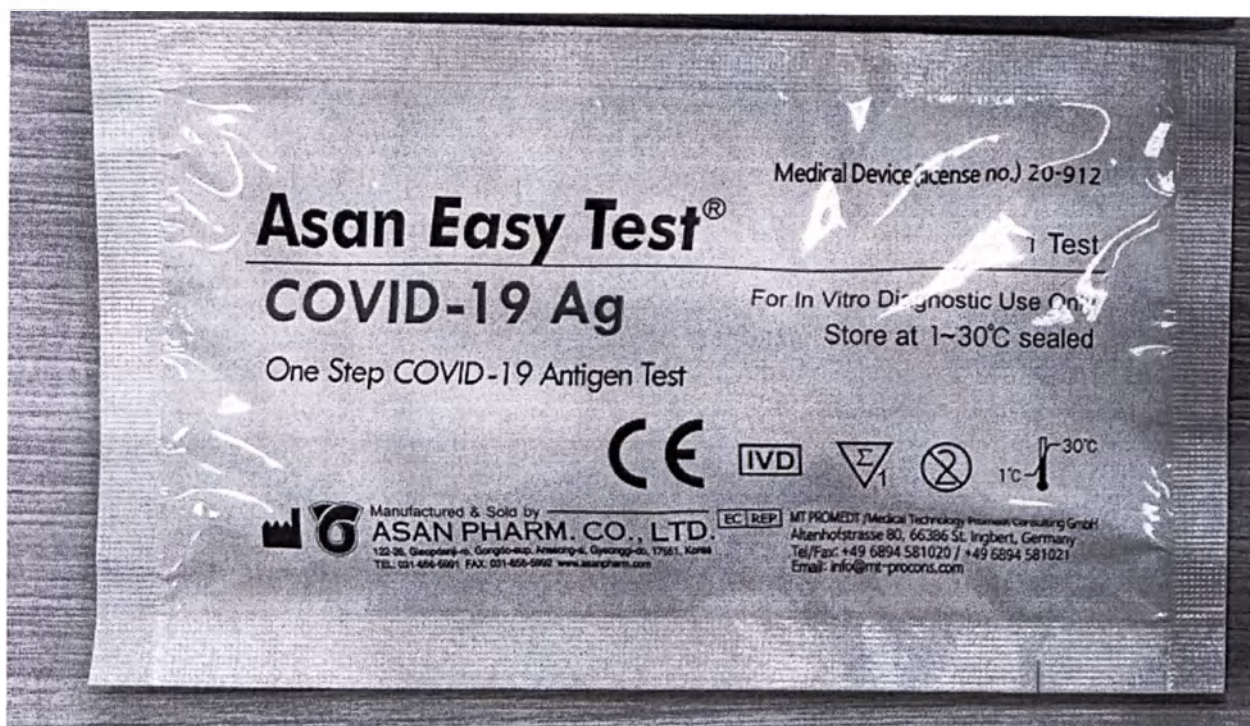


Фото 5. Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги) - 1 шт.

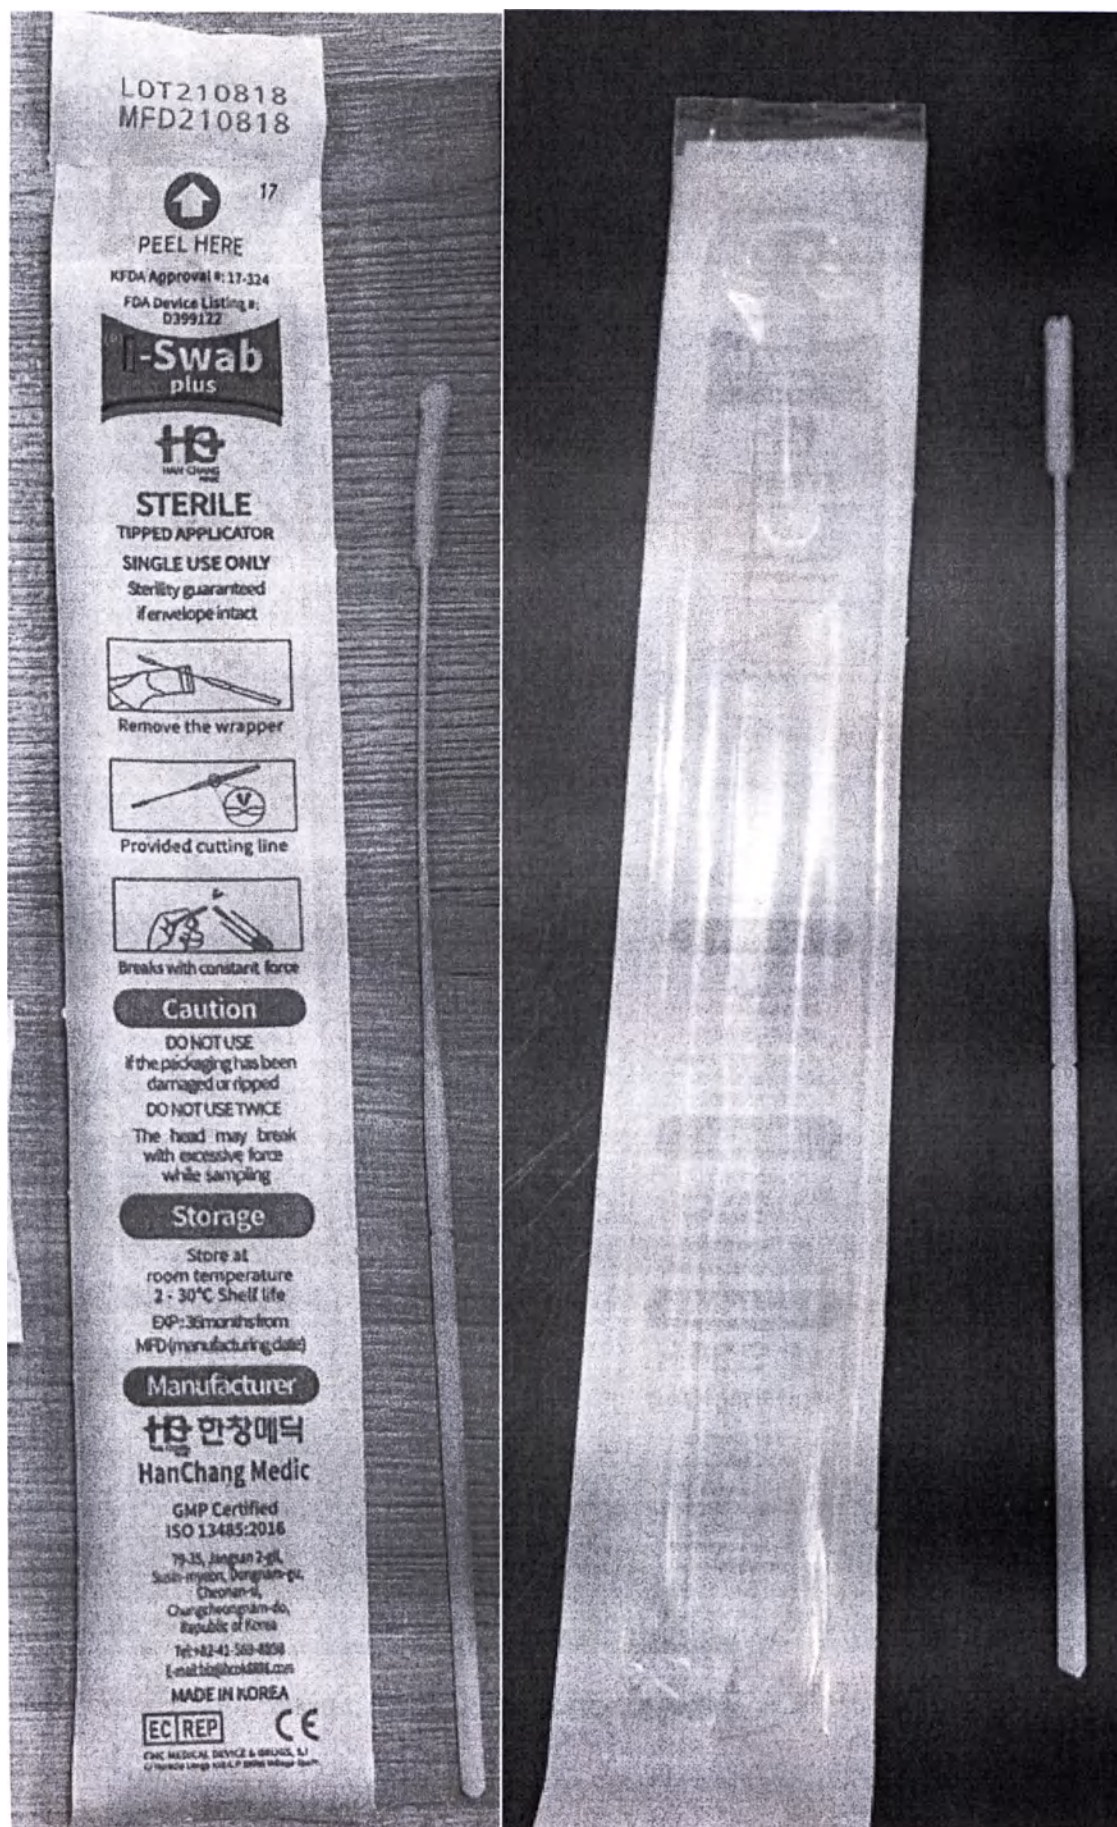


Фото 6. Стерильный тампон для взятия мазка - 1 шт. (в индивидуальной упаковке)

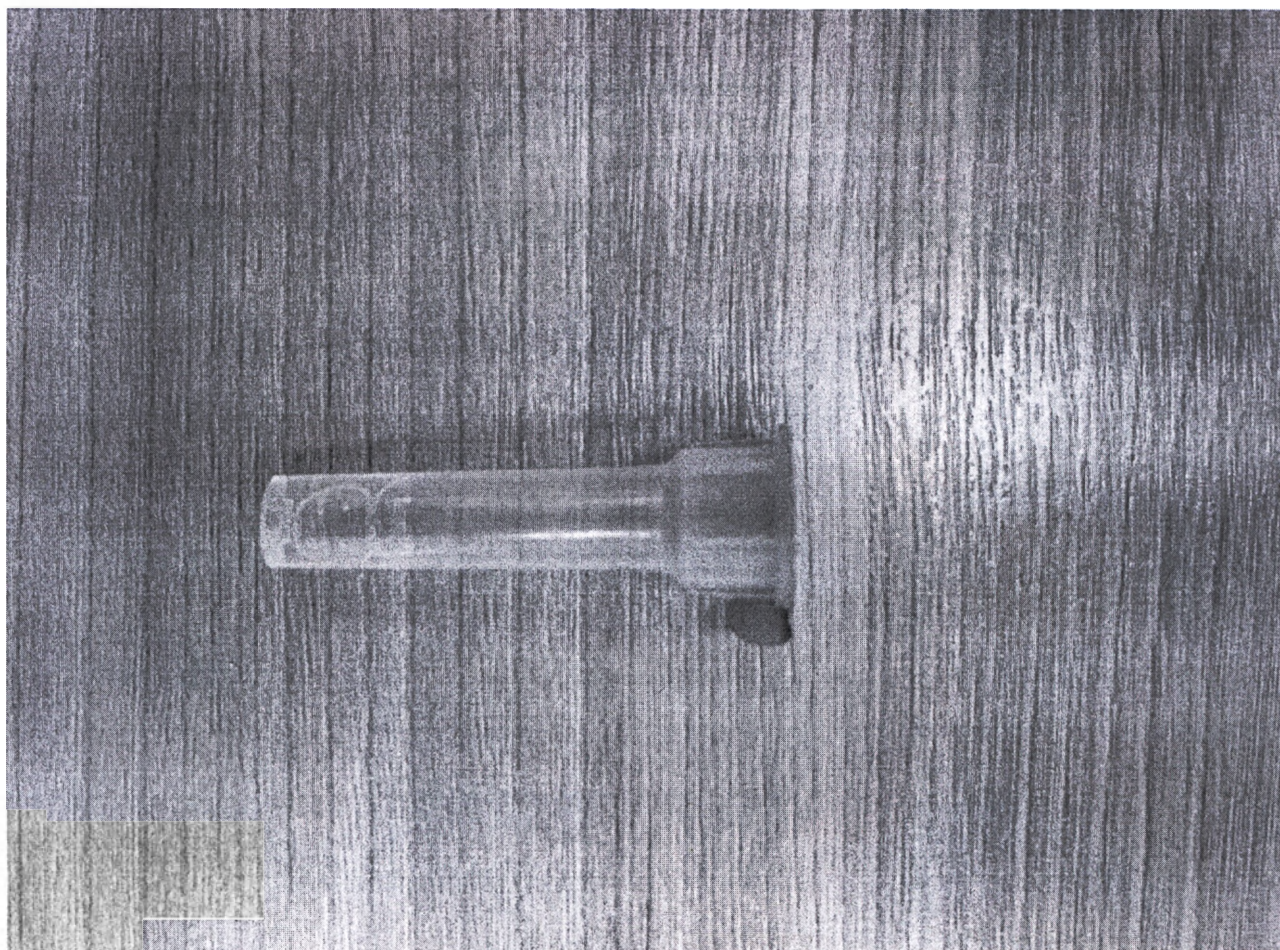


Фото 7. Пробирка с буфером для экстракции (0.35 мл) - 1 шт.

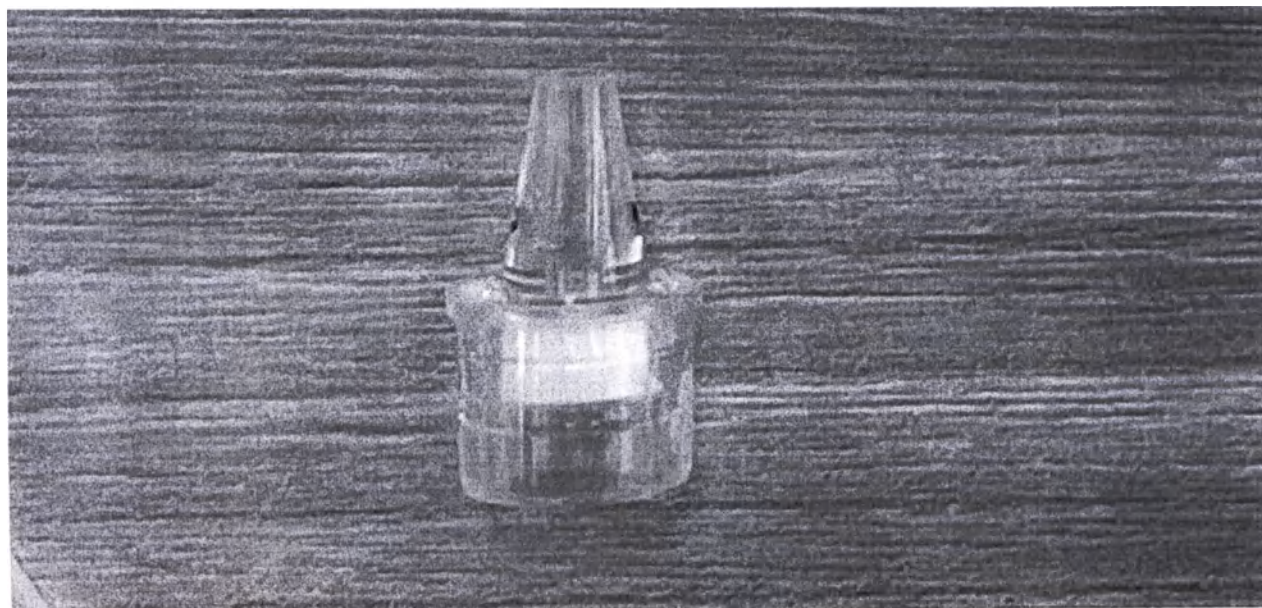


Фото 8. Насадка с капельницей к буферу - 1 шт.

Набор реагентов «Экспресс-тест для качественного определения антигена SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки человека иммунохроматографическим методом (Asan Easy Test COVID-19 Ag)». Вариант исполнения 2



Фото 9. Набор реагентов «Экспресс-тест для качественного определения антигена SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки человека иммунохроматографическим методом (Asan Easy Test COVID-19 Ag)». Вариант исполнения 2, в составе:

1. Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги) - 5 шт.
2. Пробирка с буфером для экстракции (0.35 мл) - 5 шт.
3. Насадка с капельницей к буферу - 5 шт.
4. Стерильный тампон для взятия мазка - 5 шт.
5. Инструкция по применению – 1 шт.

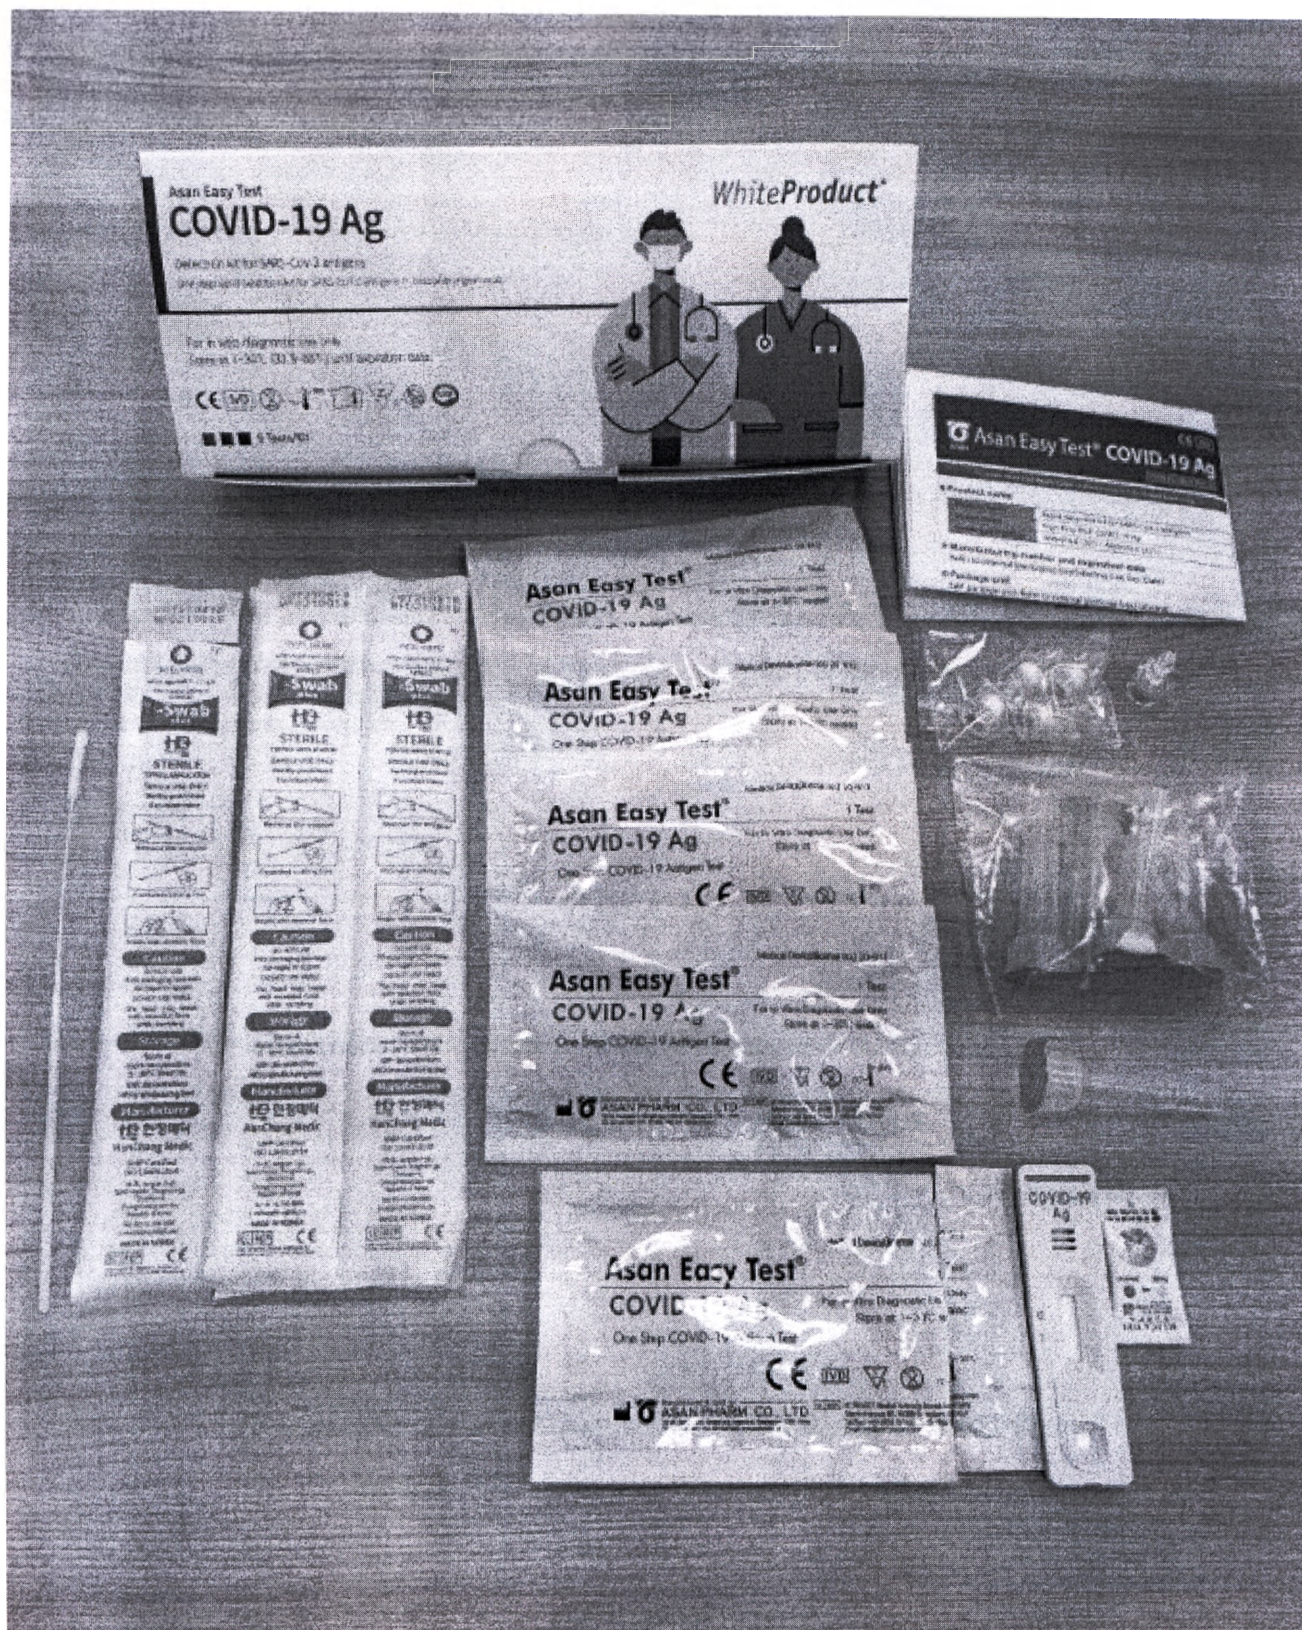


Фото 10. Набор реагентов «Экспресс-тест для качественного определения антигена SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки человека иммунохроматографическим методом (Asan Easy Test COVID-19 Ag)». Вариант исполнения 2, в составе:

1. Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги) - 5 шт.
2. Пробирка с буфером для экстракции (0.35 мл) - 5 шт.
3. Насадка с капельницей к буферу - 5 шт.
4. Стерильный тампон для взятия мазка - 5 шт.
5. Инструкция по применению – 1 шт.

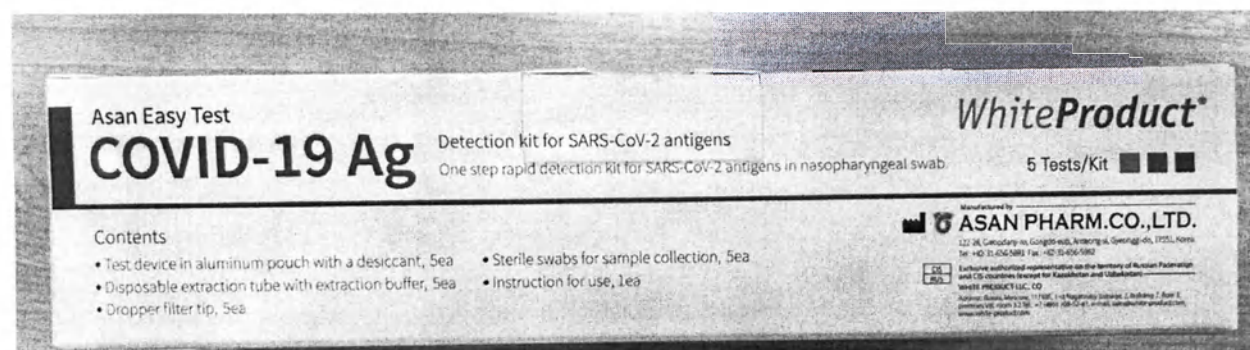
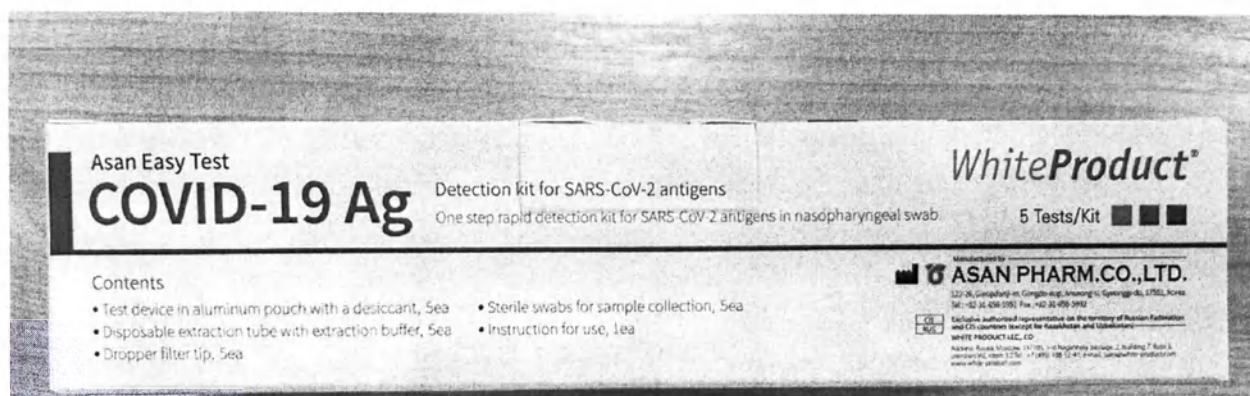
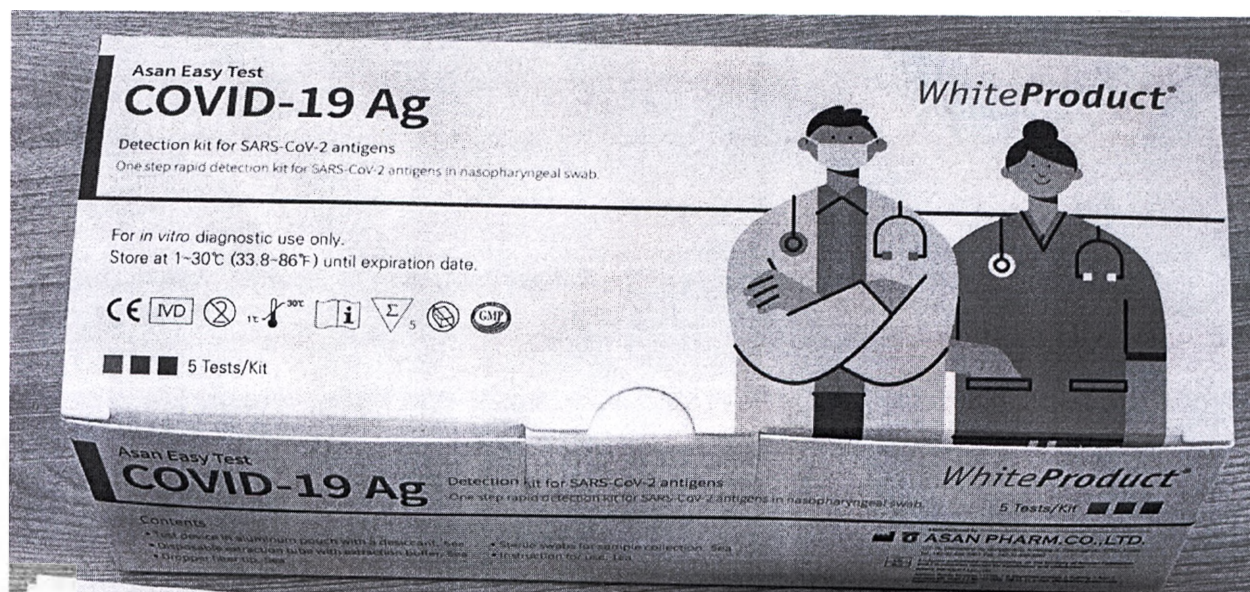


Фото 11. Общий вид потребительской упаковки

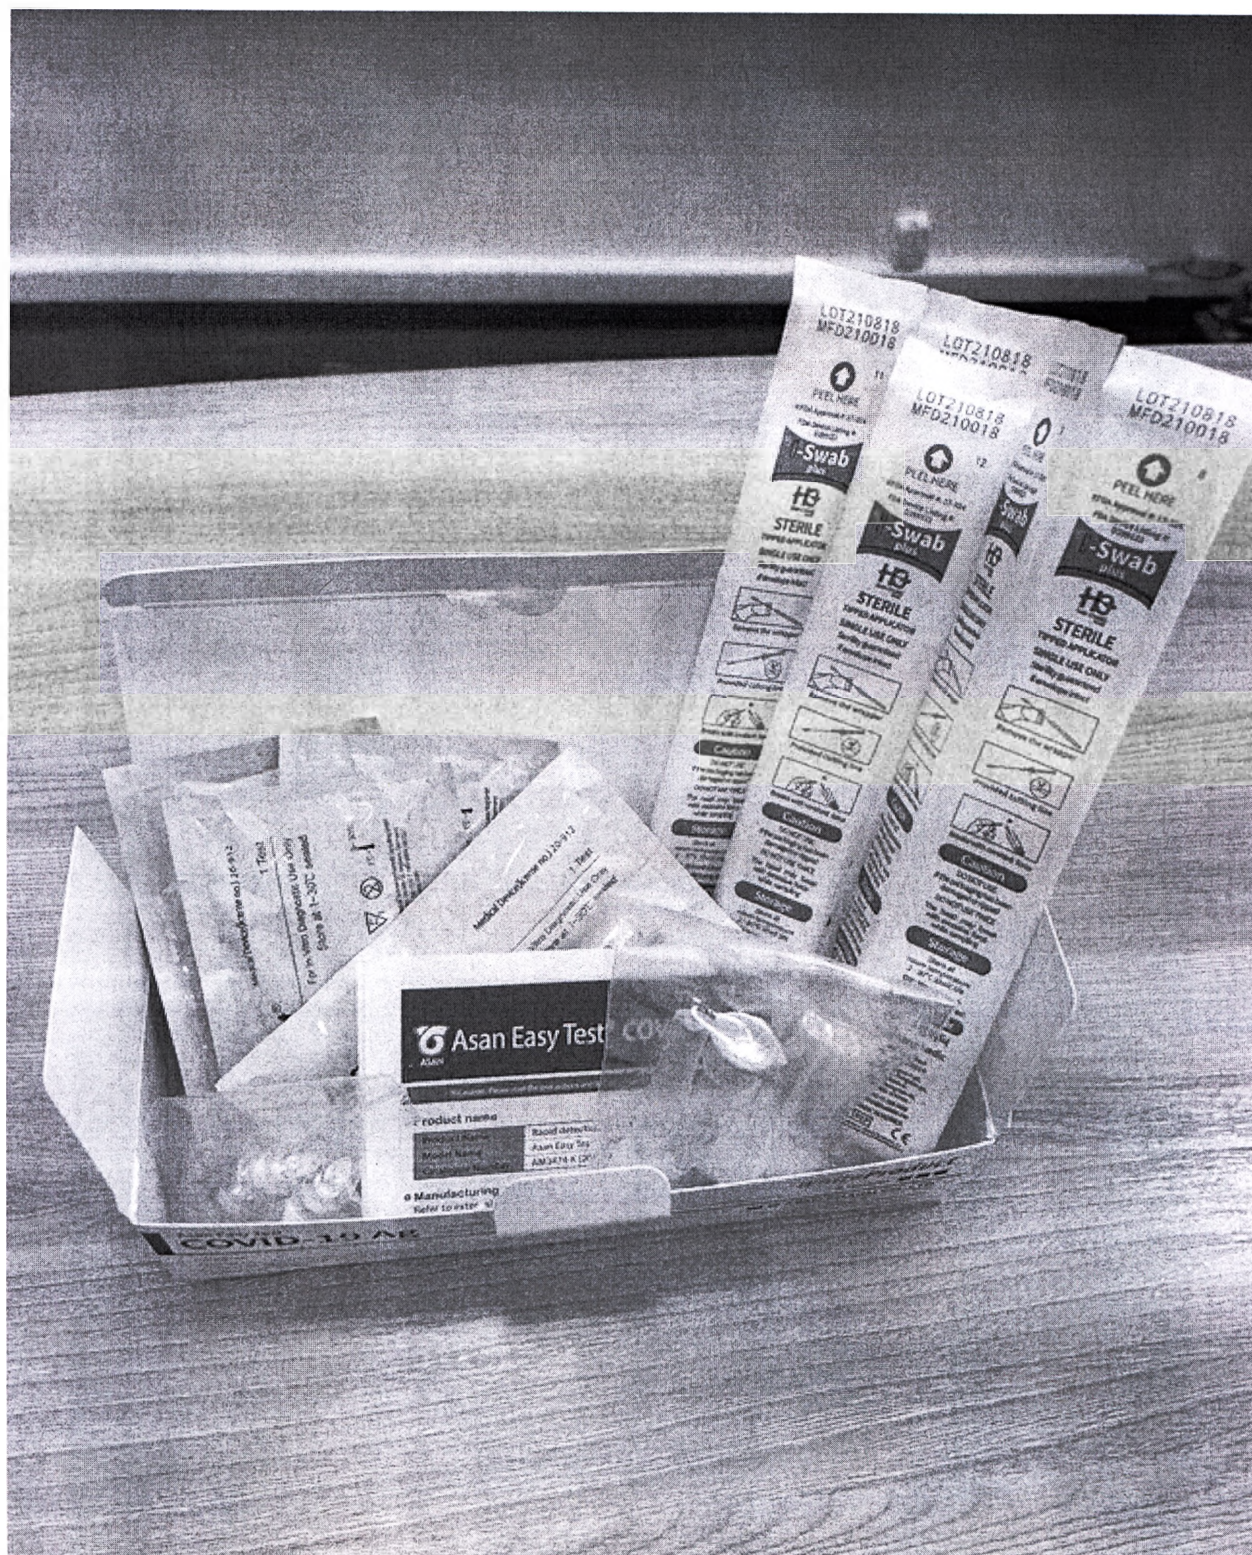


Фото 12. Набор реагентов «Экспресс-тест для качественного определения антигена SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки человека иммунохроматографическим методом (Asan Easy Test COVID-19 Ag)». Вариант исполнения 2, в составе:

1. Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги) - 5 шт.
2. Пробирка с буфером для экстракции (0.35 мл) - 5 шт.
3. Насадка с капельницей к буферу - 5 шт.
4. Стерильный тампон для взятия мазка - 5 шт.
5. Инструкция по применению – 1 шт.

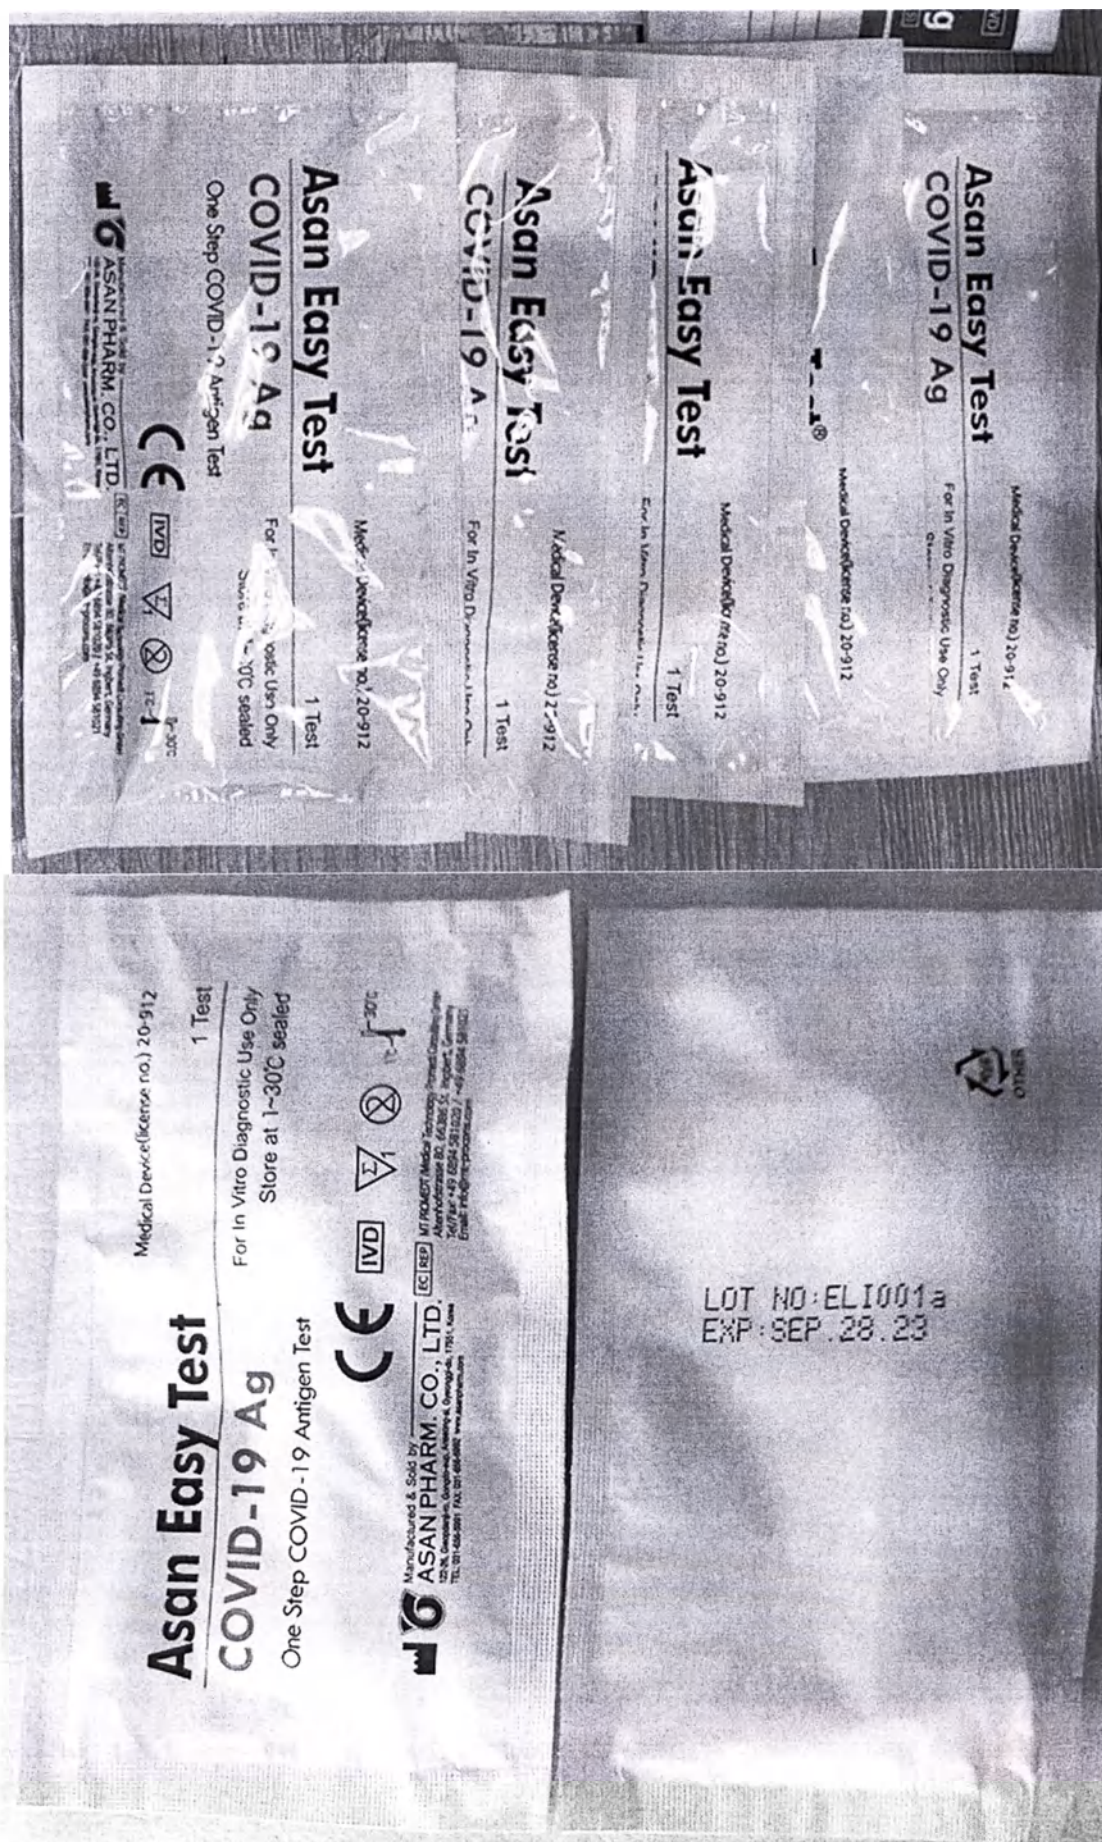


Фото 13. Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги) - 5 шт.

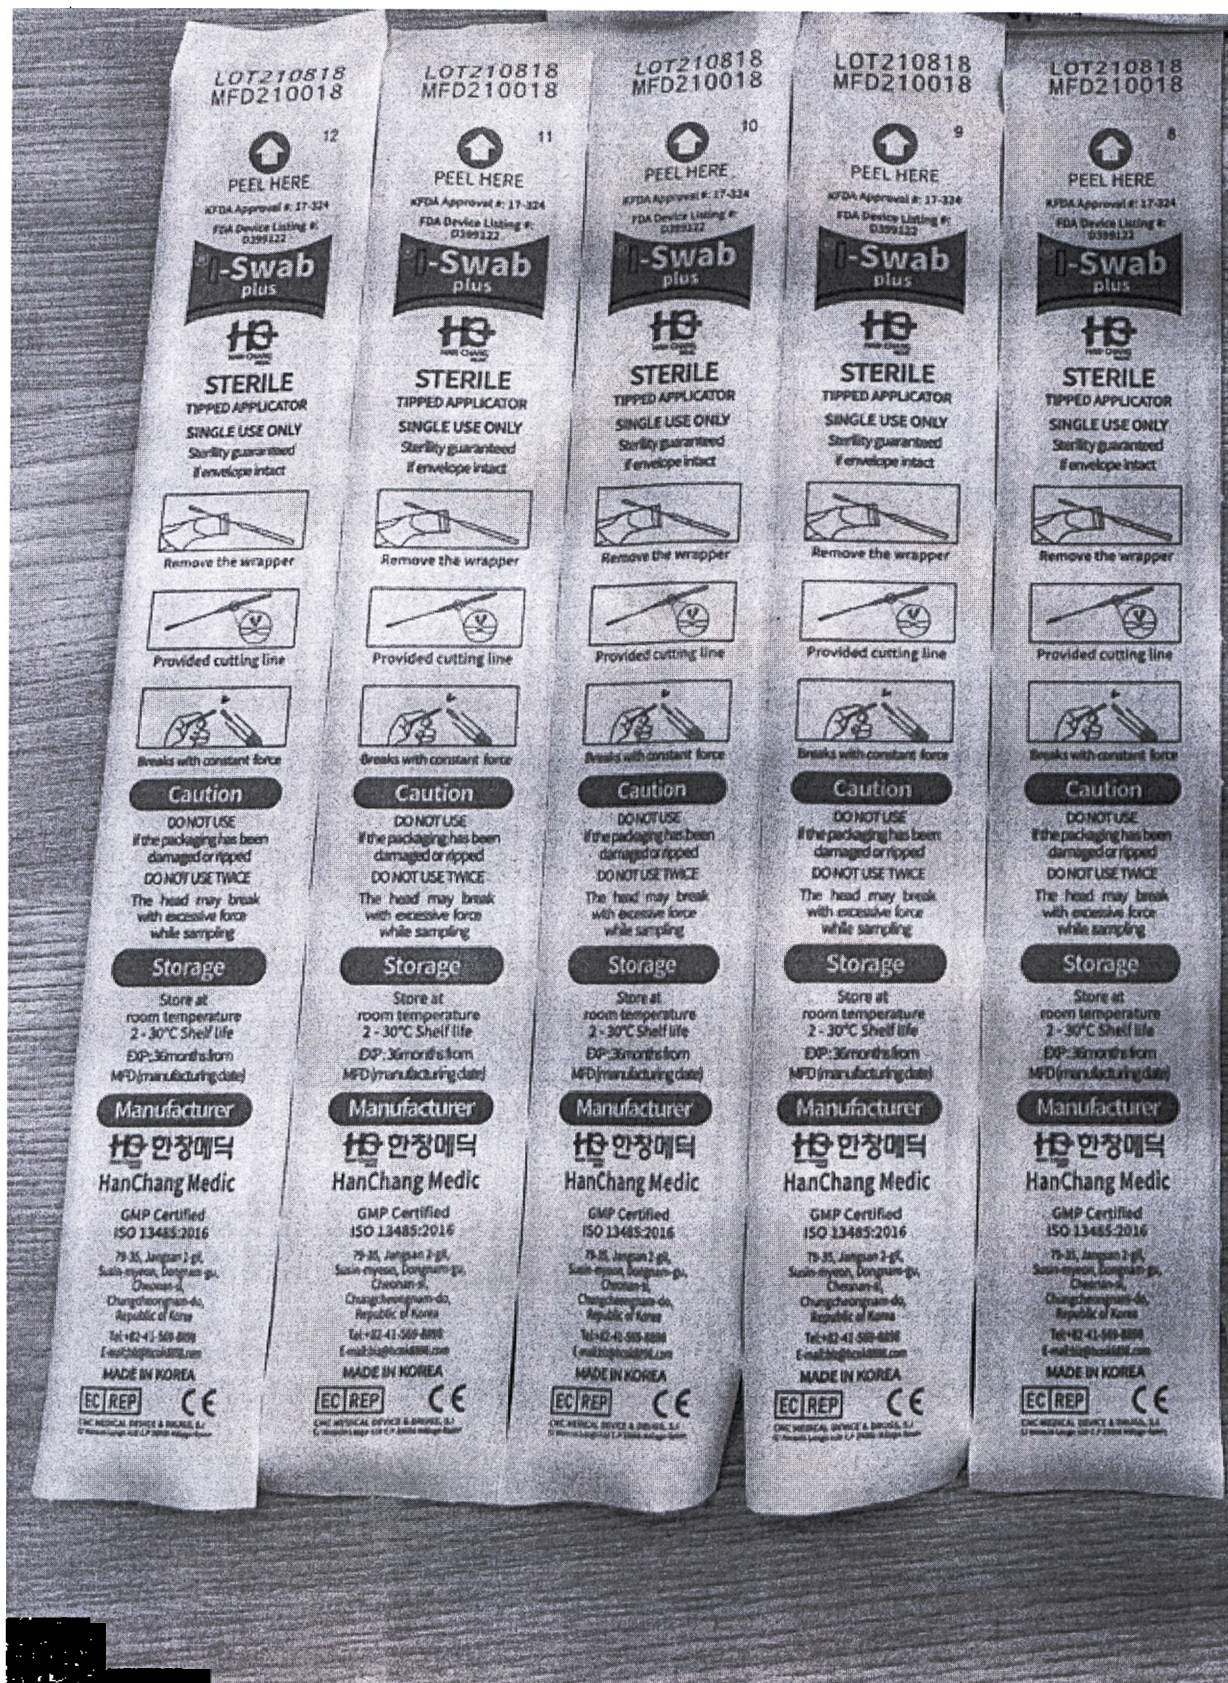


Фото 14. Стерильный тампон для взятия мазка - 5 шт. (в индивидуальной упаковке)



Фото 15. Стерильный тампон для взятия мазка (в индивидуальной упаковке)

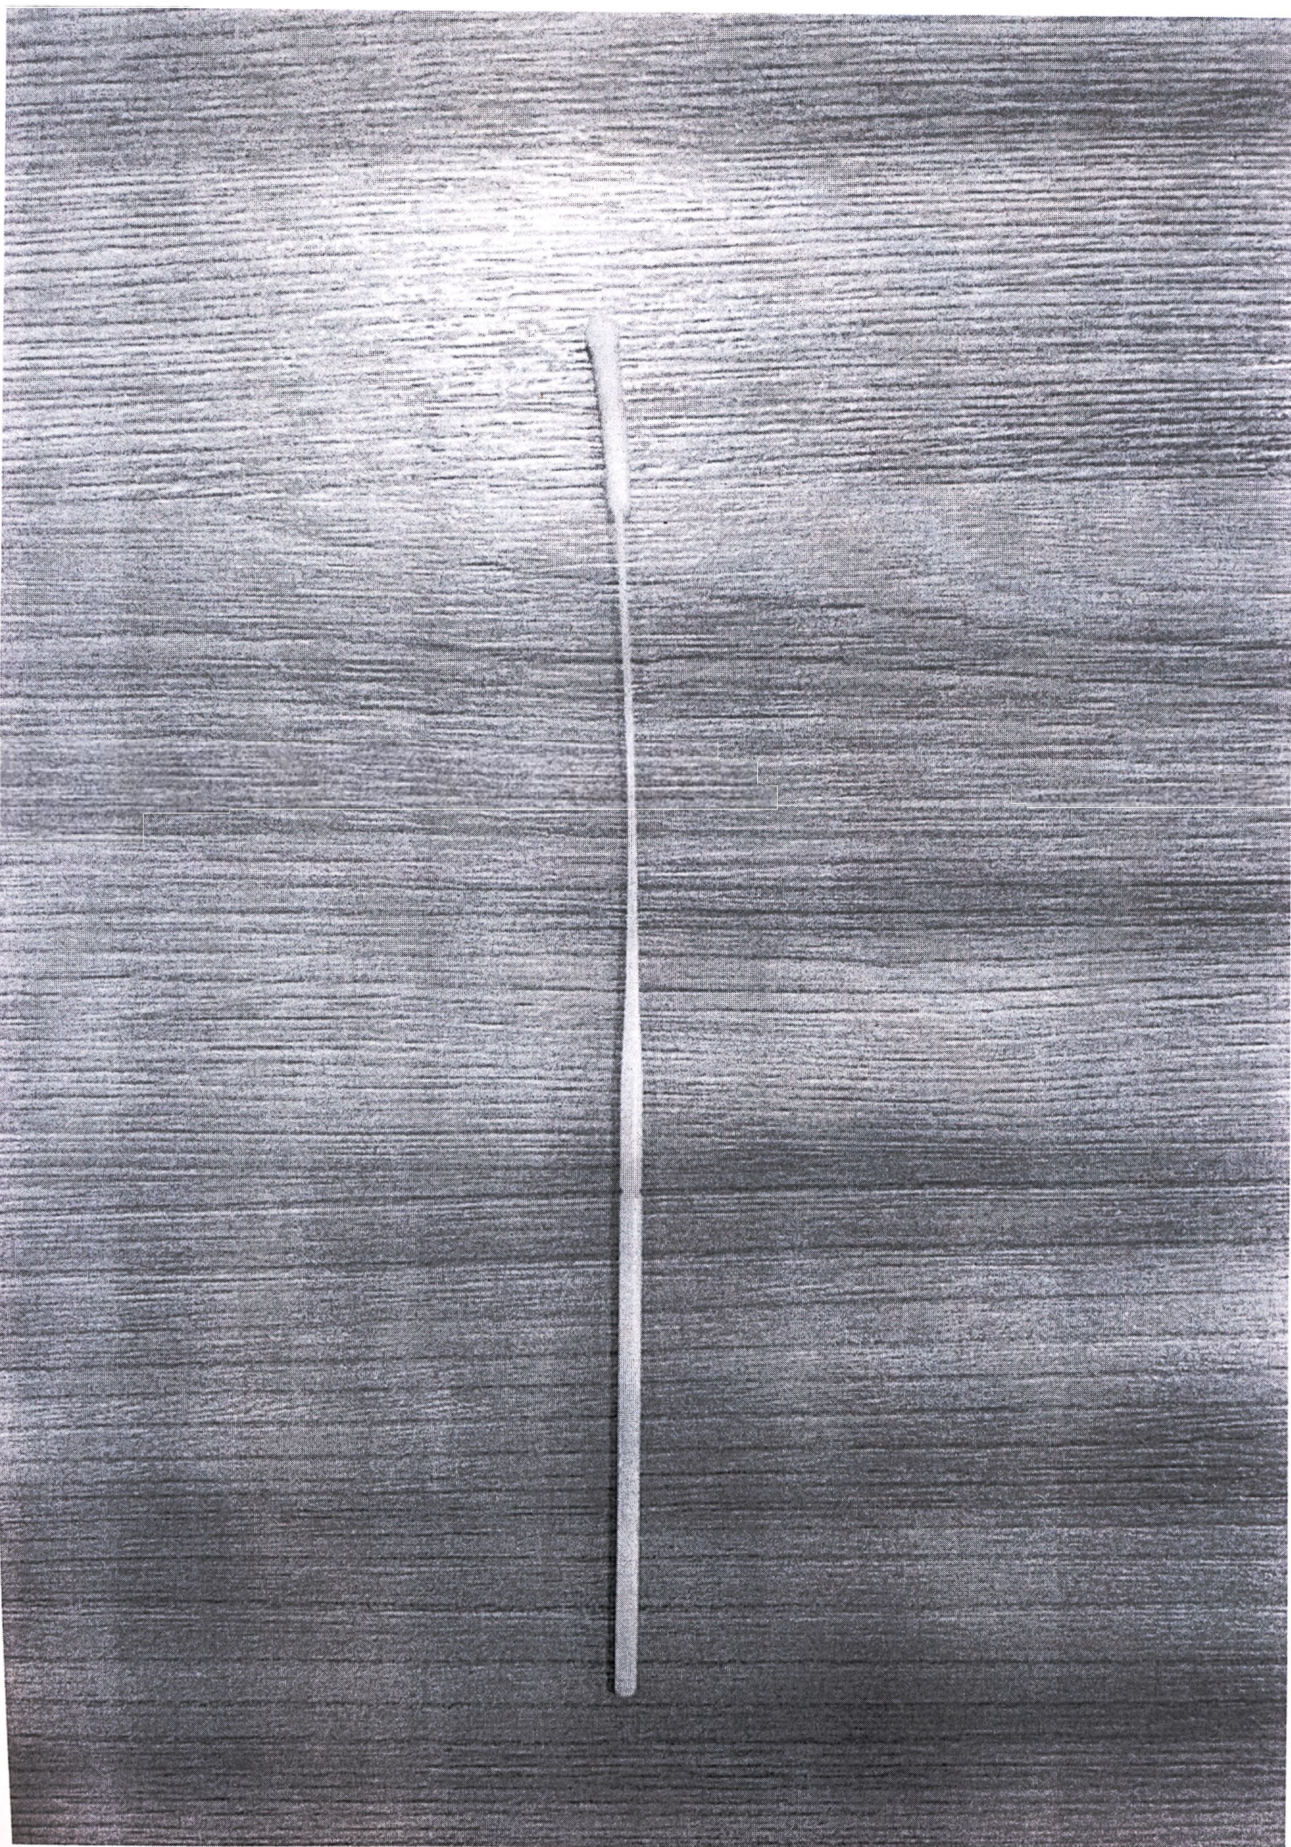


Фото 16. Стерильный тампон для взятия мазка

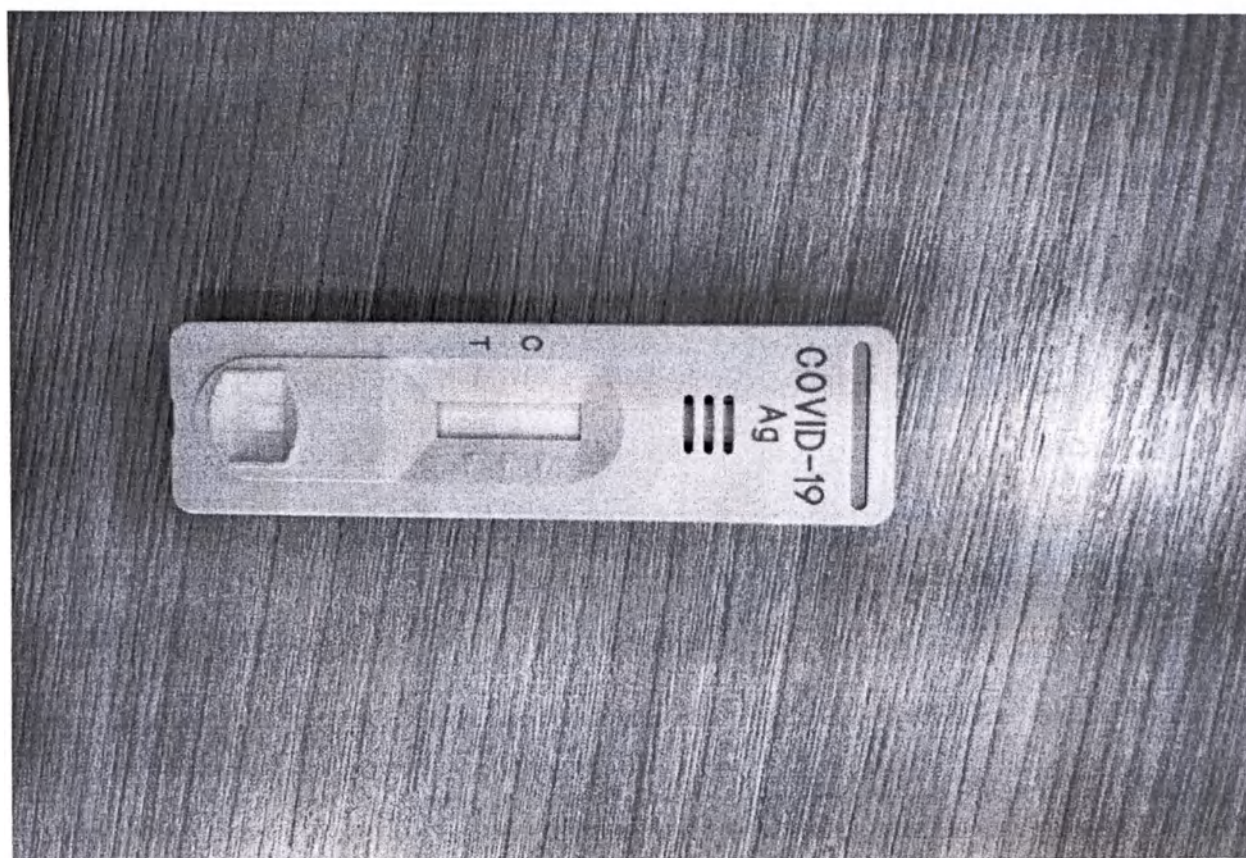
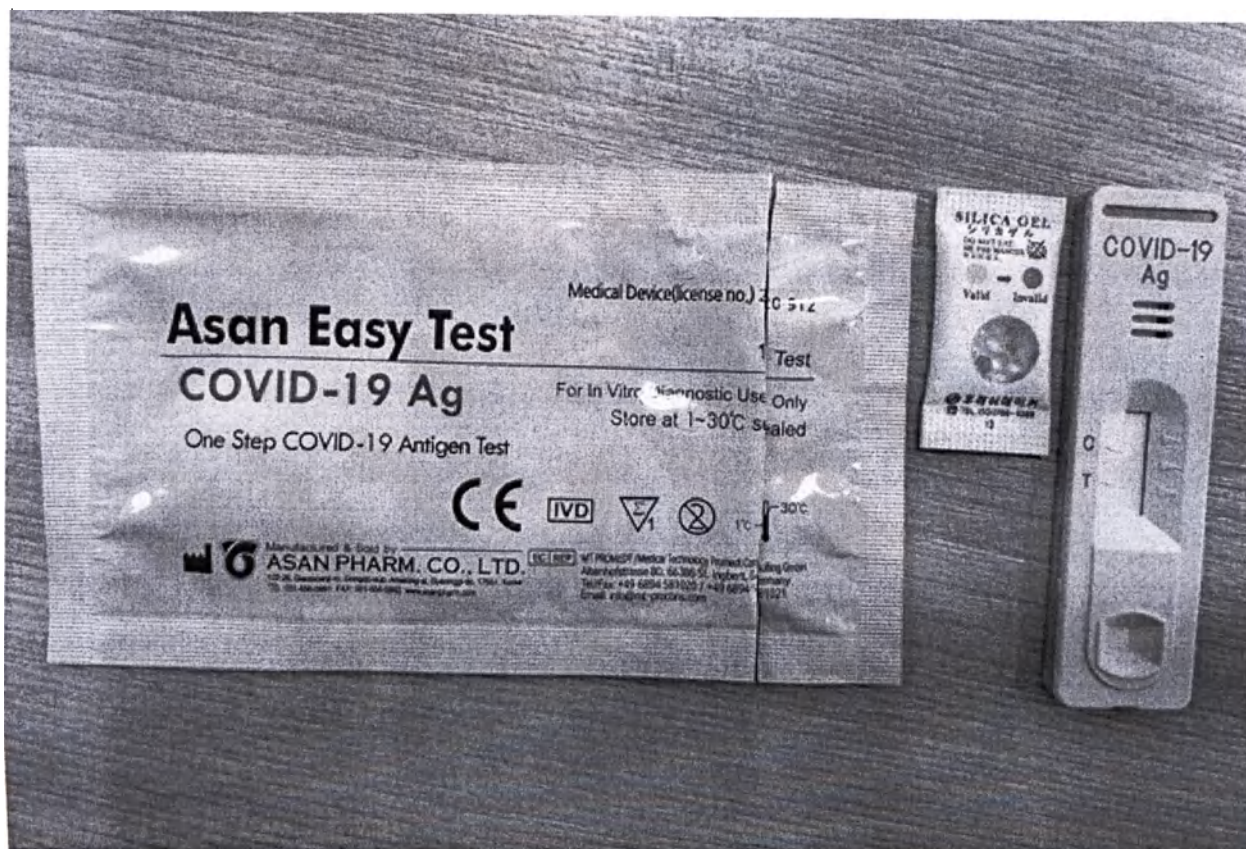


Фото 17. Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги)

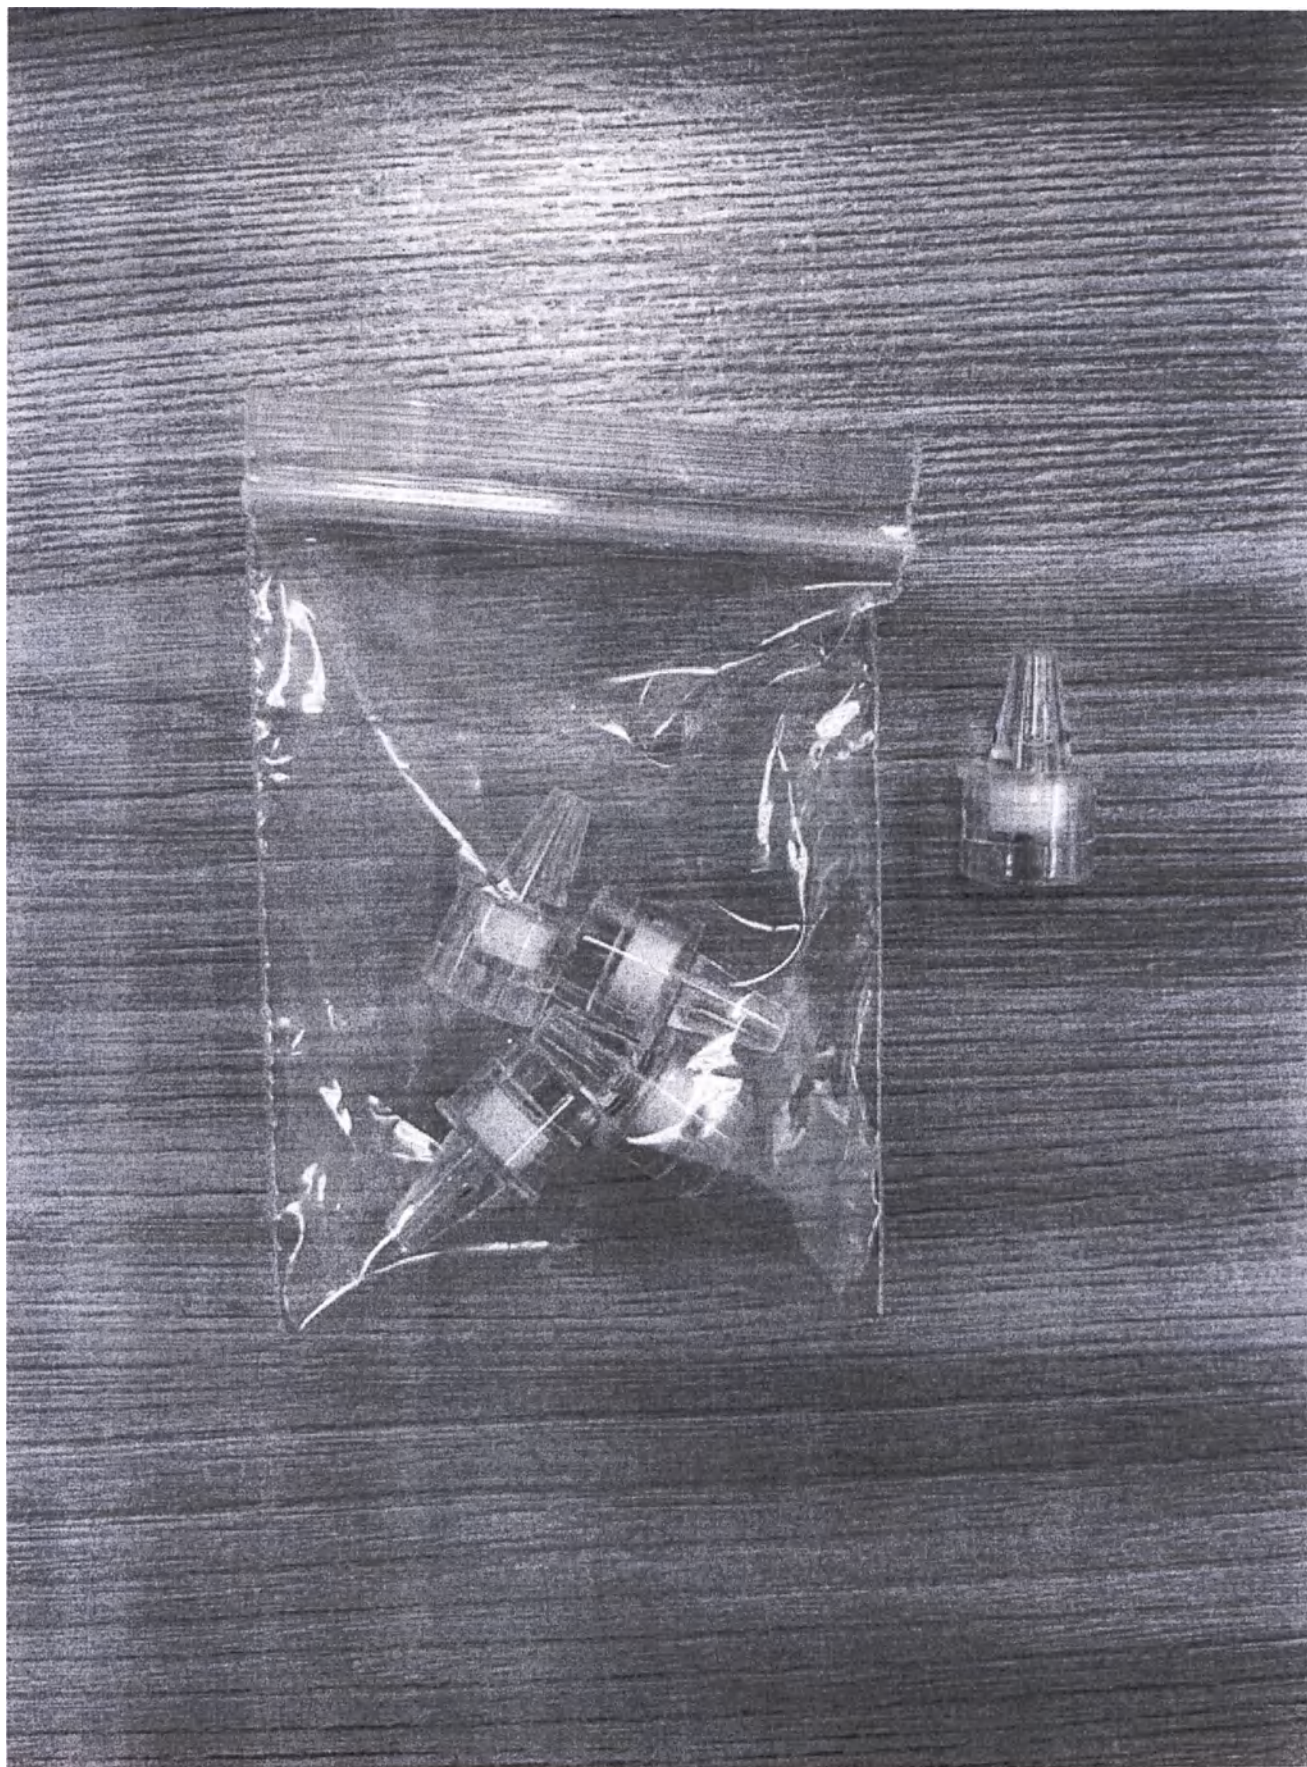


Фото 18. Насадка с капельницей к буферу - 5 шт.

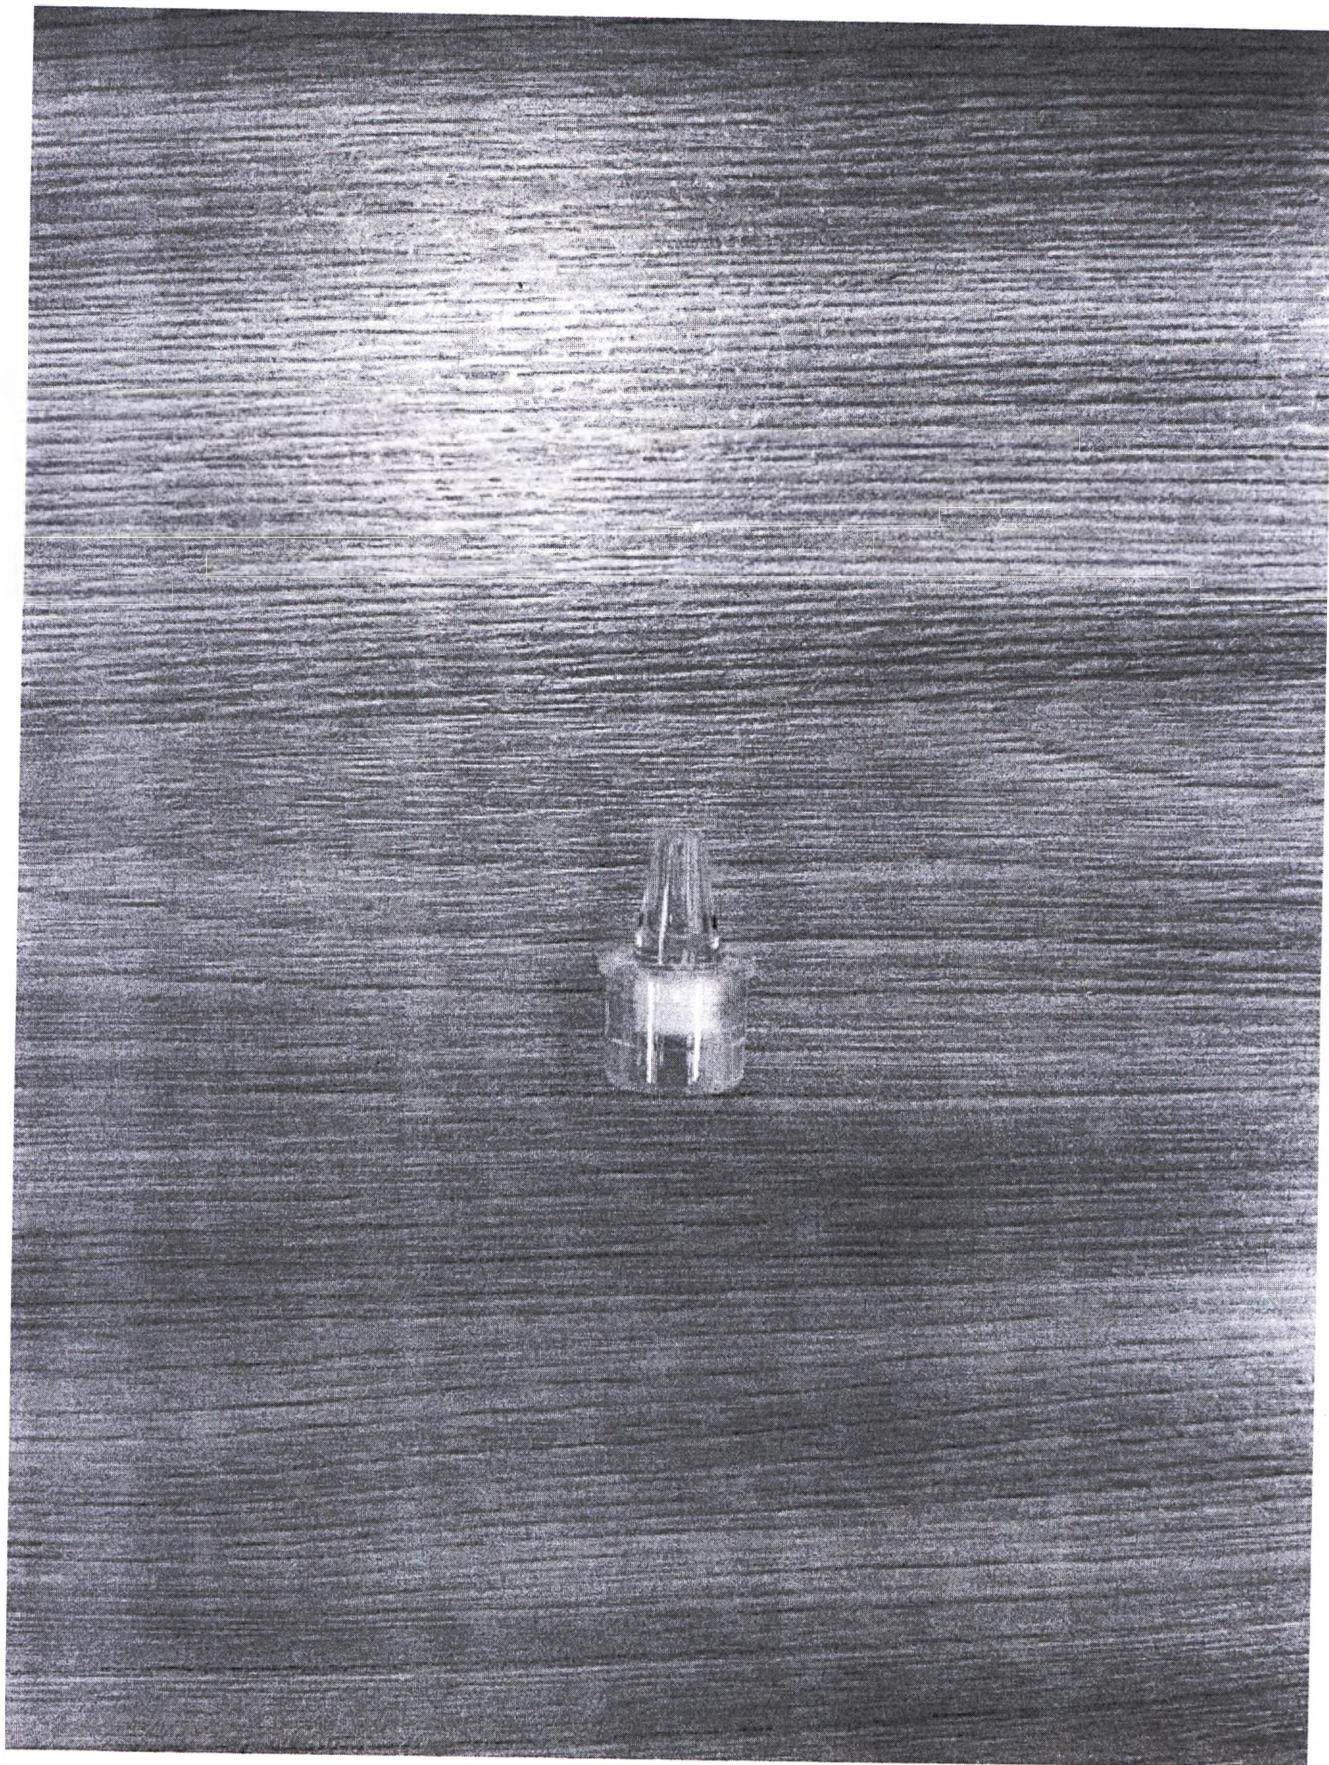


Фото 19. Насадка с капельницей к буферу



Фото 20. Пробирка с буфером для экстракции (0,35 мл) - 5 шт.

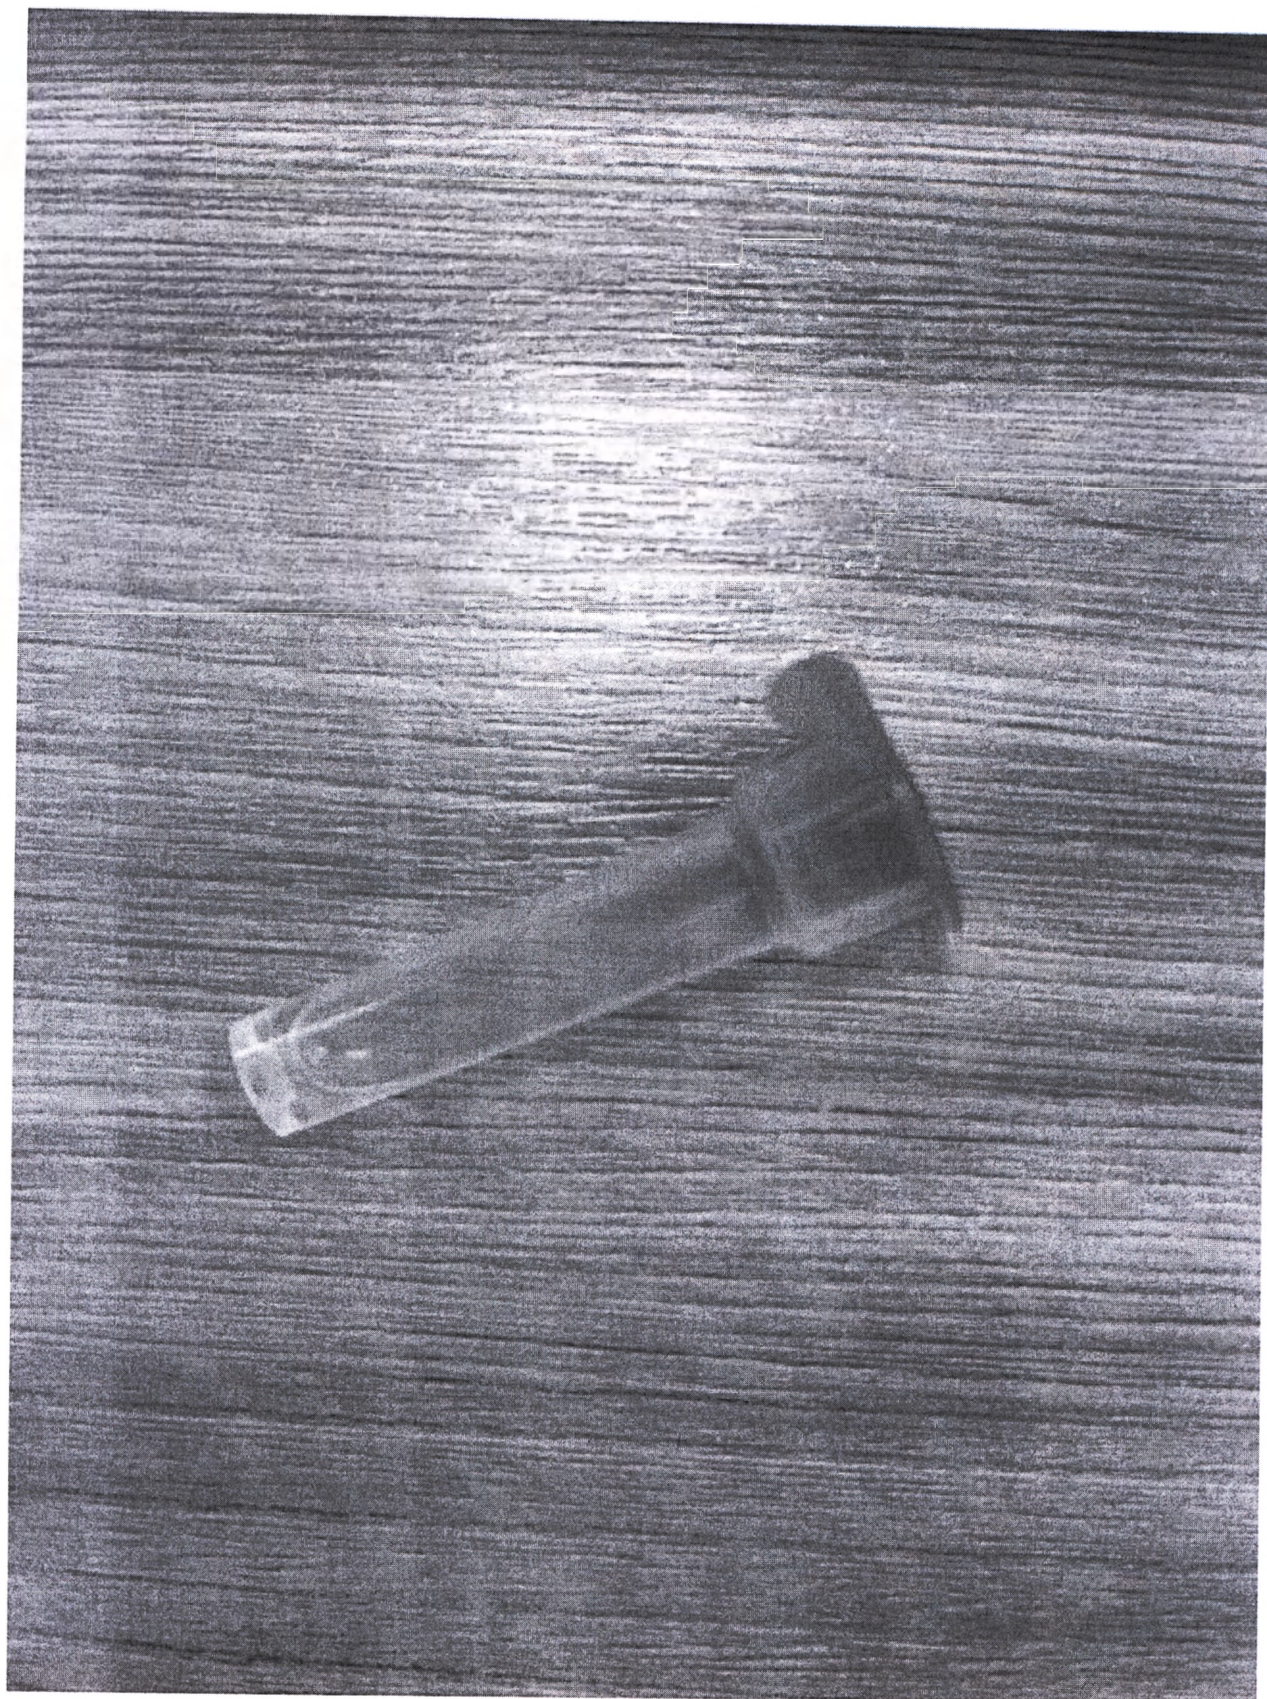


Фото 21. Пробирка с буфером для экстракции (0.35 мл)

Набор реагентов «Экспресс-тест для качественного определения антигена SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки человека иммунохроматографическим методом (Asan Easy Test COVID-19 Ag)». Вариант исполнения 3

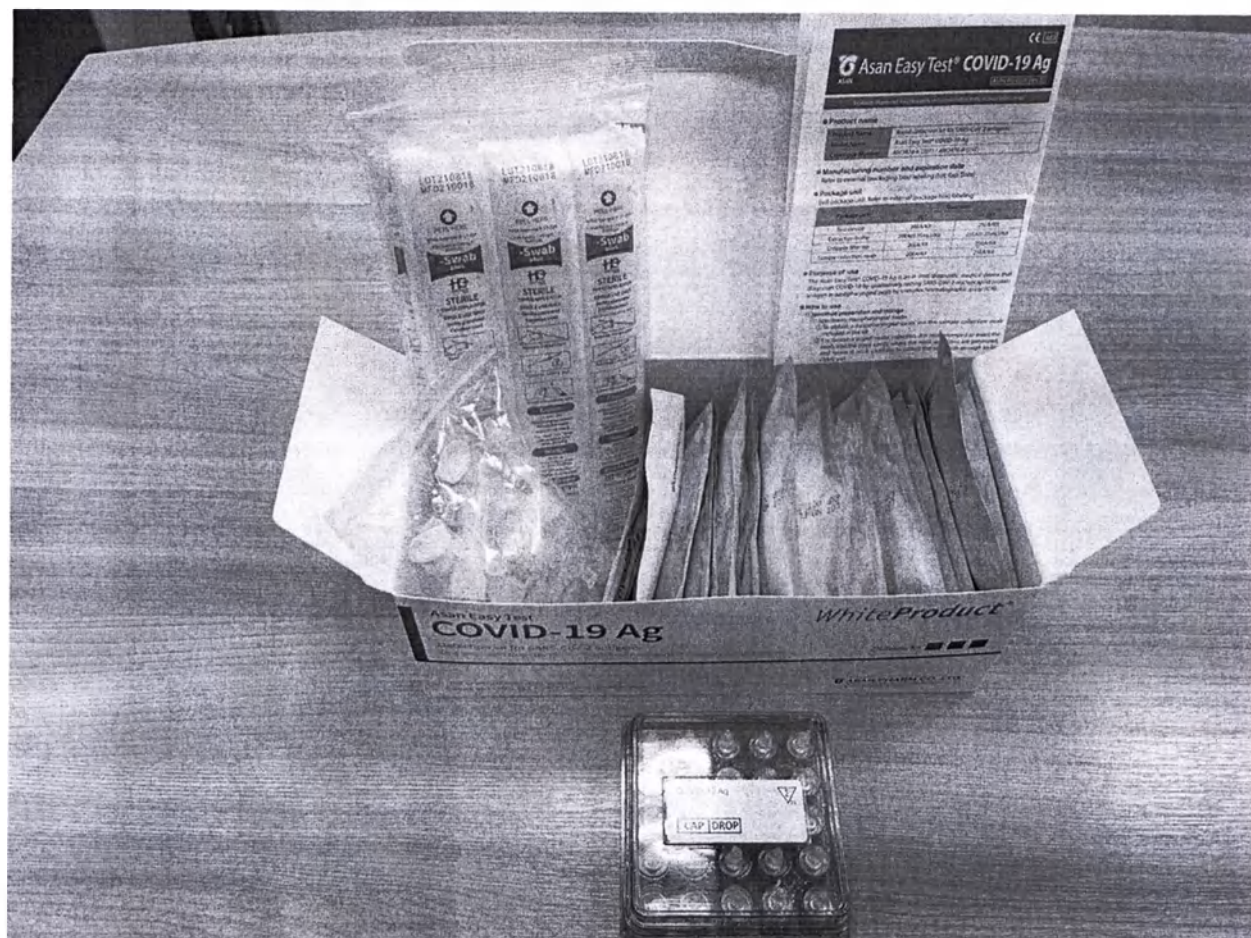


Фото 22. Набор реагентов «Экспресс-тест для качественного определения антигена SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки человека иммунохроматографическим методом (Asan Easy Test COVID-19 Ag)».

Вариант исполнения 3, в составе:

1. Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги) - 25 шт.
2. Пробирка с буфером для экстракции (0.35 мл) - 25 шт.
3. Насадка с капельницей к буферу - 25 шт.
4. Стерильный тампон для взятия мазка - 25 шт.
5. Инструкция по применению – 1 шт.

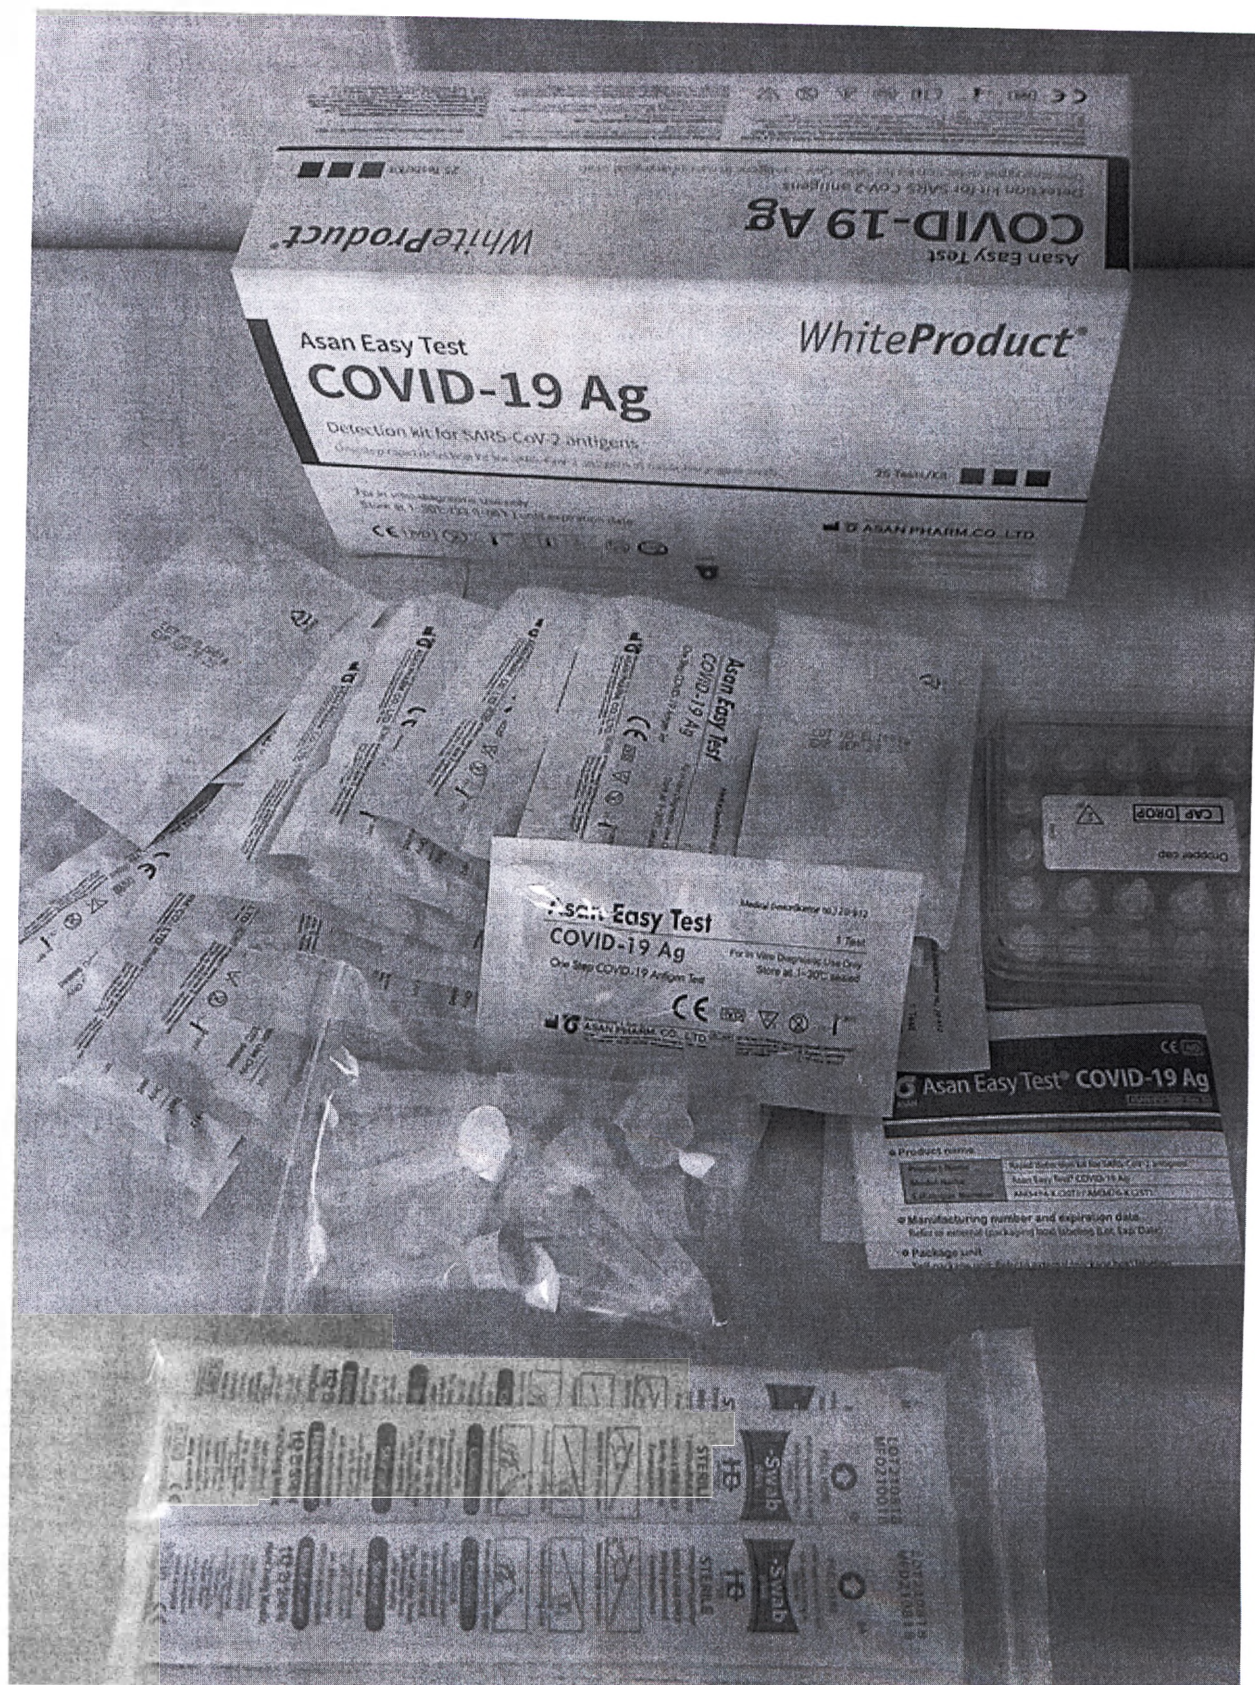


Фото 23. Набор реагентов «Экспресс-тест для качественного определения антигена SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки человека иммунохроматографическим методом (Asan Easy Test COVID-19 Ag)».

Вариант исполнения 3, в составе:

1. Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги) - 25 шт.
2. Пробирка с буфером для экстракции (0.35 мл) - 25 шт.
3. Насадка с капельницей к буферу - 25 шт.
4. Стерильный тампон для взятия мазка - 25 шт.
5. Инструкция по применению – 1 шт.

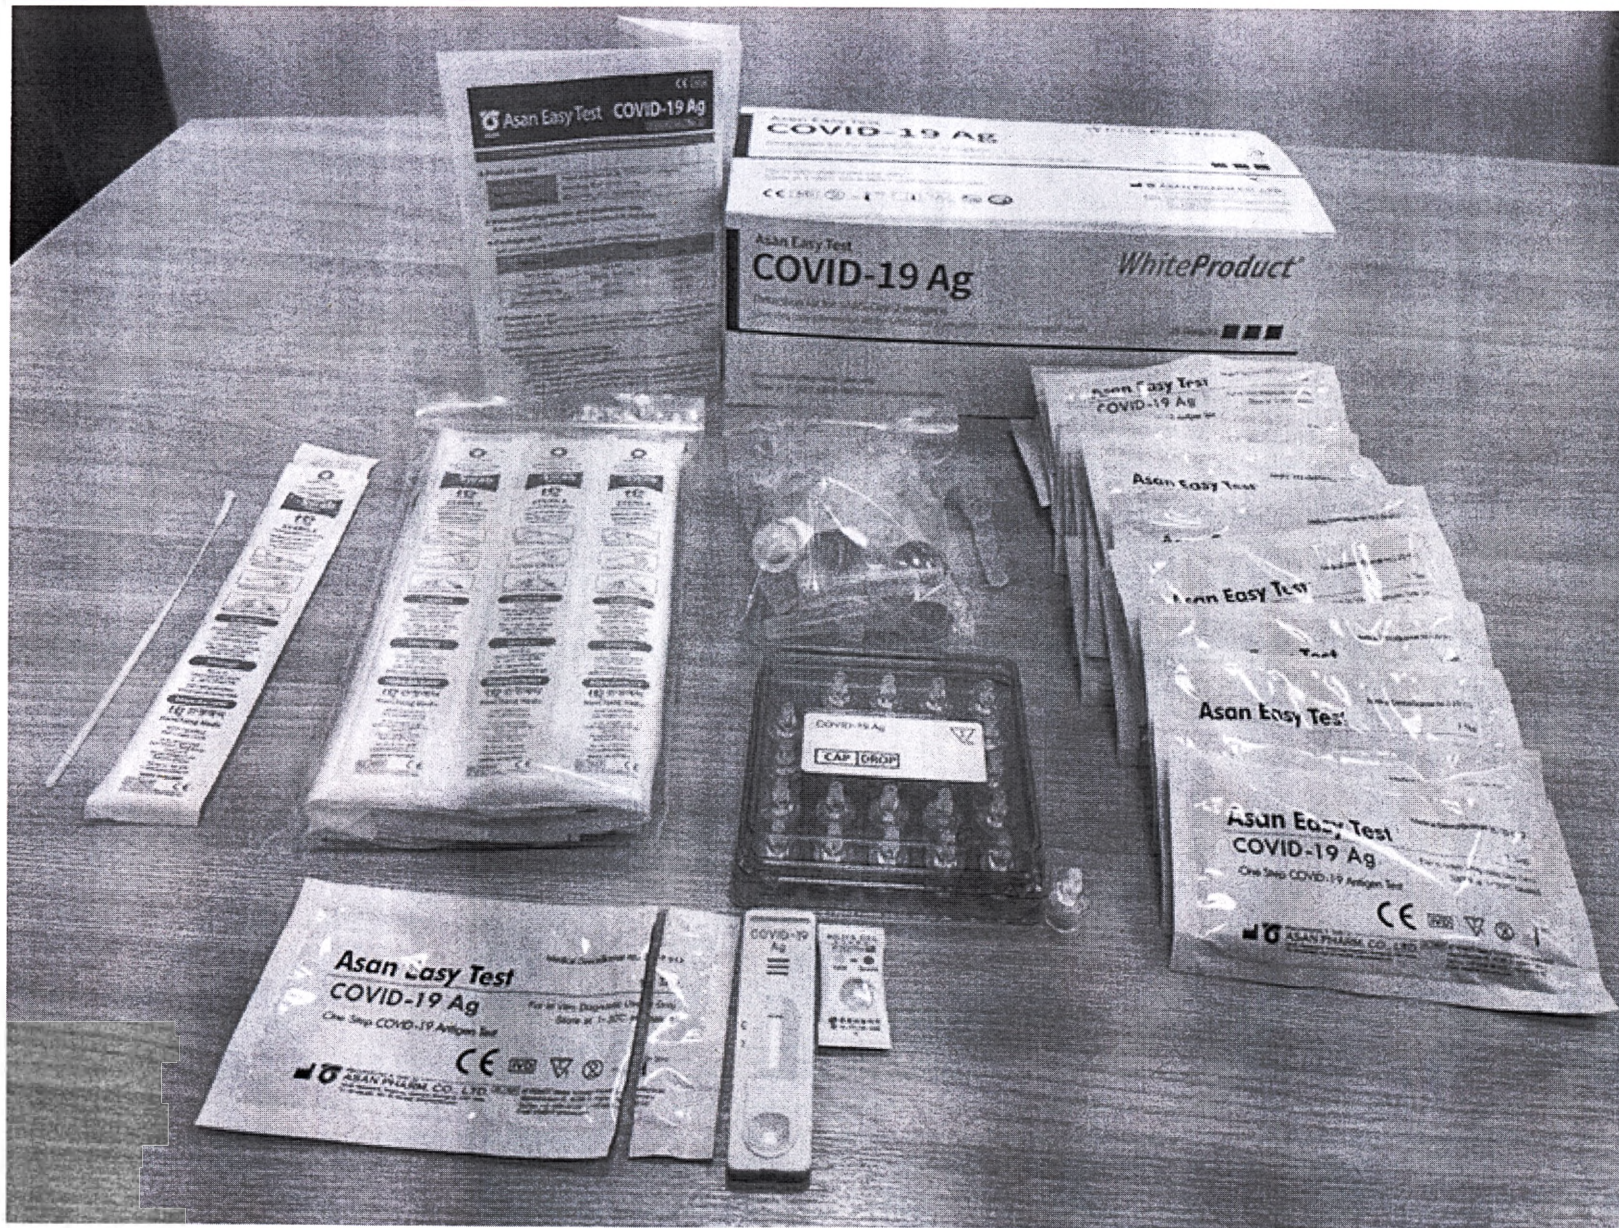


Фото 24. Набор реагентов «Экспресс-тест для качественного определения антигена SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки человека иммунохроматографическим методом (Asan Easy Test COVID-19 Ag)». Вариант исполнения 3



Фото 25. Стерильный тампон для взятия мазка - 25 шт (в упаковке)

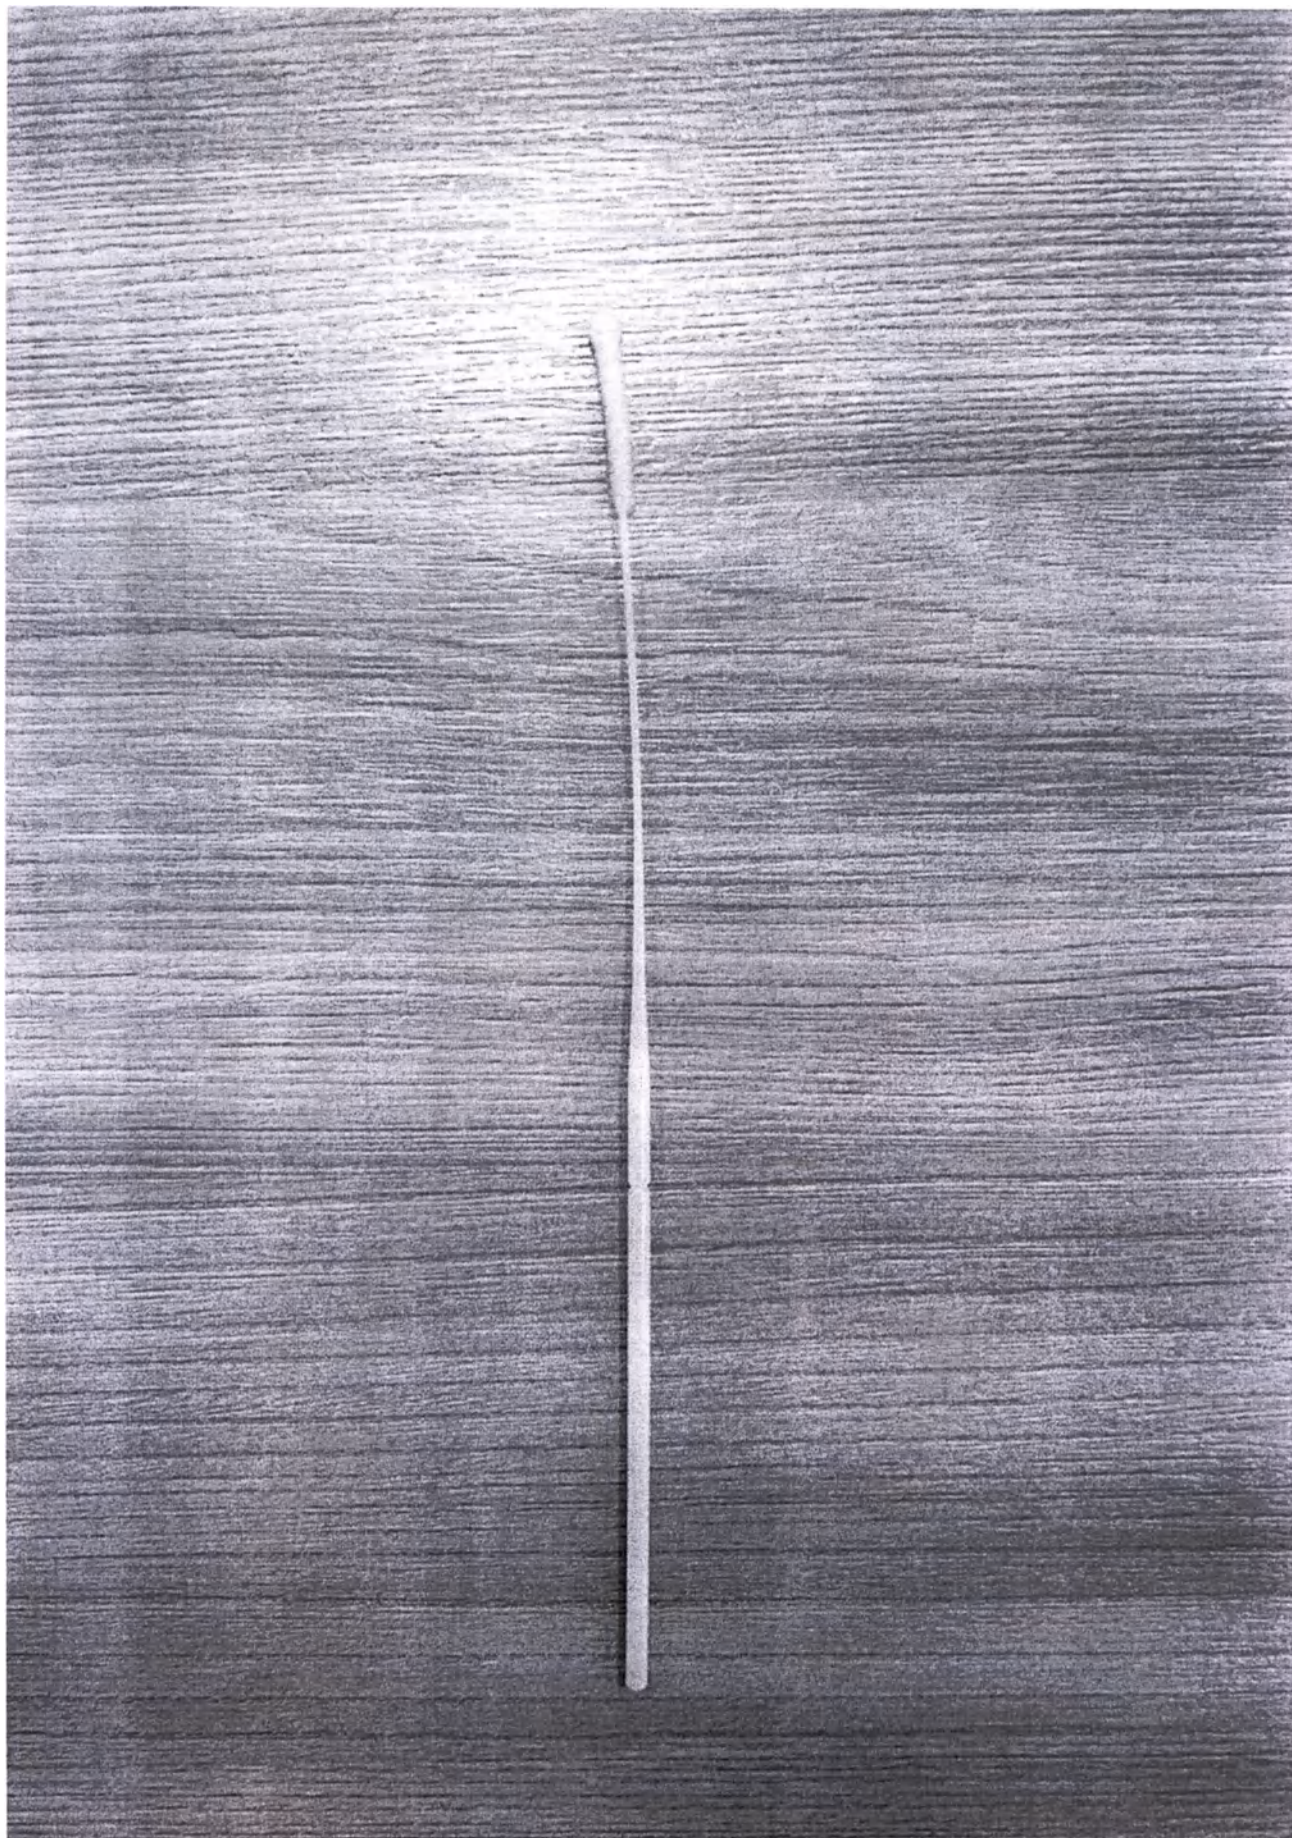


Фото 26. Стерильный тампон для взятия мазка



Фото 27. Насадка с капельницей к буферу - 25 шт. (в групповой упаковке)

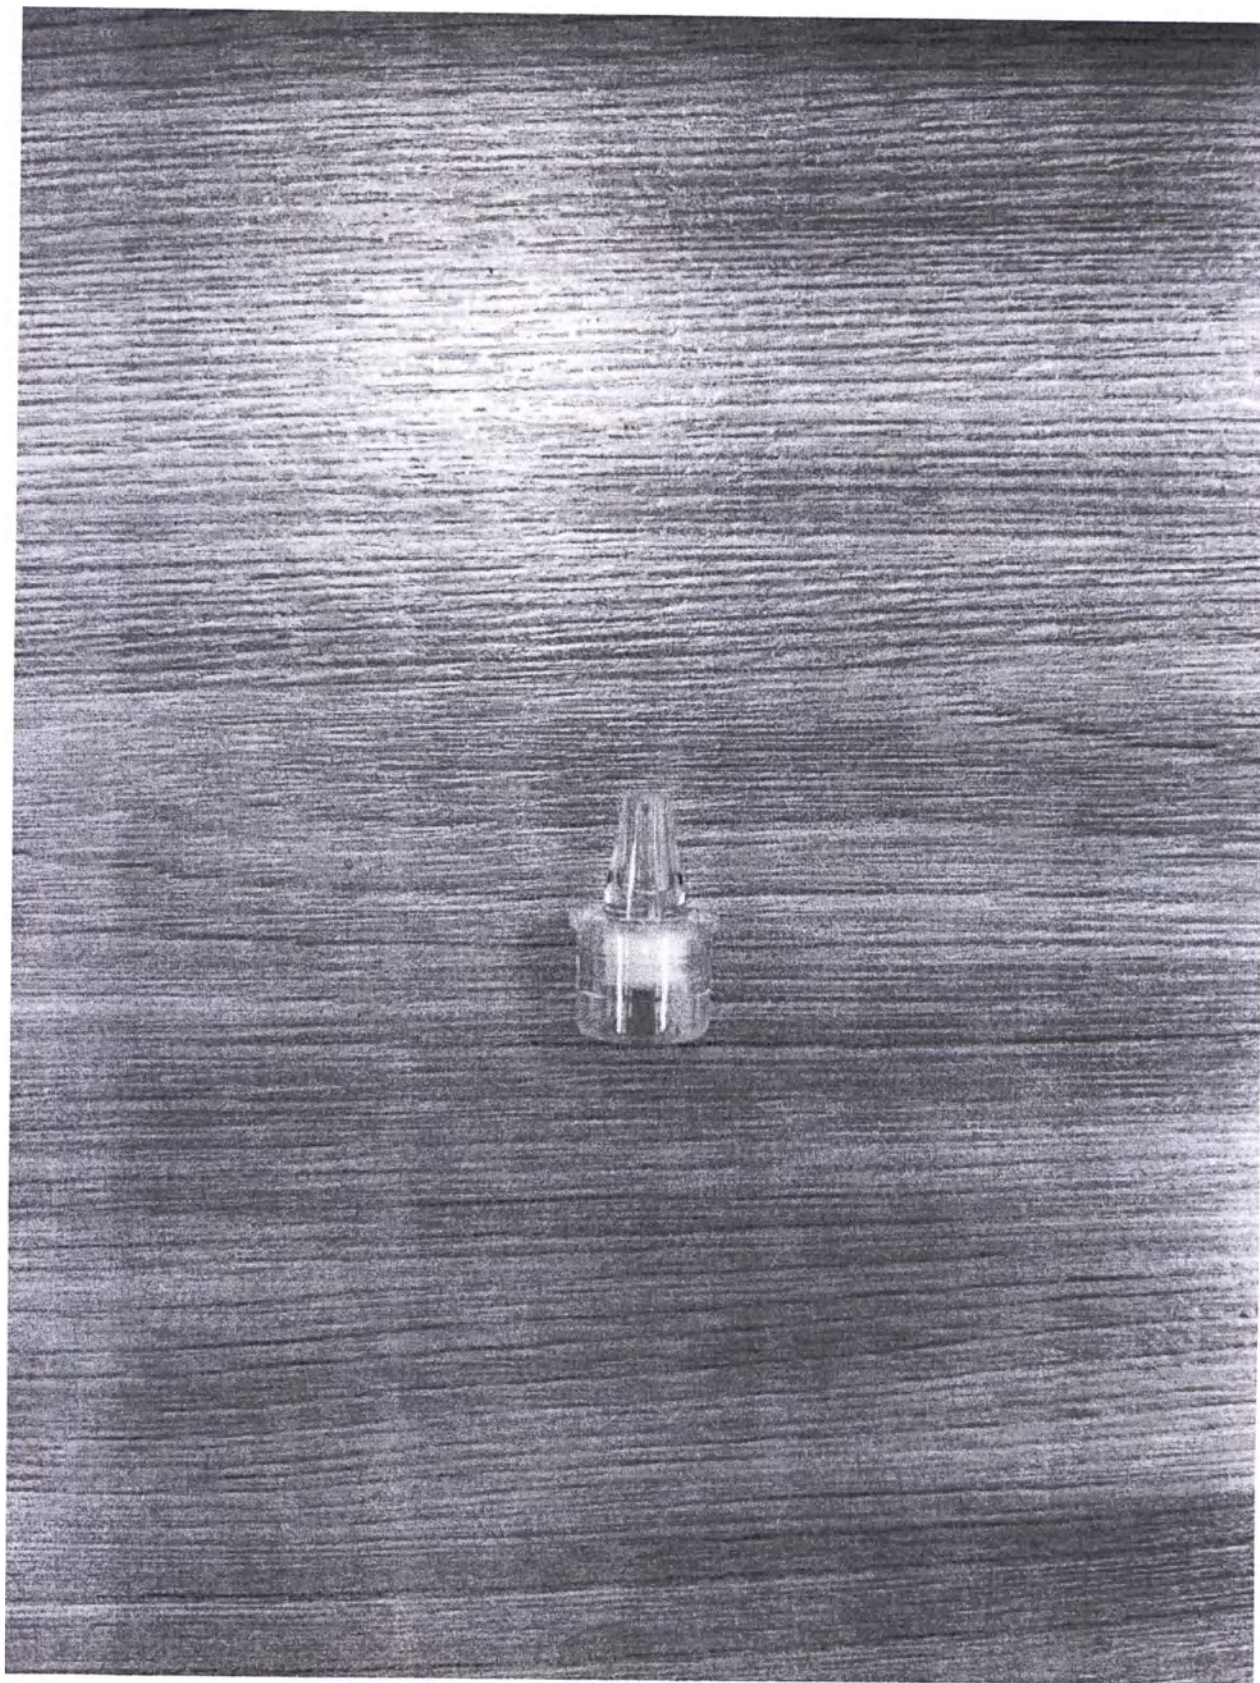


Фото 28. Насадка с капельницей к буферу

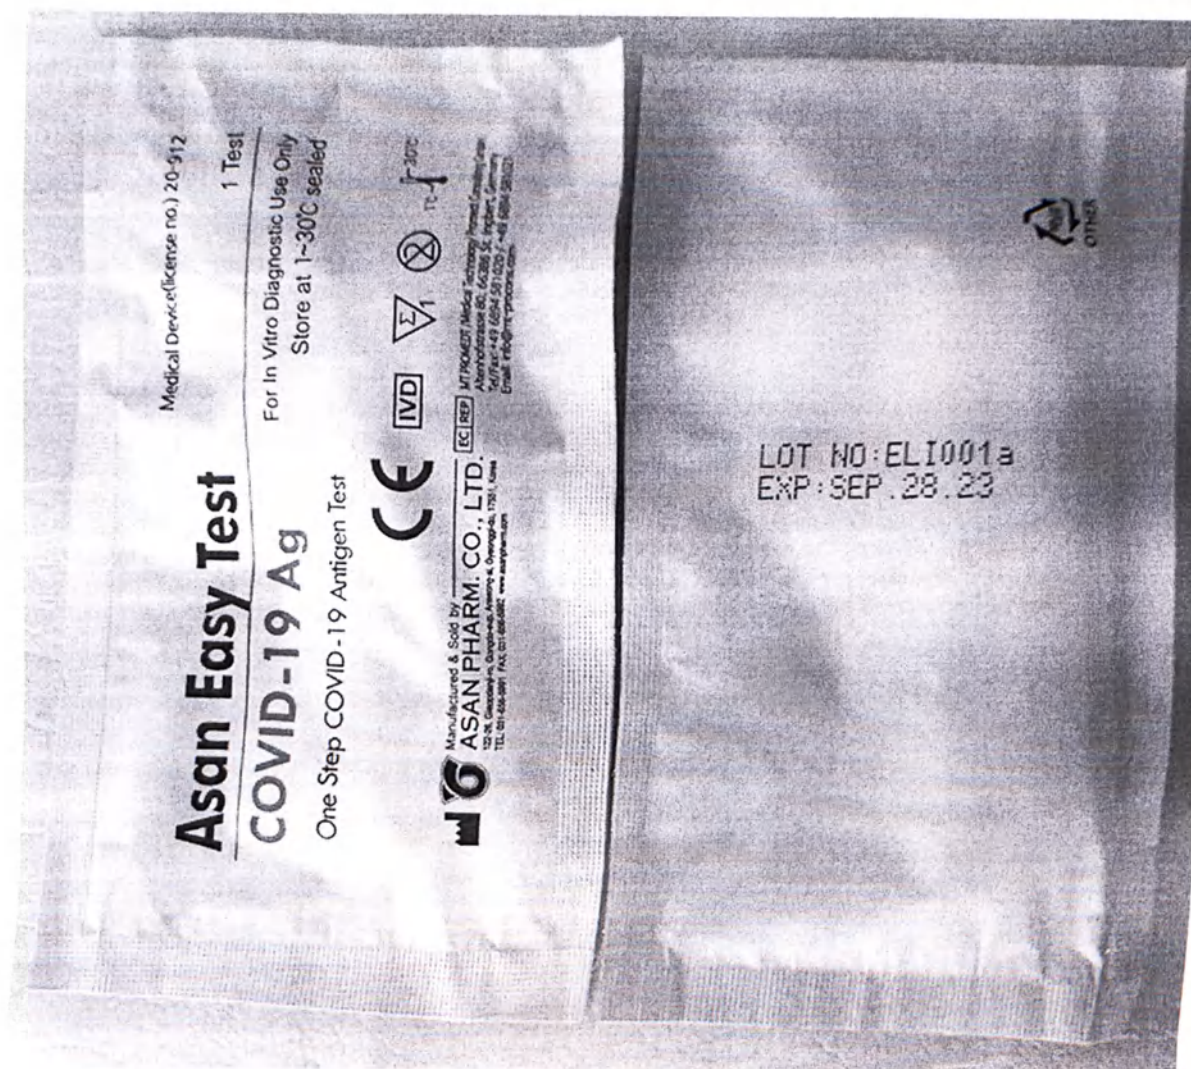
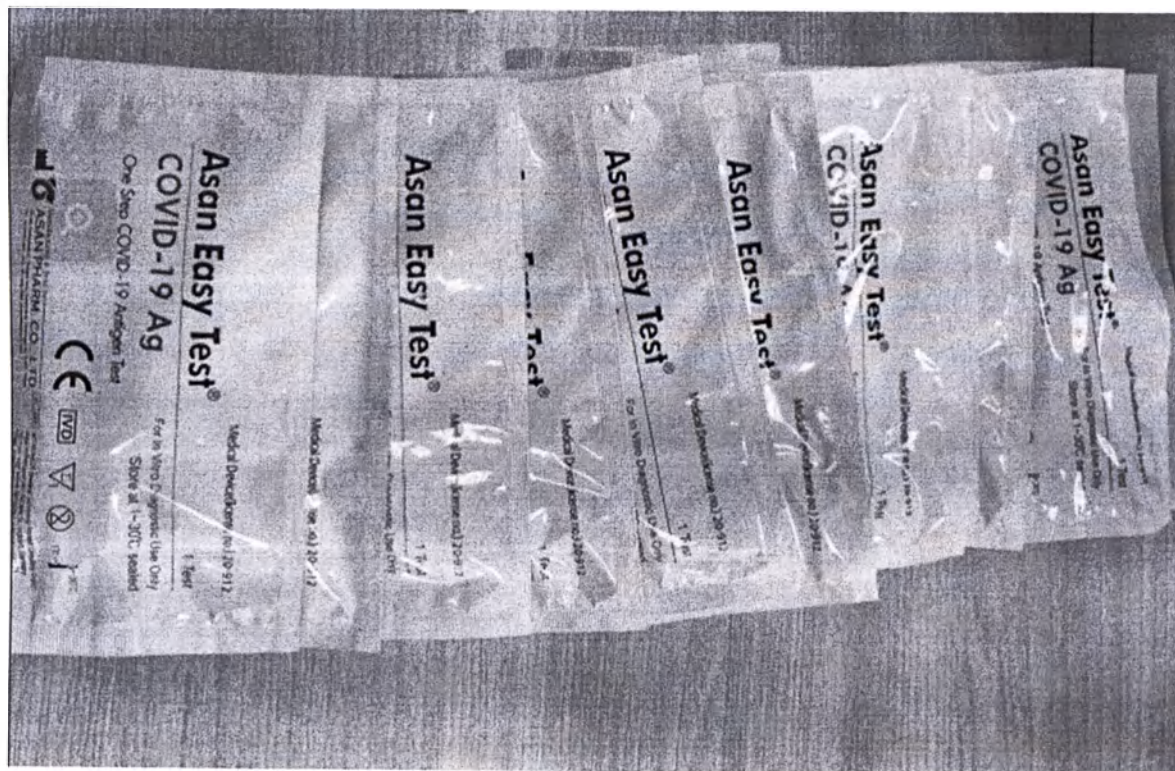


Фото 29. Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги) - 25 шт.

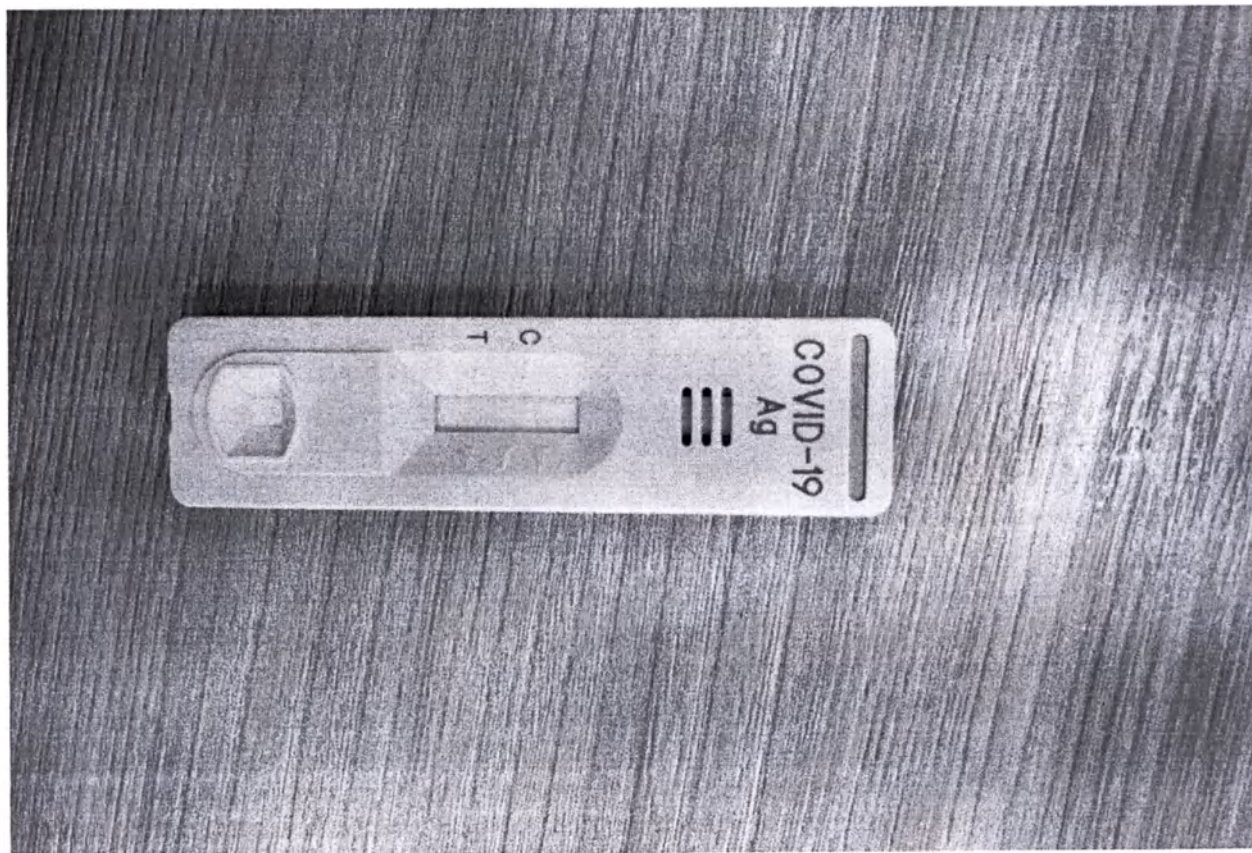


Фото 30. Тестовая кассета

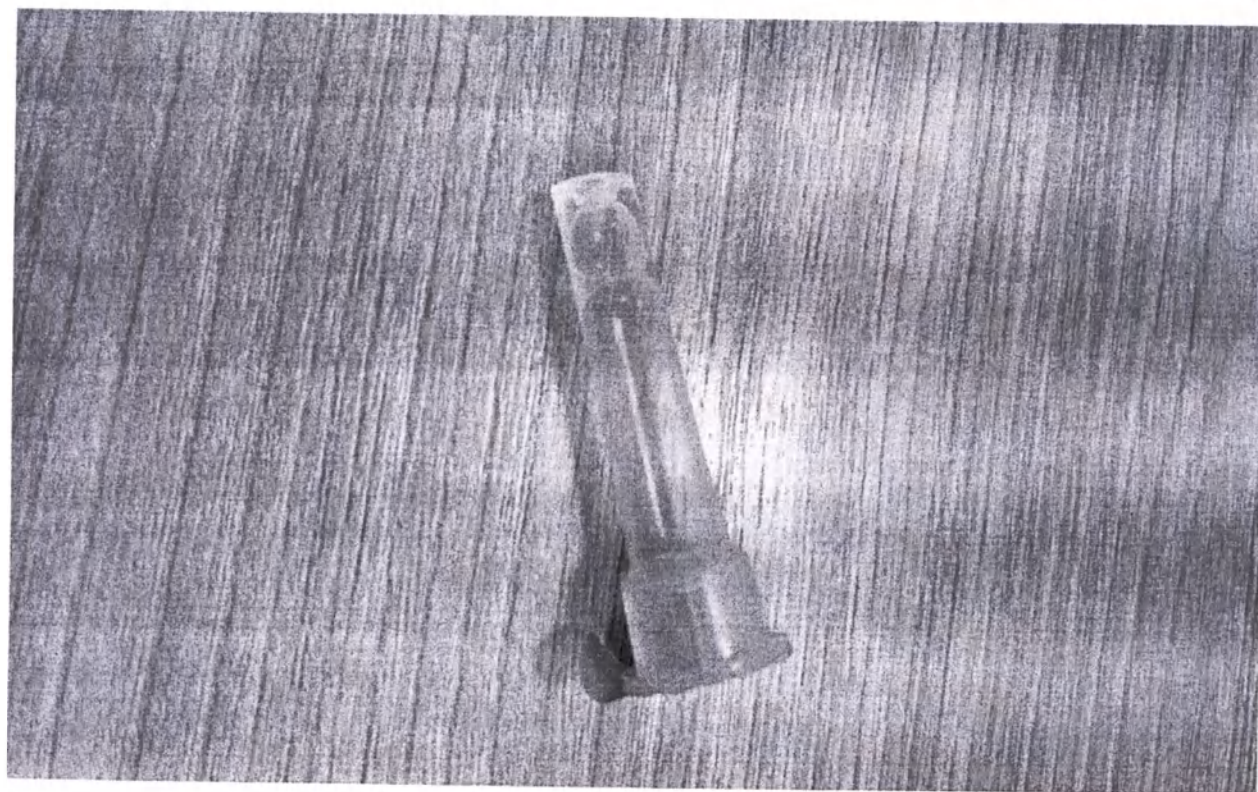


Фото 31. Пробирка с буфером для экстракции (0.35 мл) - 25 шт.

Приложение (справочное)

Варианты исполнения и состав медицинского изделия

Набор реагентов «Экспресс-тест для качественного определения антигена SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки человека иммунохроматографическим методом (Asan Easy Test COVID-19 Ag)», варианты исполнения:

I. Вариант исполнения 1, в составе:

1. Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги) - 1 шт.
2. Пробирка с буфером для экстракции (0.35 мл) - 1 шт.
3. Насадка с капельницей к буферу - 1 шт.
4. Стерильный тампон для взятия мазка - 1 шт.
5. Инструкция по применению – 1 шт.

II. Вариант исполнения 2, в составе:

1. Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги) - 5 шт.
2. Пробирка с буфером для экстракции (0.35 мл) - 5 шт.
3. Насадка с капельницей к буферу - 5 шт.
4. Стерильный тампон для взятия мазка - 5 шт.
5. Инструкция по применению – 1 шт.

III. Вариант исполнения 3, в составе:

1. Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги) - 25 шт.
2. Пробирка с буфером для экстракции (0.35 мл) - 25 шт.
3. Насадка с капельницей к буферу - 25 шт.
4. Стерильный тампон для взятия мазка - 25 шт.
5. Инструкция по применению – 1 шт.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

32 (Видеочать два) листов
цифрами прописью

Должность

Подпись

«10 декабря 2021 г.

М.П.

