


УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ЦКТ»



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:


**Морозильник медицинский лабораторный ультранизкотемпературный серии «U»
для хранения компонентов крови и плазмы крови, человеческих клеток, тканей и
других лабораторных образцов, в вариантах исполнения**

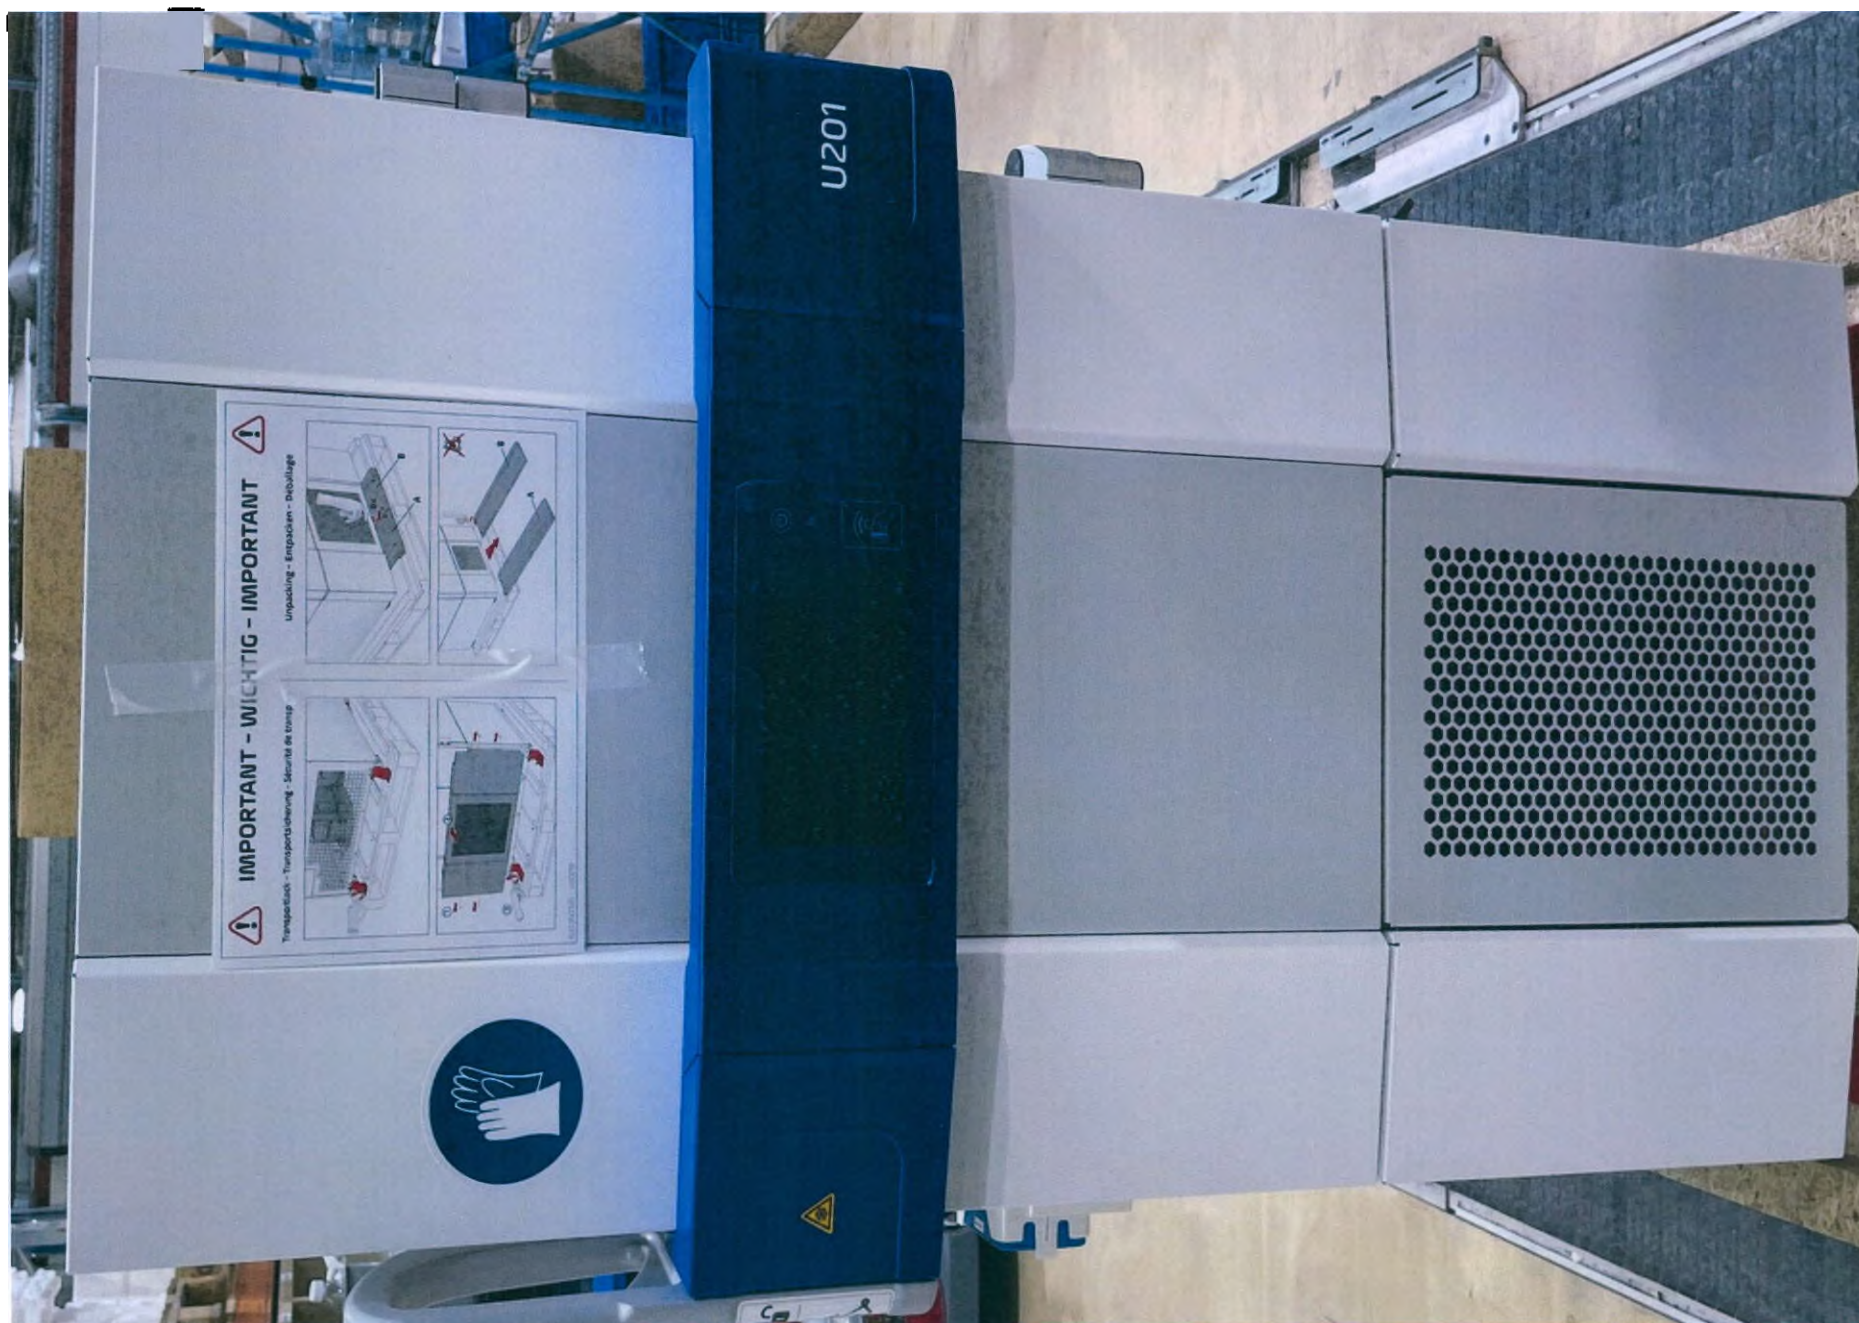


Морозильник медицинский ультранизкотемпературный для хранения компонентов крови и плазмы крови, человеческих клеток, тканей и других лабораторных образцов U201



Морозильник медицинский ультранизкотемпературный для хранения компонентов крови и плазмы крови, человеческих клеток, тканей и других лабораторных образцов U401

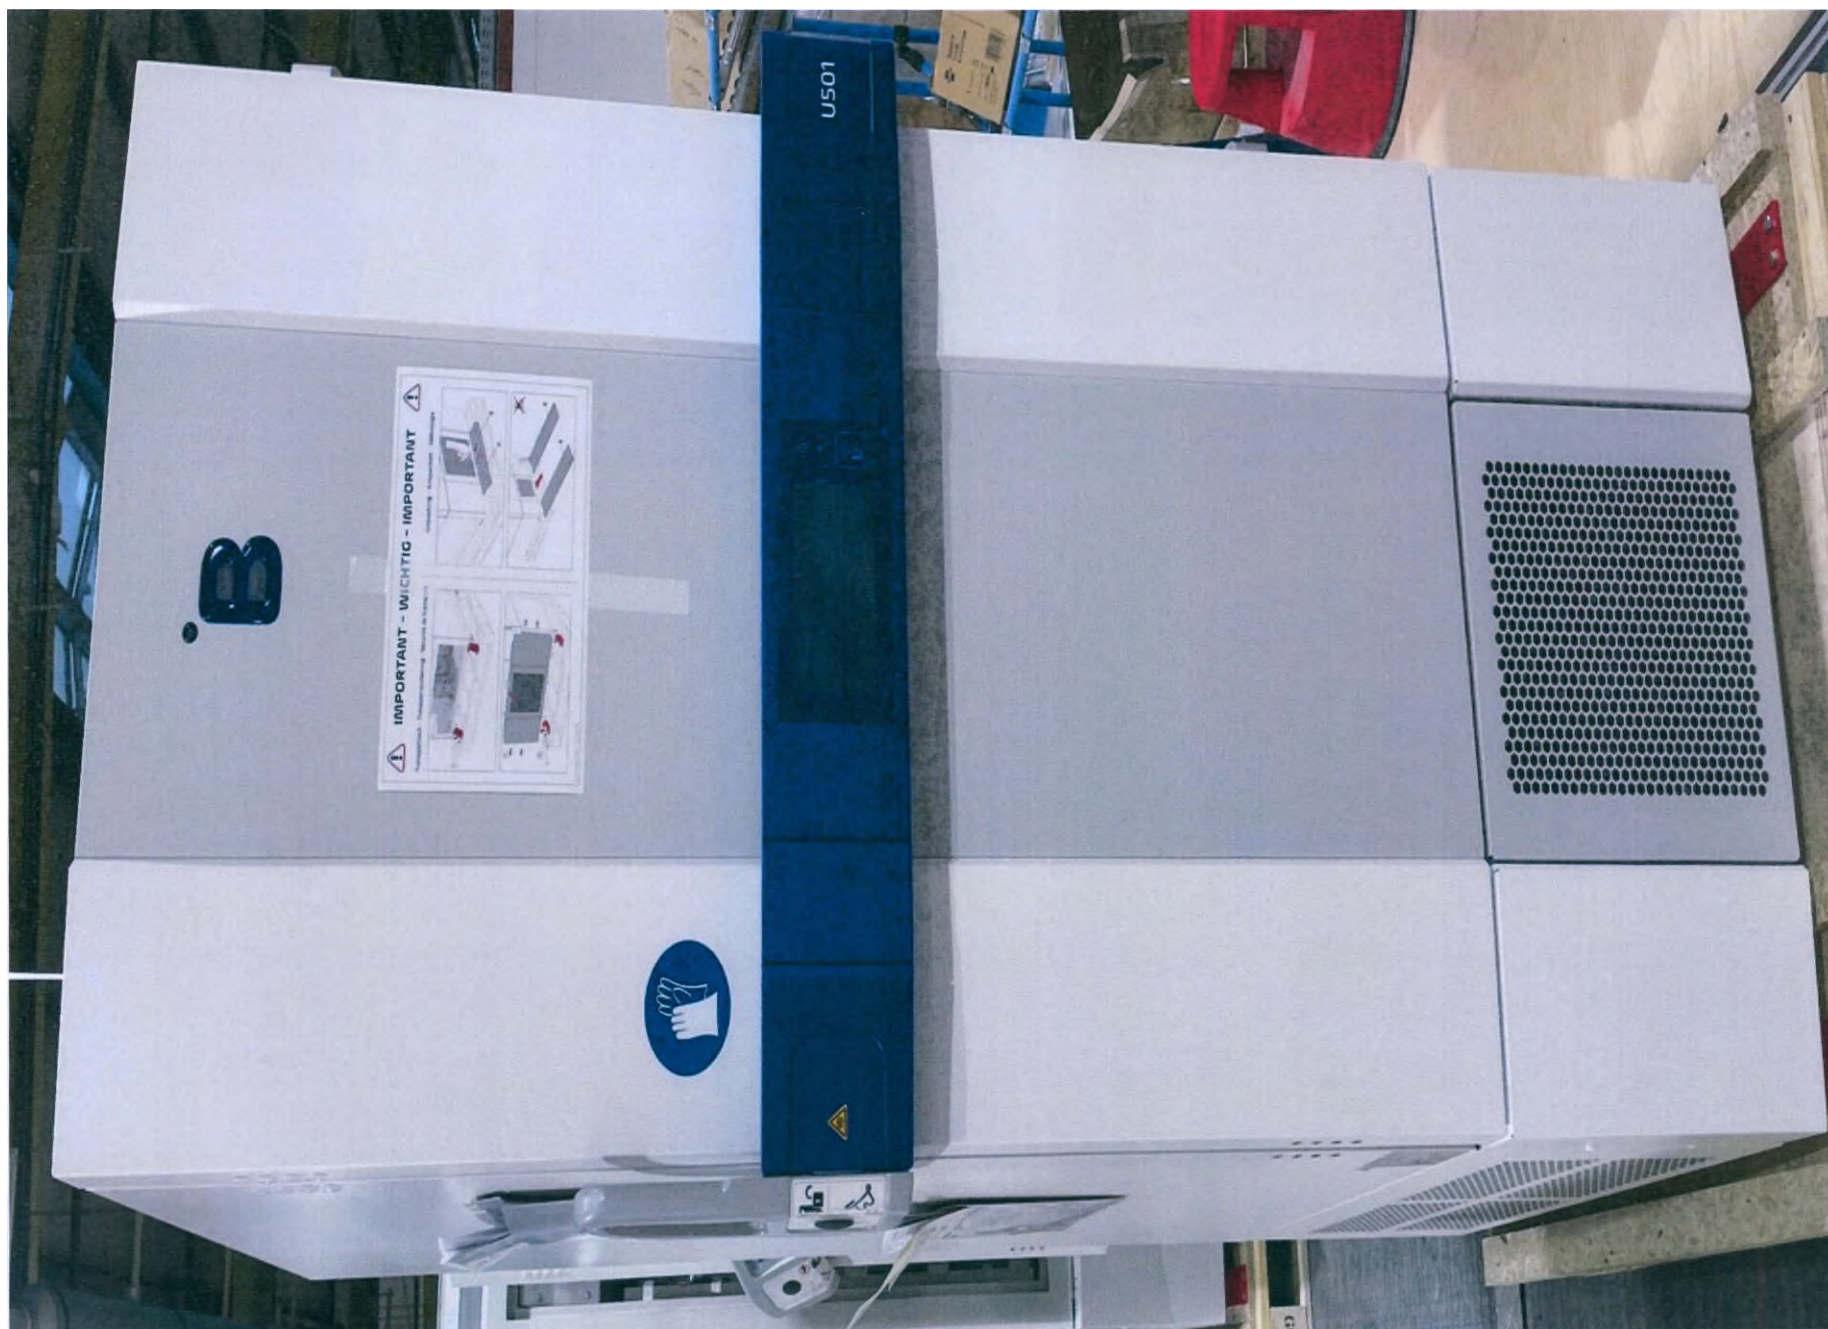


Морозильник медицинский ультранизкотемпературный для хранения компонентов крови и плазмы крови, человеческих клеток, тканей и других лабораторных образцов U501

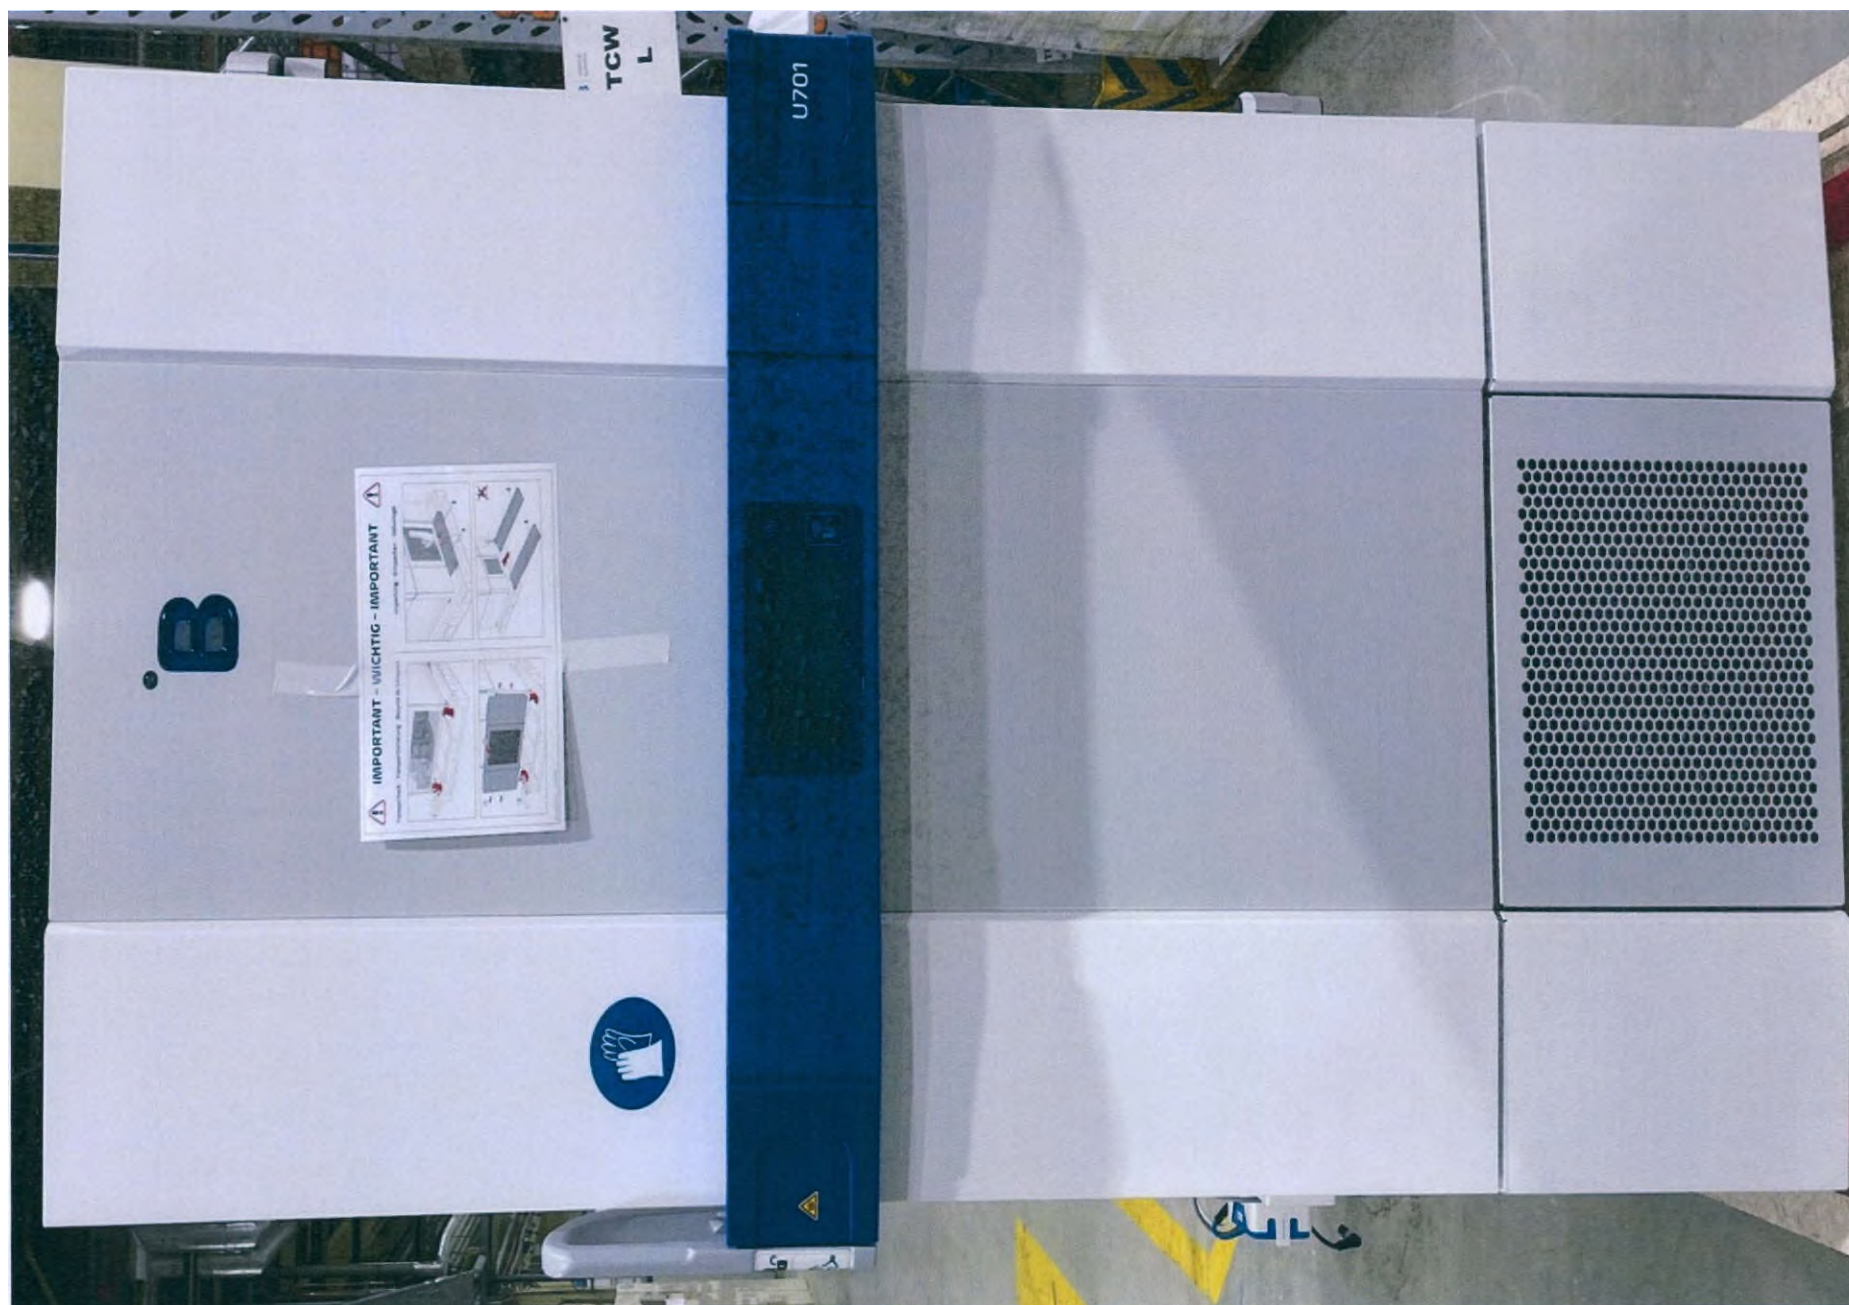

Морозильник медицинский ультранизкотемпературный для хранения компонентов крови и плазмы крови, человеческих клеток, тканей и других лабораторных образцов U701




Морозильник медицинский ультранизкотемпературный для хранения компонентов крови и плазмы крови, человеческих клеток, тканей и других лабораторных образцов U901

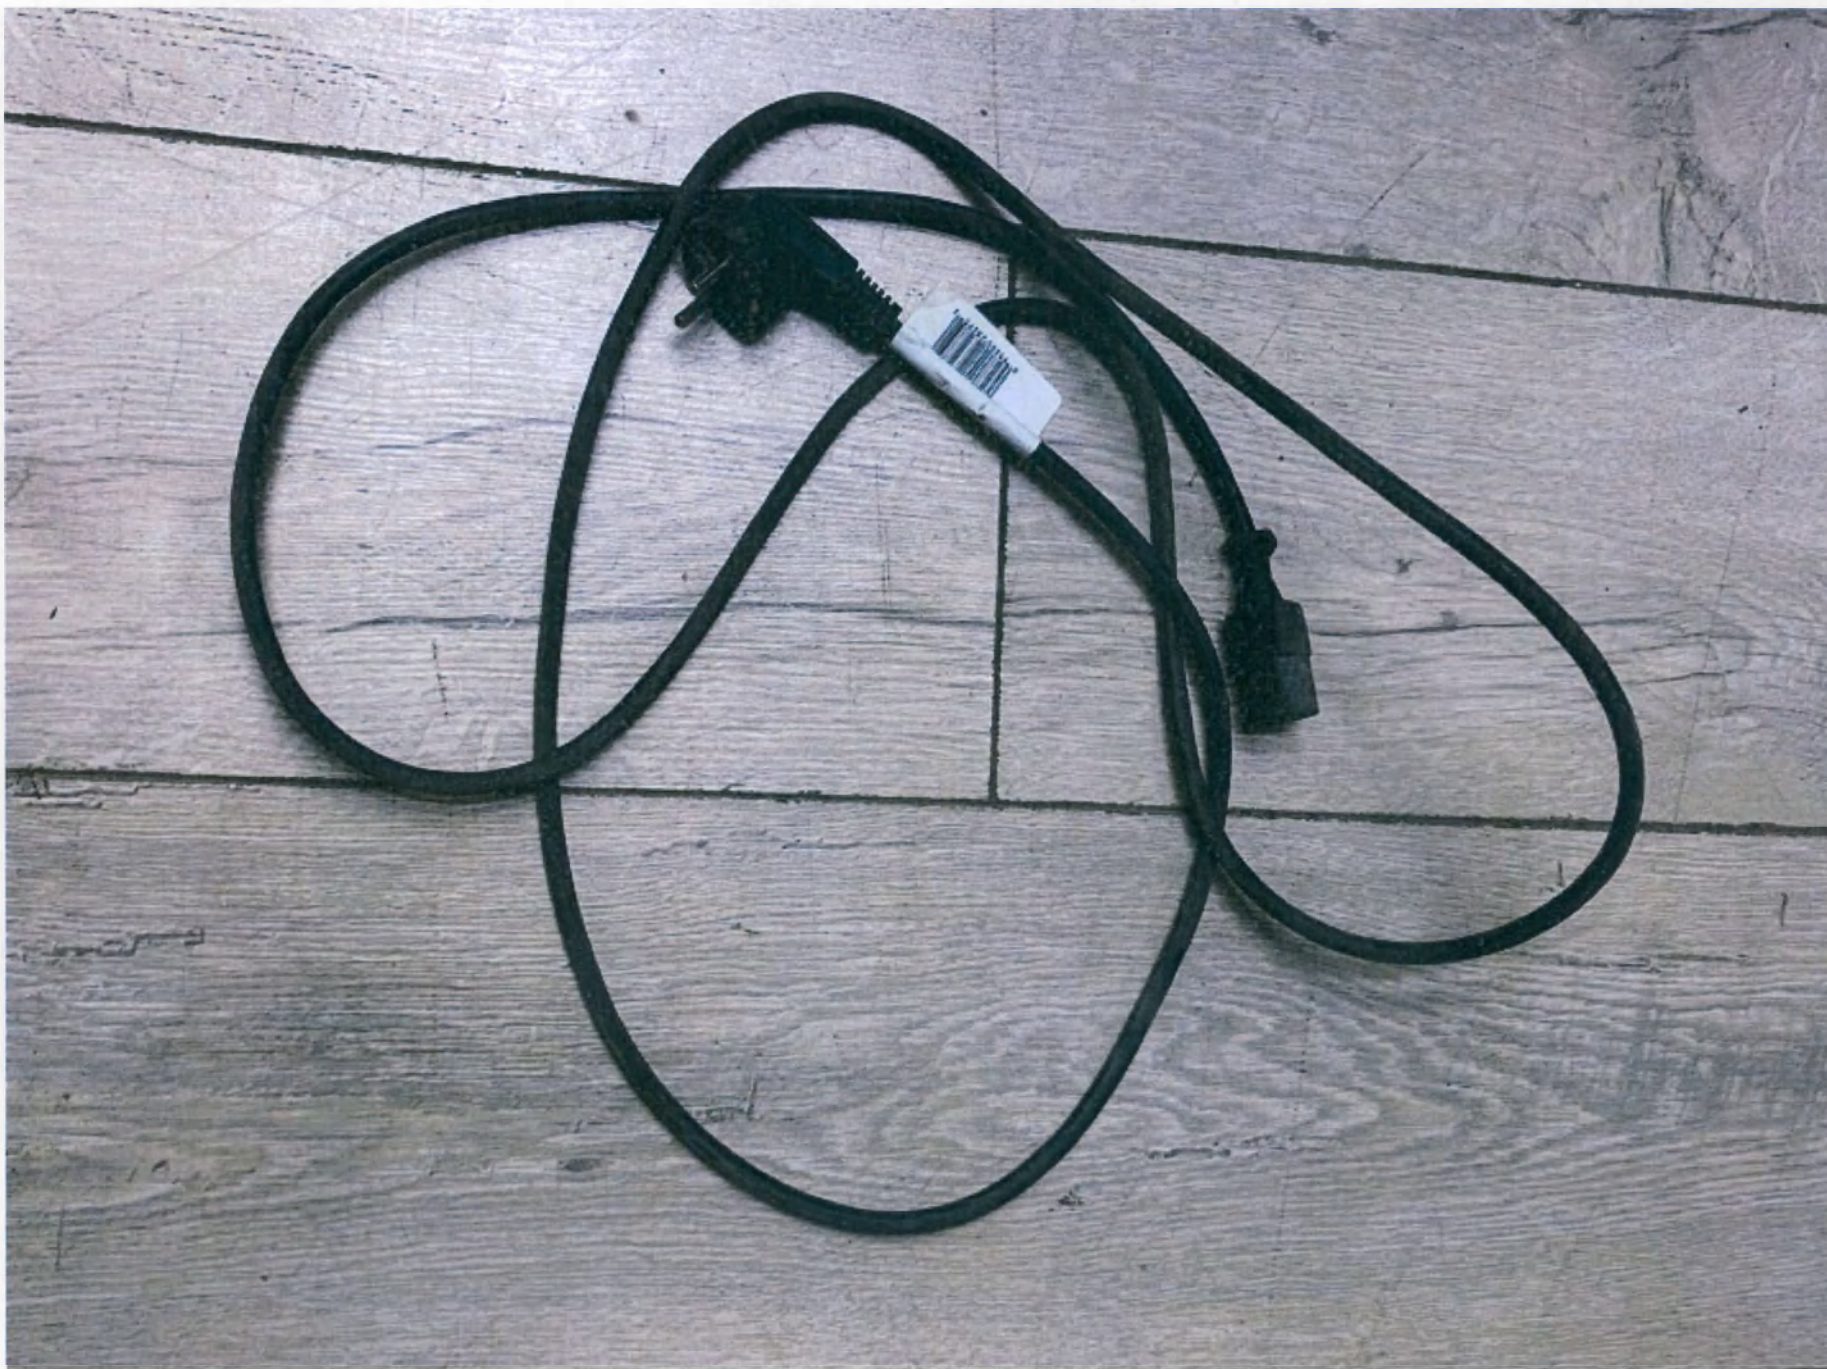


Кабель питания



Руководство по эксплуатации, на USB носителе

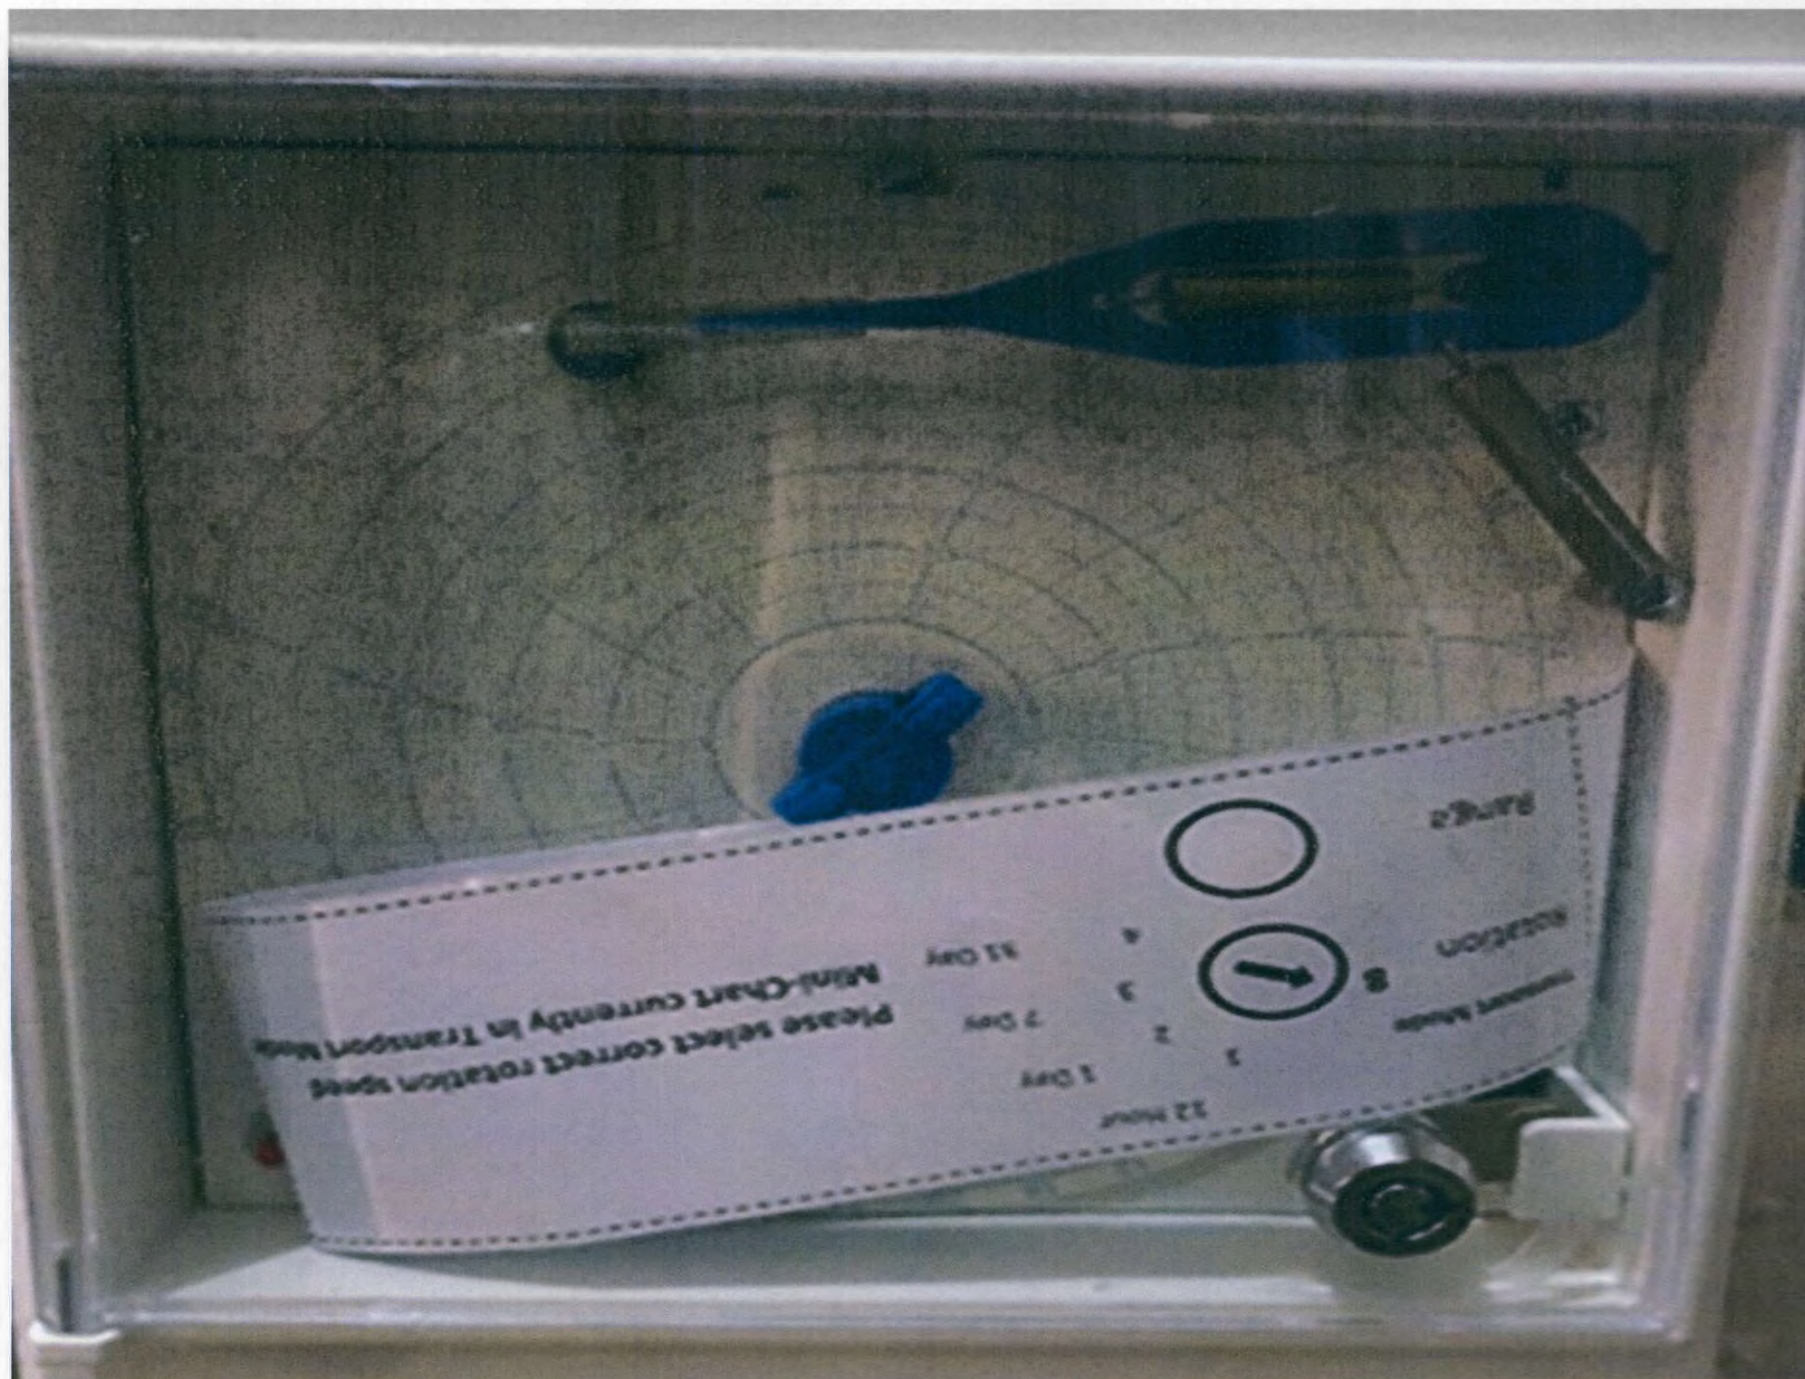

Самописец показаний температуры

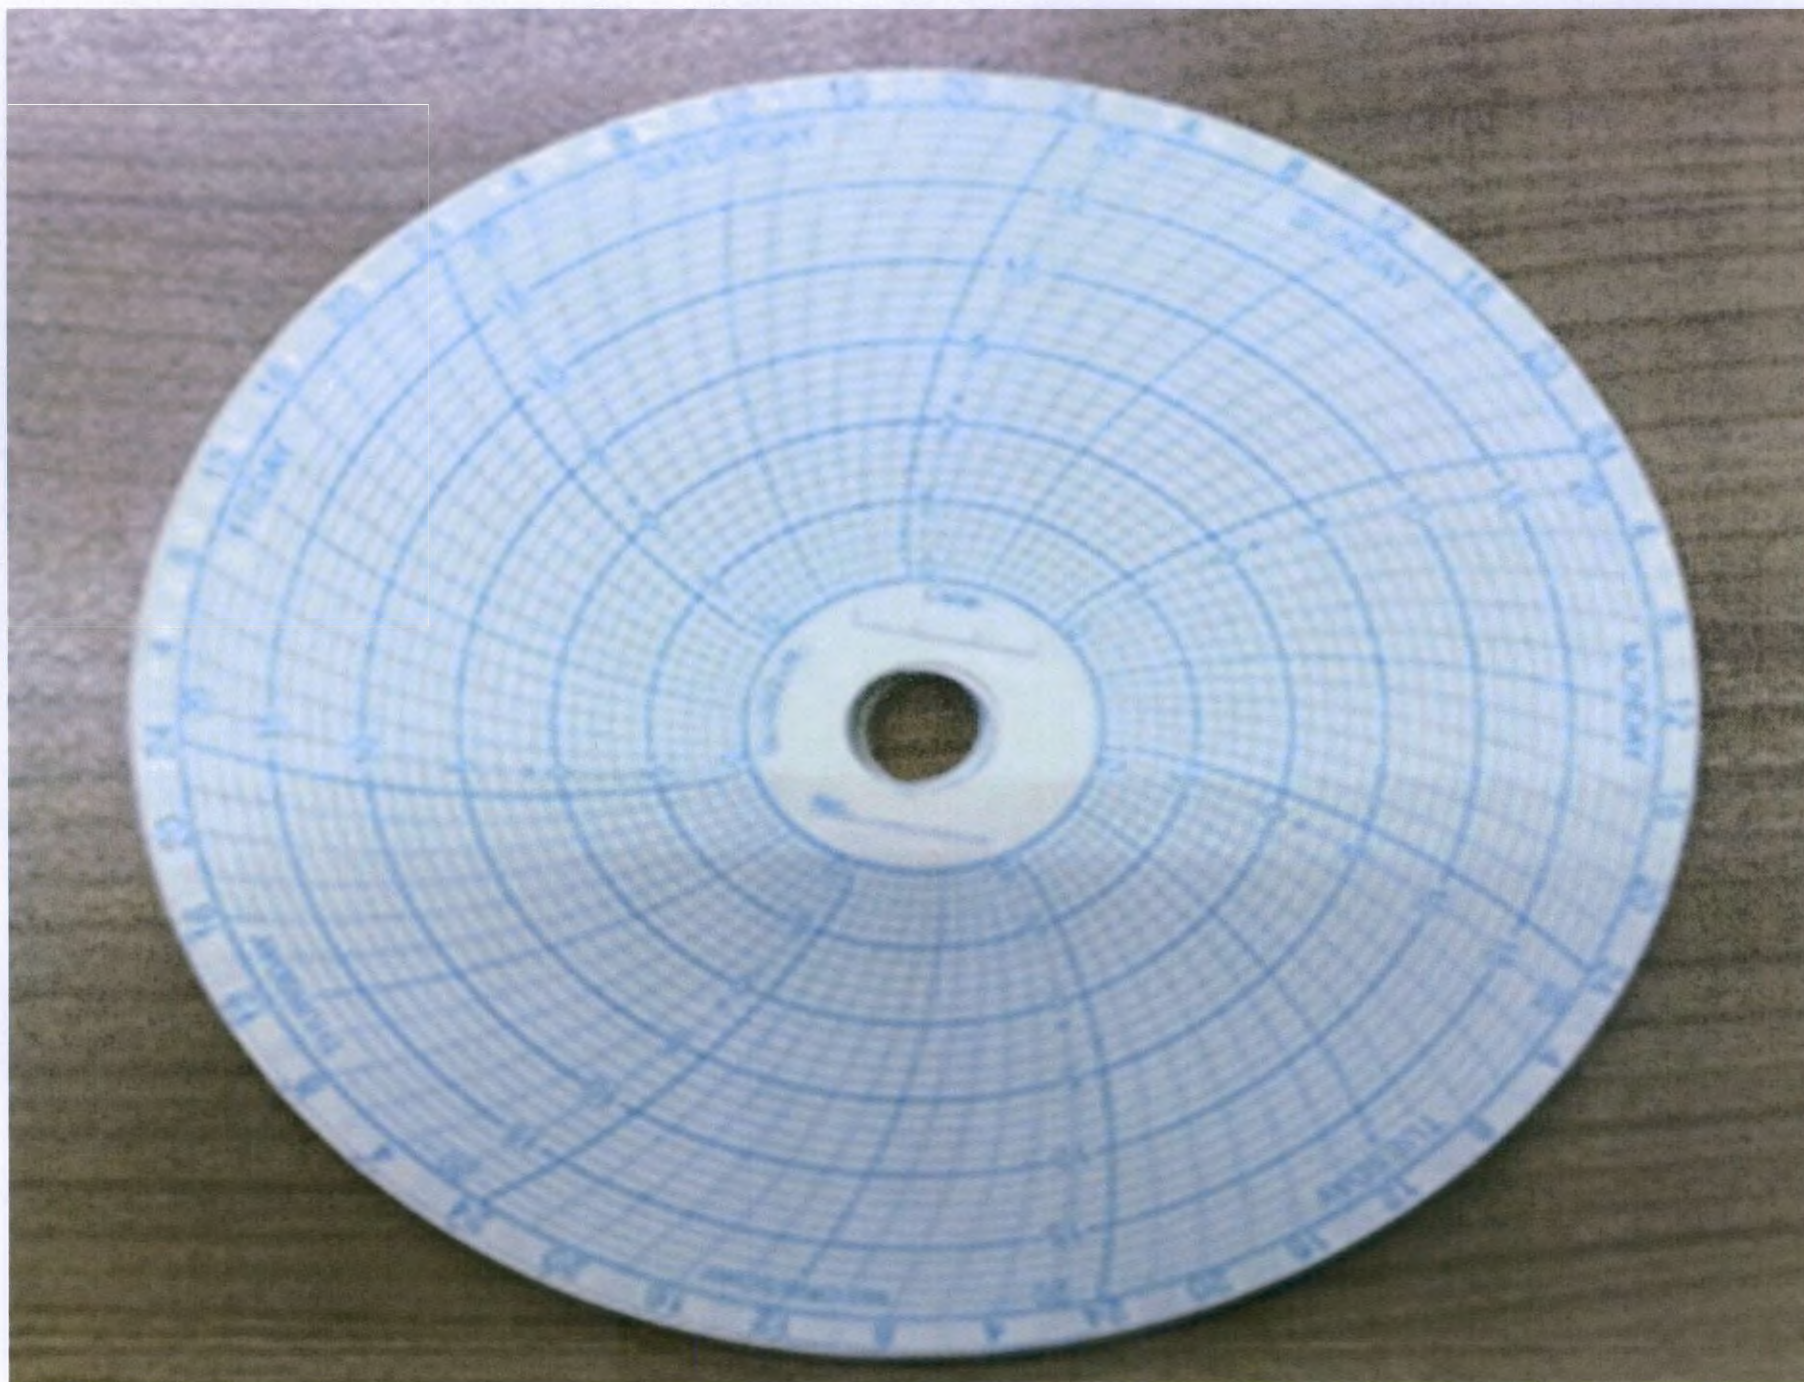

Бумага для самописца

**DE**

Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, müssen an dem örtlichen Sammelpunkt für die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Dieses Produkt darf nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden.

Kühlschränke von „B Medical Systems“ enthalten das Symbol auf dem Typenschild.

DK

Apparater, som er mærket med dette symbol, skal afleveres hos det lokale opsamlingssted til bortskaffelse af elektriske og elektroniske apparater.

Dette produkt må ikke bortskaffes gennem normal husholdningsaffald. Køleskabe fra „B Medical Systems“ har symbolet på dataskiltet (typeskiltet).

EN

Appliances bearing this symbol must be deposited at the designated local reception point for the disposal of electrical and electronic equipment.

It is not permitted that this product be disposed of by way of the normal household refuse collection system.

„B Medical Systems“ refrigerators bear this symbol on the specifications plate (data plate).

ES

Los aparatos que lleven este símbolo deberán depositarse en los lugares locales de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos. Este producto no debe desecharse en la basura doméstica convencional.

Los refrigeradores de „B Medical Systems“ llevan el símbolo en la placa de datos (placa indicadora) situada en el interior del aparato.

FR

Les appareils portant ce symbole doivent être obligatoirement remis à un point de collecte local pour la mise au rebut d'appareils électriques et électroniques.

Il est interdit de jeter ce produit dans les ordures ménagères.

Sur les réfrigérateurs „B Medical Systems“, le symbole figure sur la plaque des caractéristiques (plaque signalétique).

FI

Laitteet, jotka on merkitty viereisellä symbolilla, tulee toimittaa paikalliseen keräyspisteeseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätehuoltomäärysten mukaisesti.

Tätä tuotetta ei saa hävittää normaali kotitalousjätteiden mukana.

„B Medical Systems“ jääkaapeissa symboli löytyy laitteen sisäpuolelta sijoitetusta tyypikilvestä.

IT

Gli apparecchi che sono contrassegnati con questo simbolo devono essere consegnati al posto di raccolta locale per lo smaltimento e il trattamento di apparecchi elettrici ed elettronici.

Questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici.

Il simbolo si trova sulla targhetta dei dati tecnici dei frigoriferi „B Medical Systems“ (targhetta del modello).

NL

Apparaten, die met dit symbool zijn voorzien, moeten bij het gemeentelijk verzamelpunt voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur worden afgegeven.

Ze mogen niet via het gewone huisafval worden weggegooid.

Bij koelkasten van „B Medical Systems“ staat het symbool op het typeplaatje.

NO

Apparater som er kjennetegnet med dette symbolet, må deponeres på lokale deponier for elektriske eller elektroniske apparater. Dette produktet må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Kjøleskap fra „B Medical Systems“ bærer symbolet på typeskiltet.

PT

Aparelhos caracterizados com este símbolo precisam ser jogados fora nos pontos de recolhalocais especiais para descarte de aparelhos eléctricos e electrónicos.

Este aparelho não deve ser jogado fora junto com o lixo doméstico normal!

Os frigoríficos da „B Medical Systems“ levam um símbolo na placa de características técnicas(placa do tipo).

SE

Apparater märkta med denna symbol skall lämnas in till kommunens insamlingsställe för omhändertagande av elektriska och elektroniska apparater.

Denna produkt får inte slängas i hushållsavfallet.

På kylskåp från „B Medical Systems“ sitter denna symbol på märkskylten (typskylten).

GR

Συσκευές μ' αυτό το σύμβολο πρέπει να συγκεντρώνονται για αποκομιδή στα τυπικά σημεία αποκομιδής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.


Απαγορεύεται η αποκομιδή αυτού του προϊόντος μαζί με τα συνήθη απορρίμματα του νοικοκυριού. Τα ψυγεία φέρουν αυτό το σύμβολο στην πινακίδα δεδομένων (πινακίδα μοντέλου).

RU


Приборы, имеющие этот символ, должны быть помещены в специальный местный пункт приема для утилизации электрического и электронного оборудования.

Не допускается утилизация данного продукта путем обычной системы сбора бытовых отходов.

Приборы B Medical Systems S.a. r.l. имеют этот символ на шильдике с маркировкой.

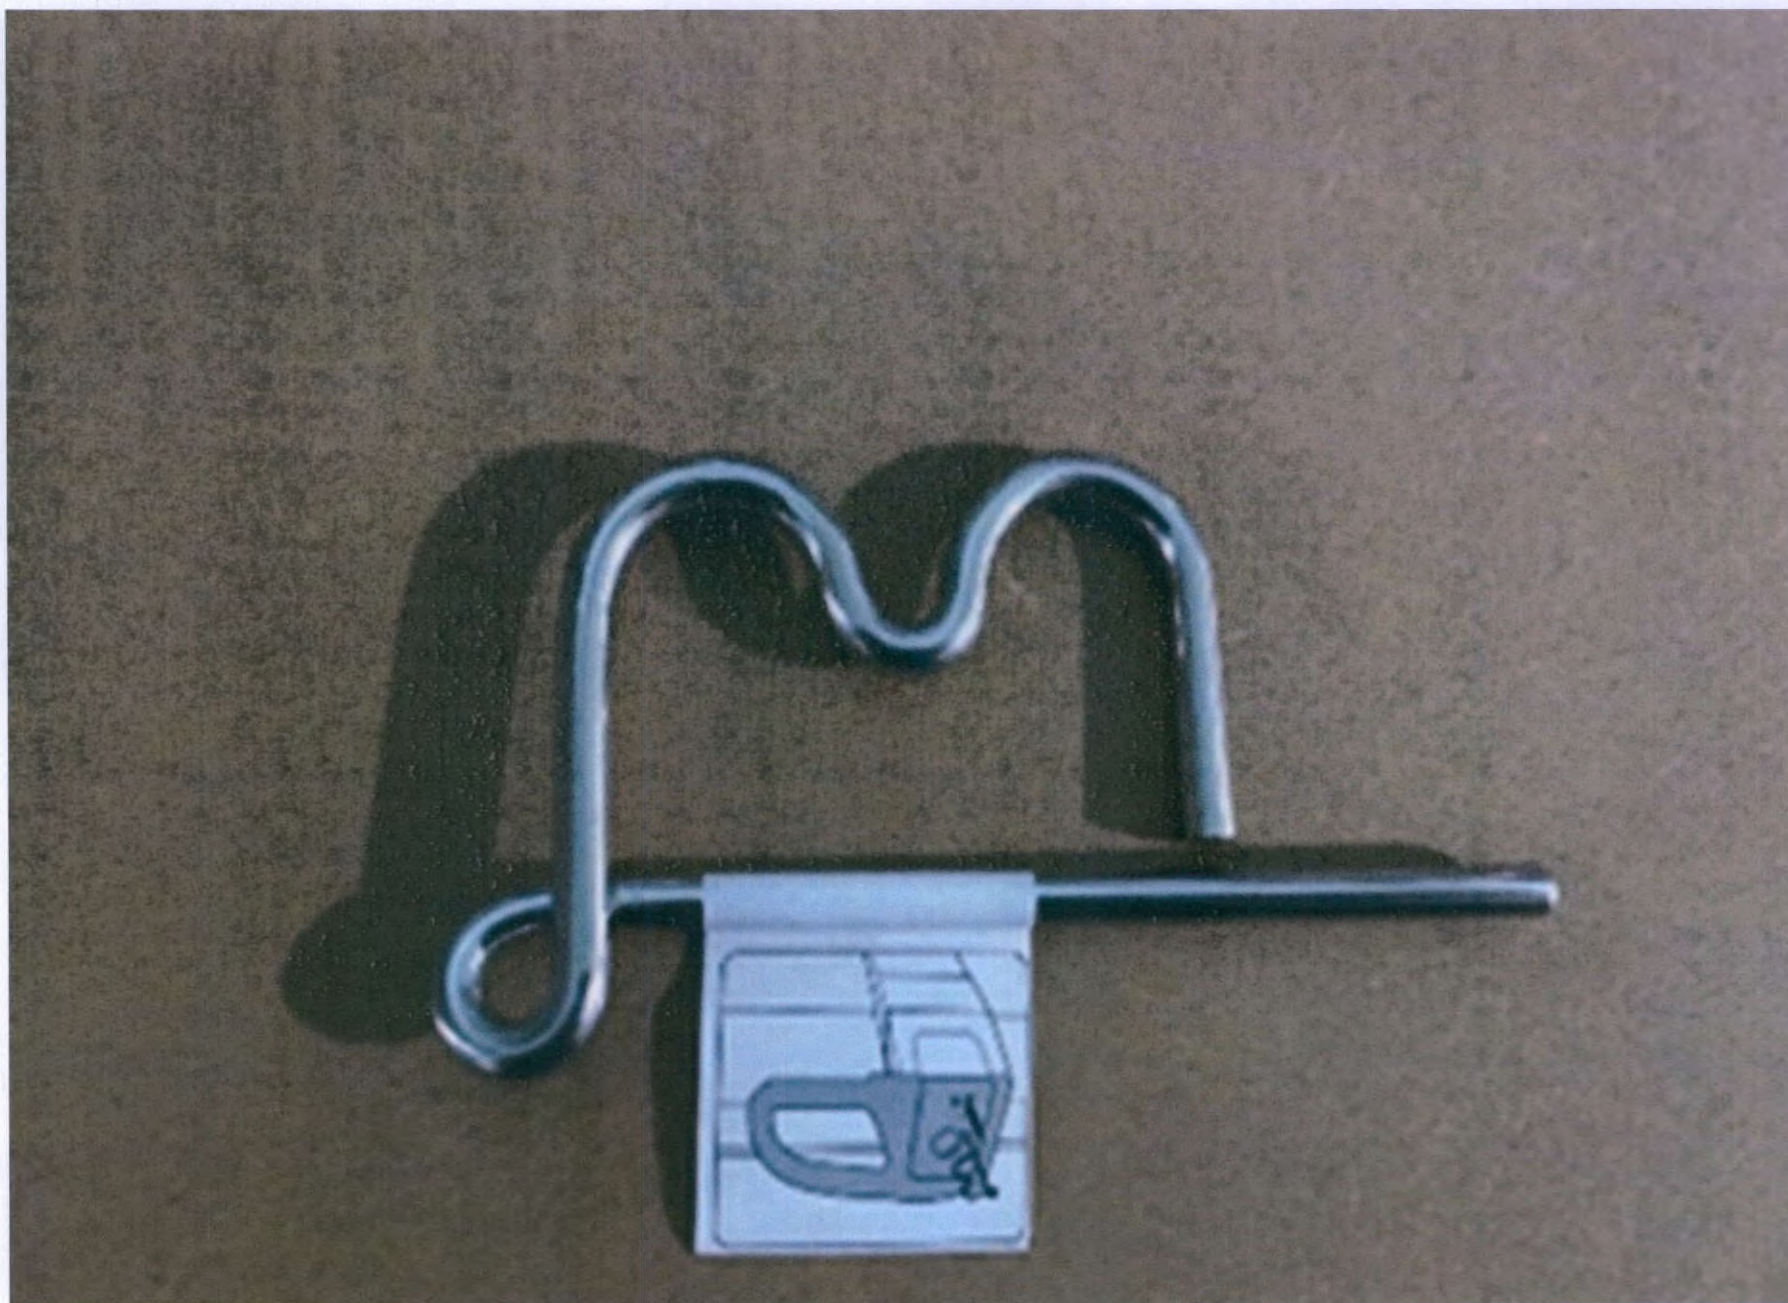


Инструмент для аварийного открытия двери

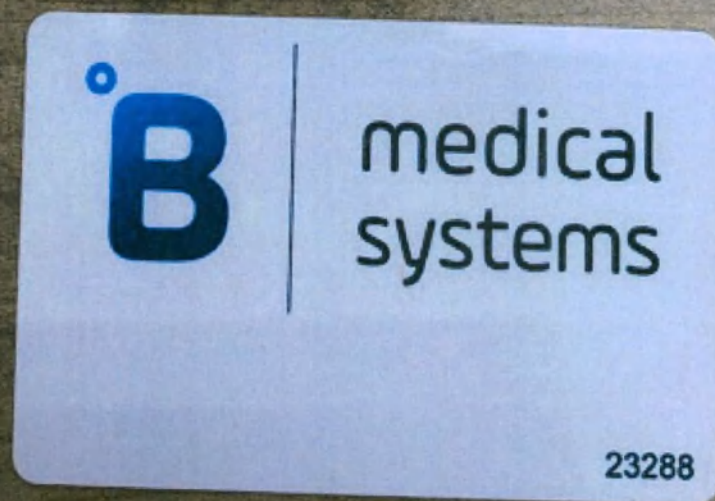


Карта доступа



Заглушка разъемом D19/M8

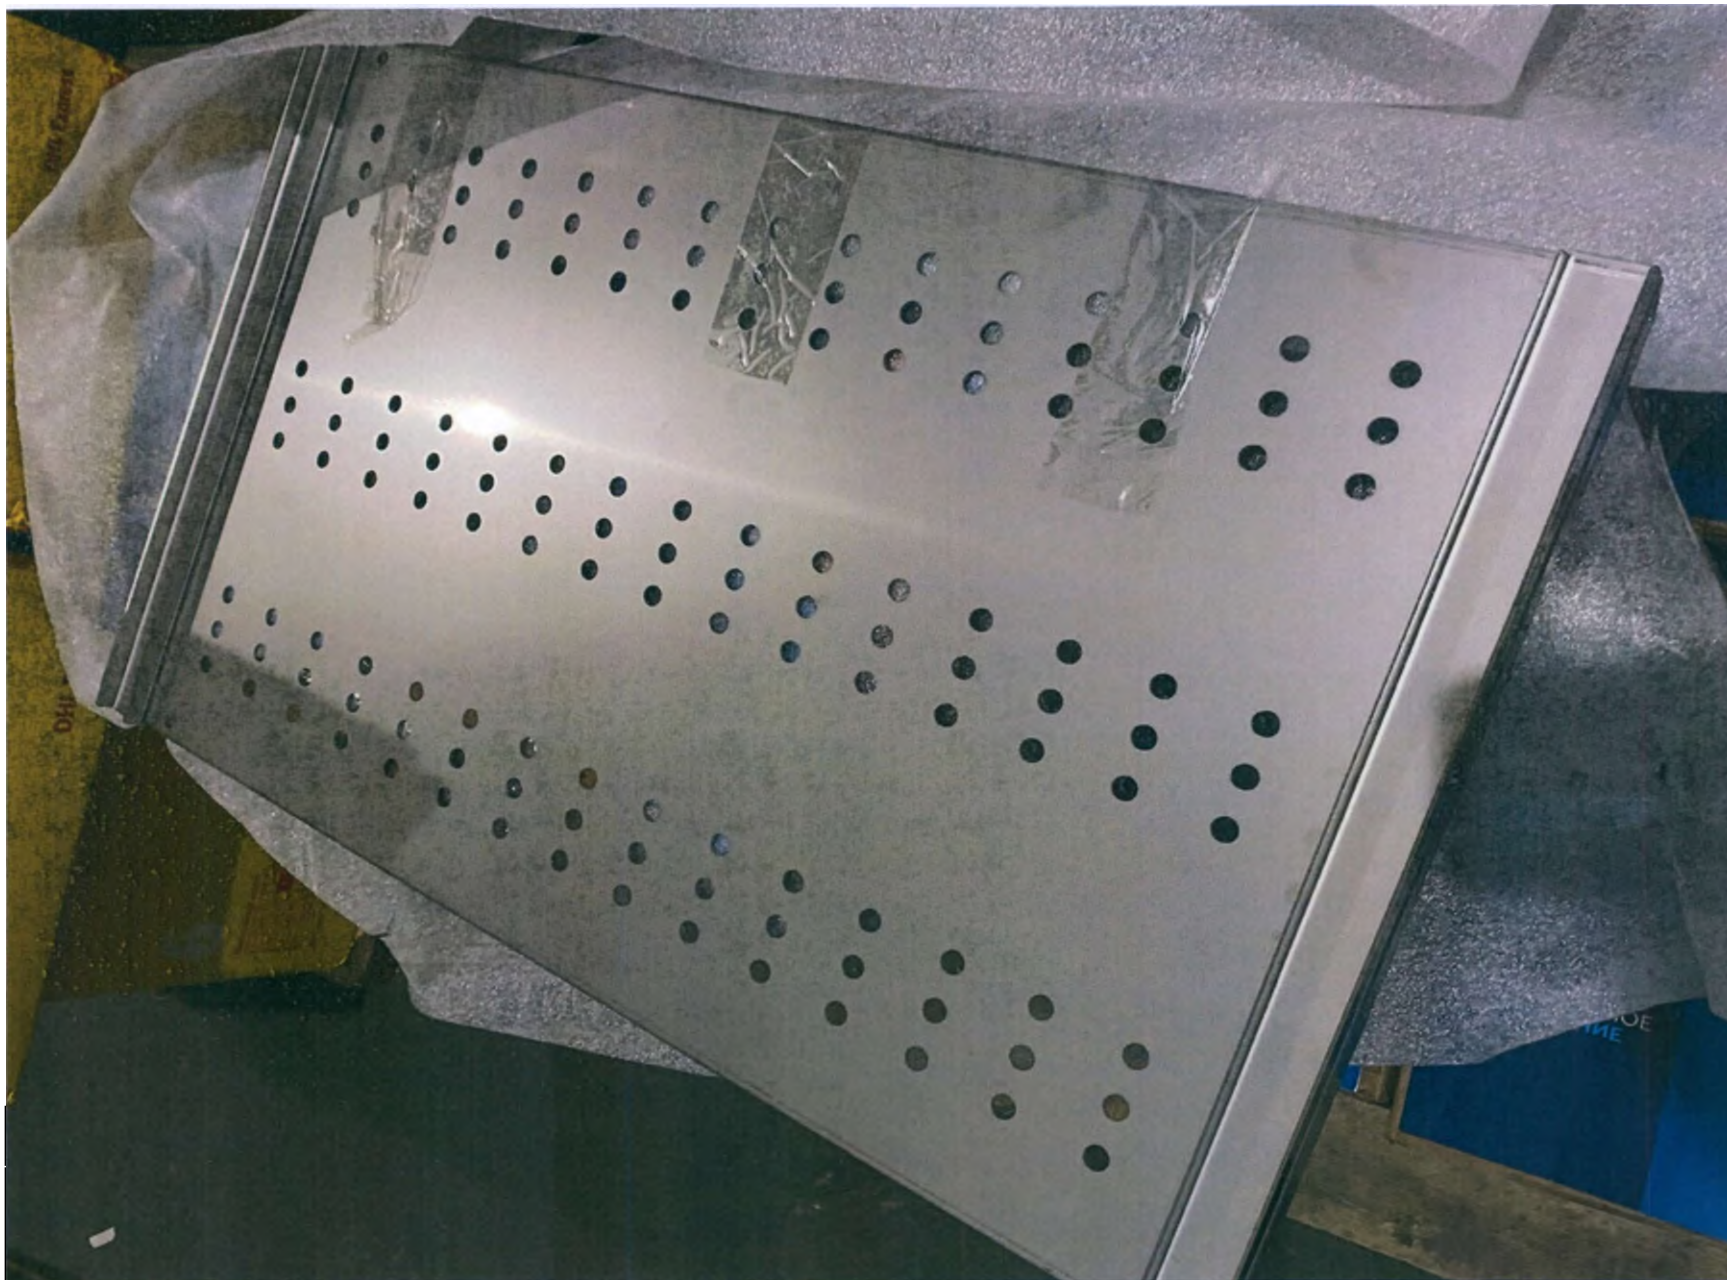

Стальная полка

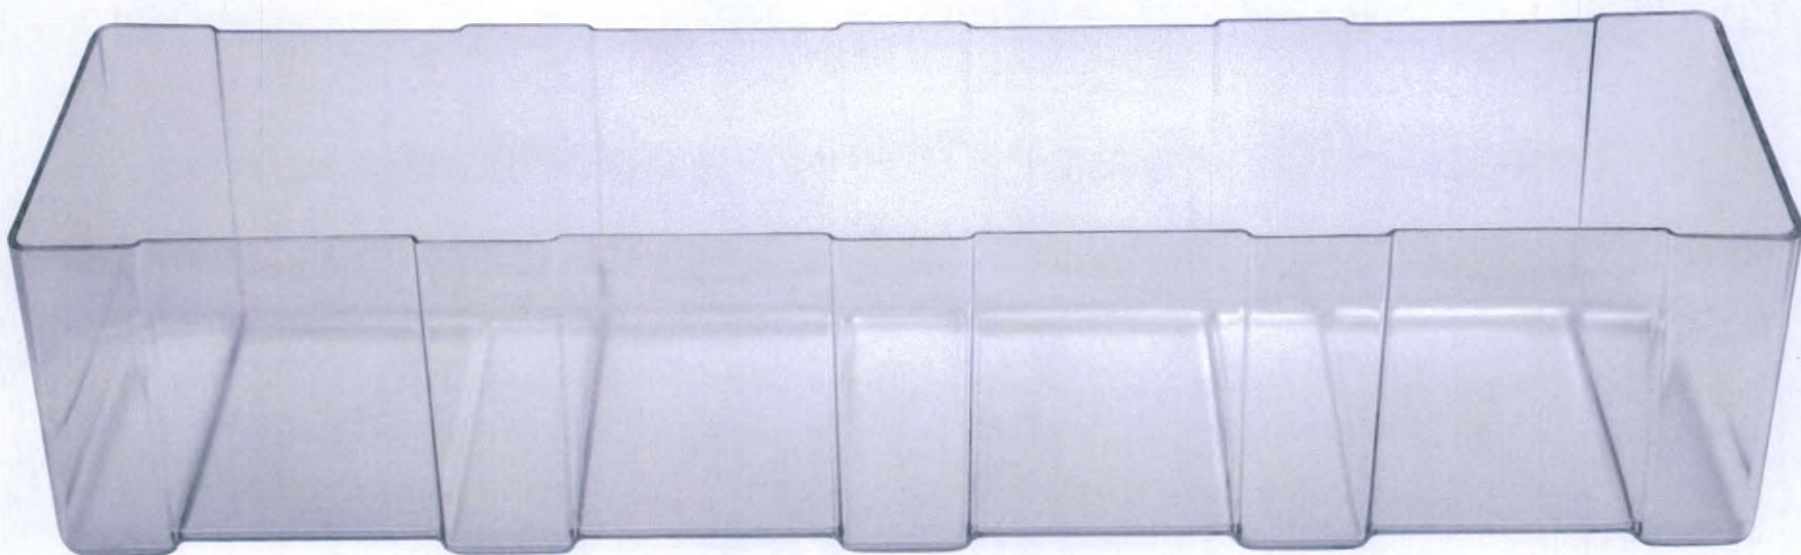


Пластиковая подставка




Разделитель для пластиковой подставки



Стальная подставка

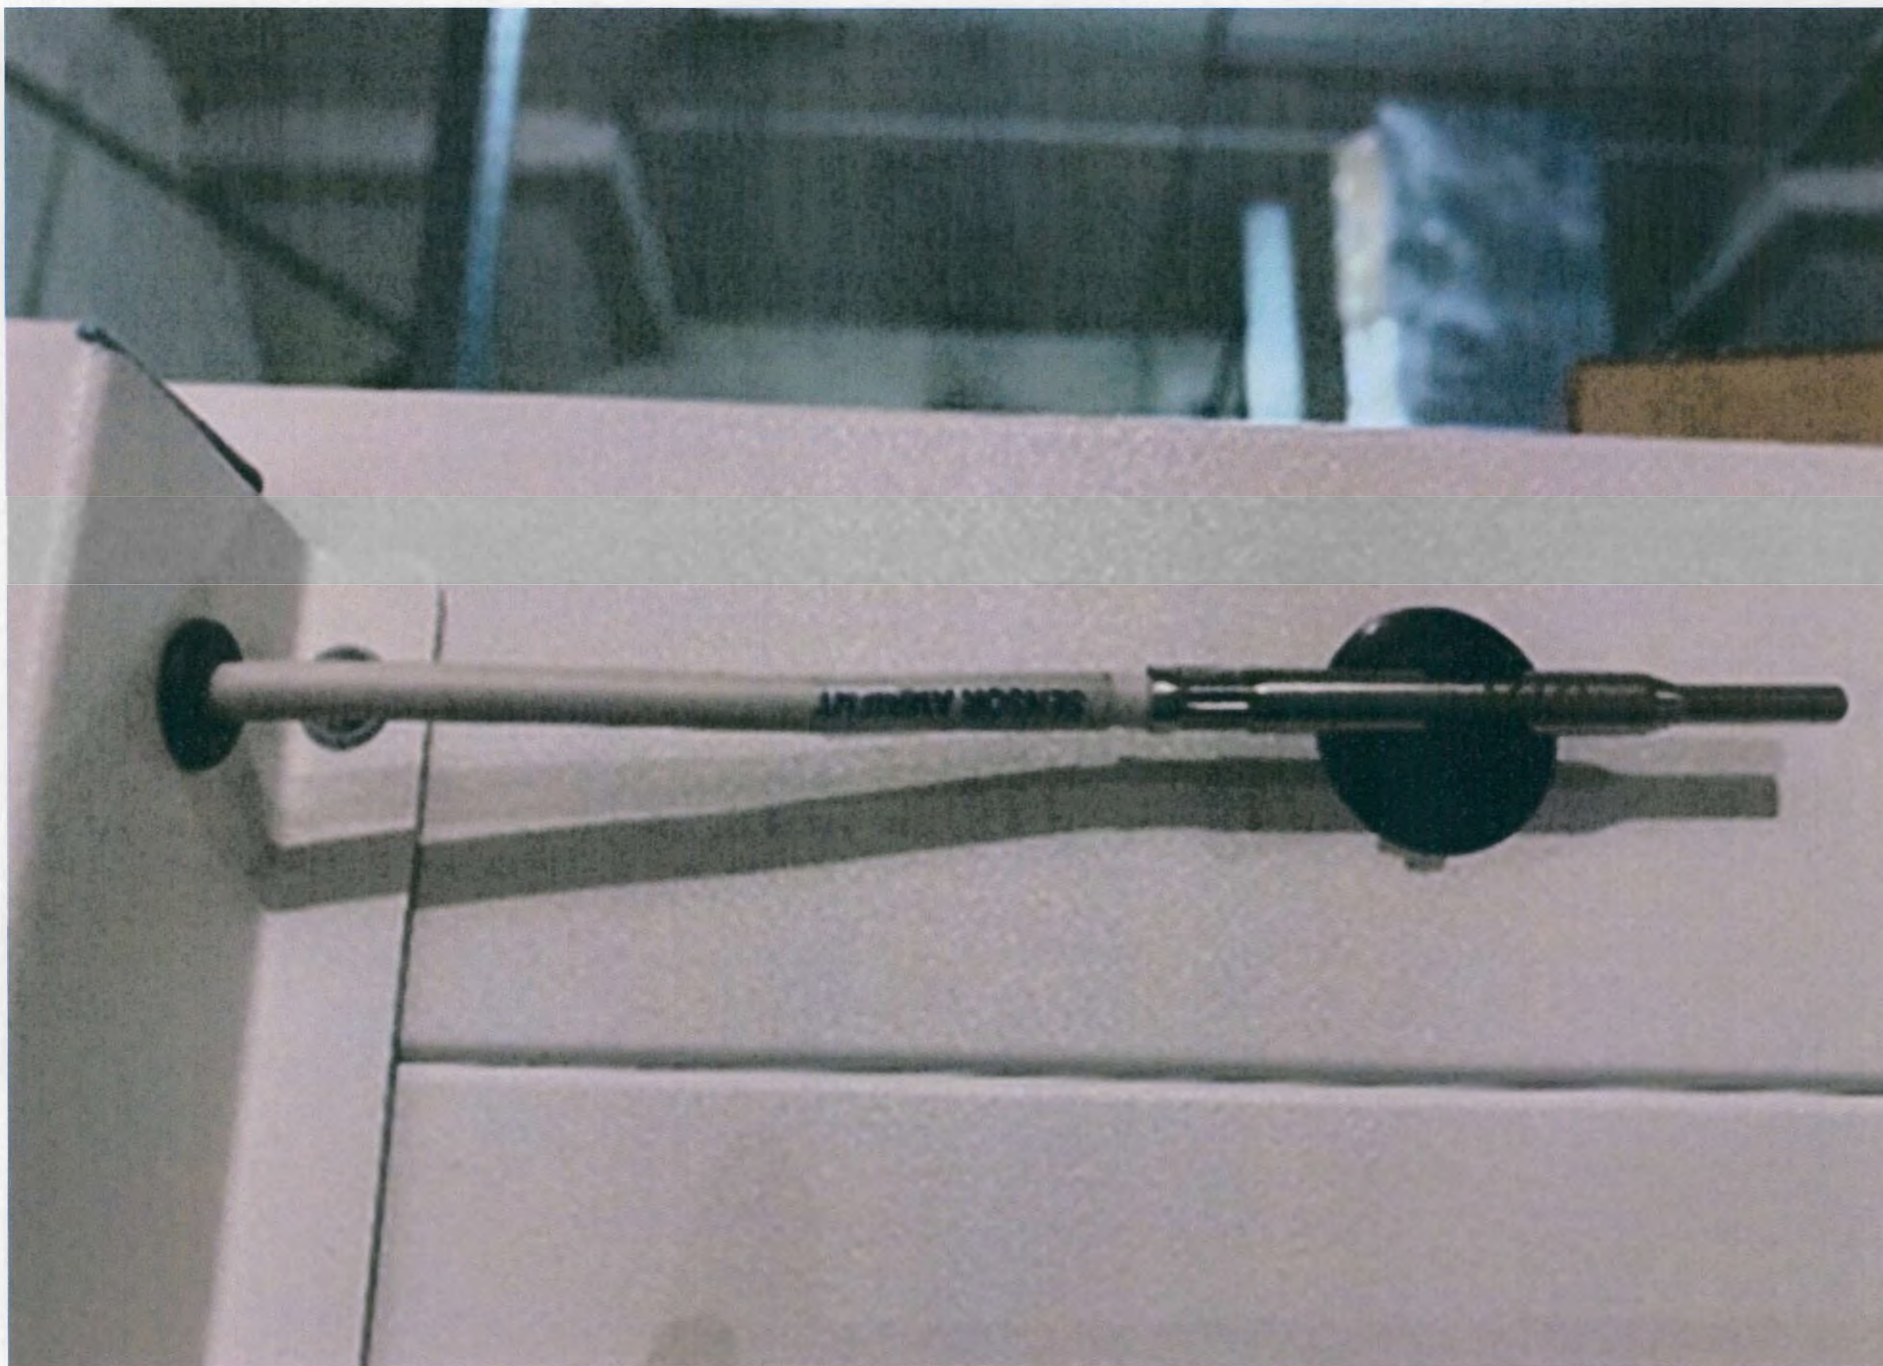

Датчик температуры окружающей среды

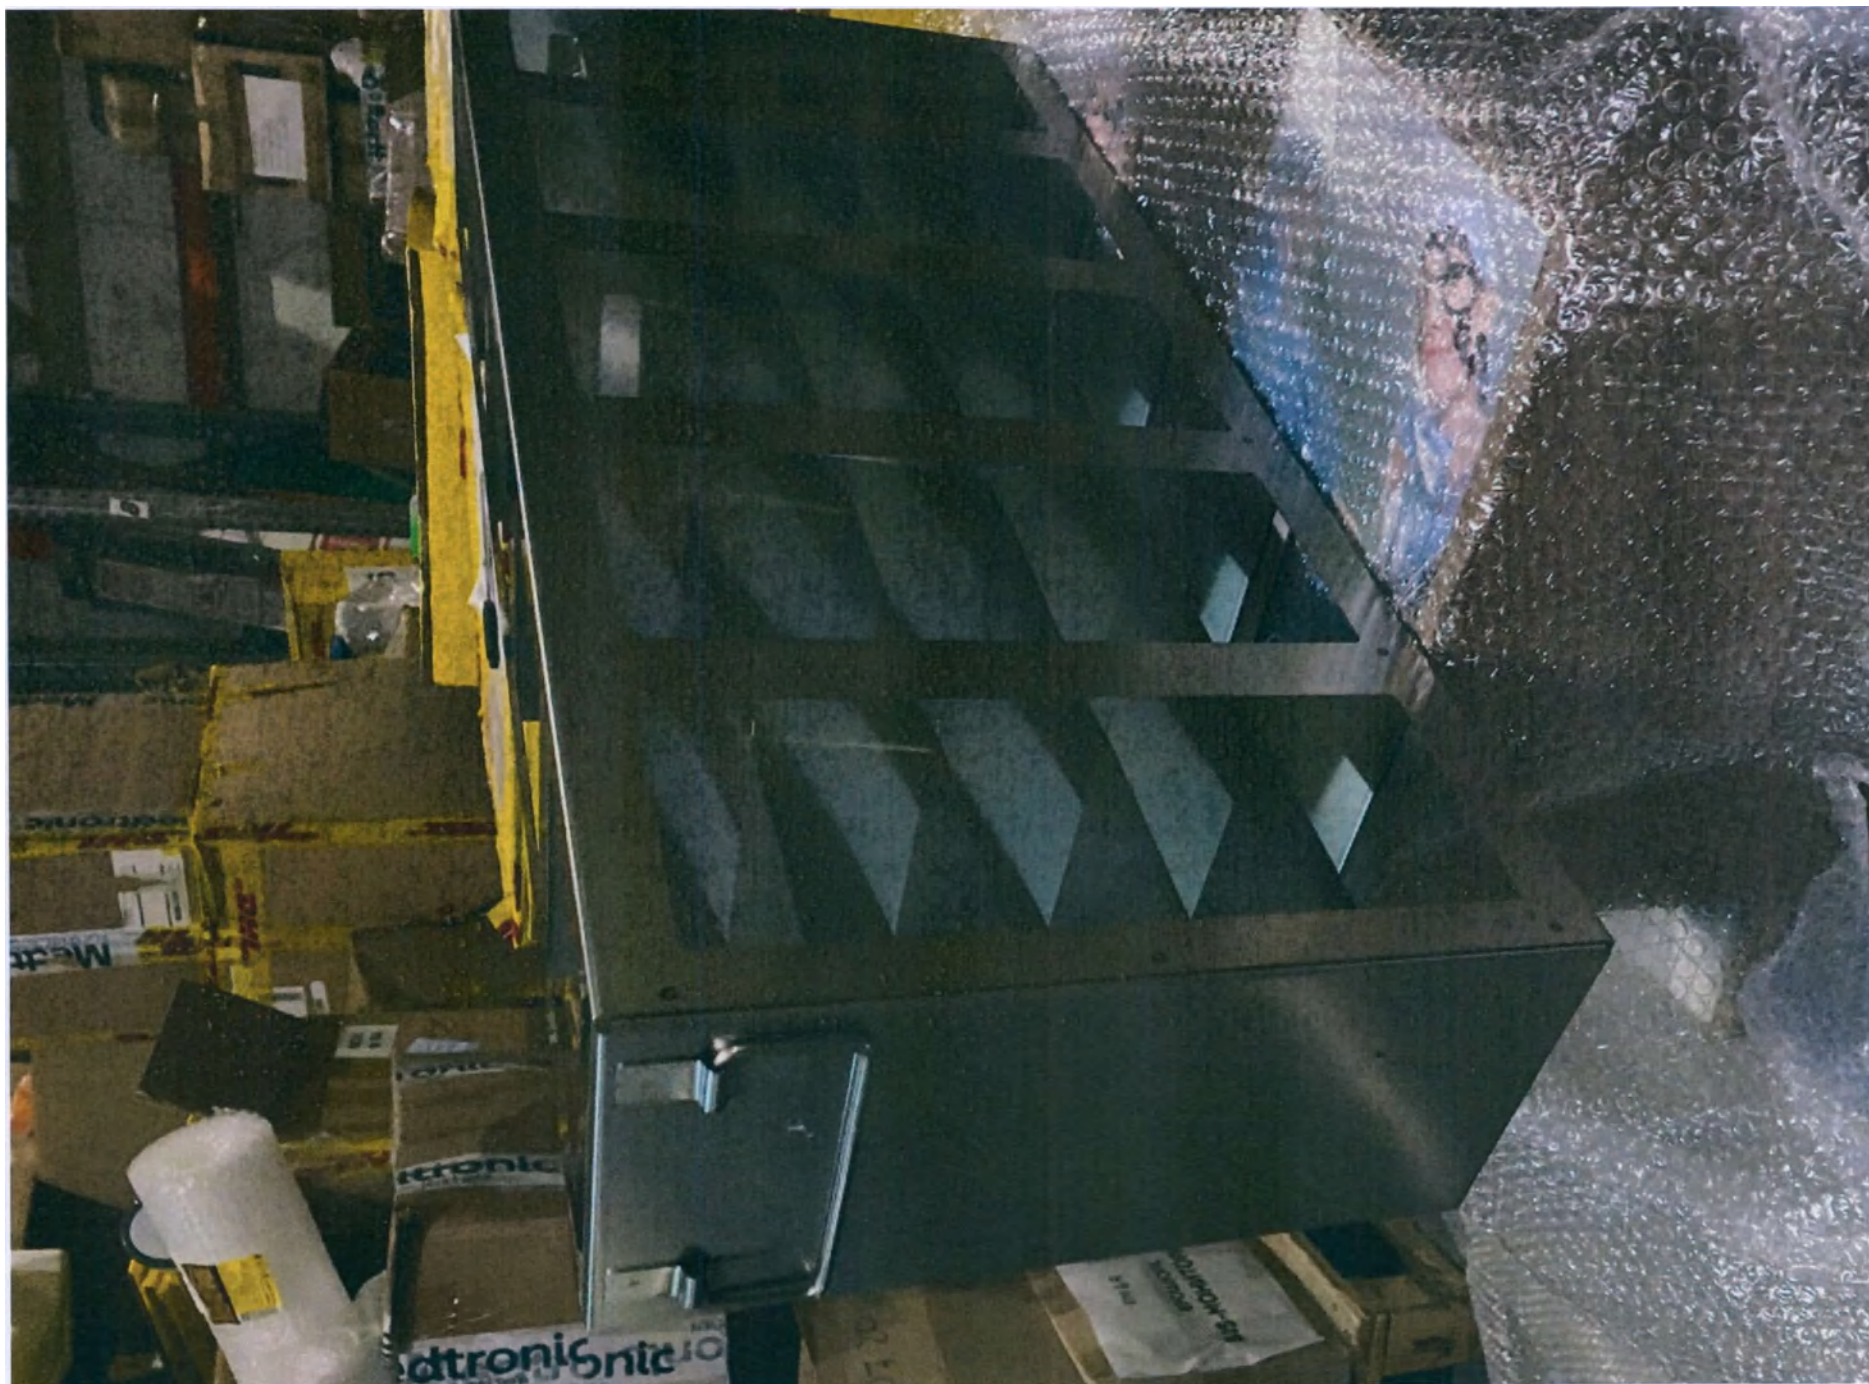

Криостеллаж 5-уровневый Н50




Криостеллаж 6-уровневый H50



Криостеллаж Н75



Криостеллаж Н100

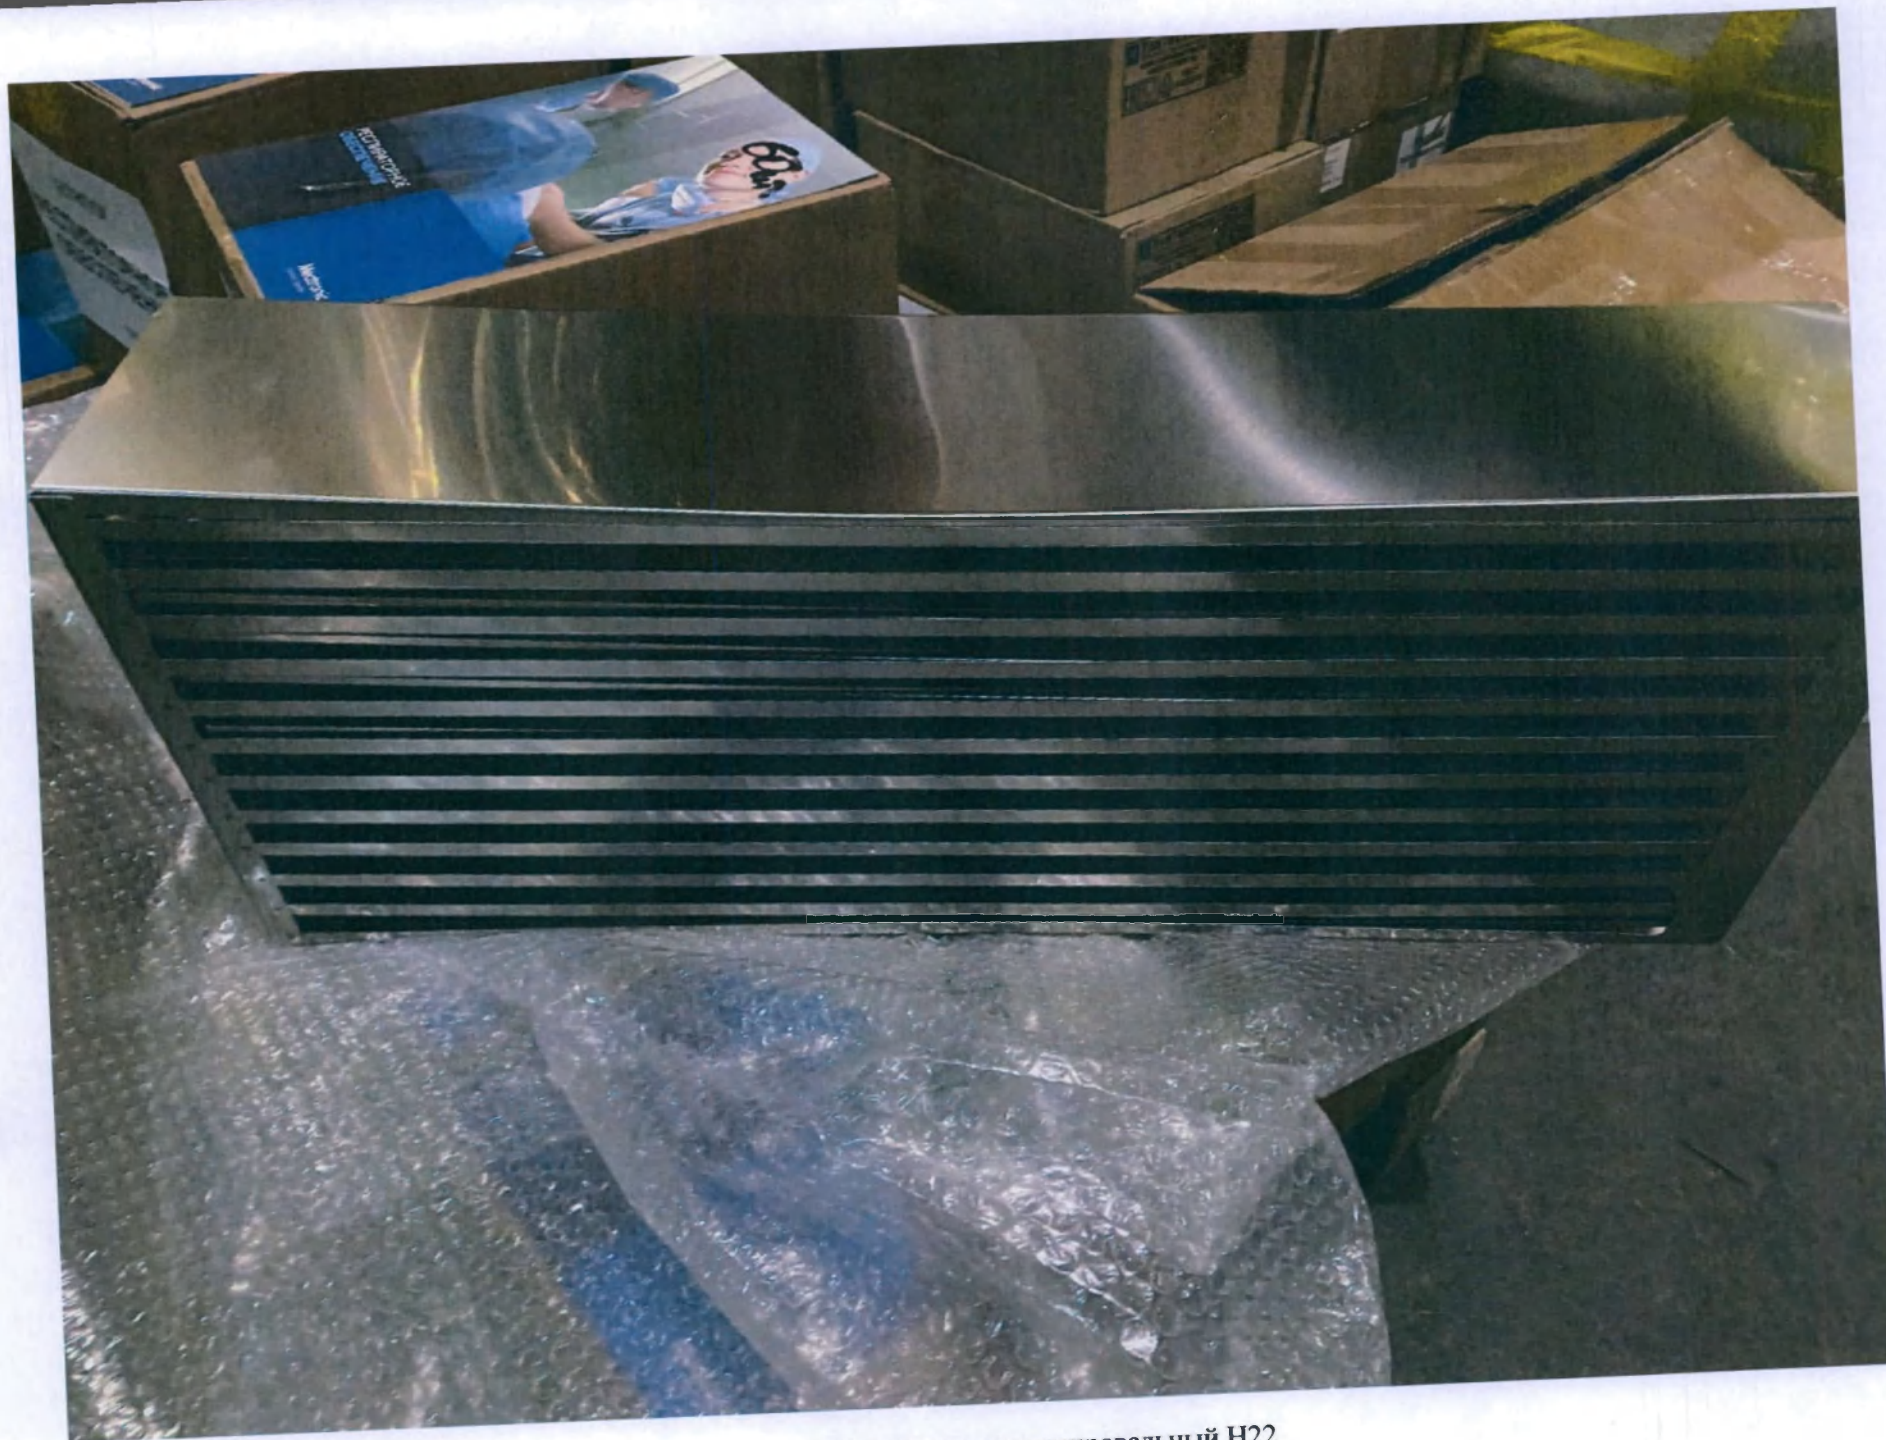

D-стеллаж микротировальный H22




D-стеллаж H50




D-стеллаж Н75




D-стеллаж Н100

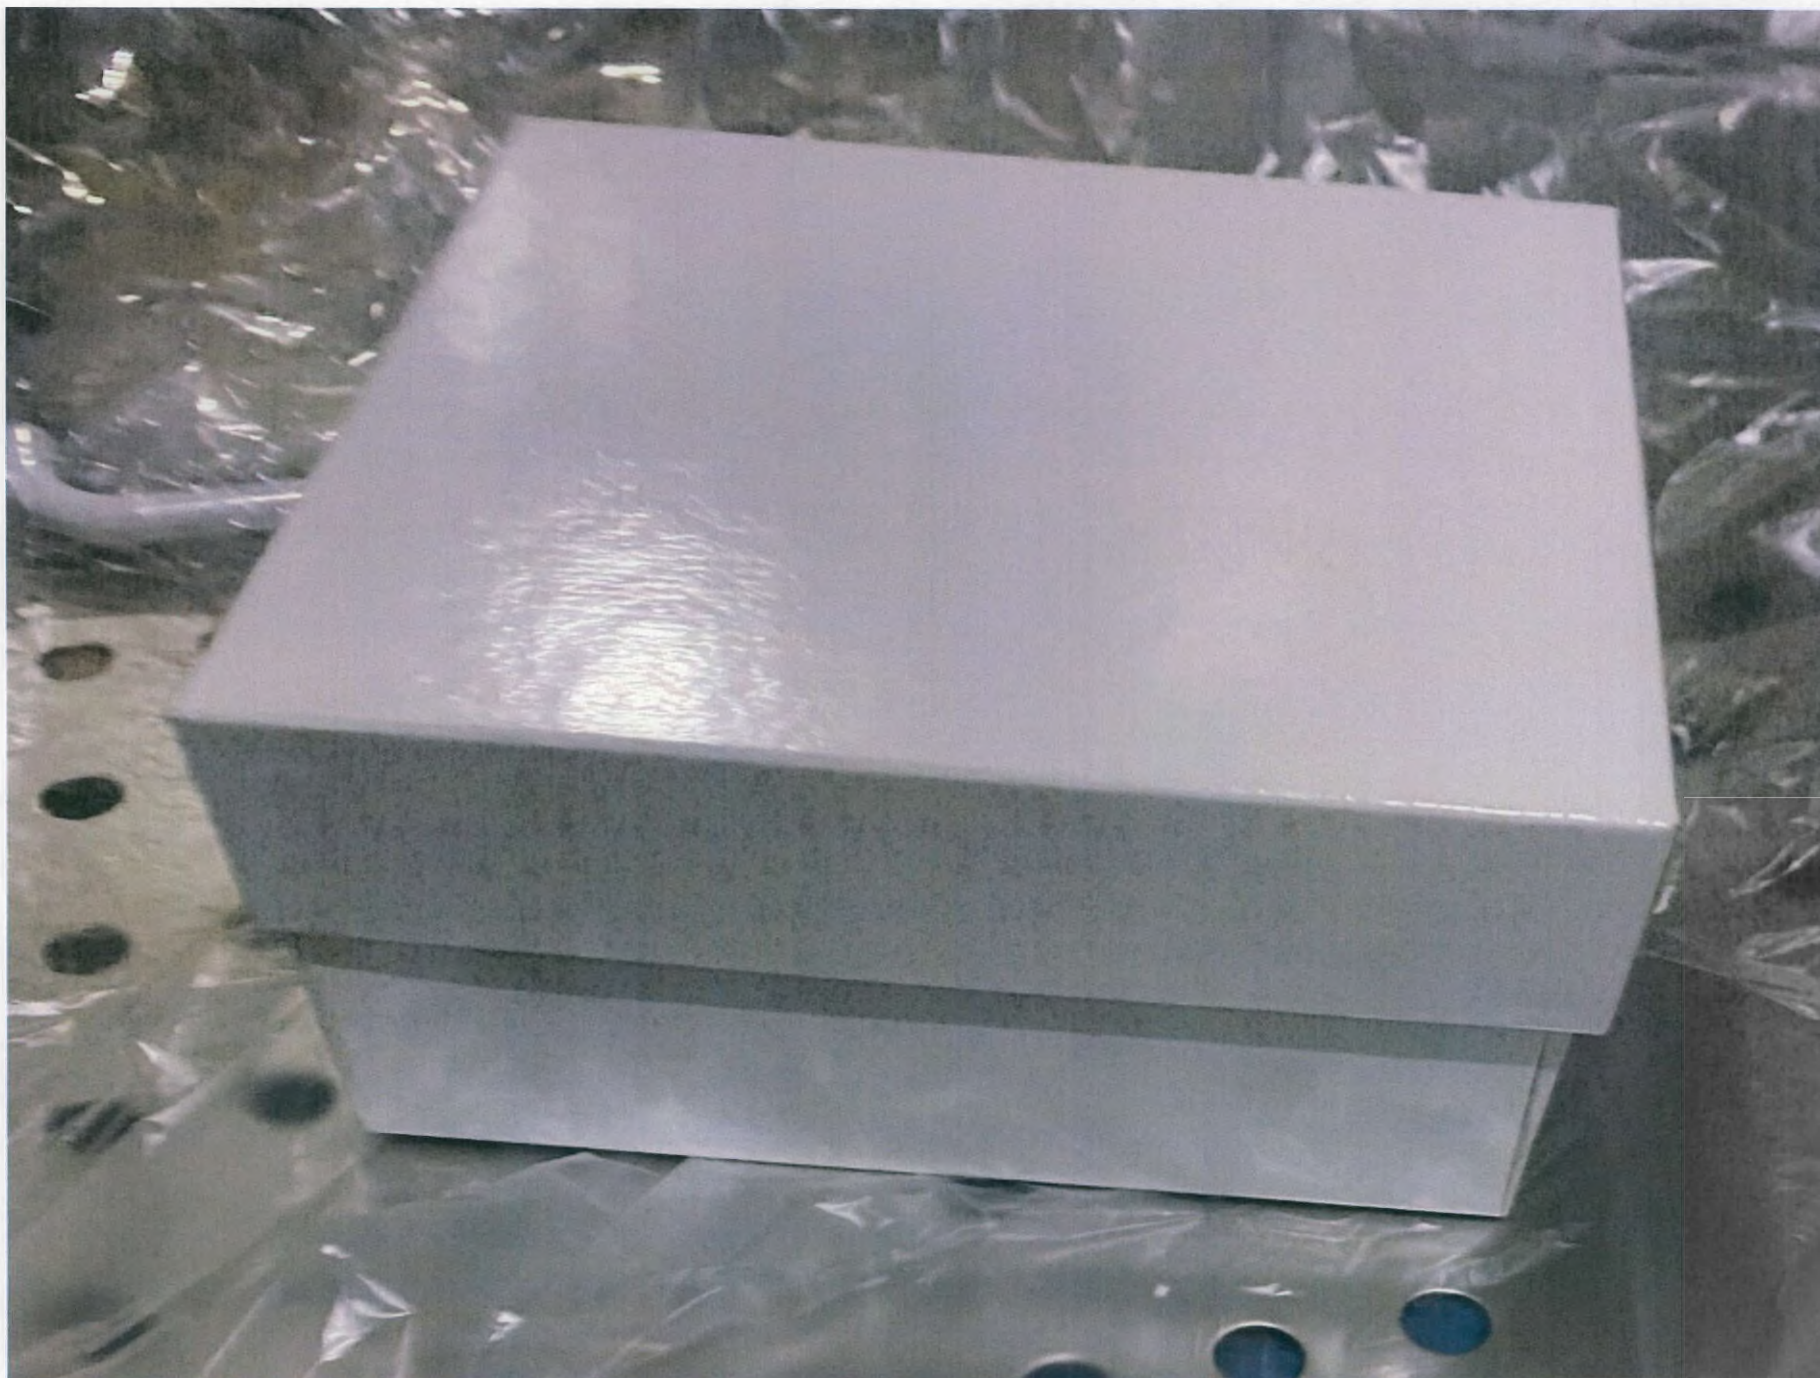


Картонные криобоксы H50

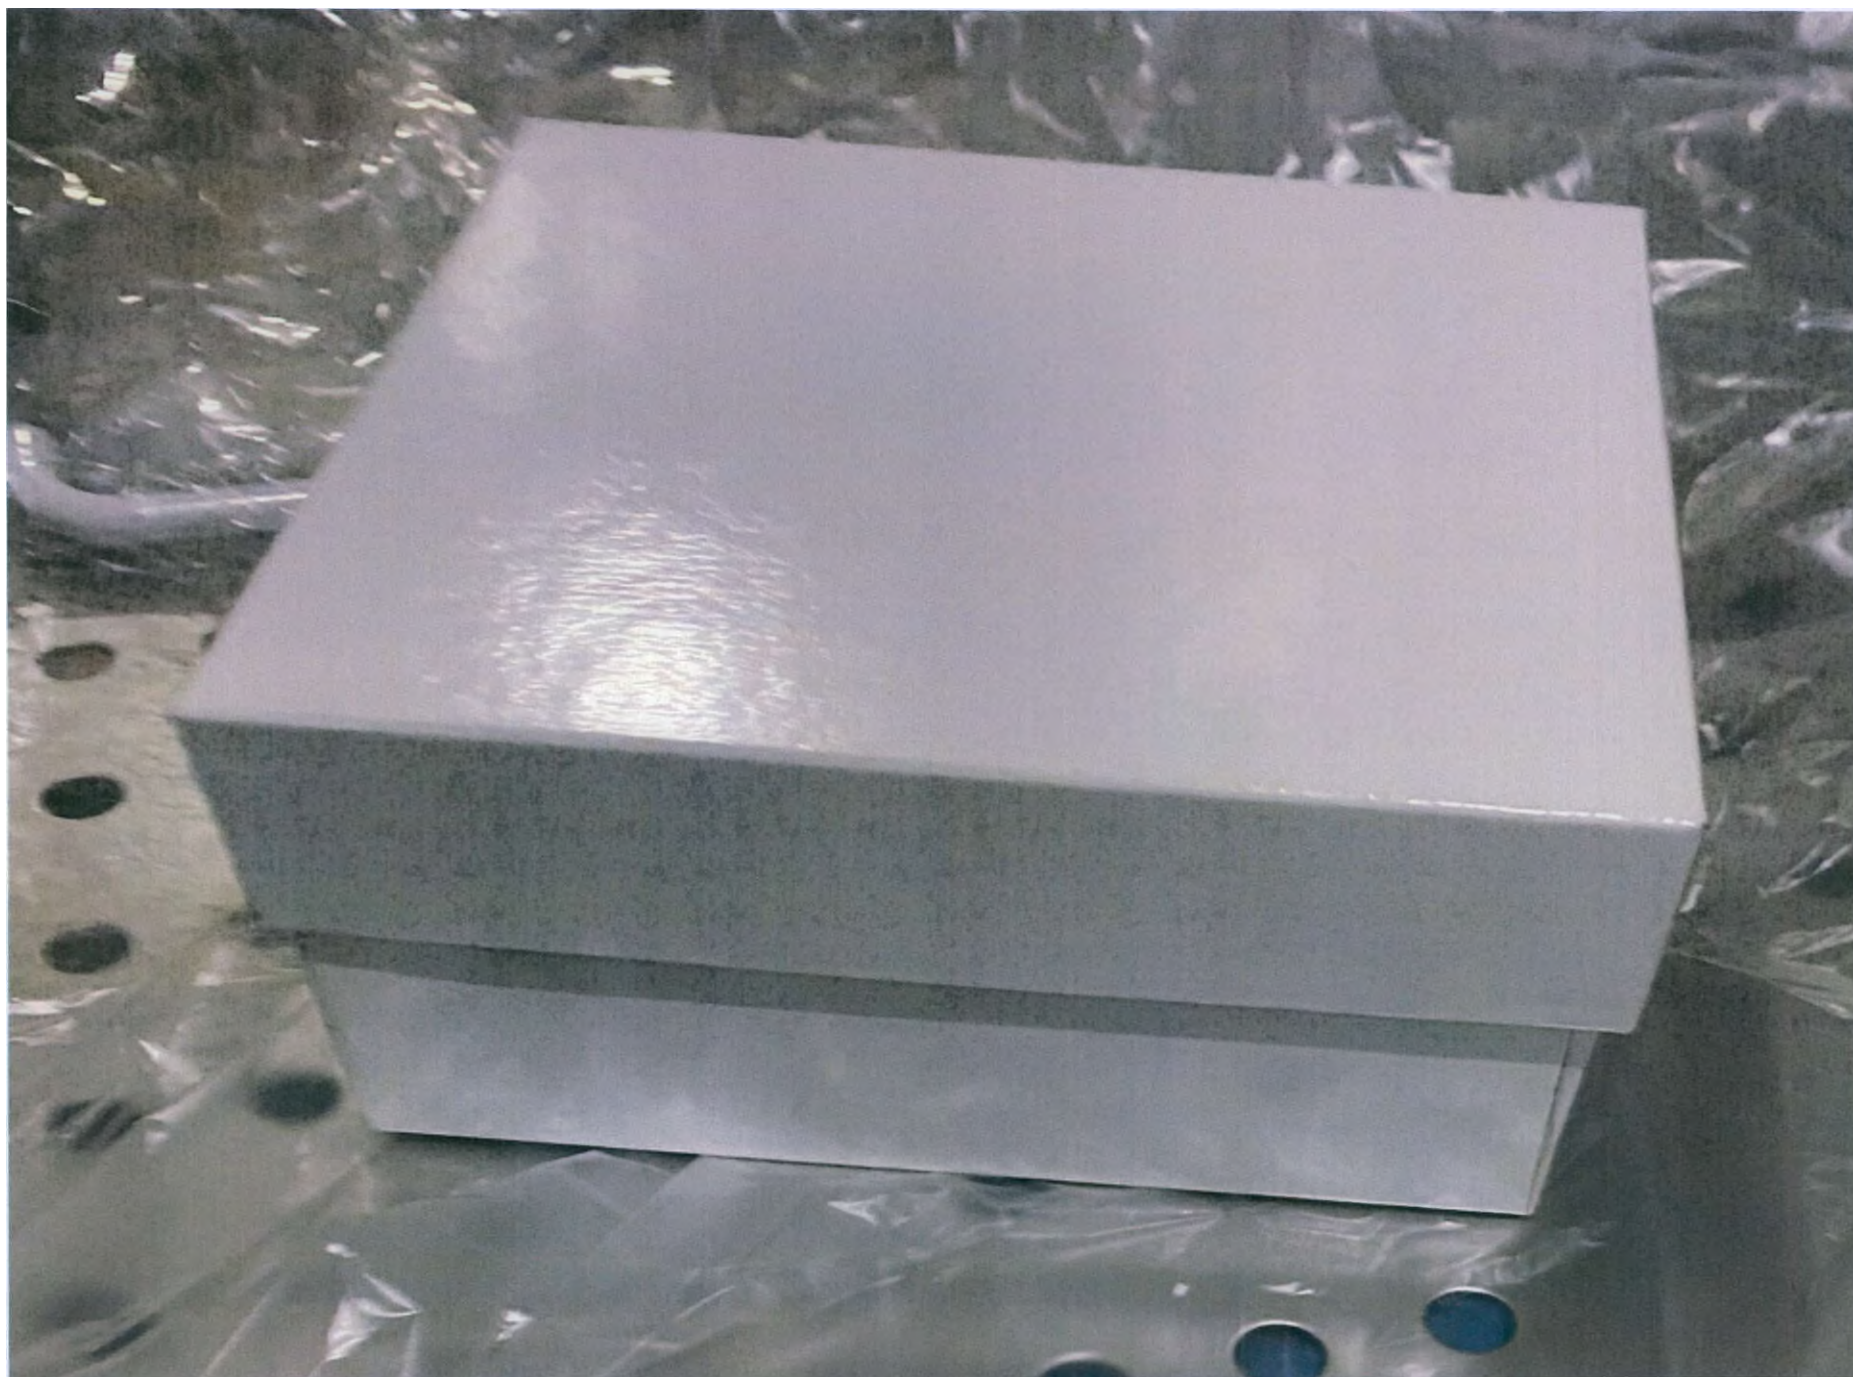

Картонные криобоксы Н75

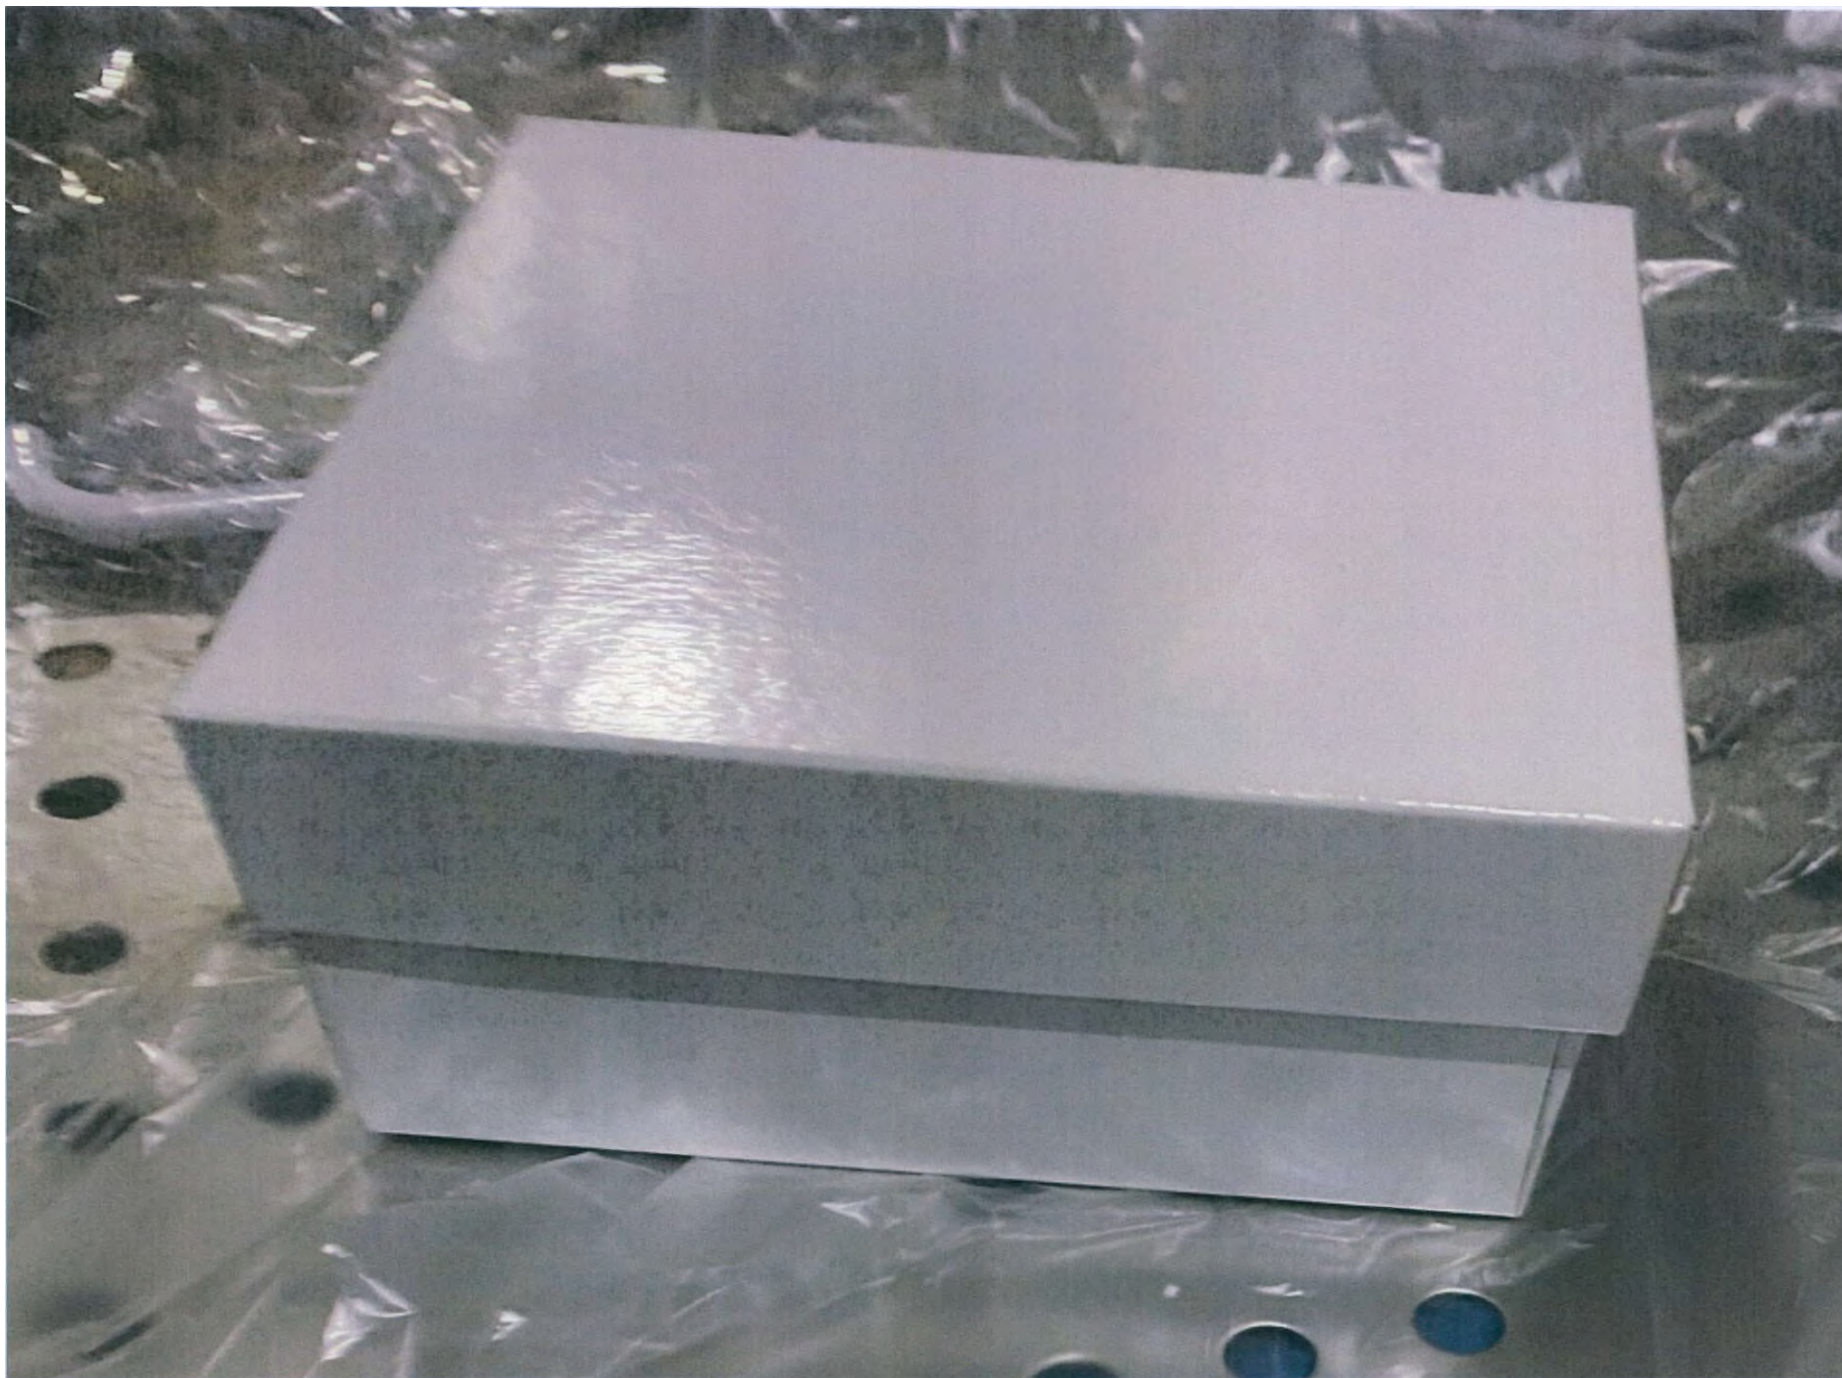

Картонные криобоксы Н100

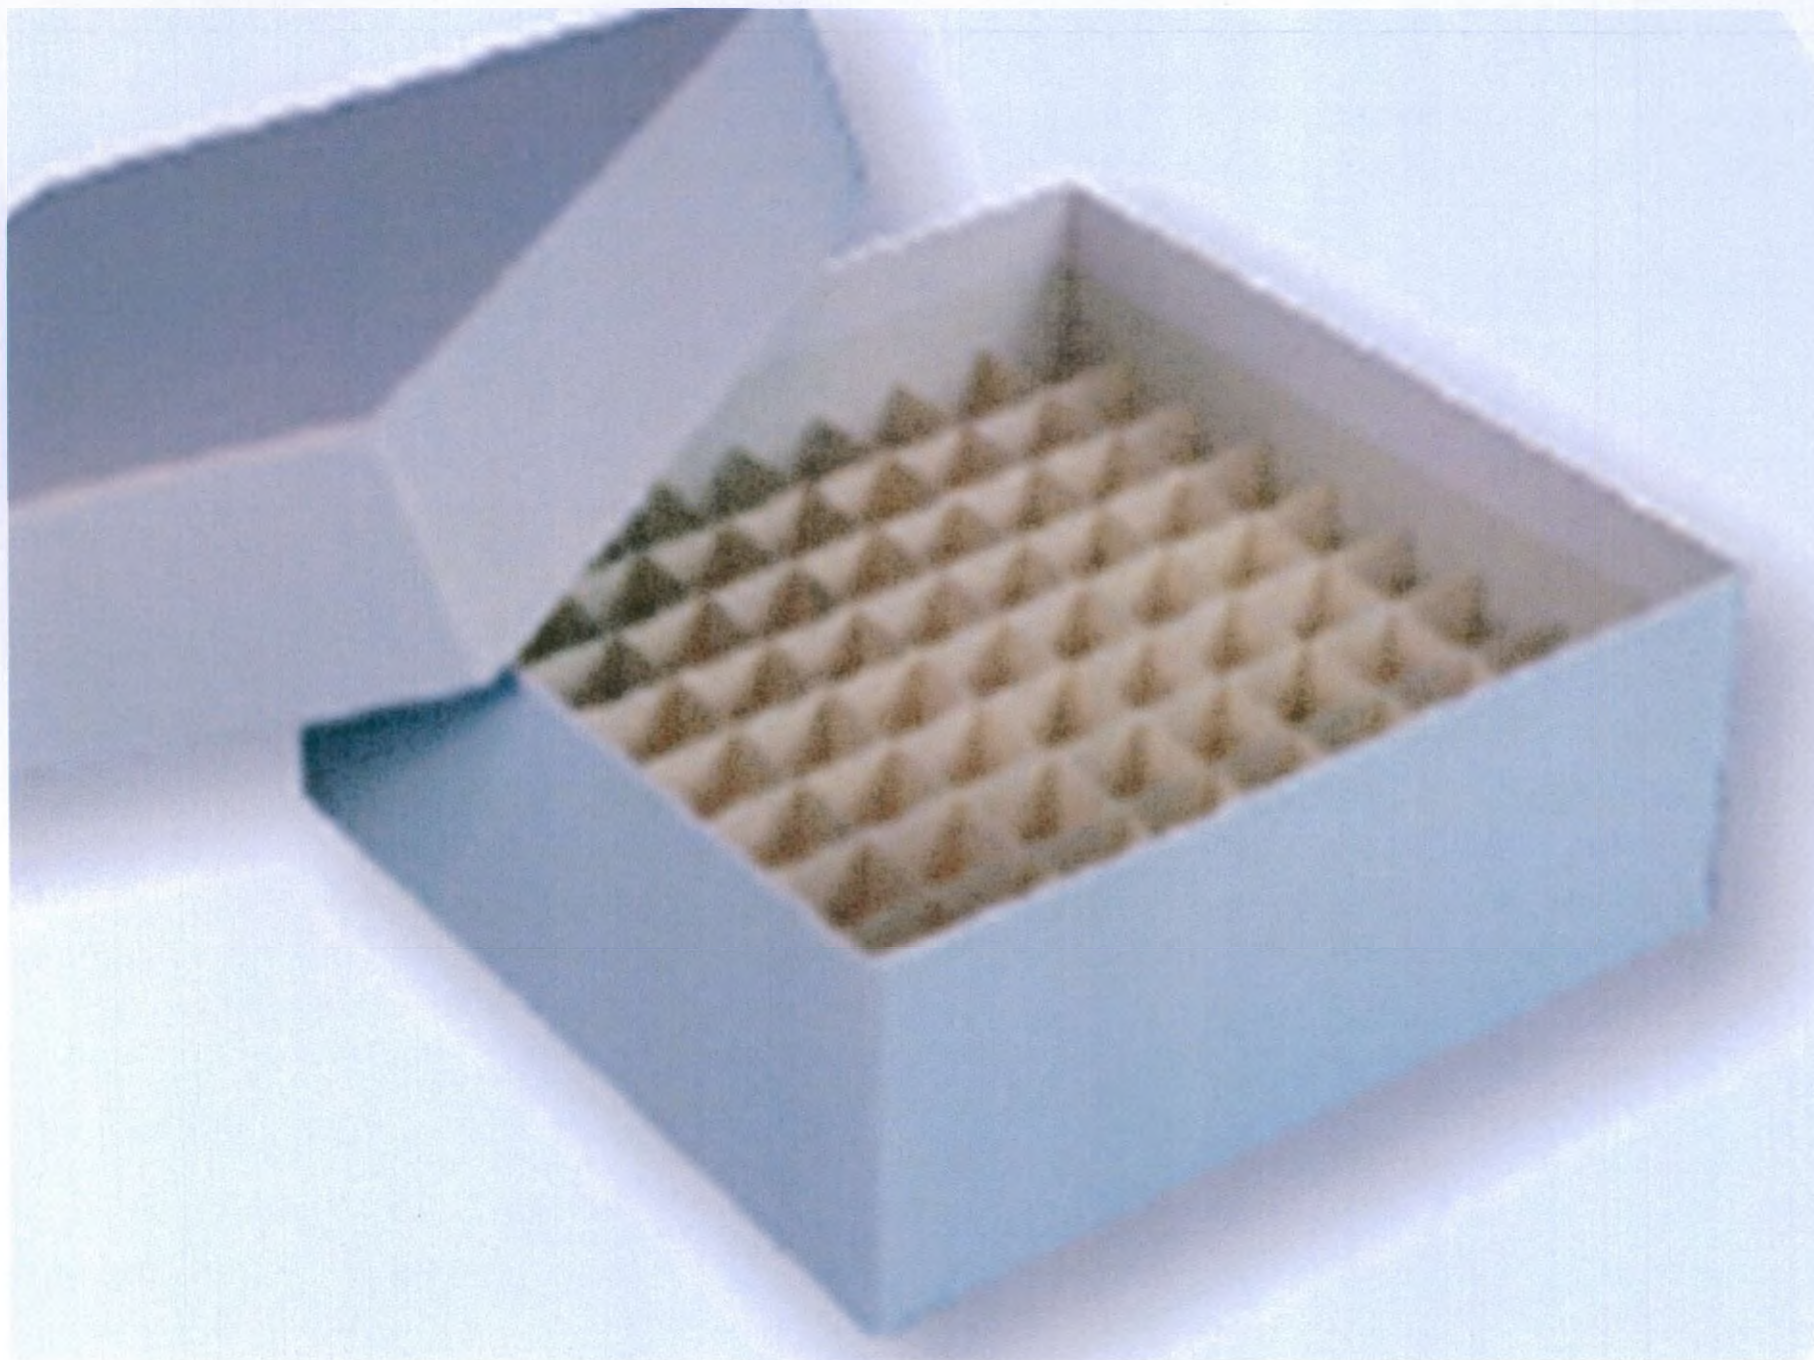

Разделитель для картонных криобоксов




Разделитель для картонных криобоксов



medical
systems

Морозильник медицинский лабораторный
ультранизкотемпературный серии «U» для хранения
компонентов крови и плазмы крови, человеческих клеток,
тканей и других лабораторных образцов

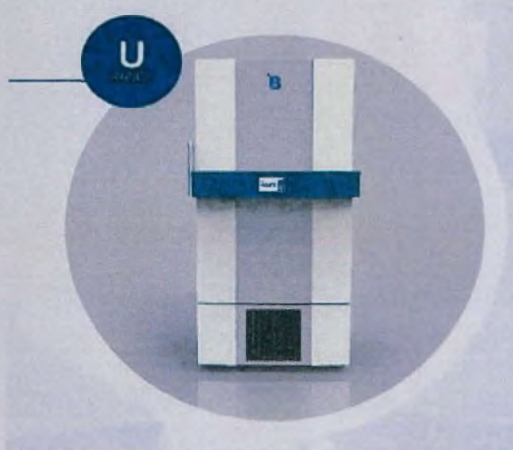

820.9507.24e ed0719

Руководство по эксплуатации

Руководство по эксплуатации на бумажном носителе

Всего прошито, пронумеровано
И скреплено печатью

34/Тридцать четыре листов

Директор Киричков Е.А.

