

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА

медицинского изделия

**СТАНЦИЯ ЗАЛИВКИ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ ПАРАФИНОМ
МОДУЛЬНАЯ AGS,
с принадлежностями**

производства

Ralf W. Weinkauff (Ральф В. Вайнкауф),

Германия

СОДЕРЖАНИЕ

Рисунок 1 – Станция заливки гистологических образцов парафином AGS 2000. Общий вид	3
Рисунок 2 – Станция заливки гистологических образцов парафином AGS 2000. Вид сверху	4
Рисунок 3 – Станция заливки гистологических образцов парафином AGS 2000. Задняя панель	5
Рисунок 4 – Охлаждающий блок AGS-KP20. Общий вид	6
Рисунок 5 – Охлаждающий блок AGS-KP20. Задняя панель	7
Рисунок 6 – Подогревающий блок AGS-WP20 со снятой крышкой. Общий вид	8
Рисунок 7 – Подогревающий блок AGS-WP20. Задняя панель	9
Рисунок 8 – Пинцет подогреваемый. Общий вид	10
Рисунок 9 – Лупа	11
Рисунок 10 – Ножной переключатель	12
Рисунок 11 – Кабель для подключения модулей к питающей сети	13
Рисунок 12 – Упакованная для транспортирования Станция заливки гистологических образцов парафином AGS 2000	14
Рисунок 13 – Упакованный для транспортирования Модуль подогревающий AGS-WP20	15
Рисунок 14 – Упакованный для транспортирования Модуль охлаждающий AGS-KP20	16
Рисунок 15 – Упаковка для транспортирования медицинского изделия «Станция заливки гистологических образцов парафином модульная AGS, с принадлежностями»	17

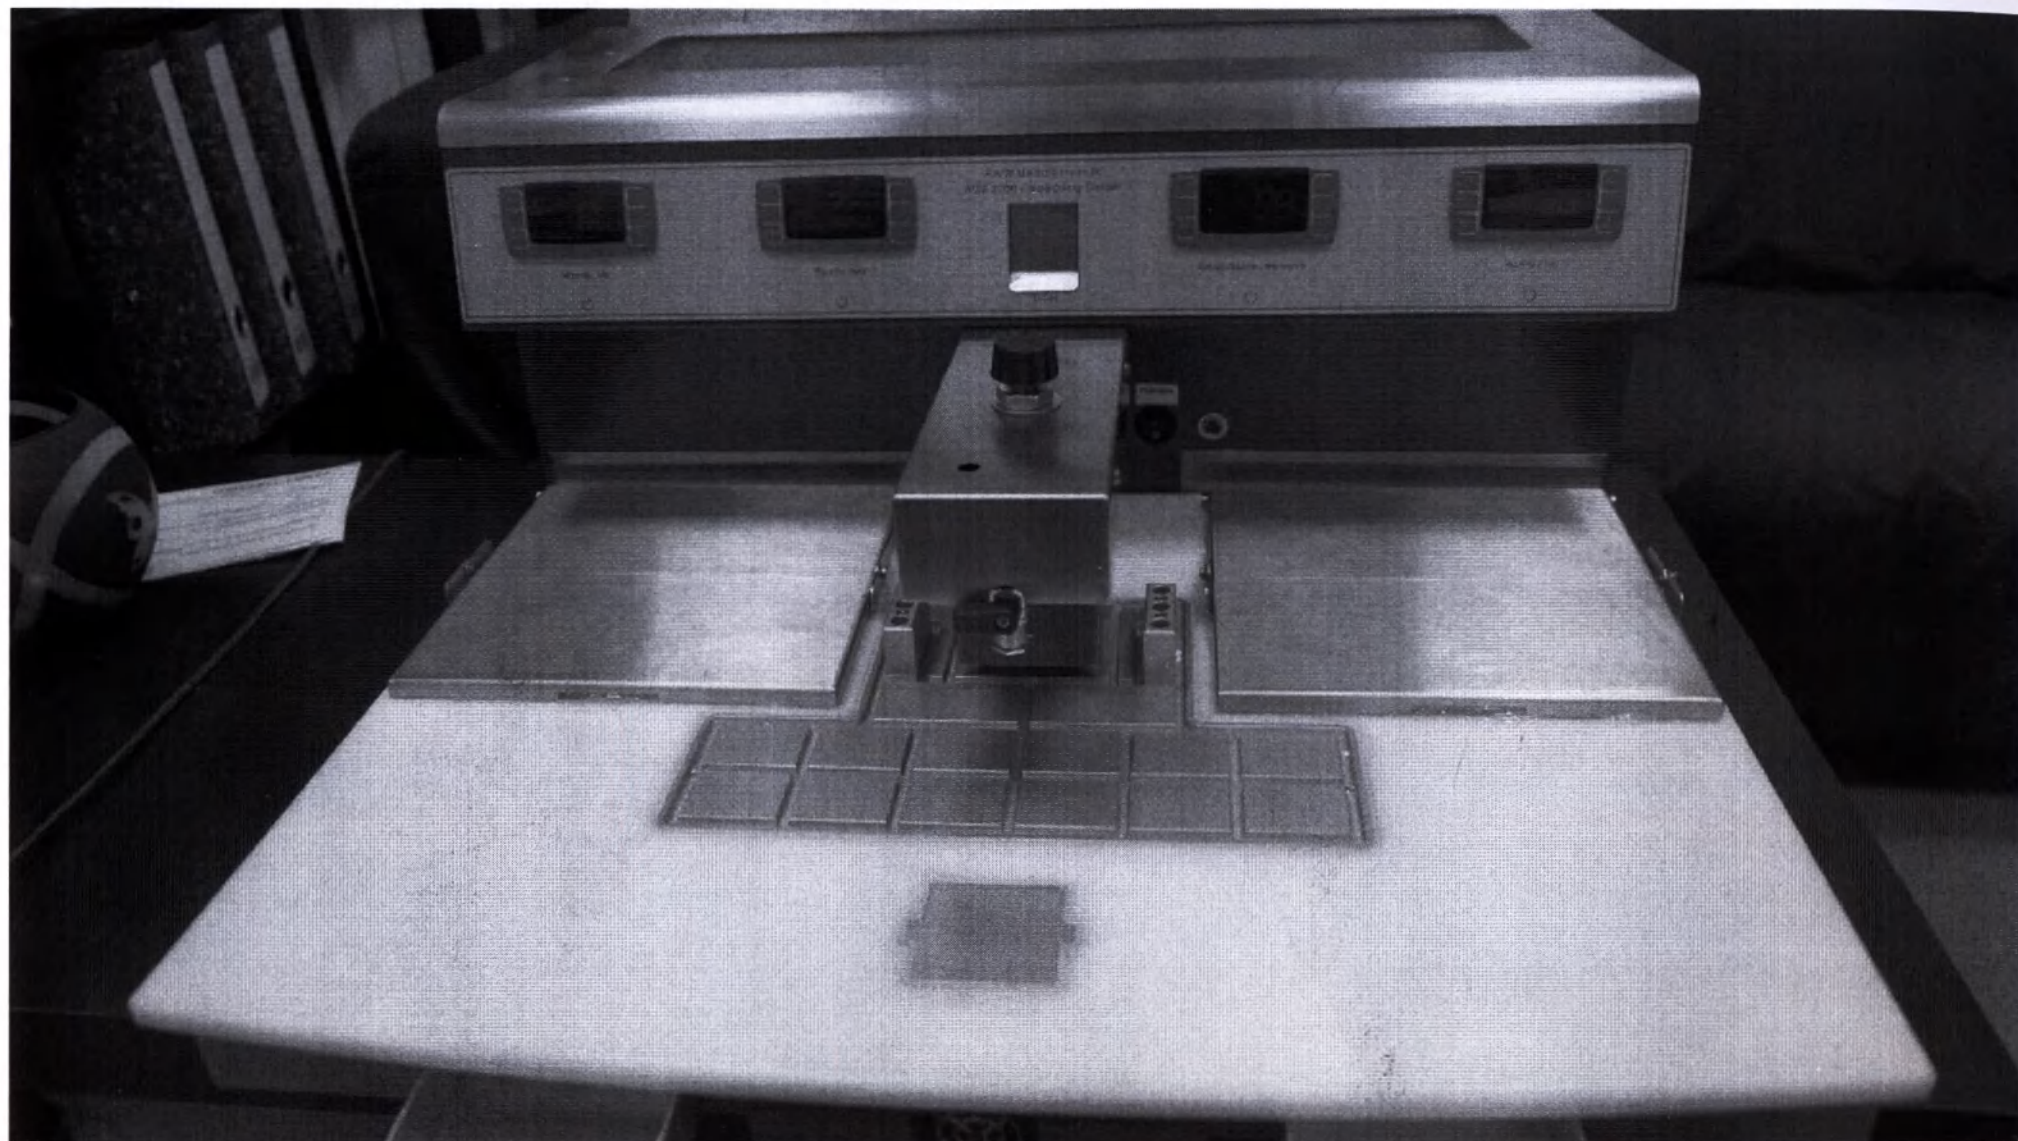


Рисунок 1 – Станция заливки гистологических образцов парафином AGS 2000. Общий вид

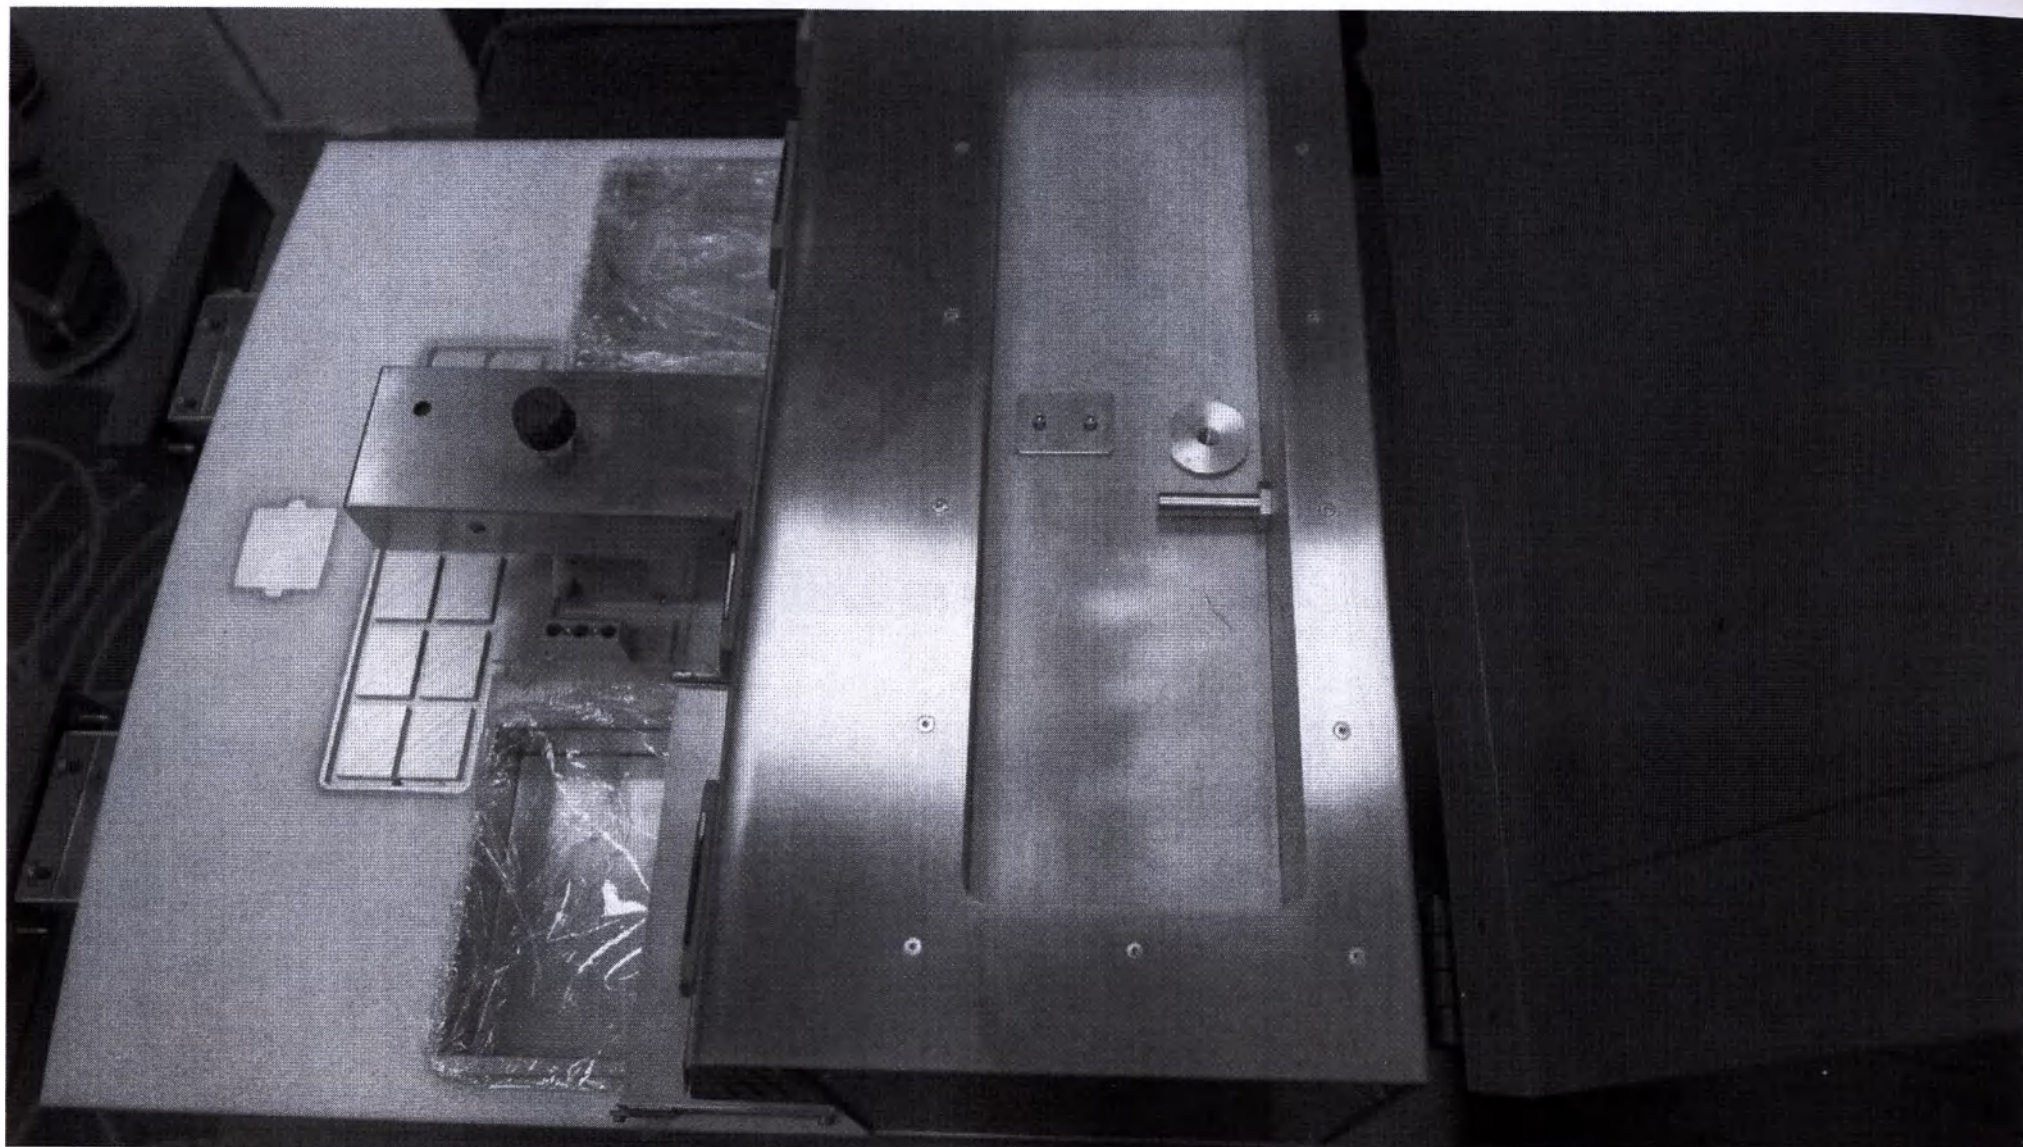


Рисунок 2 – Станция заливки гистологических образцов парафином AGS 2000. Вид сверху



Рисунок 3 – Станция заливки гистологических образцов парафином AGS 2000. Задняя панель

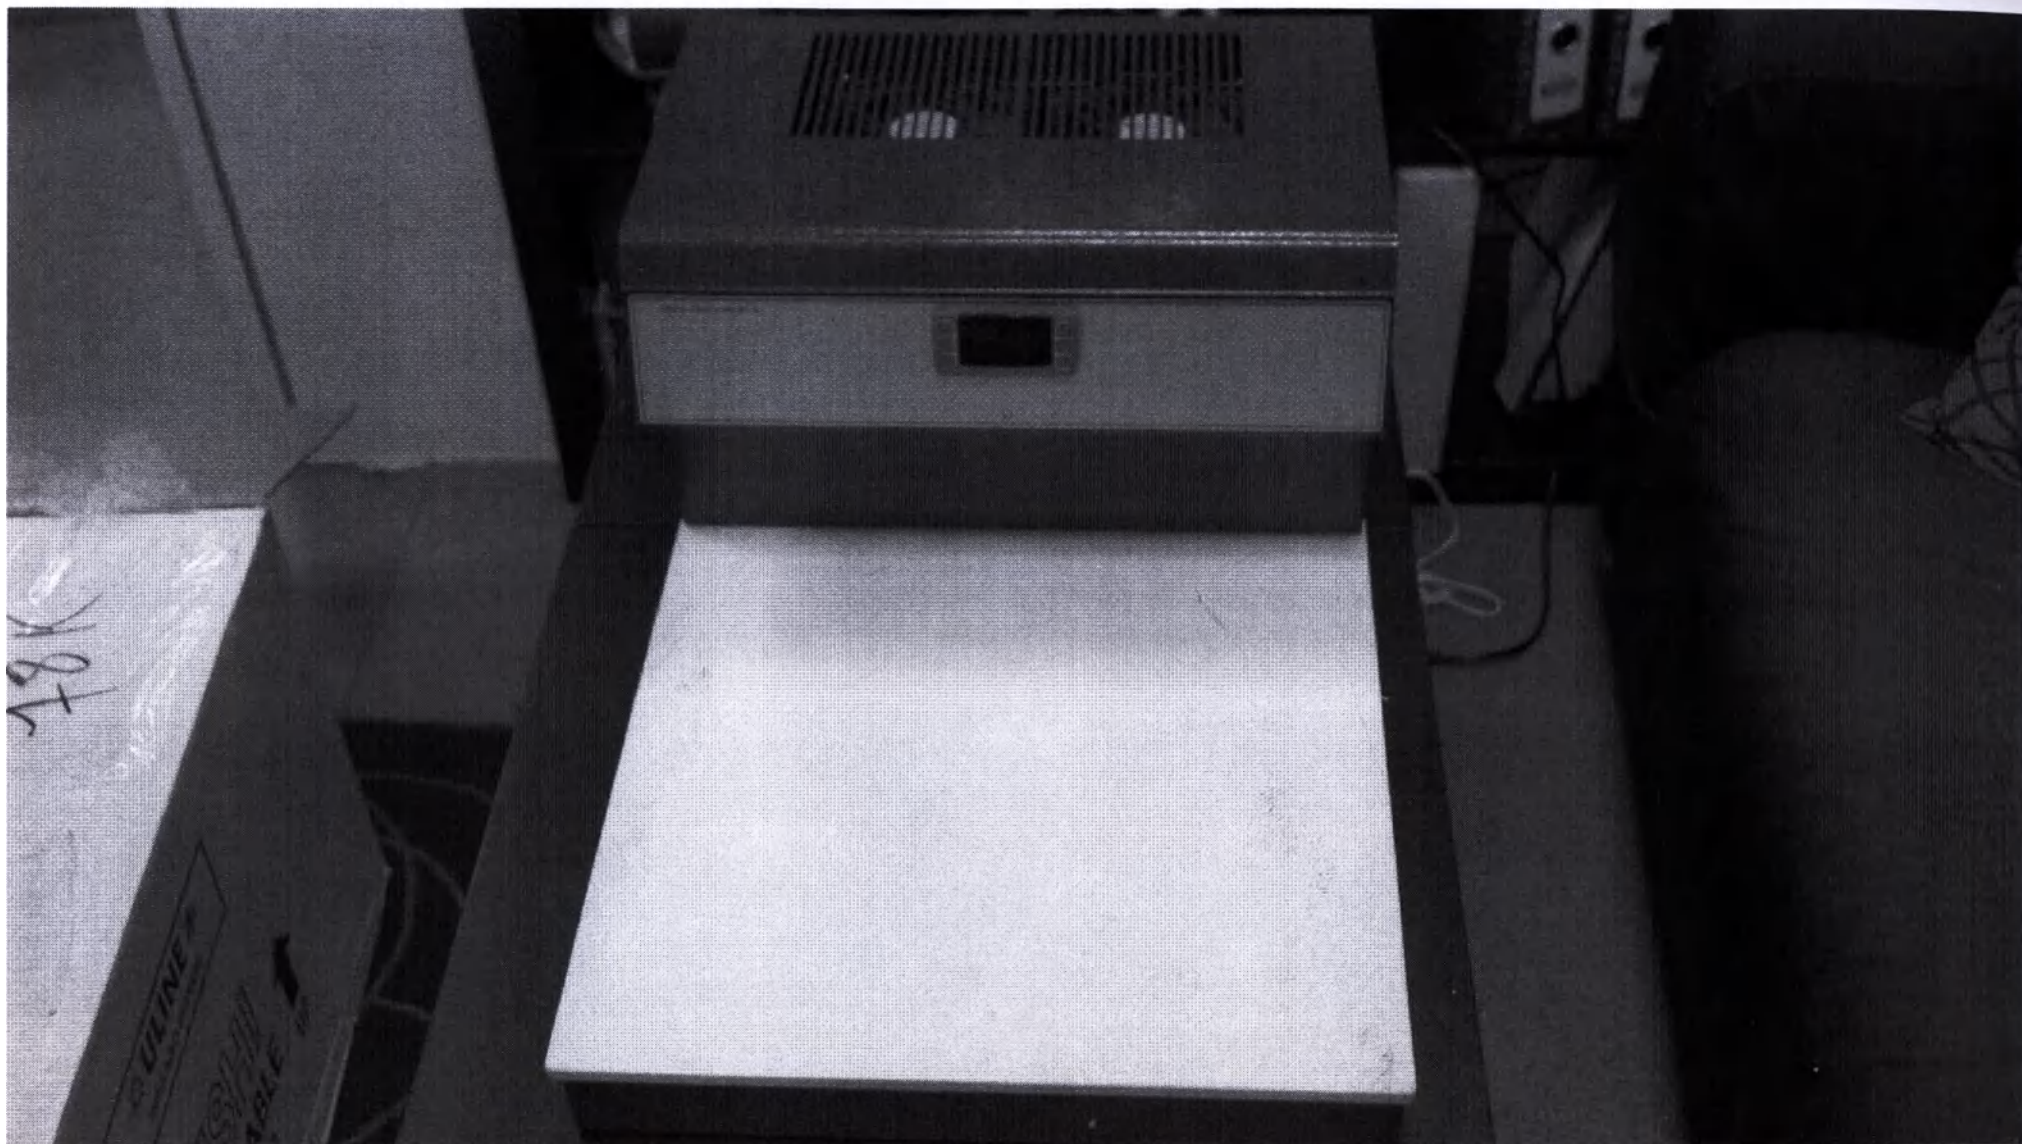


Рисунок 4 – Охлаждающий блок AGS-KP20. Общий вид

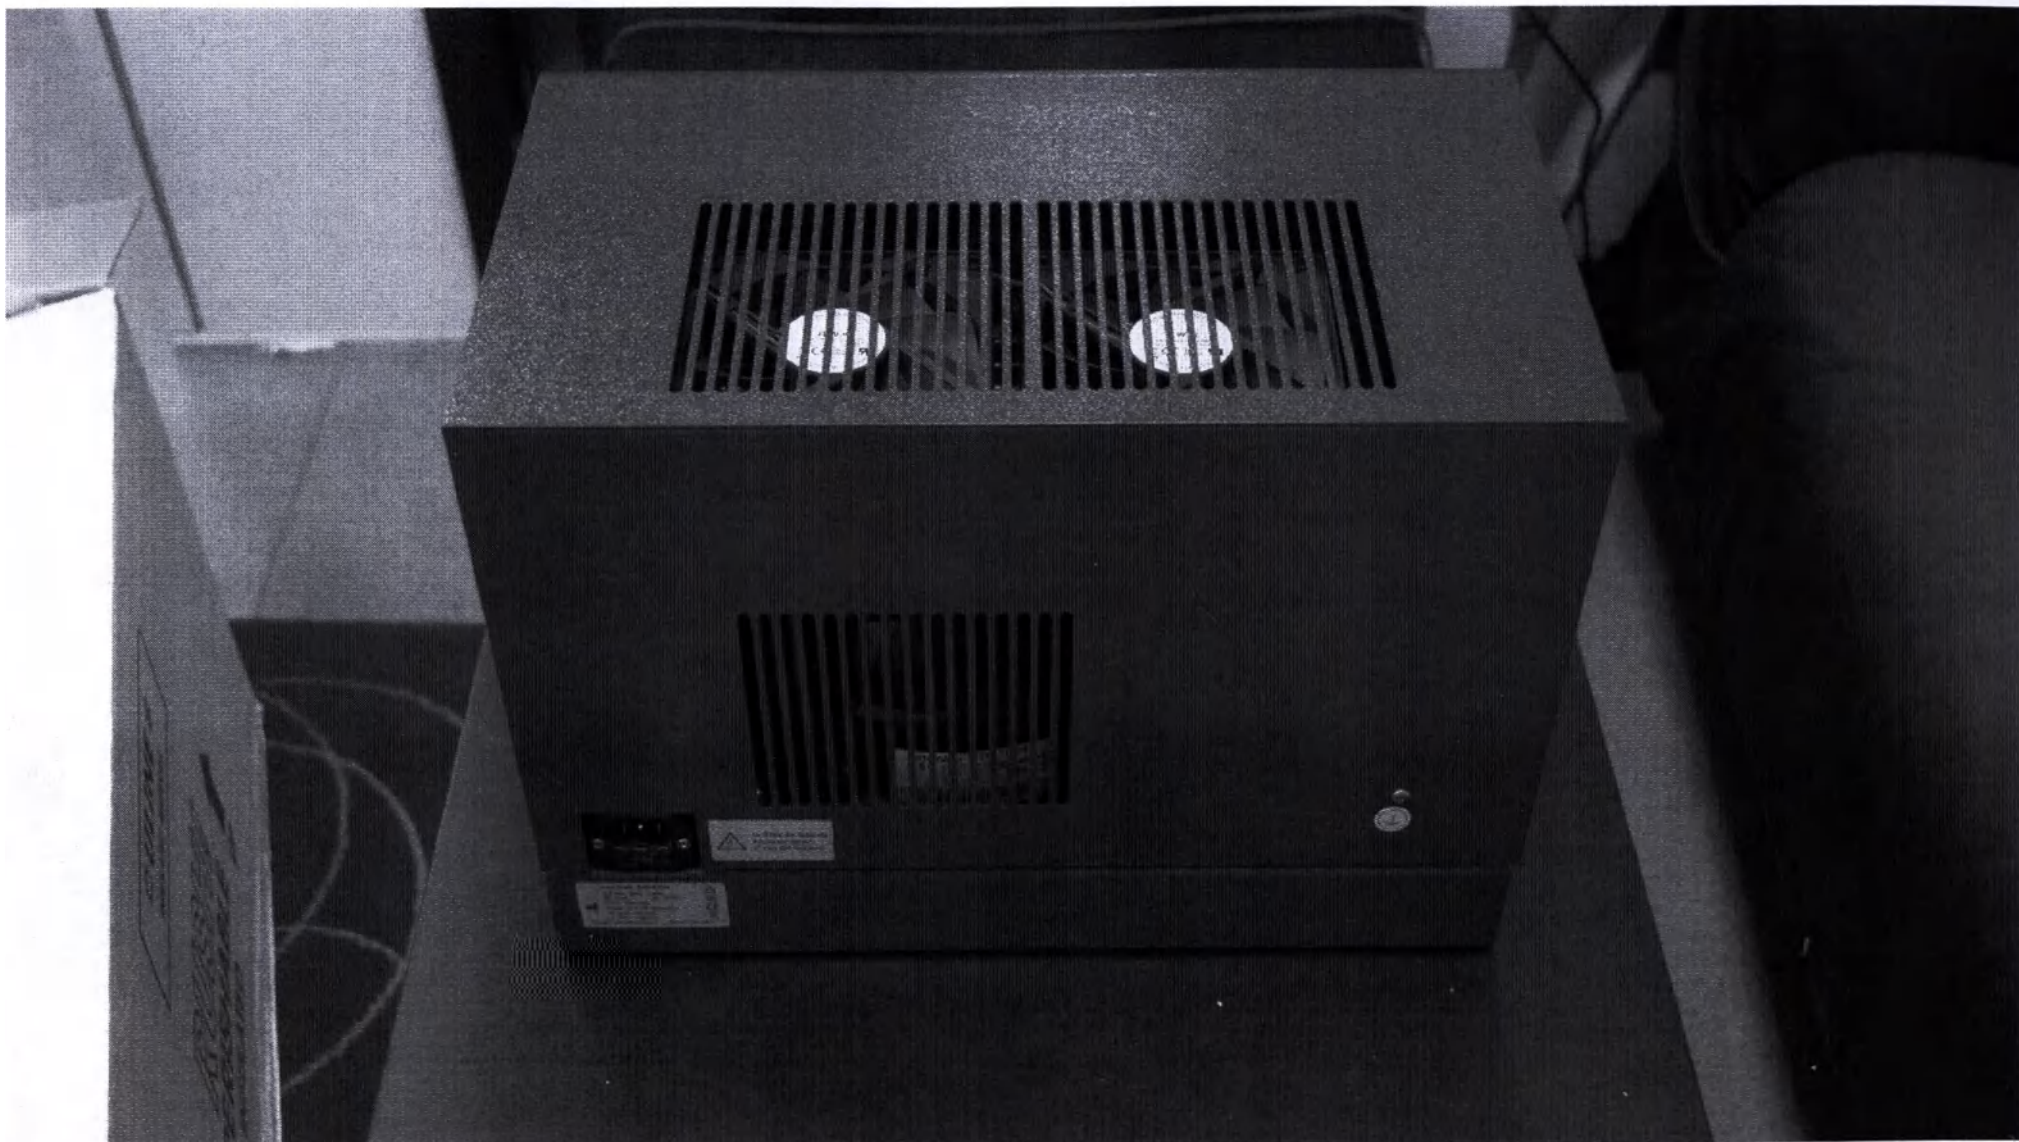


Рисунок 5 – Охлаждающий блок AGS-KP20. Задняя панель



Рисунок 6 – Подогревающий блок AGS-WP20 со снятой крышкой. Общий вид

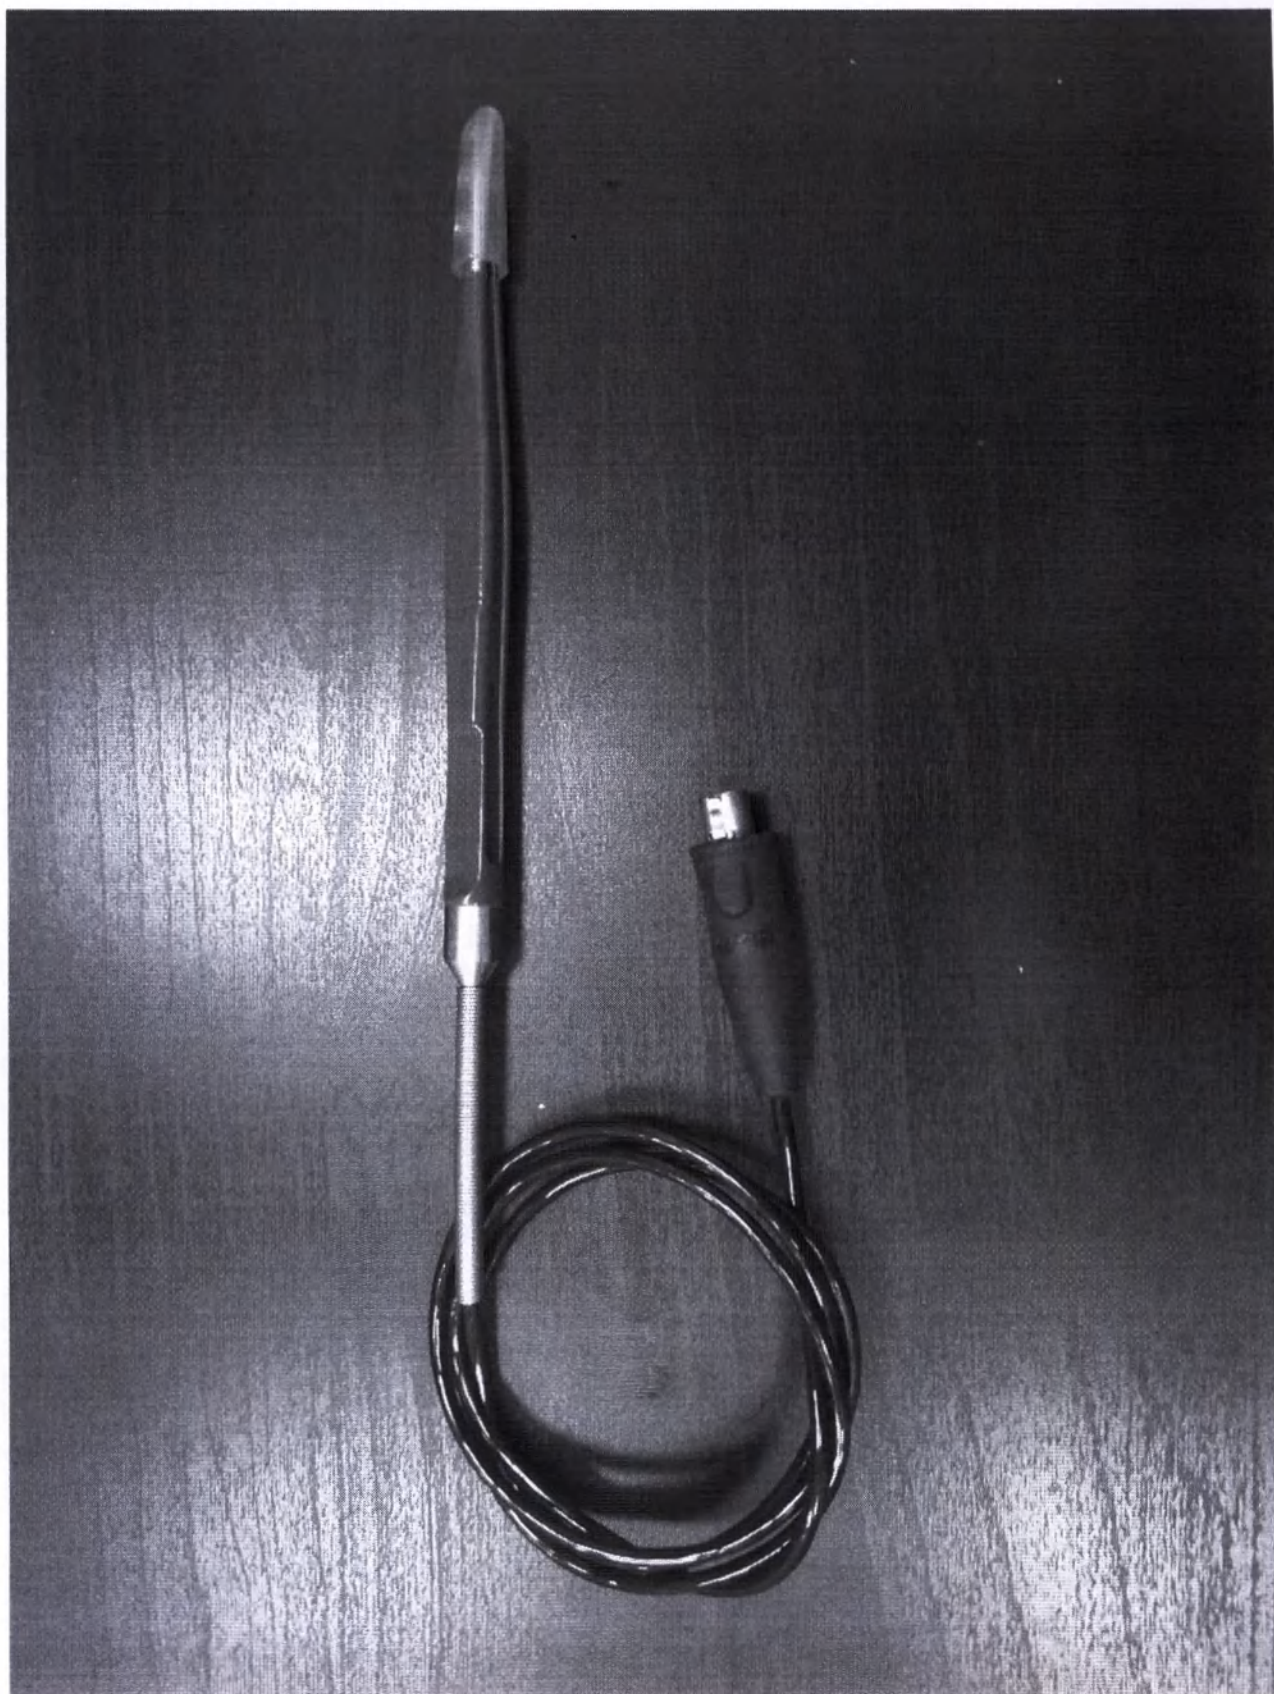


Рисунок 8 – Пинцет подогреваемый. Общий вид

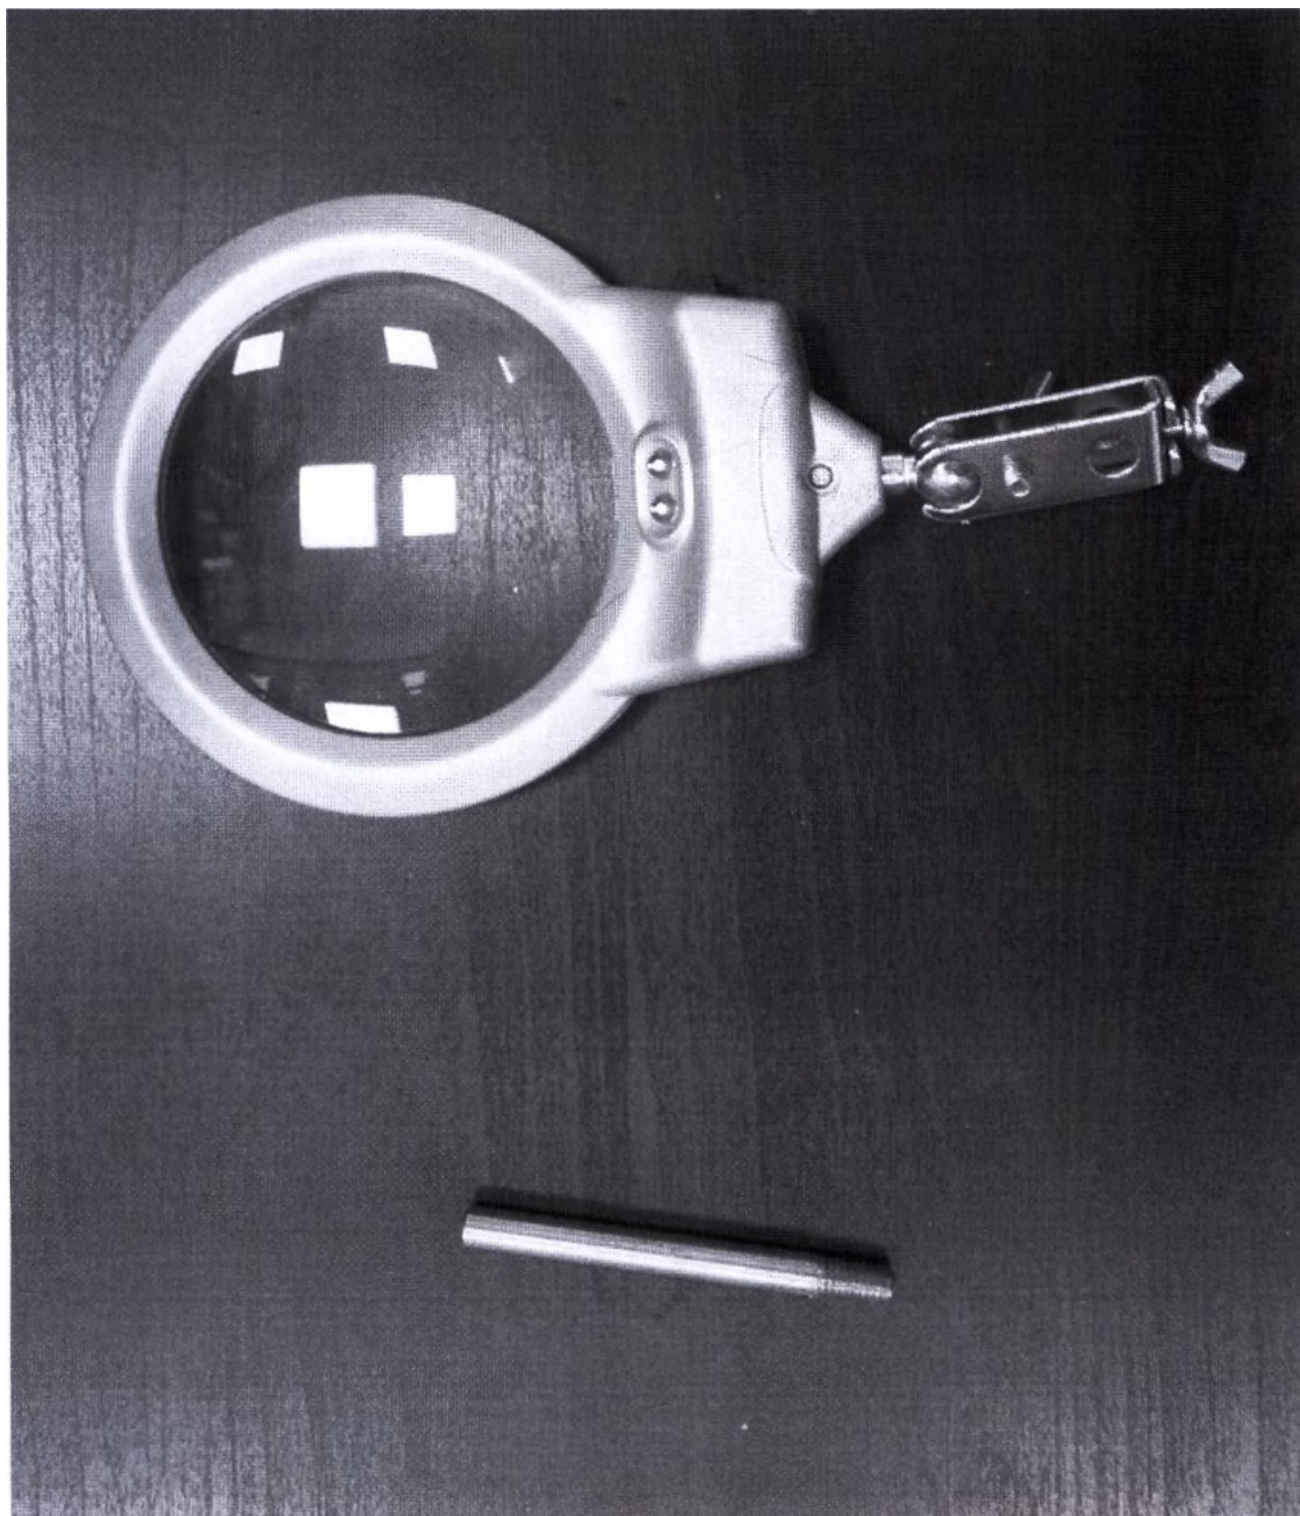


Рисунок 9 – Лупа



Рисунок 10 – Ножной переключатель



Рисунок 11 – Кабель для подключения модулей к питающей сети

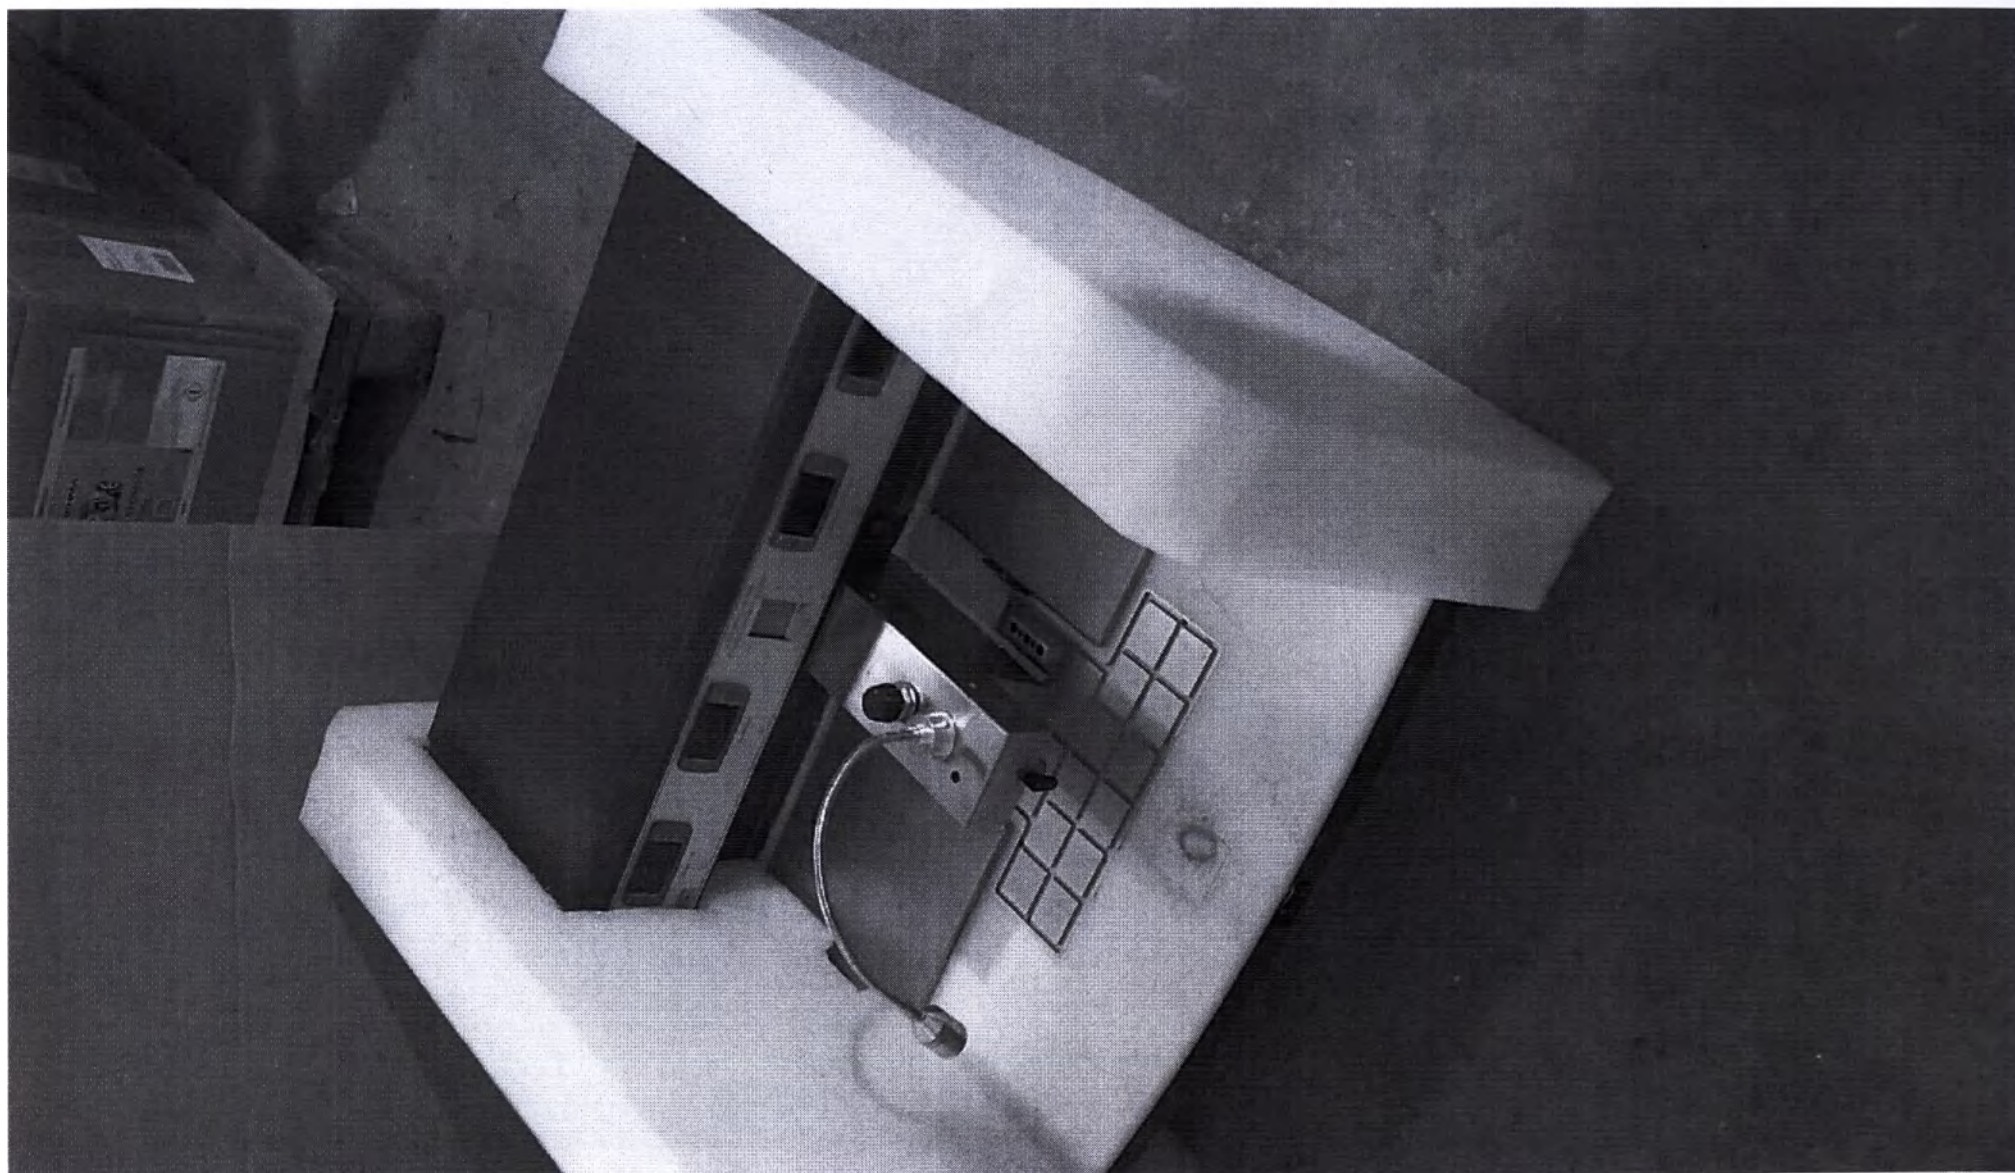


Рисунок 12 – Упакованная для транспортирования Станция заливки гистологических образцов парафином AGS 2000

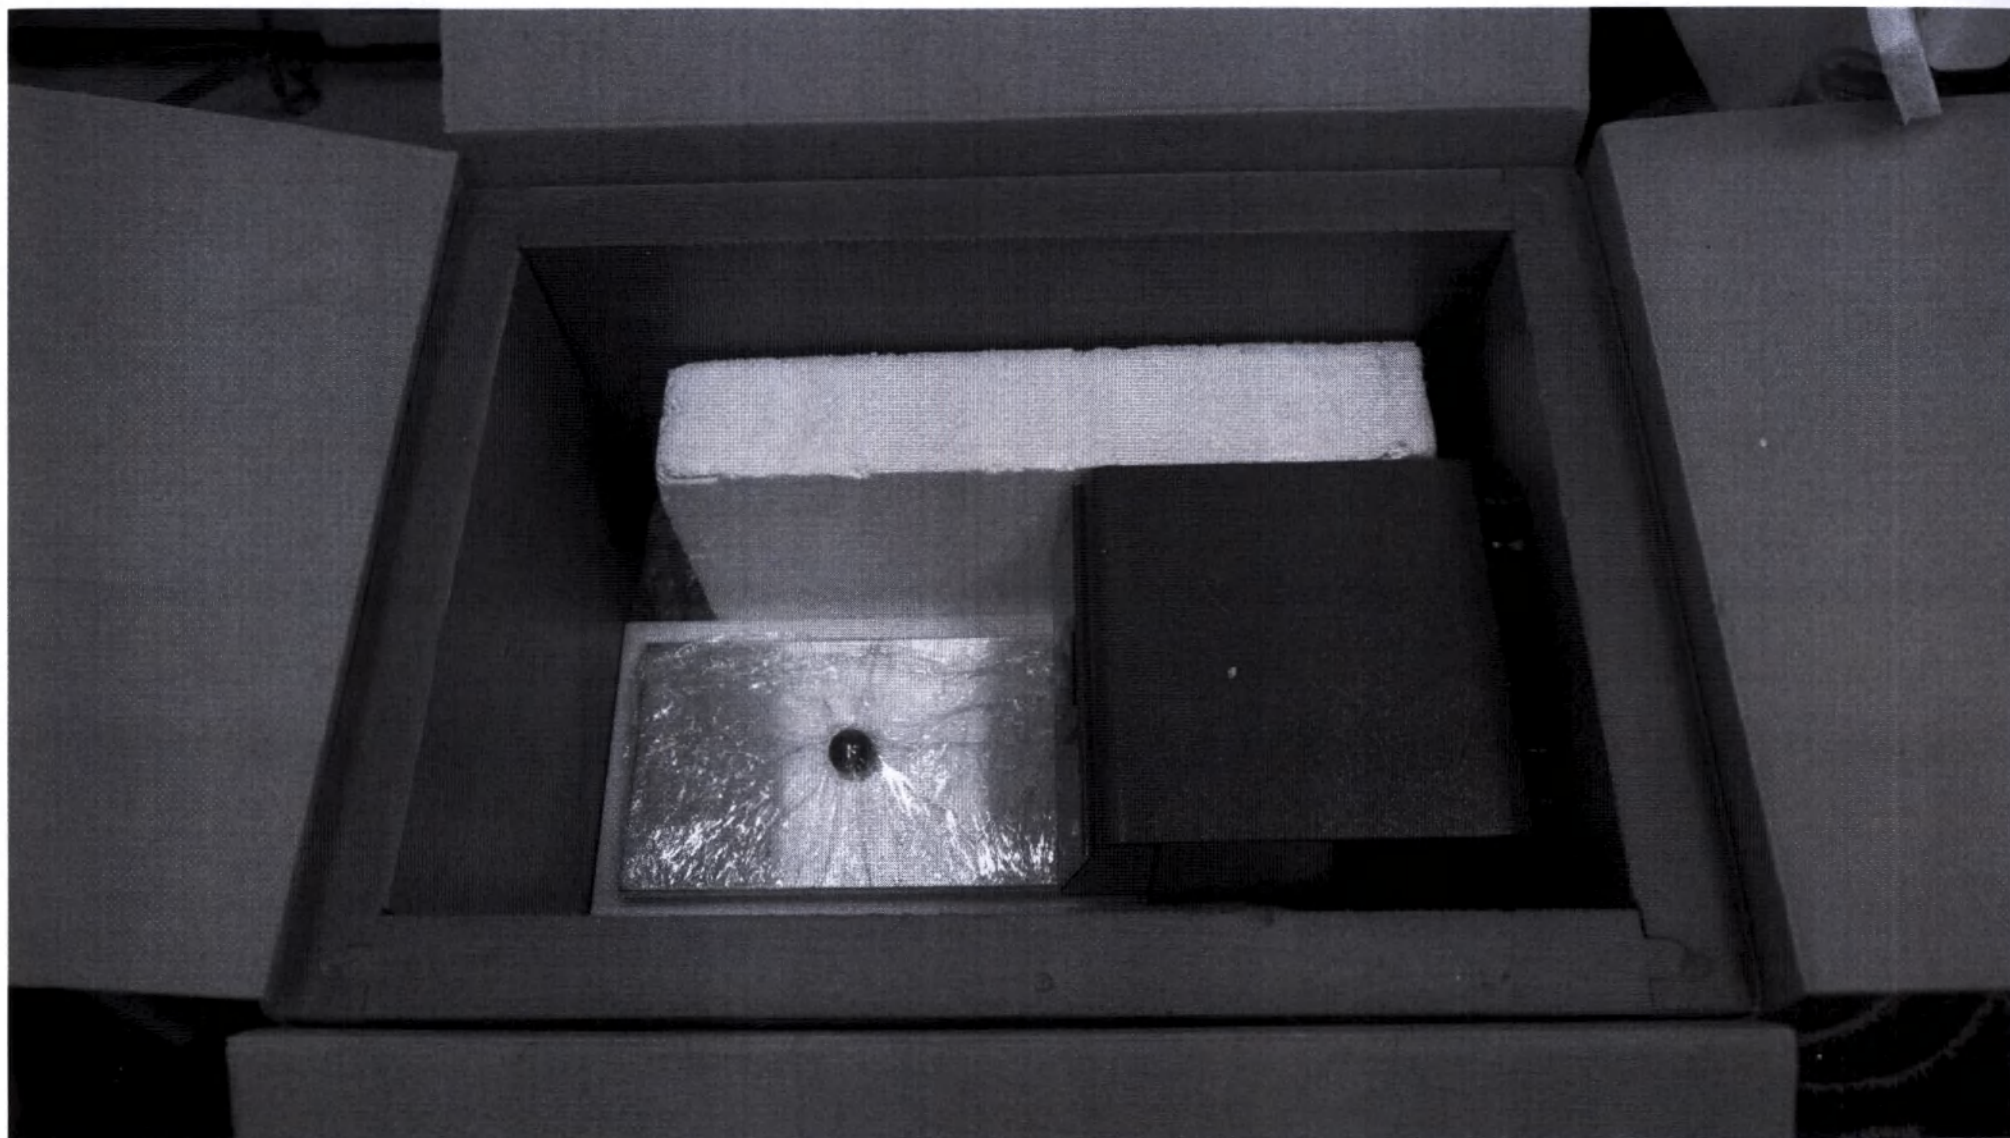


Рисунок 13 – Упакованный для транспортирования Модуль подогревающий AGS-WP20

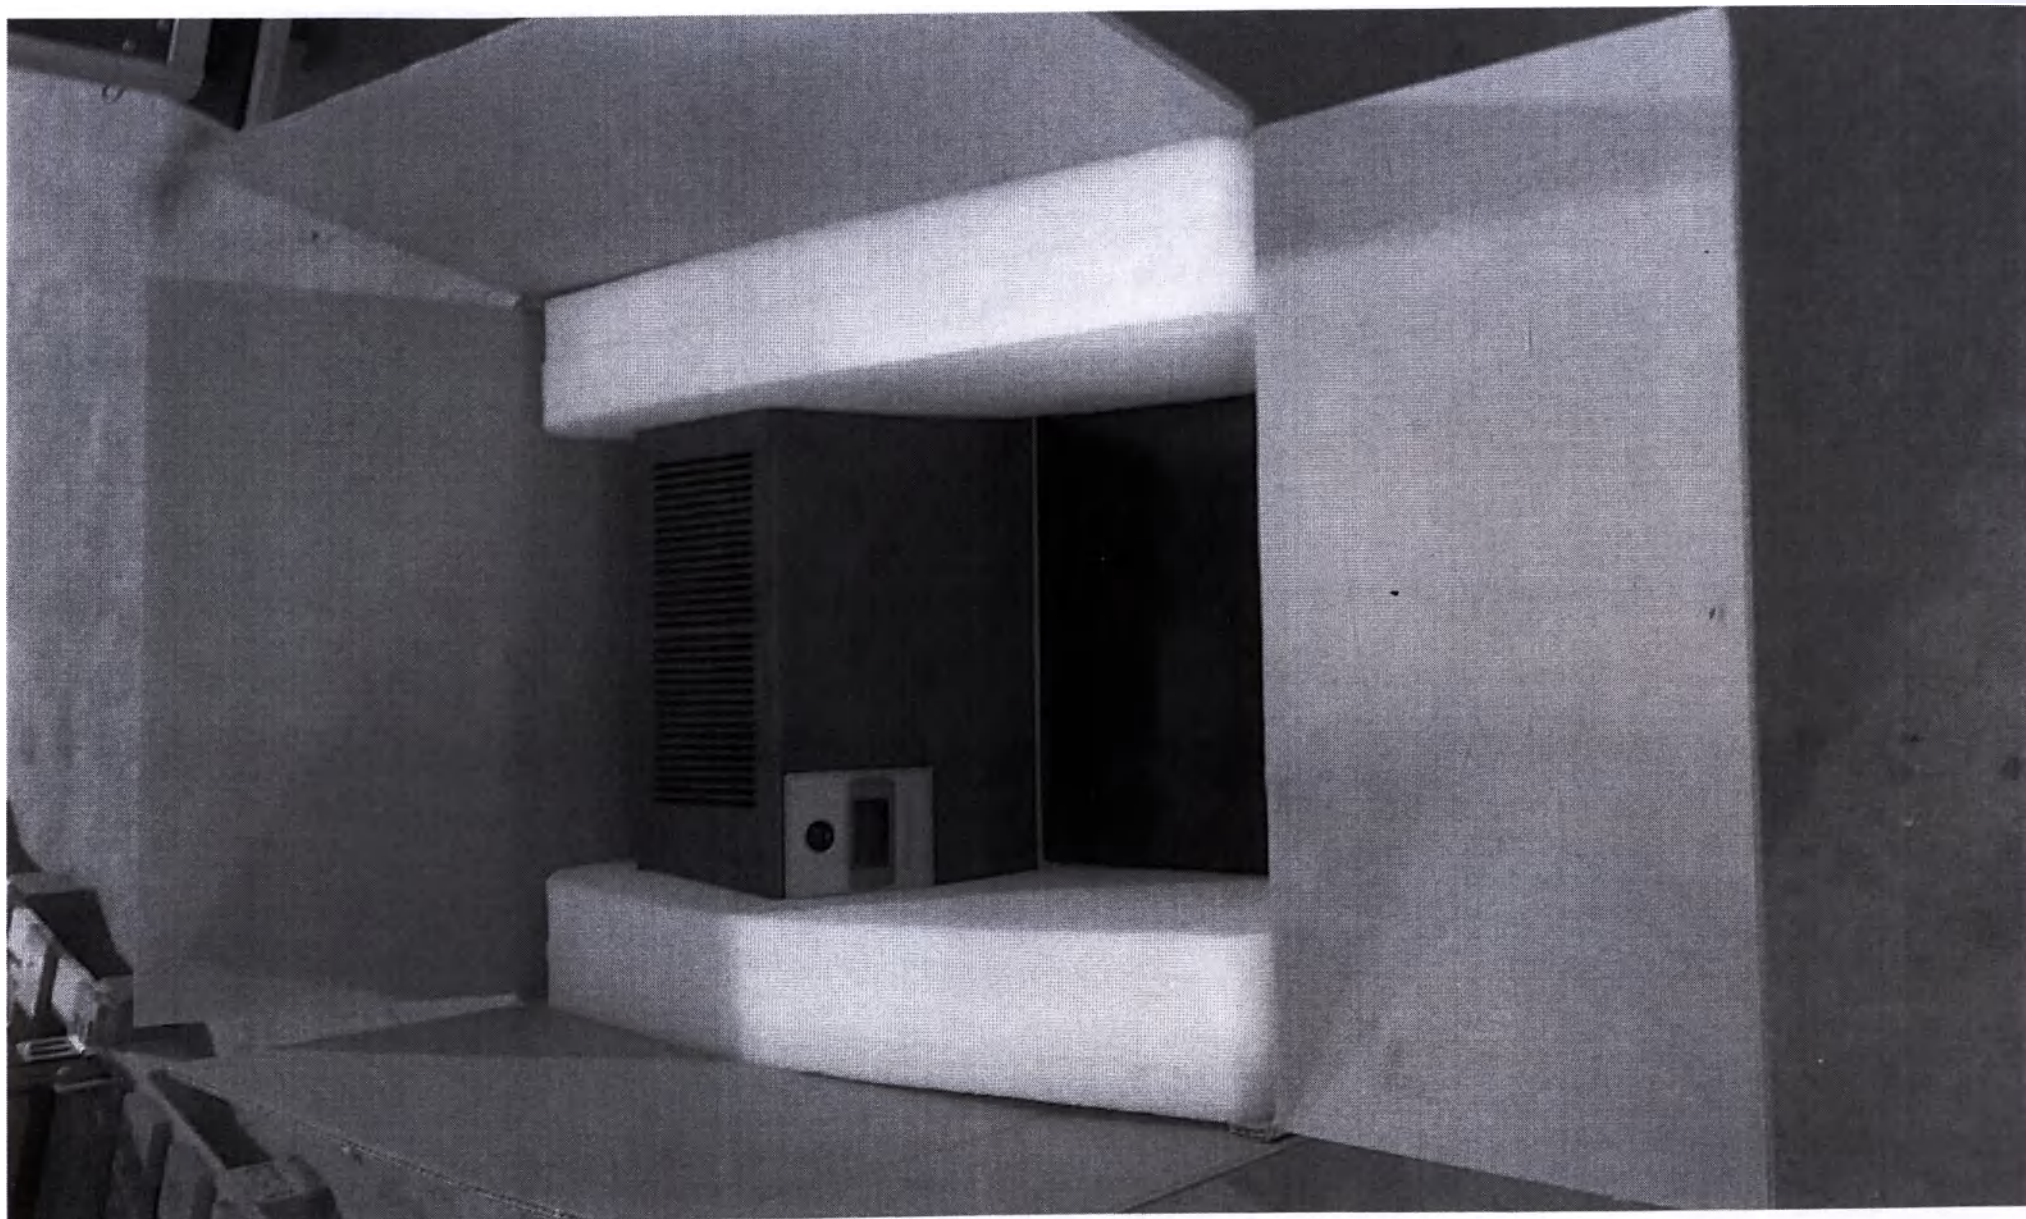


Рисунок 14 – Упакованный для транспортирования Модуль охлаждающий AGS-KP20

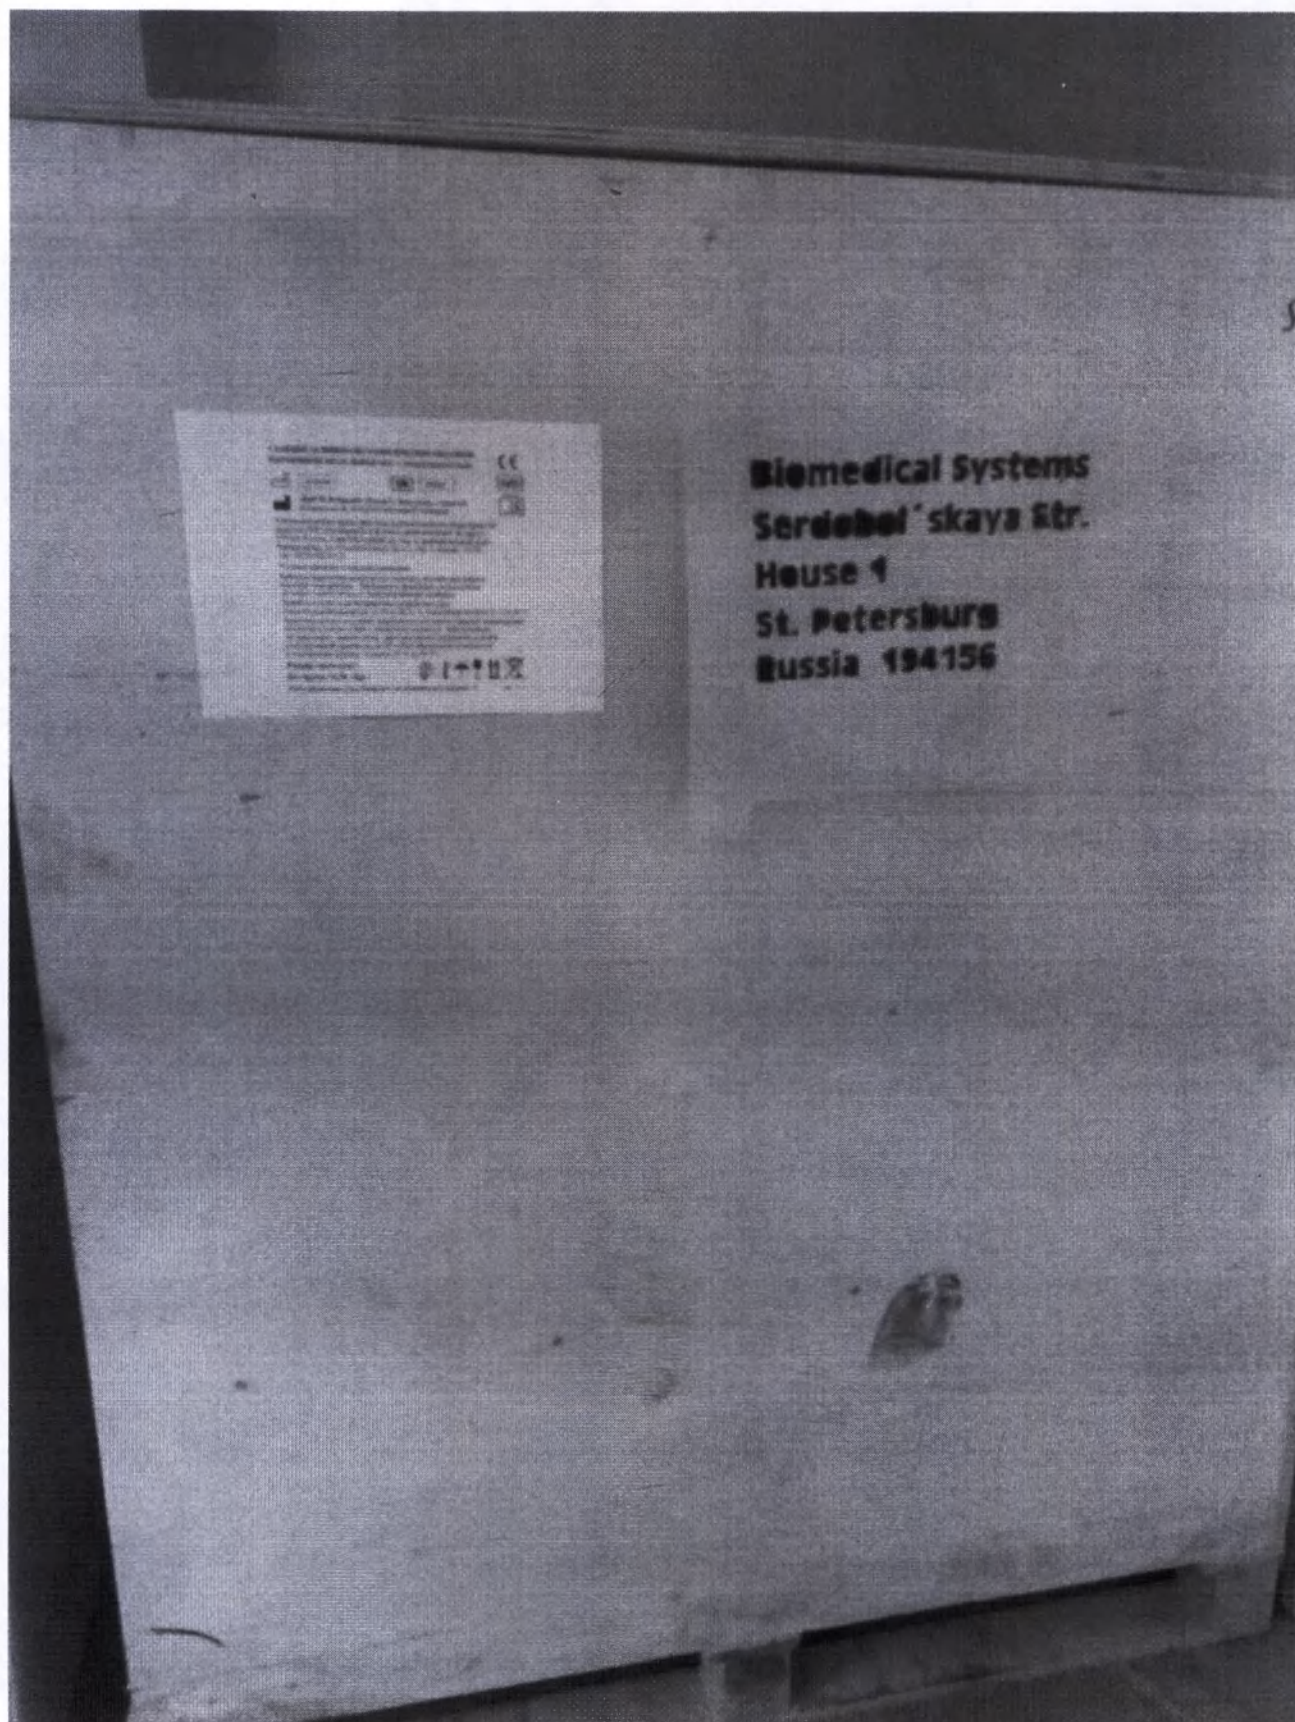


Рисунок 15 – Упаковка для транспортирования медицинского изделия «Станция заливки гистологических образцов парафином модульная AGS, с принадлежностями»

Итого в документе
пронумеровано и прошито



листов

Генеральный директор
ООО «БИОМЕДИКАЛ СИСТЕМС»

В.В. Березин