


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НаноМед»

 А.А. Ходяков

11 2023 г.



Фотографическое изображение медицинского изделия:

«Катетер баллонный для ангиопластики «Natrix» для коронарной артерии с лекарственным антипролиферативным
покрытием по НАЕФ.942511.028 ТУ»,
производства ООО «НаноМед»

2023 год

катетер баллонный для ангиопластики

«Natrix»

для коронарной артерии

с лекарственным антипролиферативным покрытием

RX SP 2,5/14-DE-142-14

с баллоном стандартного давления

Содержит лекарственное средство наплатасон



NanoMed

XXX	катетер баллонный для ангиопластики «Natrix» для коронарной артерии с лекарственным антипролиферативным покрытием RX SP 2,5/14-DE-142-14 РАЗМЕР БАЛЛОНА 2,5х14 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО 2026-03
XXX	катетер баллонный для ангиопластики «Natrix» для коронарной артерии с лекарственным антипролиферативным покрытием RX SP 2,5/14-DE-142-14 РАЗМЕР БАЛЛОНА 2,5х14 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО 2026-03
XXX	катетер баллонный для ангиопластики «Natrix» для коронарной артерии с лекарственным антипролиферативным покрытием RX SP 2,5/14-DE-142-14 РАЗМЕР БАЛЛОНА 2,5х14 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО 2026-03
XXX	катетер баллонный для ангиопластики «Natrix» для коронарной артерии с лекарственным антипролиферативным покрытием RX SP 2,5/14-DE-142-14 РАЗМЕР БАЛЛОНА 2,5х14 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО 2026-03


2,5 MM

14 MM

0,36 MM/0,014"

1,67 MM (5F)

ДИАМЕТР БАЛЛОНА — ДЛИНА БАЛЛОНА — ПРОВОДНИК Ø МАКС ПРОВ. КАТЕТЕР Ø МИН.

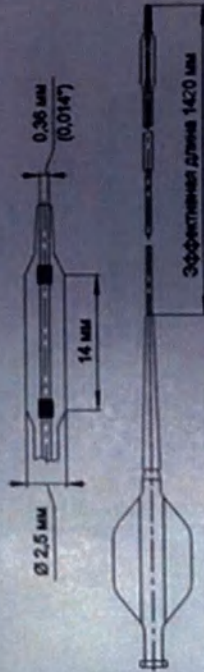

2023-03

2026-03

LOT 23.03-0021

Давление атм/ x10 ² , кПа	Диаметр баллона ± 10%, мм
7	2,33
8	2,41
9 (Номинал)	2,50
10	2,54
11	2,59
12	2,64
13	2,68
14	2,71
15	2,75
16 (Максимум)	2,78

NanoMed

ООО «НаноМед», 440068, Россия, г. Пенза,

ул. Центральная, д.1

тел. (8412) 38-09-59, 38-06-63

E-mail: nanomed.penza@mail.ru

http://www.medeng.ru

Катетер баллонный для ангиопластики «Natrix»

по НАЕФ.942511.028 ТУ

Регистрационное удостоверение № _____

STERILE EO



НЕТОКСИЧНО


катетер баллонный для ангиопластики
«Natrix»
для коронарной артерии
с лекарственным антипролиферативным покрытием
RX SP 3,0/8-DE-140-14
с баллоном стандартного давления
Содержит лекарственное средство пацитаксел



NanoMed

XXX	Катетер баллонный для коронарных артерий для перекрестного использования в интервенционной кардиологии	Регистрационный номер: 942511.028 ТУ
МОДЕЛЬ	RX SP 3,0/8-DE-140-14	22.05-01003
РАЗМЕР БАЛЛОНА	3,0x8	3,0x8
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО	2025-05	
XXX	Катетер баллонный для коронарных артерий для перекрестного использования в интервенционной кардиологии	Регистрационный номер: 942511.028 ТУ
МОДЕЛЬ	RX SP 3,0/8-DE-140-14	22.05-01003
РАЗМЕР БАЛЛОНА	3,0x8	3,0x8
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО	2025-05	
XXX	Катетер баллонный для коронарных артерий для перекрестного использования в интервенционной кардиологии	Регистрационный номер: 942511.028 ТУ
МОДЕЛЬ	RX SP 3,0/8-DE-140-14	22.05-01003
РАЗМЕР БАЛЛОНА	3,0x8	3,0x8
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО	2025-05	
XXX	Катетер баллонный для коронарных артерий для перекрестного использования в интервенционной кардиологии	Регистрационный номер: 942511.028 ТУ
МОДЕЛЬ	RX SP 3,0/8-DE-140-14	22.05-01003
РАЗМЕР БАЛЛОНА	3,0x8	3,0x8
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО	2025-05	

3,0 MM	8 MM	0,36 MM/0,014"	1,67 MM (5F)
ДИАМЕТР БАЛЛОНА	ДЛИНА БАЛЛОНА	ПРОВОДНИК Ø МАКС.	ПРОВОДНИК Ø МИН.

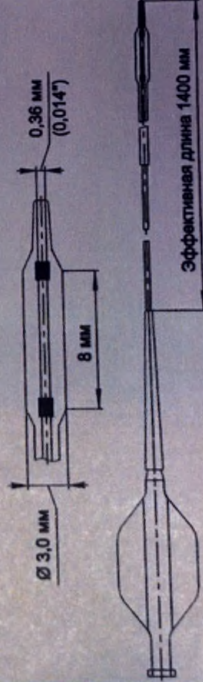

2022-05 2025-05 LOT22.05-01003


Давление атм/×10 ³ , кПа	Диаметр баллона ± 10%, мм
7	2,88
8	2,98
9 (Номинал)	3,00
10	3,15
11	3,23
12	3,29
13	3,34
14	3,38
15	3,42
16 (Максимум)	3,45

NanoMed

ООО «НаноМед», 440068, Россия, г. Пенза,
ул. Центральная, д.1
тел. (8412) 38-09-59, 38-06-63
E-mail: nanomed.penza@mail.ru
<http://www.medeng.ru>

Катетер баллонный для ангиопластики «Natrix»
по НАЕФ.942511.028 ТУ
Регистрационное удостоверение № _____ от _____

STERILE EO



НЕТОКСИЧНО

катетер баллонный для ангиопластики

«Natrix»

для коронарной артерии

с лекарственным антипролиферативным покрытием

RX SP 2,5/14-DE-142-14

с баллоном стандартного давления

Содержит лекарственное средство паклитаксел




NanoMed

	катетер баллонный для коронарной артерии с лекарственным антипролиферативным покрытием Регистрационный номер: 942511.028 ТУ
МОДЕЛЬ	RX SP 2,5/14-DE-142-14
ЛОТ/НОМЕР ПАРТИИ	23 03-0021
РАЗМЕР БАЛЛОНА	2,5х14
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО	2026-03

	катетер баллонный для коронарной артерии с лекарственным антипролиферативным покрытием Регистрационный номер: 942511.028 ТУ
МОДЕЛЬ	RX SP 2,5/14-DE-142-14
ЛОТ/НОМЕР ПАРТИИ	23 03-0021
РАЗМЕР БАЛЛОНА	2,5х14
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО	2026-03

	катетер баллонный для коронарной артерии с лекарственным антипролиферативным покрытием Регистрационный номер: 942511.028 ТУ
МОДЕЛЬ	RX SP 2,5/14-DE-142-14
ЛОТ/НОМЕР ПАРТИИ	23 03-0021
РАЗМЕР БАЛЛОНА	2,5х14
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО	2026-03

2,5 мм	14 мм	0,36 мм/0,014"	1,67 мм (5F)
ДИАМЕТР БАЛЛОНА	ДЛИНА БАЛЛОНА	ПРОВОДНИК Ø МАКС.	ПРОВ. КАТЕТЕР Ø МИН.

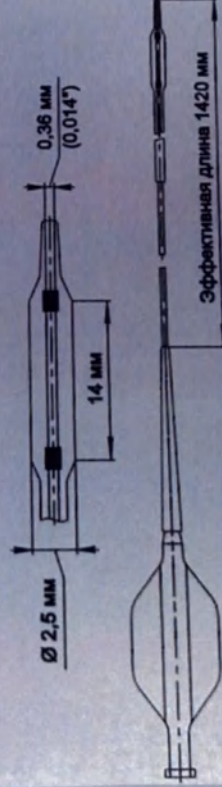

2023-03 2026-03 LOT23.03-0021

Давление атм/ x10 ² , кПа	Диаметр баллона ± 10%, мм
7	2,33
8	2,41
9 (Номинал)	2,50
10	2,54
11	2,59
12	2,64
13	2,68
14	2,71
15	2,75
16 (Максимум)	2,78

NanoMed

ООО «НаноМед», 440068, Россия, г. Пенза,
ул. Центральная, д.1

тел. (8412) 38-09-59, 38-06-63


E-mail: nanomed.penza@mail.ru

<http://www.medeng.ru>

Катетер баллонный для ангиопластики «Natrix»


по НАЕФ.942511.028 ТУ

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

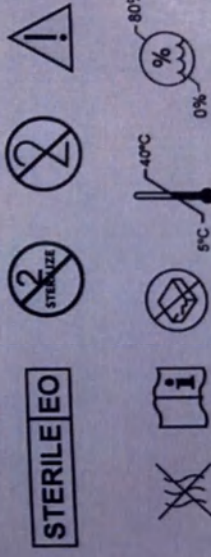

НЕТОКСИЧНО

катетер баллонный для ангиопластики
«Natrix»
для коронарной артерии
с лекарственным антипролиферативным покрытием
RX SP 3,0/8-DE-140-14
с баллоном стандартного давления
Содержит лекарственное средство паклитаксел



Катетер баллонный для ангиопластики «Natrix» для коронарной артерии
с лекарственным антипролиферативным покрытием по НАЕФ.942511.028 ТУ
Регистрационное удостоверение № _____
Производитель ООО «НаноМед»

МОДЕЛЬ RX SP 3,0/8-DE-140-14
ЛОТ/НОМЕР ПАРТИИ 22.05-01003
РАЗМЕР БАЛЛОНА 3,0x8
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО 2025-05



Катетер баллонный для ангиопластики «Natrix» для коронарной артерии
с лекарственным антипролиферативным покрытием по НАЕФ.942511.028 ТУ
Регистрационное удостоверение № _____
Производитель ООО «НаноМед»

МОДЕЛЬ RX SP 3,0/8-DE-140-14
ЛОТ/НОМЕР ПАРТИИ 22.05-01003
РАЗМЕР БАЛЛОНА 3,0x8
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО 2025-05



Катетер баллонный для ангиопластики «Natrix» для коронарной артерии
с лекарственным антипролиферативным покрытием по НАЕФ.942511.028 ТУ
Регистрационное удостоверение № _____
Производитель ООО «НаноМед»


МОДЕЛЬ RX SP 3,0/8-DE-140-14
ЛОТ/НОМЕР ПАРТИИ 22.05-01003
РАЗМЕР БАЛЛОНА 3,0x8
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО 2025-05



Катетер баллонный для ангиопластики «Natrix» для коронарной артерии
с лекарственным антипролиферативным покрытием по НАЕФ.942511.028 ТУ
Регистрационное удостоверение № _____
Производитель ООО «НаноМед»

МОДЕЛЬ RX SP 3,0/8-DE-140-14
ЛОТ/НОМЕР ПАРТИИ 22.05-01003
РАЗМЕР БАЛЛОНА 3,0x8
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО 2025-05

3,0 мм	8 мм	0,36 мм/0,014"	1,67 мм (5F)
ДИАМЕТР БАЛЛОНА	ДЛИНА БАЛЛОНА	ПРОВОДНИК Ø МАКС.	ПРОВ. КАТЕТЕР Ø МИН.

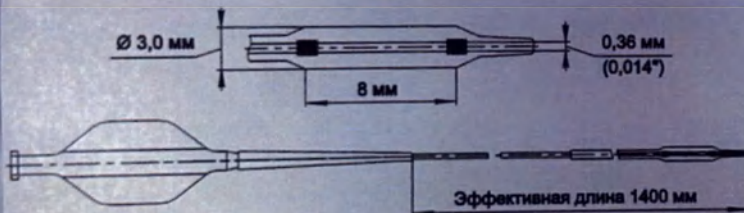


2022-05

2025-05

LOT 22.05-01003



Давление атм/ ×10 ² , кПа	Диаметр баллона ± 10%, мм
7	2,88
8	2,98
9 (Номинал)	3,00
10	3,15
11	3,23
12	3,29
13	3,34
14	3,38
15	3,42
16 (Максимум)	3,45



ООО «НаноМед», 440068, Россия, г. Пенза,
ул. Центральная, д.1
тел. (8412) 38-09-59, 38-06-63
E-mail: nanomed.penza@mail.ru
http://www.medeng.ru

Катетер баллонный для ангиопластики «Natrix»
по НАЕФ.942511.028 ТУ
Регистрационное удостоверение № _____ от _____

STERILE EO



НЕТОКСИЧНО


Катетер баллонный для ангиопластики

«Natrix»

для коронарной артерии с лекарственным антипролиферативным покрытием
RX SP 2,5/14-DE-142-14

с баллоном стандартного давления
Содержит лекарственное средство в виде таблеток

2,5 мм	14 мм	0,36 мм/0,014"	1,67 мм (5F)
ДИАМЕТР БАЛЛОНА	ДЛИНА БАЛЛОНА	ПРОВОДНИК Ø МАКС.	ПРОВОДНИК Ø МИН.

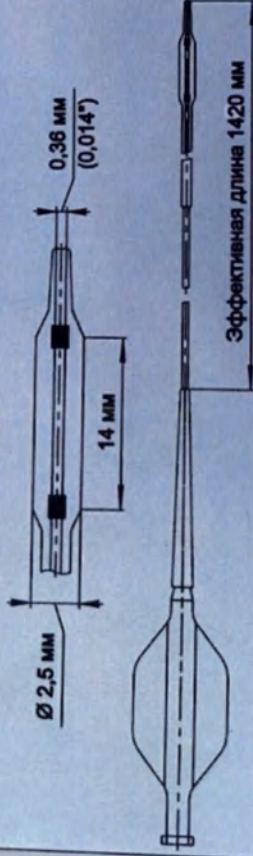

2023-03 2026-03 LOT 23.03-0021


NanoMed

ООО «НаноМед», 440068, Россия, г. Пенза,
ул. Центральная, д.1
тел. (8412) 38-09-59, 38-06-63
E-mail: nanomed.penza@mail.ru
<http://www.medeng.ru>

Катетер баллонный для ангиопластики «Natrix»
по НAEФ.942511.028 ТУ
Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Давление атм/ x10 ² , кПа	Диаметр баллона ± 10%, мм
7	2,33
8	2,41
9 (Номинал)	2,50
10	2,54
11	2,59
12	2,64
13	2,68
14	2,71
15	2,75
16 (Максимум)	2,78

STERILE EO



НЕТОКСИЧНО

катетер баллонный для ангиопластики

«Natrix»
для коронарной артерии
с лекарственным антипролиферативным покрытием
RX SP 2,5/14-DE-142-14
Содержит лекарственное средство в виде таблеток



NanoMed

МОДЕЛЬ РАЗМЕР БАЛЛОНА ИСПОЛНИТЕЛЬ ДО	МОДЕЛЬ РАЗМЕР БАЛЛОНА ИСПОЛНИТЕЛЬ ДО	МОДЕЛЬ РАЗМЕР БАЛЛОНА ИСПОЛНИТЕЛЬ ДО	МОДЕЛЬ РАЗМЕР БАЛЛОНА ИСПОЛНИТЕЛЬ ДО
TX SP 2,5/14-DE-142-14 2,5x14 23.03-0021	TX SP 2,5/14-DE-142-14 2,5x14 23.03-0021	TX SP 2,5/14-DE-142-14 2,5x14 23.03-0021	TX SP 2,5/14-DE-142-14 2,5x14 23.03-0021

RX SP 2,5/14-DE-142-14
2,5x14
23.03-0021
2023-03
2026-03

Катетер баллонный для ангиопластики

«Natrix»

для коронарной артерии с лекарственным антипролиферативным покрытием

RX SP 3,0/8-DE-140-14

с баллоном стандартного давления

Содержит лекарственное средство паклитаксел

Комплектация:

- Катетер баллонный - 1 шт.;
- Инструкция по применению - 1 шт.;
- Идентификационная наклейка - 4 шт.

3,0 мм

ДИАМЕТР БАЛЛОНА

8 мм


← ДЛИНА БАЛЛОНА →

0,36 мм/0,014"

ПРОВОДНИК Ø МАКС.

1,67 мм (5F)

ПРОВ. КАТЕТЕР Ø МИН.

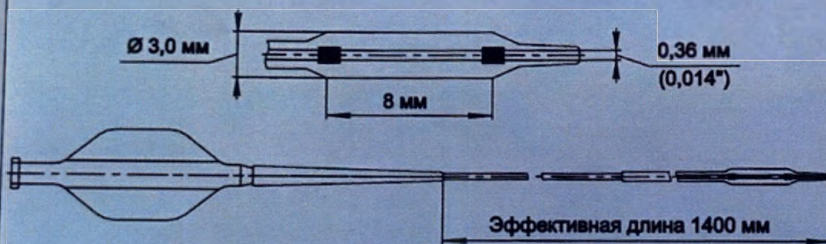

2022-05

2025-05

LOT22.05-01003

Давление атм/ ×10 ⁵ , кПа	Диаметр баллона ± 10%, мм
7	2,88
8	2,98
9 (Номинал)	3,00
10	3,15
11	3,23
12	3,29
13	3,34
14	3,38
15	3,42
16 (Максимум)	3,45



NanoMed



ООО «НаноМед», 440068, Россия, г. Пенза,

ул. Центральная, д.1

тел. (8412) 38-09-59, 38-06-63

E-mail: nanomed.penza@mail.ru



http://www.medeng.ru

Катетер баллонный для ангиопластики «Natrix»

по НАЕФ.942511.028 ТУ

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

STERILE EO



НЕТОКСИЧНО

Катетер баллонный для ангиопластики

«Natrix»

для коронарной артерии

с лекарственным антипролиферативным покрытием

RX SP 3,0/8-DE-140-14

с баллоном стандартного давления

Содержит лекарственное средство паклитаксел



NanoMed

МОДЕЛЬ	RX SP 3,0/8-DE-140-14
ЛОТ/НОМЕР ПАРТИИ	22.05-01003
РАЗМЕР БАЛЛОНА	3,0x8
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО	2025-05
МОДЕЛЬ	RX SP 3,0/8-DE-140-14
ЛОТ/НОМЕР ПАРТИИ	22.05-01003
РАЗМЕР БАЛЛОНА	3,0x8
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО	2025-05
МОДЕЛЬ	RX SP 3,0/8-DE-140-14
ЛОТ/НОМЕР ПАРТИИ	22.05-01003
РАЗМЕР БАЛЛОНА	3,0x8
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО	2025-05

RX

ВИД
КАТЕТЕРА

SP

ИНДЕКС
ДАВЛЕНИЯ

DE

ПОКРЫТИЕ
БАЛЛОНА

0,36 мм
(0,014")

ПРОВОДНИК
Ø МАКС.

3,0


ДИАМЕТР
БАЛЛОНА, мм

8

ДЛИНА
БАЛЛОНА, мм

2022-05

2025-05

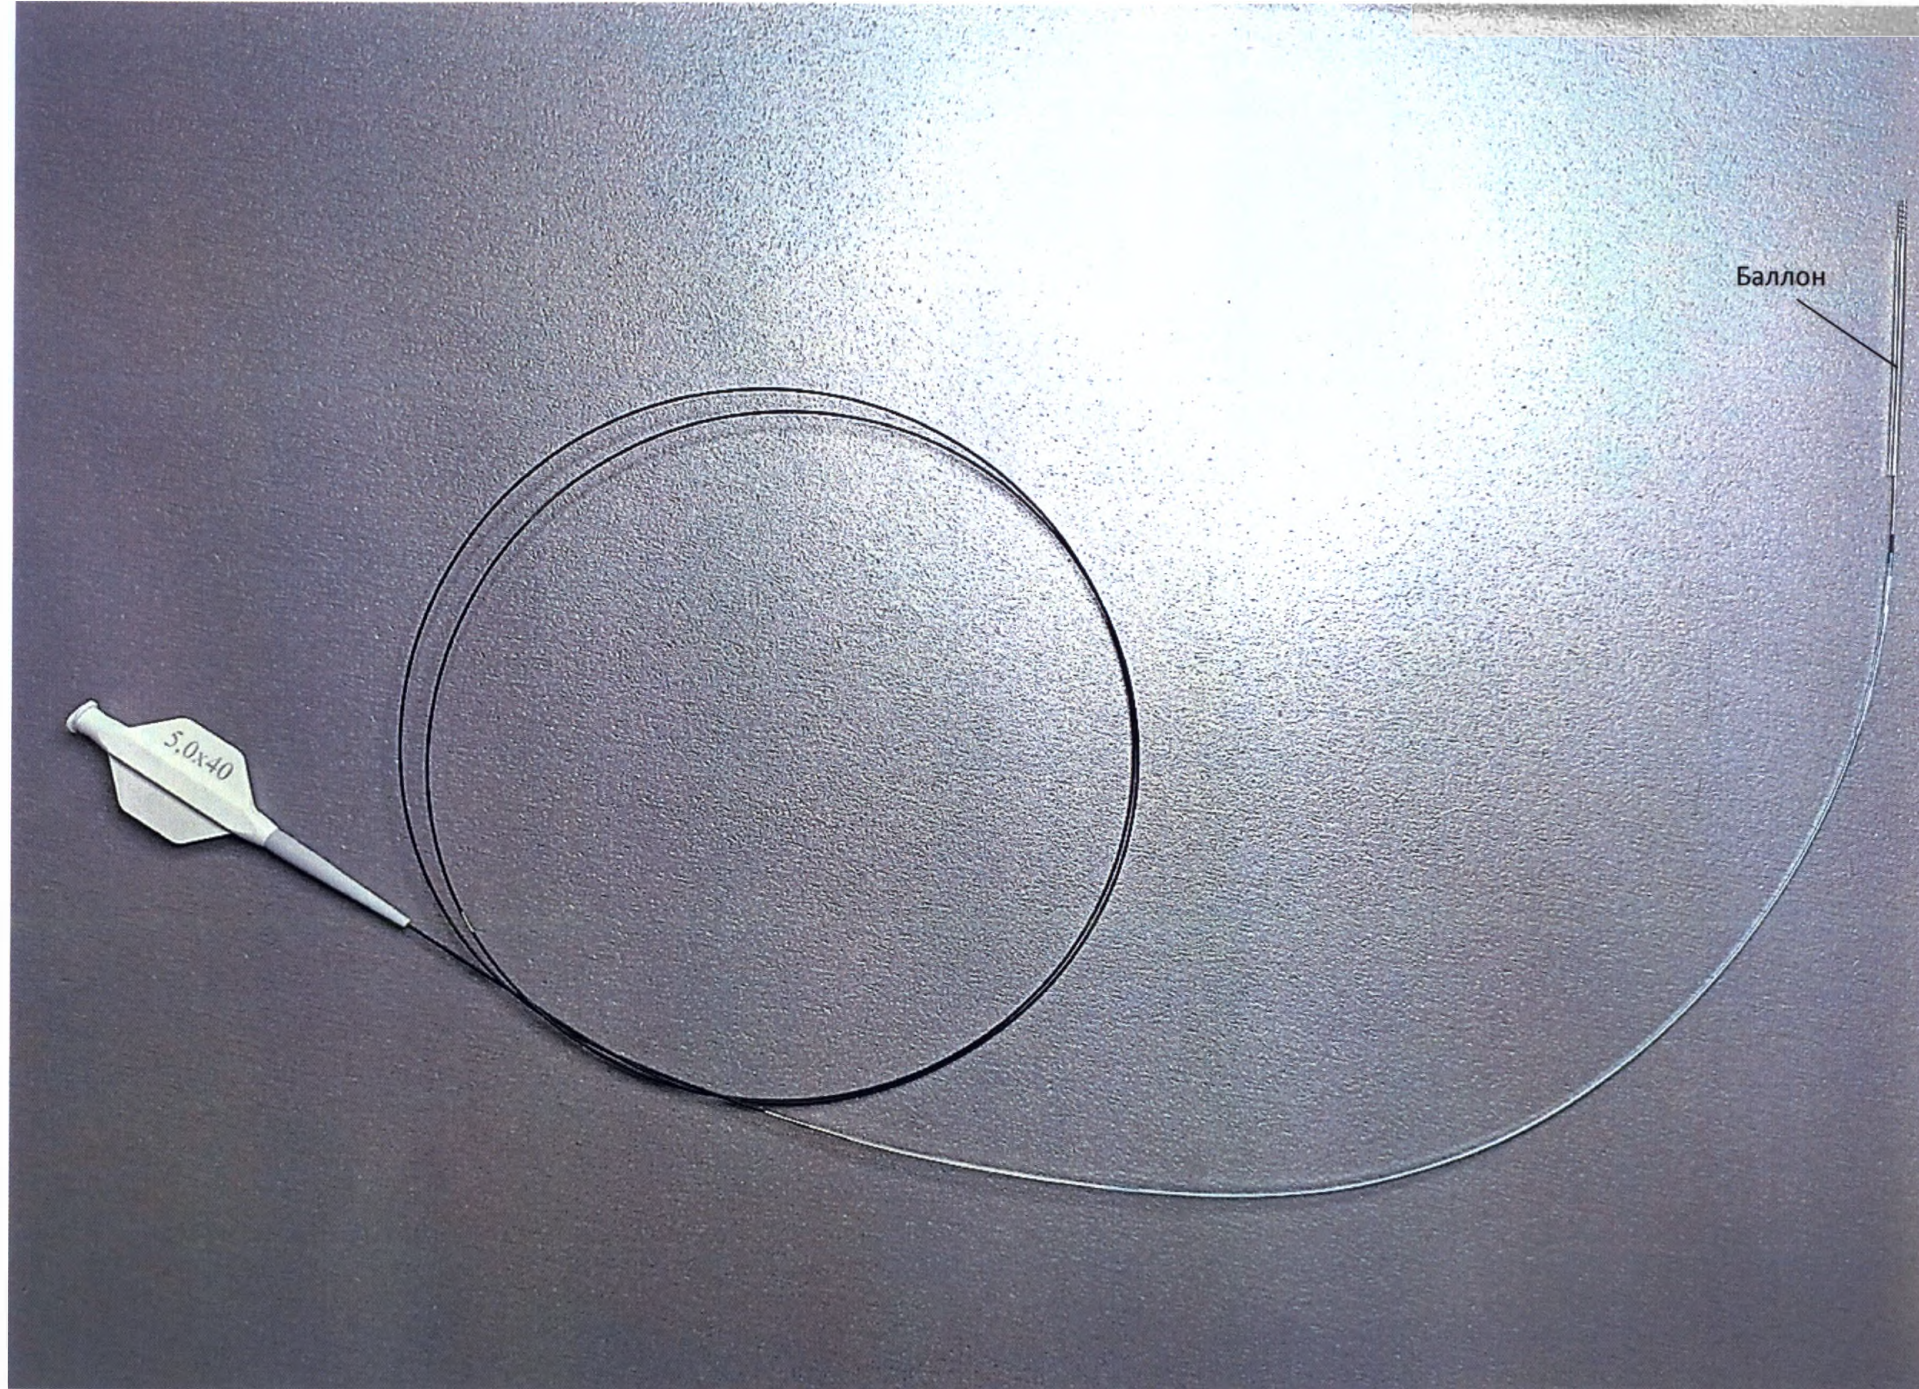

Баллон

3,0x18

Трубка
транспортировочная

Длина, м ± 10%, мПа	Длина, м ± 10%, мм
7	1,89
8	1,98
9 (Номинал)	2,00
10	2,13
11	2,20
12	2,25
13	2,30
14	2,35
15	2,40
16 (Максимум)	2,47

Ярлык

Клипсы

**Пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью**

