



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 24 ноября 2022 года № РЗН 2022/18833

На медицинское изделие

**Катетеры баллонные "R-CROSS", "R-CROSS NC" одноразовые стерильные
по ТУ 32.50.13-003-41237435-2021**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "Ангиолайн Ресерч"
(ООО "Ангиолайн Ресерч"), Россия,**

630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Технопарковая, д. 6, оф. 336

Производитель

Акционерное общество "Р-Васкуляр"

(АО "Р-Васкуляр"), Россия,

630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 18, эт. 1, пом. 21

Место производства медицинского изделия

АО "Р-Васкуляр", Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 18

Номер регистрационного досье № РД-47819/95460 от 17.02.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 3

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.13.110

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 25 листах

приказом Росздравнадзора от 24 ноября 2022 года № 11138
допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0069418

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 24 ноября 2022 года

№ РЗН 2022/18833

Лист 1

На медицинское изделие

Катетеры баллонные "R-CROSS", "R-CROSS NC" одноразовые стерильные по ТУ 32.50.13-003-41237435-2021, варианты исполнения:

I. Катетеры баллонные "R-CROSS NC" высокого давления одноразовые, стерильные:

1. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 1,25 мм, длиной баллона 10 мм. Артикул RN10125 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

2. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 1,5 мм, длиной баллона 10 мм. Артикул RN10150 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

3. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 1,75 мм, длиной баллона 10 мм. Артикул RN10175 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

4. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2 мм, длиной баллона 10 мм. Артикул RN10200 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

5. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2,25 мм, длиной баллона 10 мм. Артикул RN10225 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

6. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2,5 мм, длиной баллона 10 мм. Артикул RN10250 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

7. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0112905

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 24 ноября 2022 года

№ РЗН 2022/18833

Лист 2

баллона 2,75 мм, длиной баллона 10 мм. Артикул RN10275 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

8. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3 мм, длиной баллона 10 мм. Артикул RN10300 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

9. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3,25 мм, длиной баллона 10 мм. Артикул RN10325 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

10. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3,5 мм, длиной баллона 10 мм. Артикул RN10350 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

11. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3,75 мм, длиной баллона 10 мм. Артикул RN10375 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

12. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 4 мм, длиной баллона 10 мм. Артикул RN10400 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

13. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 4,25 мм, длиной баллона 10 мм. Артикул RN10425 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

14. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 4,5 мм, длиной баллона 10 мм. Артикул RN10450 - 1 шт.; Инструкция по

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0112906

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 24 ноября 2022 года

№ РЗН 2022/18833

Лист 3

применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

15. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 1,25 мм, длиной баллона 15 мм. Артикул RN15125 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

16. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 1,5 мм, длиной баллона 15 мм. Артикул RN15150 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

17. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 1,75 мм, длиной баллона 15 мм. Артикул RN15175 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

18. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2 мм, длиной баллона 15 мм. Артикул RN15200 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

19. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2,25 мм, длиной баллона 15 мм. Артикул RN15225 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

20. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2,5 мм, длиной баллона 15 мм. Артикул RN15250 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

21. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2,75 мм, длиной баллона 15 мм. Артикул RN15275 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0112907

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 24 ноября 2022 года

№ РЗН 2022/18833

Лист 4

изделии - 4 шт.

22. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3 мм, длиной баллона 15 мм. Артикул RN15300 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

23. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3,25 мм, длиной баллона 15 мм. Артикул RN15325 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

24. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3,5 мм, длиной баллона 15 мм. Артикул RN15350 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

25. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3,75 мм, длиной баллона 15 мм. Артикул RN15375 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

26. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 4 мм, длиной баллона 15 мм. Артикул RN15400 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

27. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 4,25 мм, длиной баллона 15 мм. Артикул RN15425 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

28. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 4,5 мм, длиной баллона 15 мм. Артикул RN15450 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0112908

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 24 ноября 2022 года

№ РЗН 2022/18833

Лист 5

29. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 1,25 мм, длиной баллона 17 мм. Артикул RN17125 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

30. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 1,5 мм, длиной баллона 17 мм. Артикул RN17150 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

31. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 1,75 мм, длиной баллона 17 мм. Артикул RN17175 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

32. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2 мм, длиной баллона 17 мм. Артикул RN17200 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

33. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2,25 мм, длиной баллона 17 мм. Артикул RN17225 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

34. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2,5 мм, длиной баллона 17 мм. Артикул RN17250 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

35. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2,75 мм, длиной баллона 17 мм. Артикул RN17275 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

36. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0112909

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 24 ноября 2022 года

№ РЗН 2022/18833

Лист 6

дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3 мм, длиной баллона 17 мм. Артикул RN17300 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

37. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3,25 мм, длиной баллона 17 мм. Артикул RN17325 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

38. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3,5 мм, длиной баллона 17 мм. Артикул RN17350 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

39. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3,75 мм, длиной баллона 17 мм. Артикул RN17375 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

40. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 4 мм, длиной баллона 17 мм. Артикул RN17400 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

41. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 4,25 мм, длиной баллона 17 м. Артикул RN17425 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

42. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 4,5 мм, длиной баллона 17 мм. Артикул RN17450 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

43. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0112910

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 24 ноября 2022 года

№ РЗН 2022/18833

Лист 7

баллона 1,25 мм, длиной баллона 20 мм. Артикул RN20125 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

44. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 1,5 мм, длиной баллона 20 мм. Артикул RN20150 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

45. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 1,75 мм, длиной баллона 20 мм. Артикул RN20175 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

46. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2 мм, длиной баллона 20 мм. Артикул RN20200 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.


47. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2,25 мм, длиной баллона 20 мм. Артикул RN20225 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

48. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2,5 мм, длиной баллона 20 мм. Артикул RN20250 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

49. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2,75 мм, длиной баллона 20 мм. Артикул RN20275 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

50. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3 мм, длиной баллона 20 мм. Артикул RN20300 - 1 шт.; Инструкция по

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

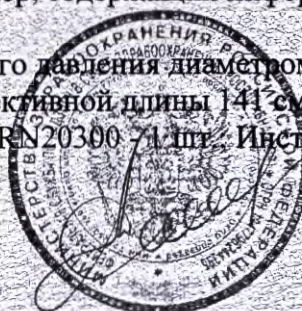

А.В. Самойлова

0112911

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 24 ноября 2022 года

№ РЗН 2022/18833

Лист 8

применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

51. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3,25 мм, длиной баллона 20 мм. Артикул RN20325 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

52. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3,5 мм, длиной баллона 20 мм. Артикул RN20350 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

53. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3,75 мм, длиной баллона 20 мм. Артикул RN20375 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

54. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 4 мм, длиной баллона 20 мм. Артикул RN20400 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

55. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 4,25 мм, длиной баллона 20 мм. Артикул RN20425 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

56. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 4,5 мм, длиной баллона 20 мм. Артикул RN20450 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

57. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 1,25 мм, длиной баллона 25 мм. Артикул RN25125 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0112912

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 24 ноября 2022 года

№ РЗН 2022/18833

Лист 9

изделии - 4 шт.

58. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 1,5 мм, длиной баллона 25 мм. Артикул RN25150 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

59. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 1,75 мм, длиной баллона 25 мм. Артикул RN25175 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

60. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2 мм, длиной баллона 25 мм. Артикул RN25200 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.


61. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2,25 мм, длиной баллона 25 мм. Артикул RN25225 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

62. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2,5 мм, длиной баллона 25 мм. Артикул RN25250 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

63. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2,75 мм, длиной баллона 25 мм. Артикул RN25275 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

64. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3 мм, длиной баллона 25 мм. Артикул RN25300 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

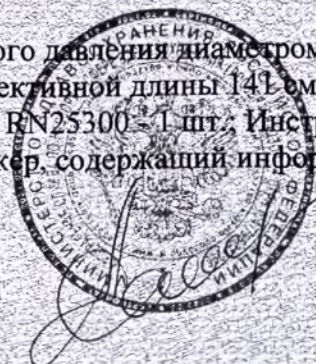

А.В. Самойлова

0112913

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 24 ноября 2022 года

№ РЗН 2022/18833

Лист 10

65. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3,25 мм, длиной баллона 25 мм. Артикул RN25325 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

66. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3,5 мм, длиной баллона 25 мм. Артикул RN25350 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

67. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3,75 мм, длиной баллона 25 мм. Артикул RN25375 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

68. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 4 мм, длиной баллона 25 мм. Артикул RN25400 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

69. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 4,25 мм, длиной баллона 25 мм. Артикул RN25425 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

70. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 4,5 мм, длиной баллона 25 мм. Артикул RN25450 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

71. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 1,25 мм, длиной баллона 30 мм. Артикул RN30125 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

72. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0112914

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 24 ноября 2022 года № РЗН 2022/18833

Лист 11

дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 1,5 мм, длиной баллона 30 мм. Артикул RN30150 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

73. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 1,75 мм, длиной баллона 30 мм. Артикул RN30175 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

74. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2 мм, длиной баллона 30 мм. Артикул RN30200 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

75. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2,25 мм, длиной баллона 30 мм. Артикул RN30225 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

76. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2,5 мм, длиной баллона 30 мм. Артикул RN30250 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

77. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2,75 мм, длиной баллона 30 мм. Артикул RN30275 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

78. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3 мм, длиной баллона 30 мм. Артикул RN30300 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

79. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0112915

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 24 ноября 2022 года

№ РЗН 2022/18833

Лист 12

баллона 3,25 мм, длиной баллона 30 мм. Артикул RN30325 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

80. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3,5 мм, длиной баллона 30 мм. Артикул RN30350 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

81. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3,75 мм, длиной баллона 30 мм. Артикул RN30375 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

82. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 4 мм, длиной баллона 30 мм. Артикул RN30400 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.


83. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 4,25 мм, длиной баллона 30 мм. Артикул RN30425 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

84. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 4,5 мм, длиной баллона 30 мм. Артикул RN30450 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

85. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 1,25 мм, длиной баллона 35 мм. Артикул RN35125 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

86. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 1,5 мм, длиной баллона 35 мм. Артикул RN35150 - 1 шт.; Инструкция по

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

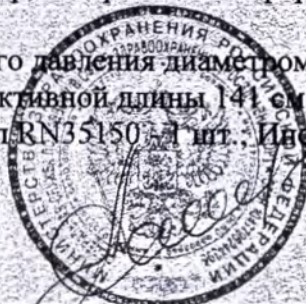

А.В. Самойлова

0112916

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 24 ноября 2022 года

№ РЗН 2022/18833

Лист 13

применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

87. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 1,75 мм, длиной баллона 35 мм. Артикул RN35175 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

88. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2 мм, длиной баллона 35 мм. Артикул RN35200 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

89. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2,25 мм, длиной баллона 35 мм. Артикул RN35225 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

90. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2,5 мм, длиной баллона 35 мм. Артикул RN35250 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.


91. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2,75 мм, длиной баллона 35 мм. Артикул RN35275

92. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3 мм, длиной баллона 35 мм. Артикул RN35300 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

93. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3,25 мм, длиной баллона 35 мм. Артикул RN35325 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

94. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

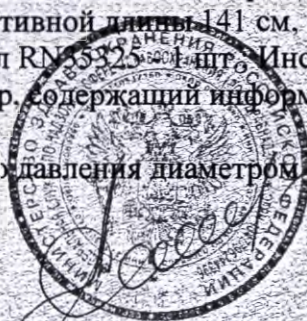

А.В. Самойлова

0112917

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 24 ноября 2022 года

№ РЗН 2022/18833

Лист 14

дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3,5 мм, длиной баллона 35 мм. Артикул RN35350 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

95. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3,75 мм, длиной баллона 35 мм. Артикул RN35375 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

96. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 4 мм, длиной баллона 35 мм. Артикул RN35400 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

97. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 4,25 мм, длиной баллона 35 мм. Артикул RN35425 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

98. Катетер баллонный «R-CROSS NC» высокого давления диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 4,5 мм, длиной баллона 35 мм. Артикул RN35450 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.


II. Катетеры баллонные «R-CROSS» одноразовые, стерильные:

1. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 1,25 мм, длиной баллона 10 мм. Артикул RS10125 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

2. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 1,5 мм, длиной баллона 10 мм. Артикул RS10150 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

3. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 1,75 мм, длиной баллона 10 мм. Артикул RS10175 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

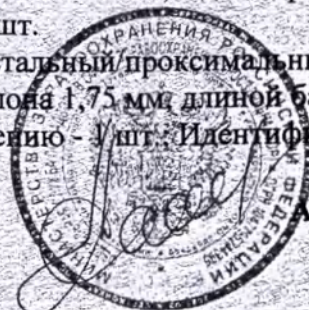

А.В. Самойлова

0112918

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 24 ноября 2022 года

№ РЗН 2022/18833

Лист 15

стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

4. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2 мм, длиной баллона 10 мм.

Артикул RS10200 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

5. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2,25 мм, длиной баллона 10 мм.

Артикул RS10225 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

6. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2,5 мм, длиной баллона 10 мм.

Артикул RS10250 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

7. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2,75 мм, длиной баллона 10 мм.

Артикул RS10275 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

8. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3 мм, длиной баллона 10 мм.

Артикул RS10300 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

9. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3,25 мм, длиной баллона 10 мм.

Артикул RS10325 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

10. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3,5 мм, длиной баллона 10 мм.

Артикул RS10350 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.


11. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3,75 мм, длиной баллона 10 мм.

Артикул RS10375 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

12. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 4,00 мм, длиной баллона 10 мм.

Артикул RS10400 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

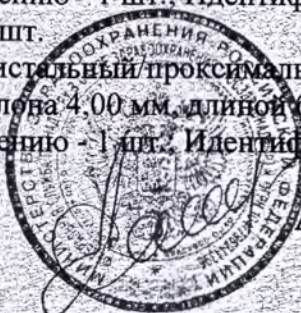

А.В. Самойлова

0112919

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 24 ноября 2022 года

№ РЗН 2022/18833

Лист 16

стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

13. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 4,25 мм, длиной баллона 10 мм. Артикул RS10425 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

14. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 4,5 мм, длиной баллона 10 мм. Артикул RS10450 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

15. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 1,25 мм, длиной баллона 15 мм. Артикул RS15125 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

16. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 1,5 мм, длиной баллона 15 мм. Артикул RS15150 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

17. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 1,75 мм, длиной баллона 15 мм. Артикул RS15175 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.


18. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2 мм, длиной баллона 15 мм. Артикул RS15200 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

19. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2,25 мм, длиной баллона 15 мм. Артикул RS15225 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

20. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2,5 мм, длиной баллона 15 мм. Артикул RS15250 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

21. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2,75 мм, длиной баллона 15 мм. Артикул RS15275 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

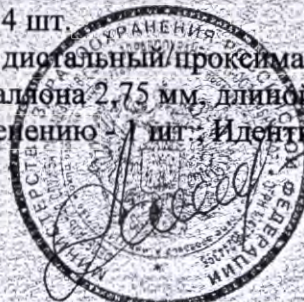

А.В. Самойлова

0112920

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 24 ноября 2022 года

№ РЗН 2022/18833

Лист 17

стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

22. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3 мм, длиной баллона 15 мм. Артикул RS15300 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

23. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3,25 мм, длиной баллона 15 мм. Артикул RS15325 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

24. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3,5 мм, длиной баллона 15 мм. Артикул RS15350 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

25. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3,75 мм, длиной баллона 15 мм. Артикул RS15375 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

26. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 4 мм, длиной баллона 15 мм. Артикул RS15400 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

27. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 4,25 мм, длиной баллона 15 мм. Артикул RS15425 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

28. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 4,5 мм, длиной баллона 15 мм. Артикул RS15450 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

29. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 1,25 мм, длиной баллона 17 мм. Артикул RS17125 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

30. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 1,5 мм, длиной баллона 17 мм. Артикул RS17150 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0112921

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 24 ноября 2022 года № РЗН 2022/18833

Лист 18

стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

31. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 1,75 мм, длиной баллона 17 мм. Артикул RS17175 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

32. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2 мм, длиной баллона 17 мм. Артикул RS17200 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

33. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2,25 мм, длиной баллона 17 мм. Артикул RS17225 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

34. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2,5 мм, длиной баллона 17 мм. Артикул RS17250 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

35. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2,75 мм, длиной баллона 17 мм. Артикул RS17275 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.


36. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3 мм, длиной баллона 17 мм. Артикул RS17300 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

37. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3,25 мм, длиной баллона 17 мм. Артикул RS17325 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

38. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3,5 мм, длиной баллона 17 мм. Артикул RS17350 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

39. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3,75 мм, длиной баллона 17 мм. Артикул RS17375 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

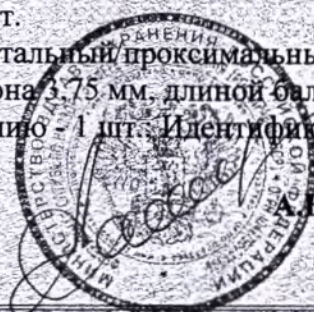

А.В. Самойлова

0112922

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 24 ноября 2022 года

№ РЗН 2022/18833

Лист 19

стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

40. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 4 мм, длиной баллона 17 мм.

Артикул RS17400 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

41. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 4,25 мм, длиной баллона 17 мм.

Артикул RS17425 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

42. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 4,5 мм, длиной баллона 17 мм.

Артикул RS17450 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

43. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 1,25 мм, длиной баллона 20 мм.

Артикул RS20125 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

44. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 1,5 мм, длиной баллона 20 мм.

Артикул RS20150 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

45. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 1,75 мм, длиной баллона 20 мм.

Артикул RS20175 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

46. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2 мм, длиной баллона 20 мм.

Артикул RS20200 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.


47. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2,25 мм, длиной баллона 20 мм.

Артикул RS20225 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

48. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2,5 мм, длиной баллона 20 мм.

Артикул RS20250 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

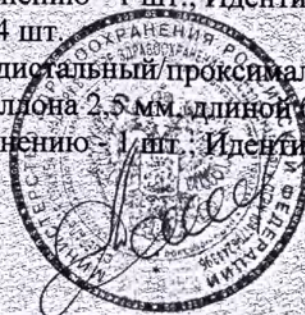

А.В. Самойлова

0112923

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 24 ноября 2022 года № РЗН 2022/18833

Лист 20

стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

49. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2,75 мм, длиной баллона 20 мм. Артикул RS20275 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

50. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3 мм, длиной баллона 20 мм. Артикул RS20300 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

51. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3,25 мм, длиной баллона 20 мм. Артикул RS20325 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

52. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3,5 мм, длиной баллона 20 мм. Артикул

RS20350 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

53. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3,75 мм, длиной баллона 20 мм. Артикул RS20375 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.


54. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 4 мм, длиной баллона 20 мм. Артикул RS20400 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

55. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 4,25 мм, длиной баллона 20 мм. Артикул RS20425 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

56. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 4,5 мм, длиной баллона 20 мм. Артикул RS20450 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

57. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 1,25 мм, длиной баллона 25 мм.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

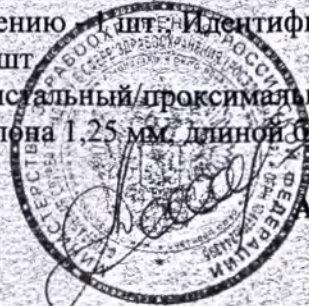

А.В. Самойлова

0112924

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 24 ноября 2022 года № РЗН 2022/18833

Лист 21

Артикул RS25125 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

58. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 1,5 мм, длиной баллона 25 мм.

Артикул RS25150 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

59. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 1,75 мм, длиной баллона 25 мм.

Артикул RS25175 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

60. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2 мм, длиной баллона 25 мм.

Артикул RS25200 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

61. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2,25 мм, длиной баллона 25 мм.

Артикул RS25225 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

62. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2,5 мм, длиной баллона 25 мм.

Артикул RS25250 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

63. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2,75 мм, длиной баллона 25 мм.

Артикул RS25275 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

64. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3 мм, длиной баллона 25 мм.


Артикул RS25300 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

65. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3,25 мм, длиной баллона 25 мм.

Артикул RS25325 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

66. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3,5 мм, длиной баллона 25 мм.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

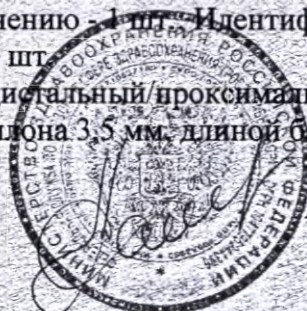

А.В. Самойлова

0112925

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 24 ноября 2022 года № РЗН 2022/18833

Лист 22

Артикул RS25350 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

67. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3,75 мм, длиной баллона 25 мм.

Артикул RS25375 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

68. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 4,0 мм, длиной баллона 25 мм.

Артикул RS25400 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

69. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 4,25 мм, длиной баллона 25 мм.

Артикул RS25425 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

70. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 4,5 мм, длиной баллона 25 мм.

Артикул RS25450 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

71. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 1,25 мм, длиной баллона 30 мм.

Артикул RS30125 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

72. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 1,5 мм, длиной баллона 30 мм.

Артикул RS30150 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

73. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 1,75 мм, длиной баллона 30 мм.


Артикул RS30175 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

74. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2 мм, длиной баллона 30 мм.

Артикул RS30200 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

75. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2,25 мм, длиной баллона 30 мм.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

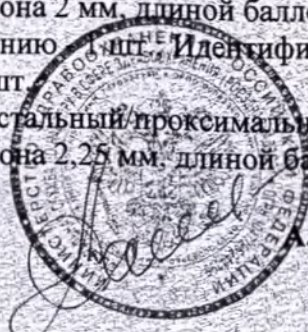

А.В. Самойлова

0112926

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 24 ноября 2022 года № РЗН 2022/18833

Лист 23

Артикул RS30225 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.
76. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2,5 мм, длиной баллона 30 мм. Артикул RS30250 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.
77. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2,75 мм, длиной баллона 30 мм. Артикул RS30275 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.
78. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3,0 мм, длиной баллона 30 мм. Артикул RS30300 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.
79. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3,25 мм, длиной баллона 30 мм. Артикул RS30325 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.
80. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3,5 мм, длиной баллона 30 мм. Артикул RS30350 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.
81. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3,75 мм, длиной баллона 30 мм. Артикул RS30375 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.
82. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 4 мм, длиной баллона 30 мм. Артикул RS30400 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.
83. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 4,25 мм, длиной баллона 30 мм. Артикул RS30425 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.
84. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 4,5 мм, длиной баллона 30 мм.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0112927

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 24 ноября 2022 года № РЗН 2022/18833

Лист 24

Артикул RS30450 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.
85. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 1,25 мм, длиной баллона 35 мм. Артикул RS35125 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.
86. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 1,5 мм, длиной баллона 35 мм. Артикул RS35150 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.
87. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 1,75 мм, длиной баллона 35 мм. Артикул RS35175 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.
88. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2 мм, длиной баллона 35 мм. Артикул RS35200 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.
89. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2,25 мм, длиной баллона 35 мм. Артикул RS35225 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.
90. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2,5 мм, длиной баллона 35 мм. Артикул RS35250 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.
91. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 2,75 мм, длиной баллона 35 мм. Артикул RS35275 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.
92. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3 мм, длиной баллона 35 мм. Артикул RS35300 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.
93. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3,25 мм, длиной баллона 35 мм.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0112928

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 24 ноября 2022 года № РЗН 2022/18833

Лист 25

Артикул RS35325 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

94. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3,5 мм, длиной баллона 35 мм.

Артикул RS35350 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

95. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 3,75 мм, длиной баллона 35 мм.

Артикул RS35375 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

96. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 4 мм, длиной баллона 35 мм.

Артикул RS35400 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

97. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 4,25 мм, длиной баллона 35 мм.

Артикул RS35425 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

98. Катетер баллонный «R-CROSS» диаметром дистальный/проксимальный 0,89/0,65 мм, эффективной длины 141 см, с диаметром баллона 4,5 мм, длиной баллона 35 мм.

Артикул RS35450 - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Идентификационный стикер, содержащий информацию об изделии - 4 шт.

≡

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0112929