Специалист по регистрации
медицинских изделий
ООО «Бектон Дикинсон Восток»
_____ Е.А. Косолапова
«__» _____ 2022 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

«Катетер BD внутривенный периферический одноразовый стерильный с заглушкой BD Luer-Lok Plug, в вариантах исполнения, с принадлежностями»

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

1. Катетер BD VENFLON внутривенный периферический одноразовый стерильный с заглушкой BD Luer-Lok Plug: 22G 0,8мм x 25 мм

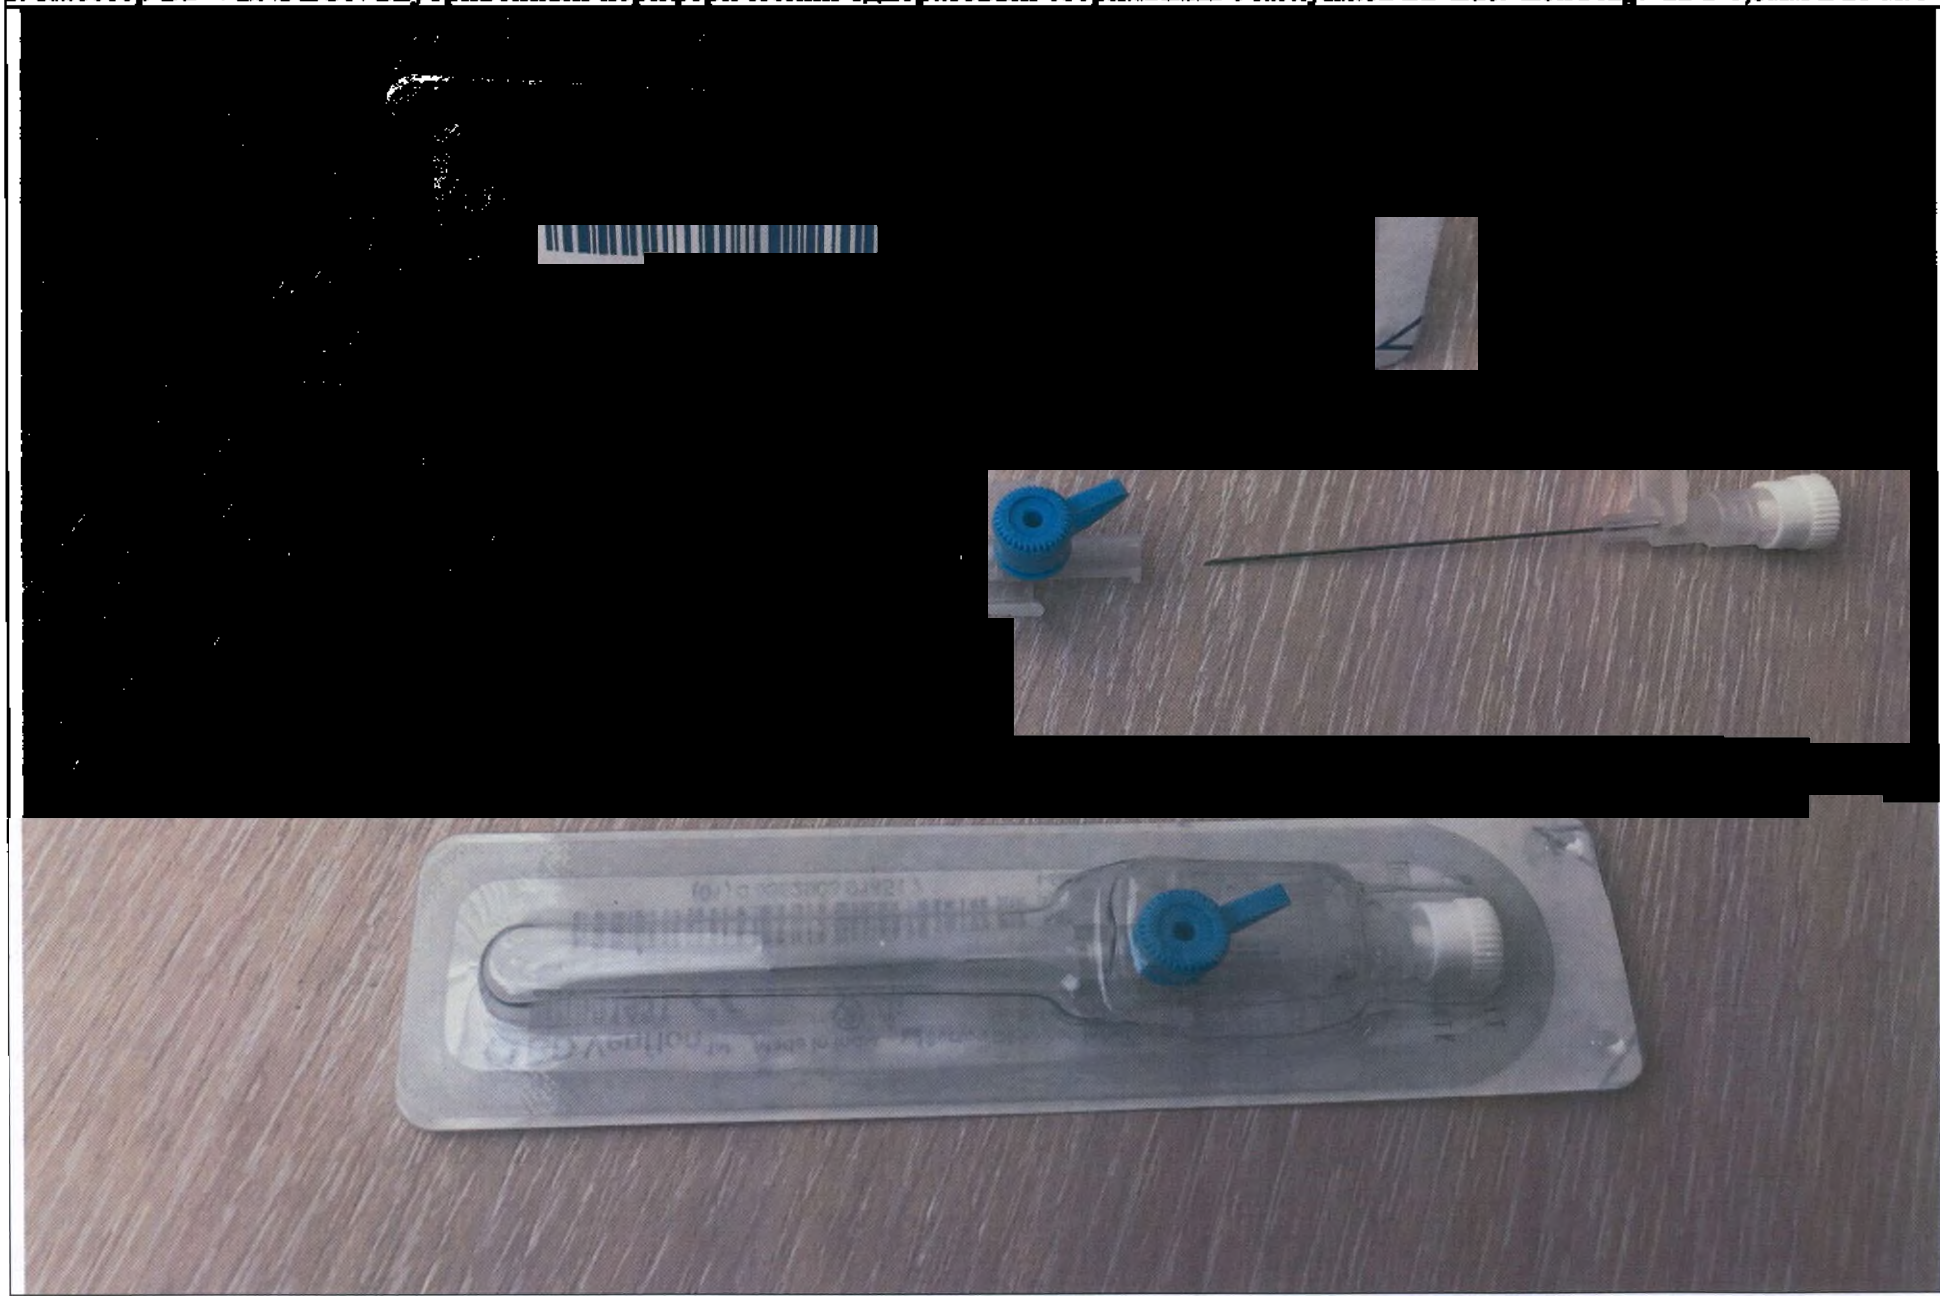

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Катетер BD VENFLON внутривенный периферический одноразовый стерильный с заглушкой BD Luer-Lok Plug: 20G 1,0мм x 32 мм

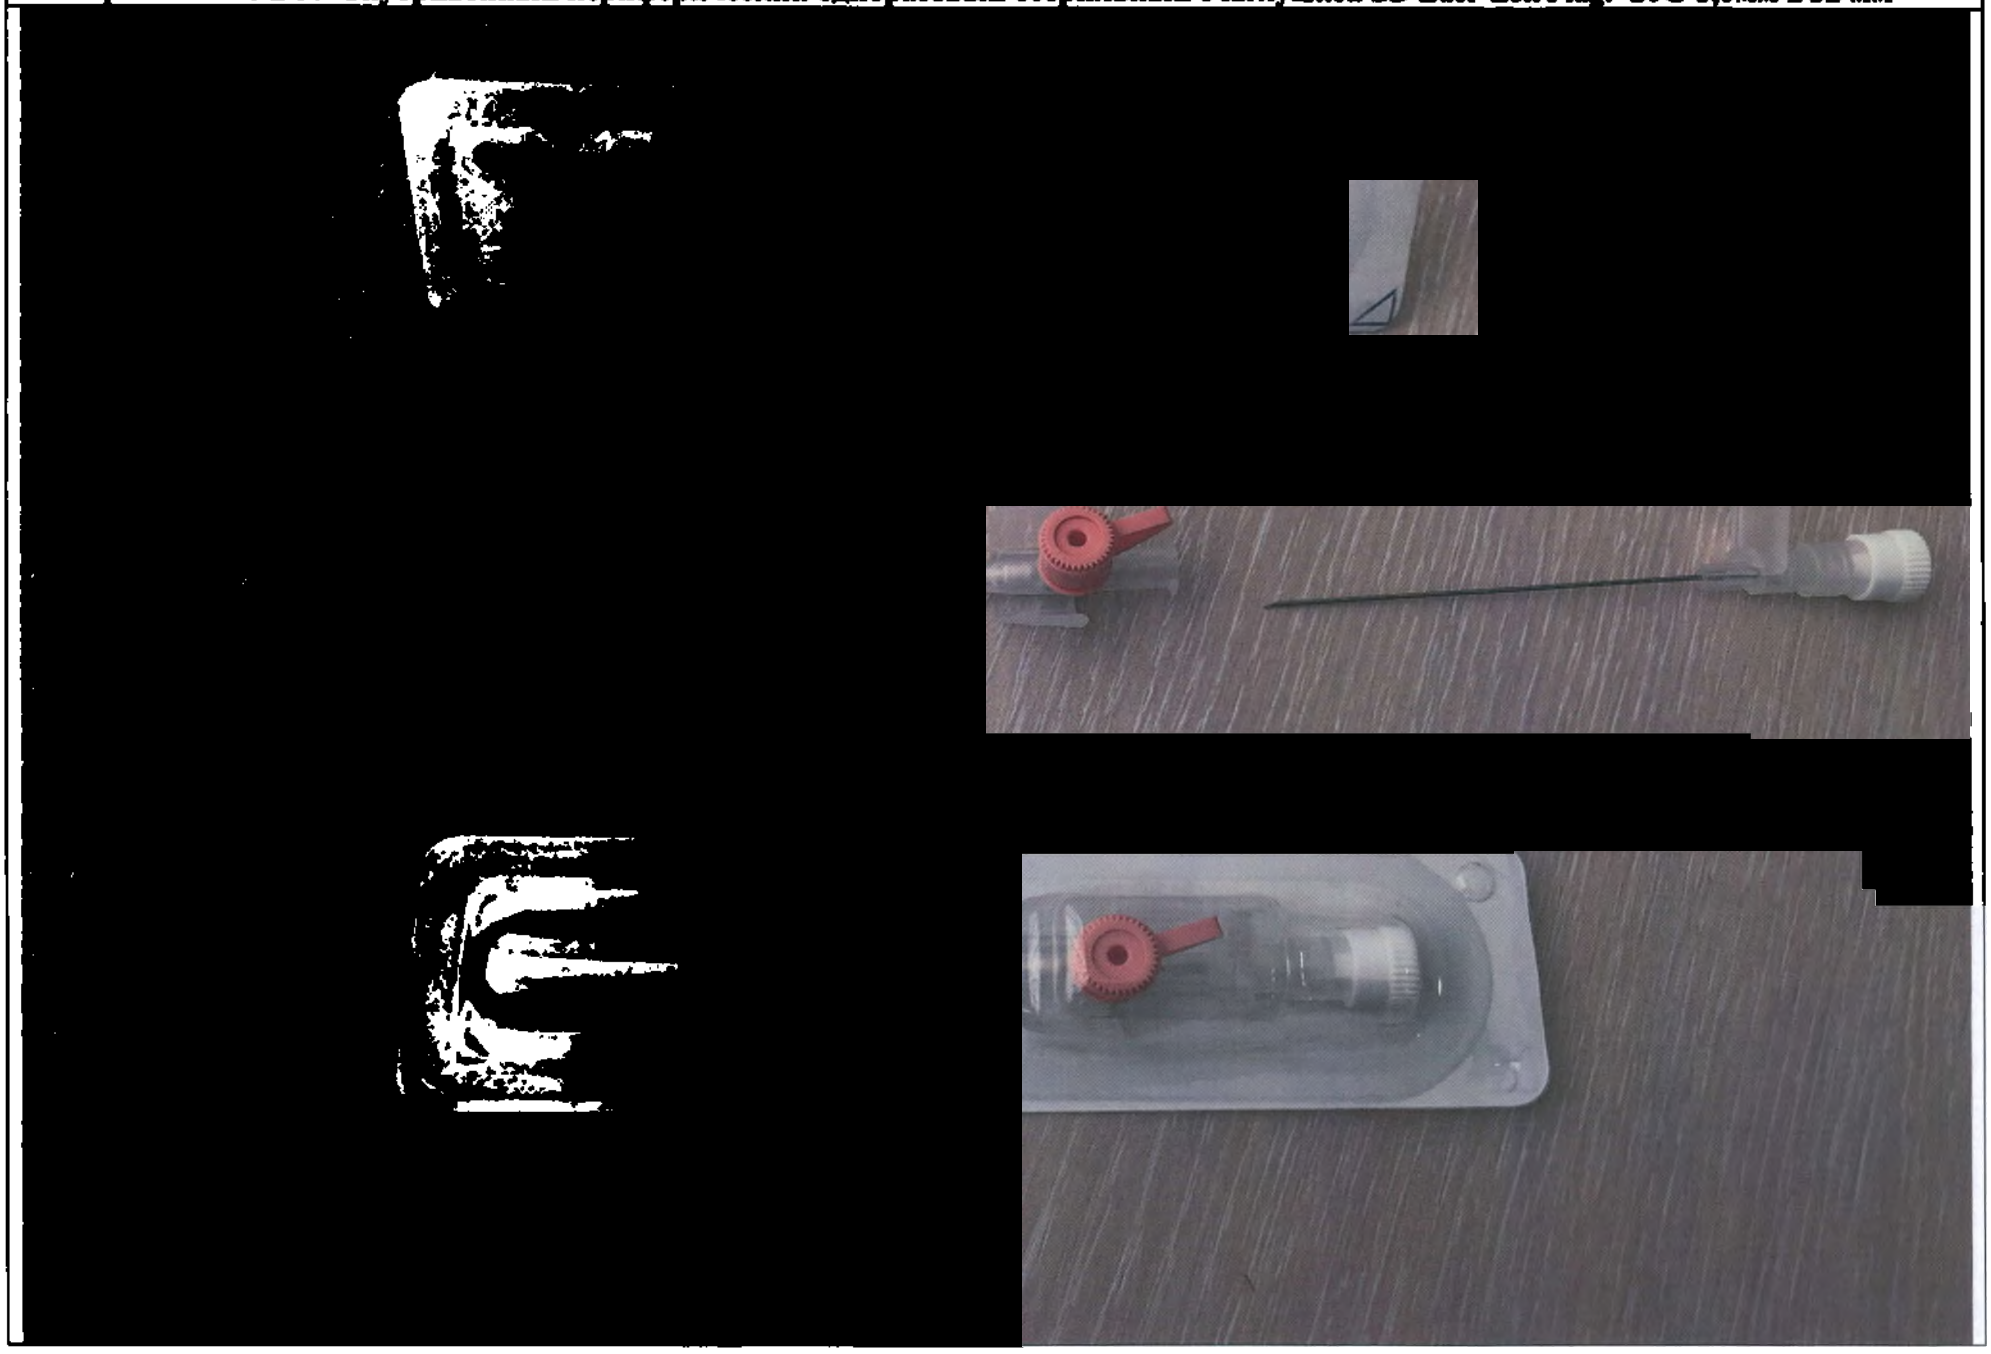

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Катетер BD VENFLON внутривенный периферический одноразовый стерильный с заглушкой BD Luer-Lok Plug: 18G 1,2мм х 45 мм

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Катетер BD VENFLON внутривенный периферический одноразовый стерильный с заглушкой BD Luer-Lok Plug: 17G 1,4мм х 45 мм

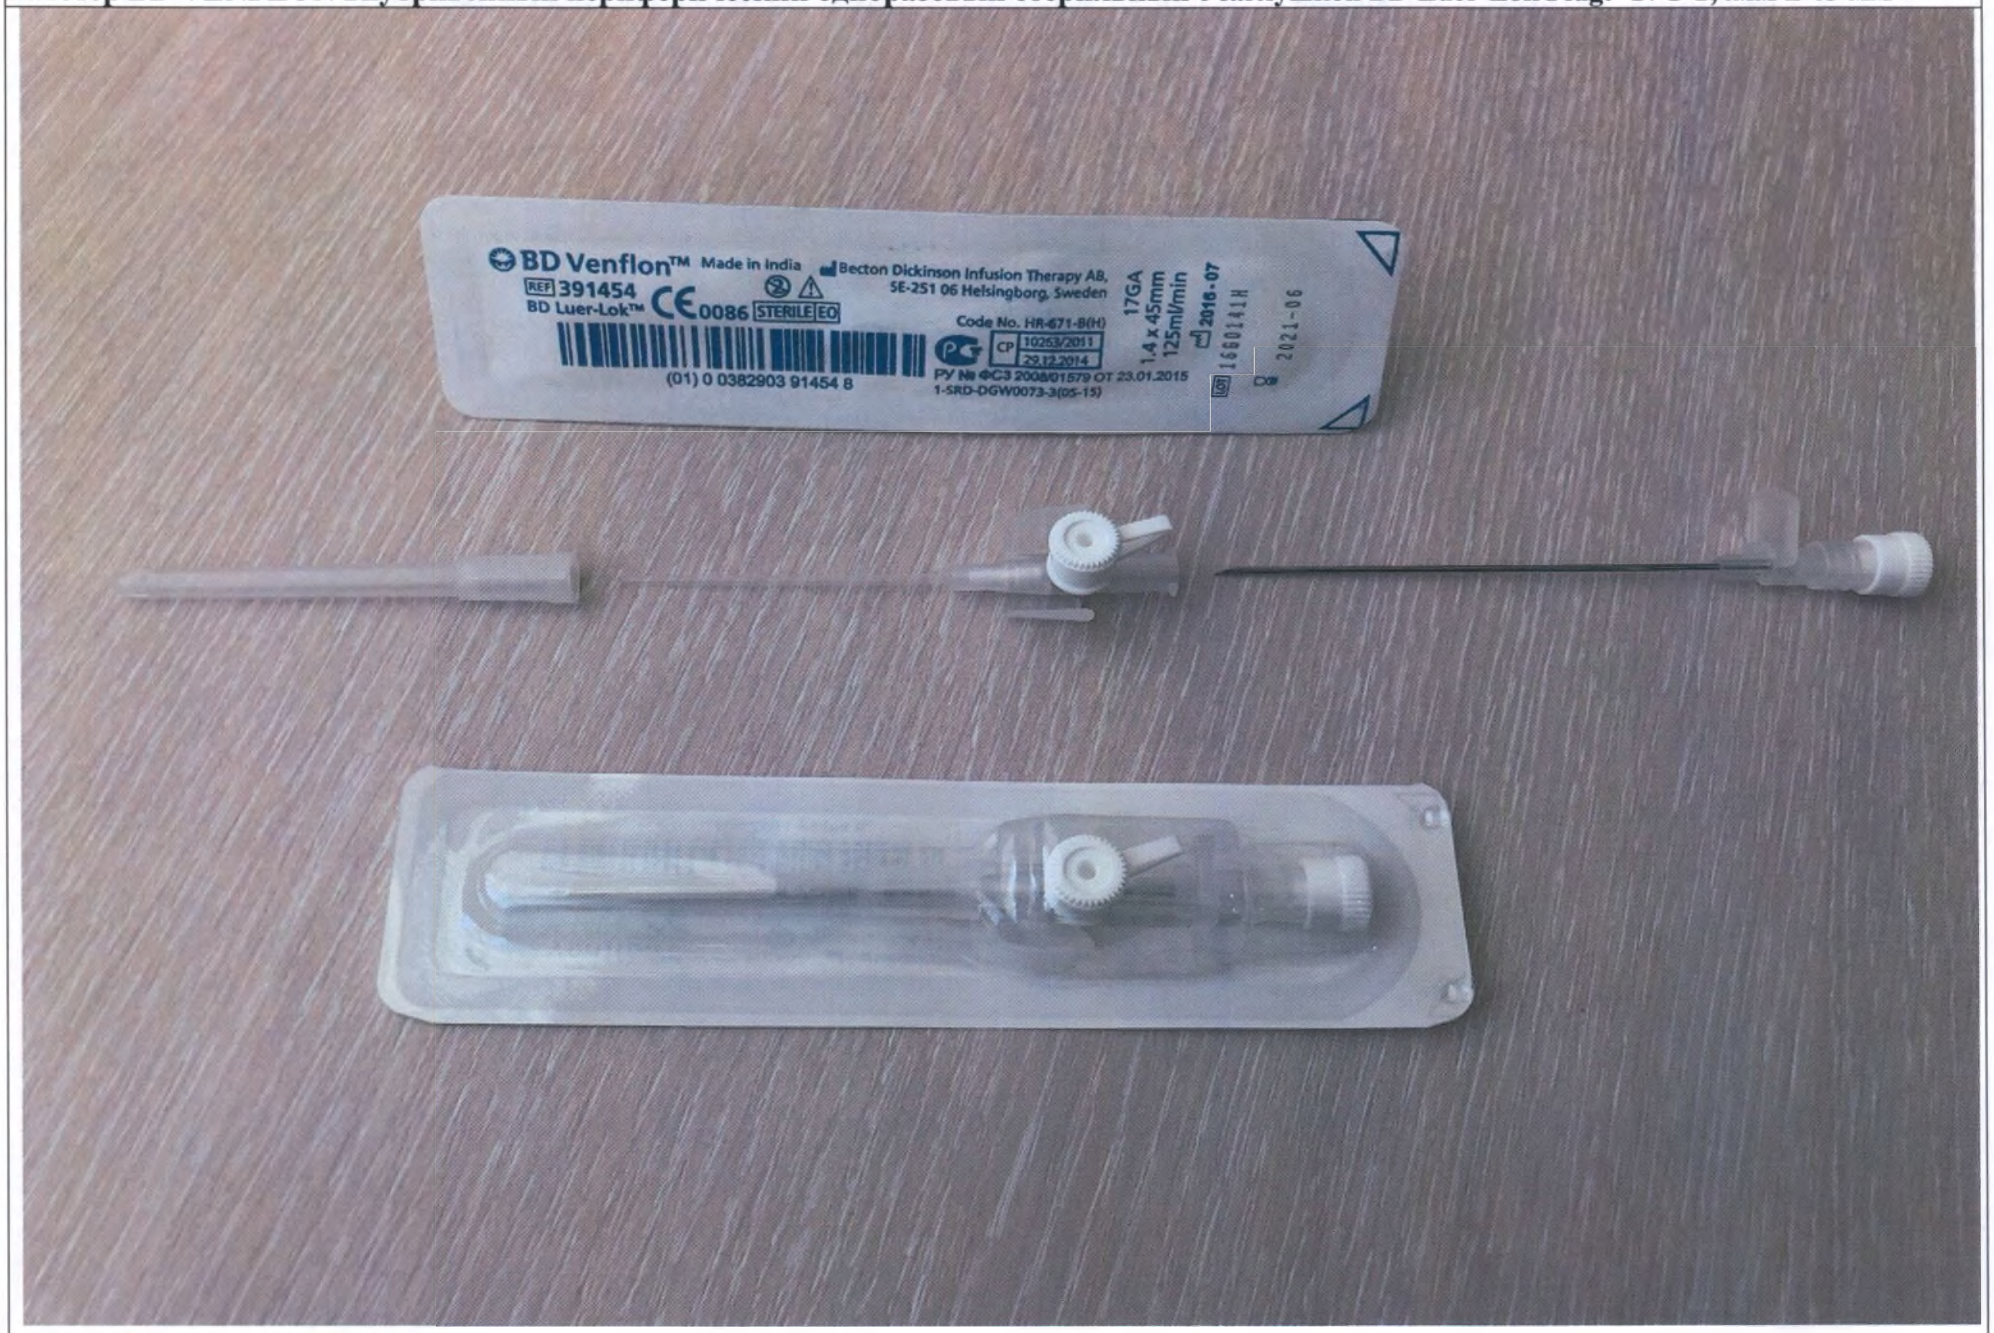

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Катетер BD VENFLON внутривенный периферический одноразовый стерильный с заглушкой BD Luer-Lok Plug: 16G 1,7мм х 45 мм

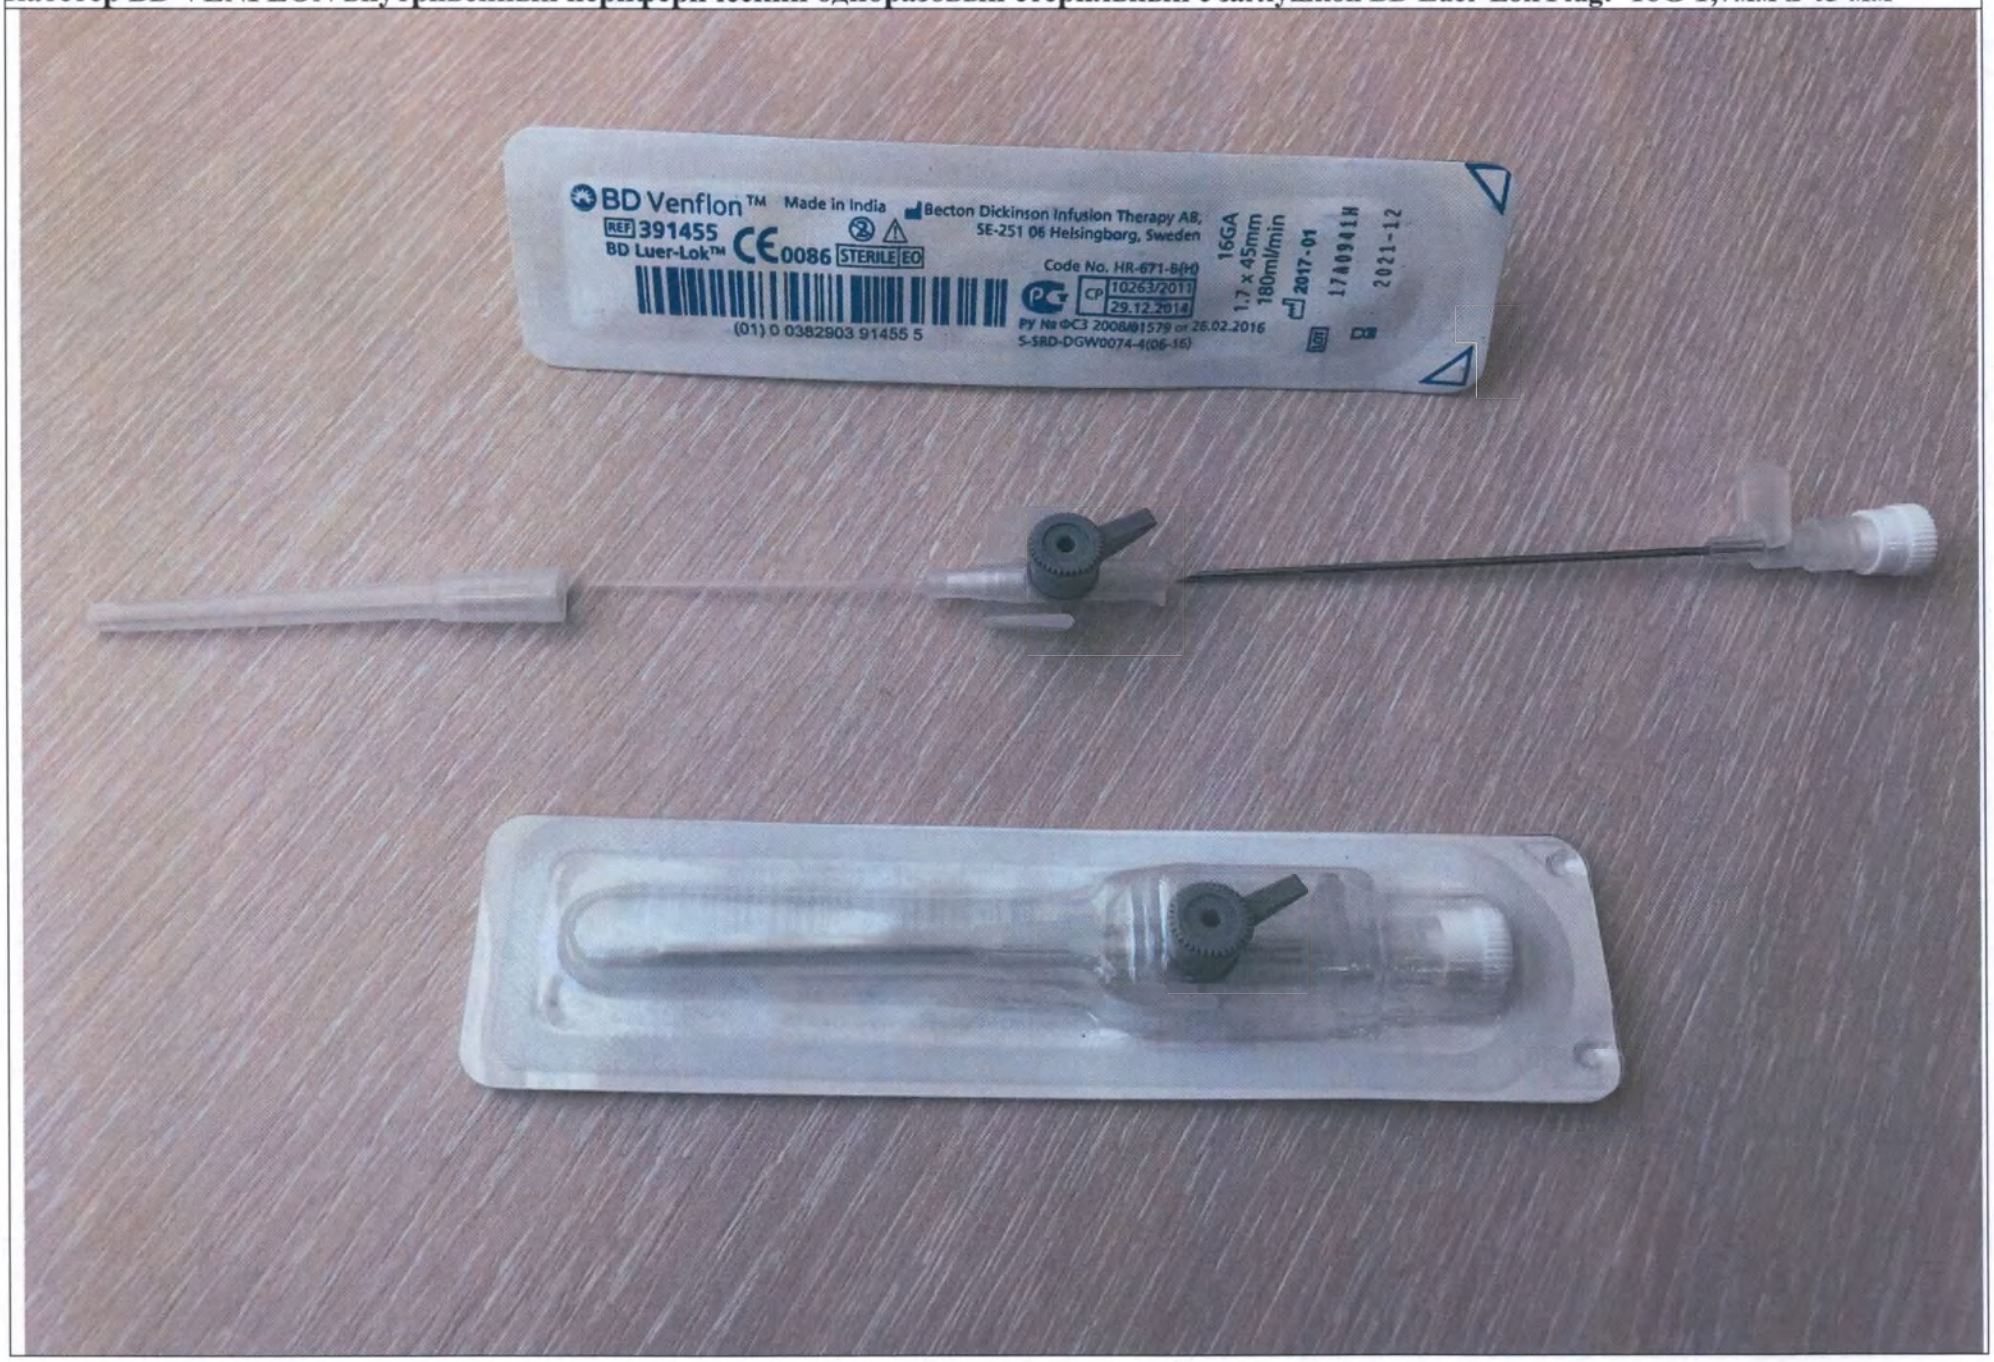

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Катетер BD VENFLON внутривенный периферический одноразовый стерильный с заглушкой BD Luer-Lok Plug: 14G 2,0мм x 45 мм

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Катетер BD VENFLON внутривенный периферический одноразовый стерильный с заглушкой BD Luer-Lok Plug: 18G 1,2мм x 32 мм

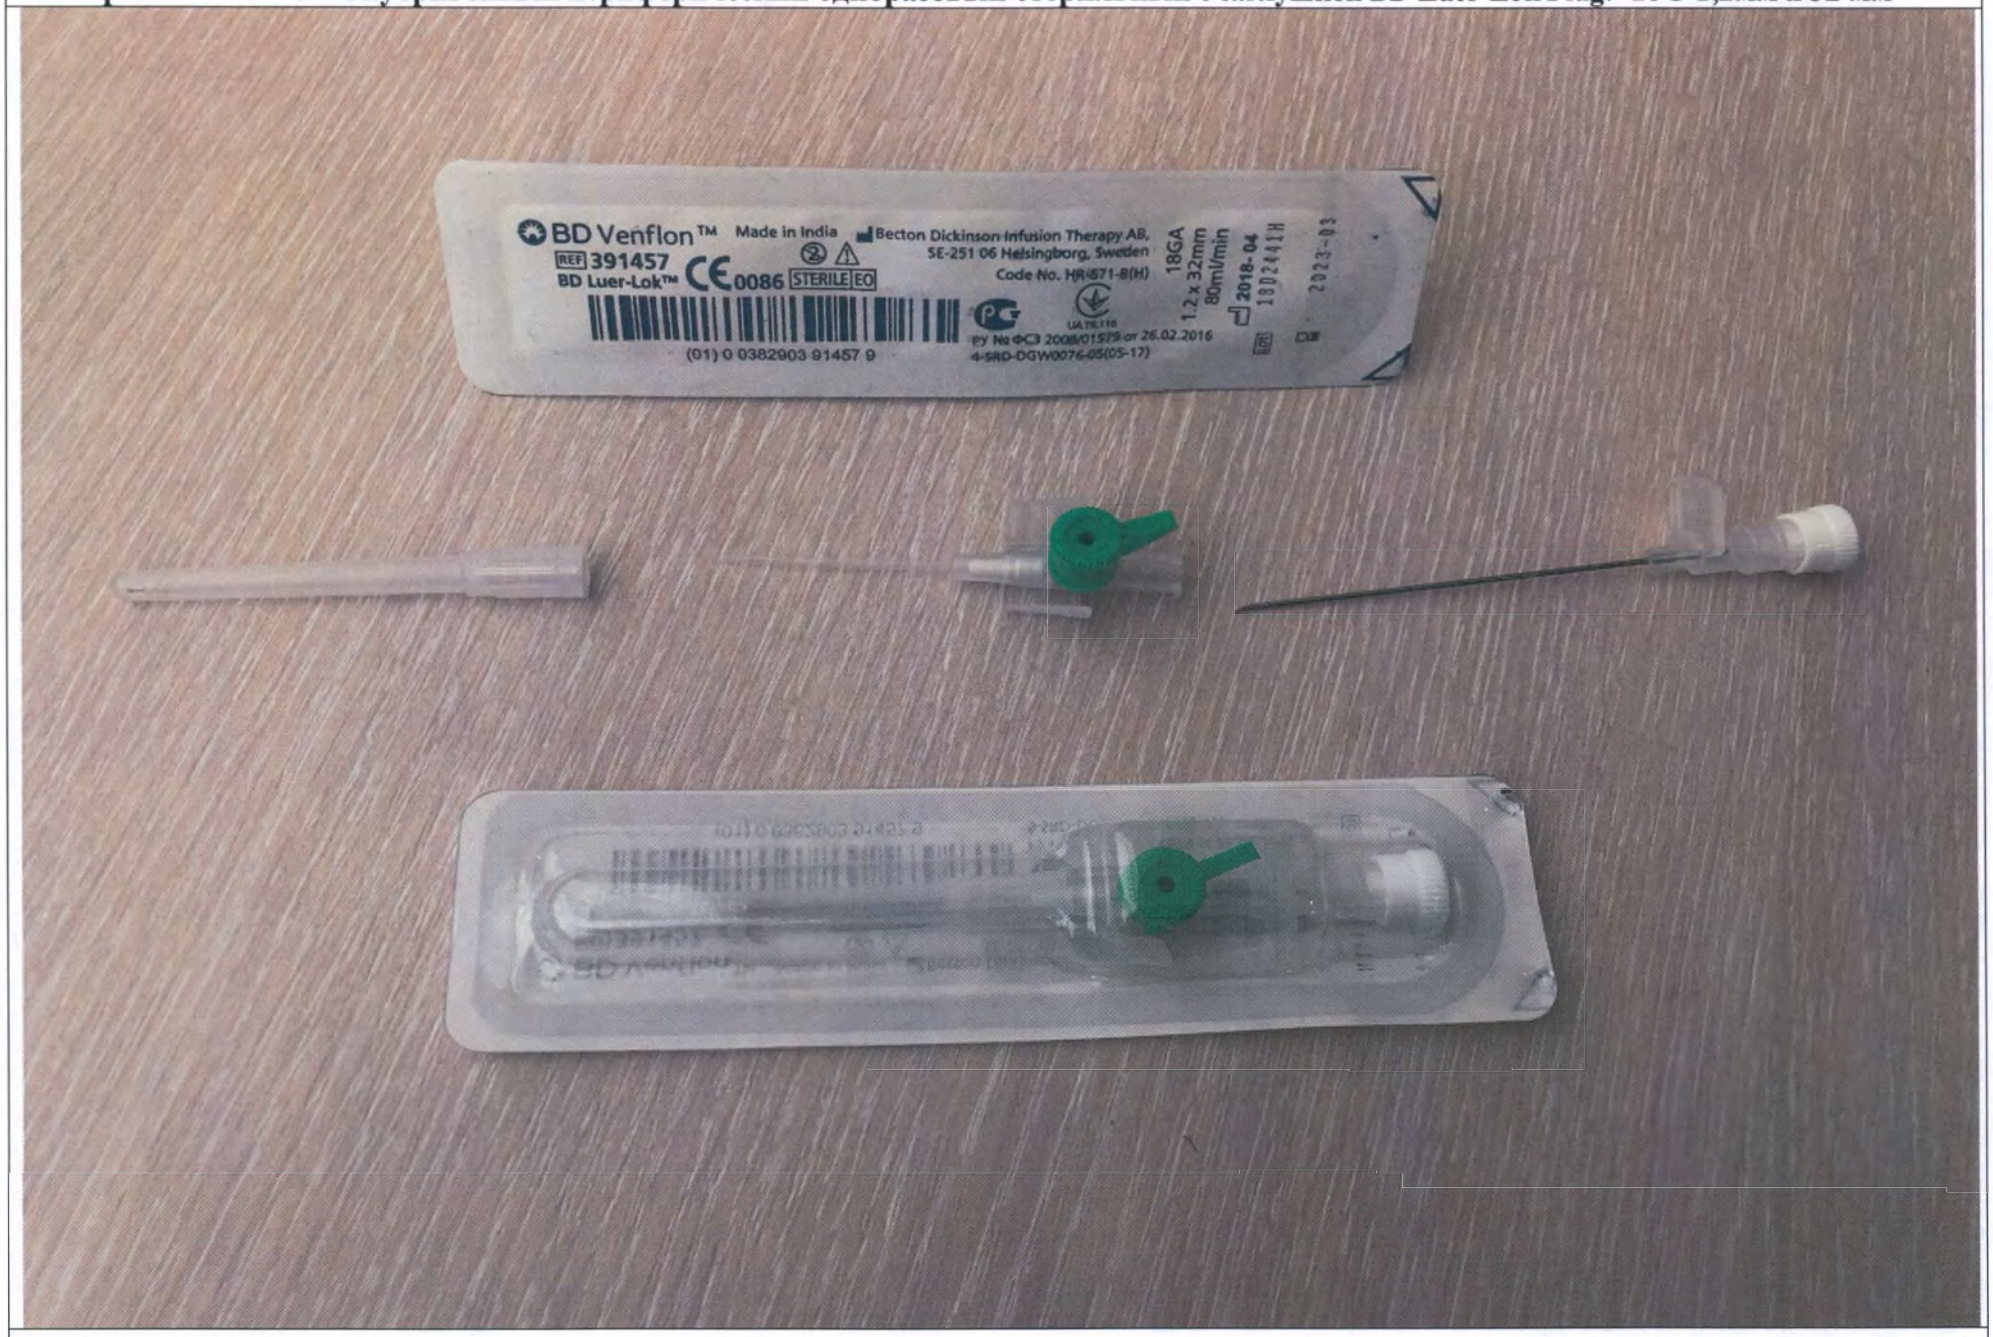

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Катетер BD VENFLON внутривенный периферический одноразовый стерильный с заглушкой BD Luer-Lok Plug (общий вид групповой упаковки)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Катетер BD VENFLON внутривенный периферический одноразовый стерильный с заглушкой BD Luer-Lok Plug (общий вид групповой упаковки)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Катетер BD VENFLON внутривенный периферический одноразовый стерильный с заглушкой BD Luer-Lok Plug (общий вид транспортной упаковки)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Катетер BD VENFLON внутривенный периферический одноразовый стерильный с заглушкой BD Luer-Lok Plug (макет маркировки на русском языке)

Катетер BD внутривенный периферический одноразовый стерильный с заглушкой BD Luer-Lok Plug, в вариантах исполнения, с принадлежностями:
Катетер BD VENFLON внутривенный периферический одноразовый стерильный с заглушкой BD Luer-Lok Plug: 22G 0,8 мм x 25 мм

Производитель: Бектон Дикинсон Инфьюжн Терапи АБ, (Becton Dickinson Infusion Therapy AB), Florettgatan 29C, PO Box 631, SE-251 06 Helsingborg, Sweden (Швеция)
Место производства: Becton Dickinson India Pvt. Ltd., Plot No. 1, Sector 3, IMT, Bawal - 123 501, District Rewari, Haryana, India (Индия)

Номер по каталогу REF : см. на упаковке
Код партии LOT : см на упаковке
Использовать до : см. на упаковке
Апирогенно. Нетоксично. Стерильно. Только для однократного применения.
Не использовать, если упаковка повреждена. Не стерилизовать повторно.
Не использовать после истечения срока годности.
Область применения: для обеспечения периферического венозного доступа с целью проведения инфузионной терапии и внутривенных вливаний
Условия хранения: при температуре от +2°С до +35°С.
Не допускать воздействия прямого солнечного света. Беречь от влаги.
Перед применением необходимо проверить целостность упаковки.
Срок годности 5 лет.

Уполномоченный представитель производителя:
ООО «Бектон Дикинсон Восток»: 127051 Москва, ул. Садовая-Самотёчная, д. 24/27, 2 этаж, помещение I, комната 18
Тел.: +7 495 775 85 82, email: Complaints_CIS@bd.com.
РУ № ФСЗ 2008/01579 от дд.мм.гг

Информацию на русскоязычном стикере просим считать приоритетной при поставке в РФ.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2.Катетер BD VENFLON PRO внутривенный периферический одноразовый стерильный с заглушкой BD Luer-Lok Plug: 22G 0,9мм х 25мм

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Катетер BD VENFLON PRO внутривенный периферический одноразовый стерильный с заглушкой BD Luer-Lok Plug: **20G 1,1мм х 32 мм**

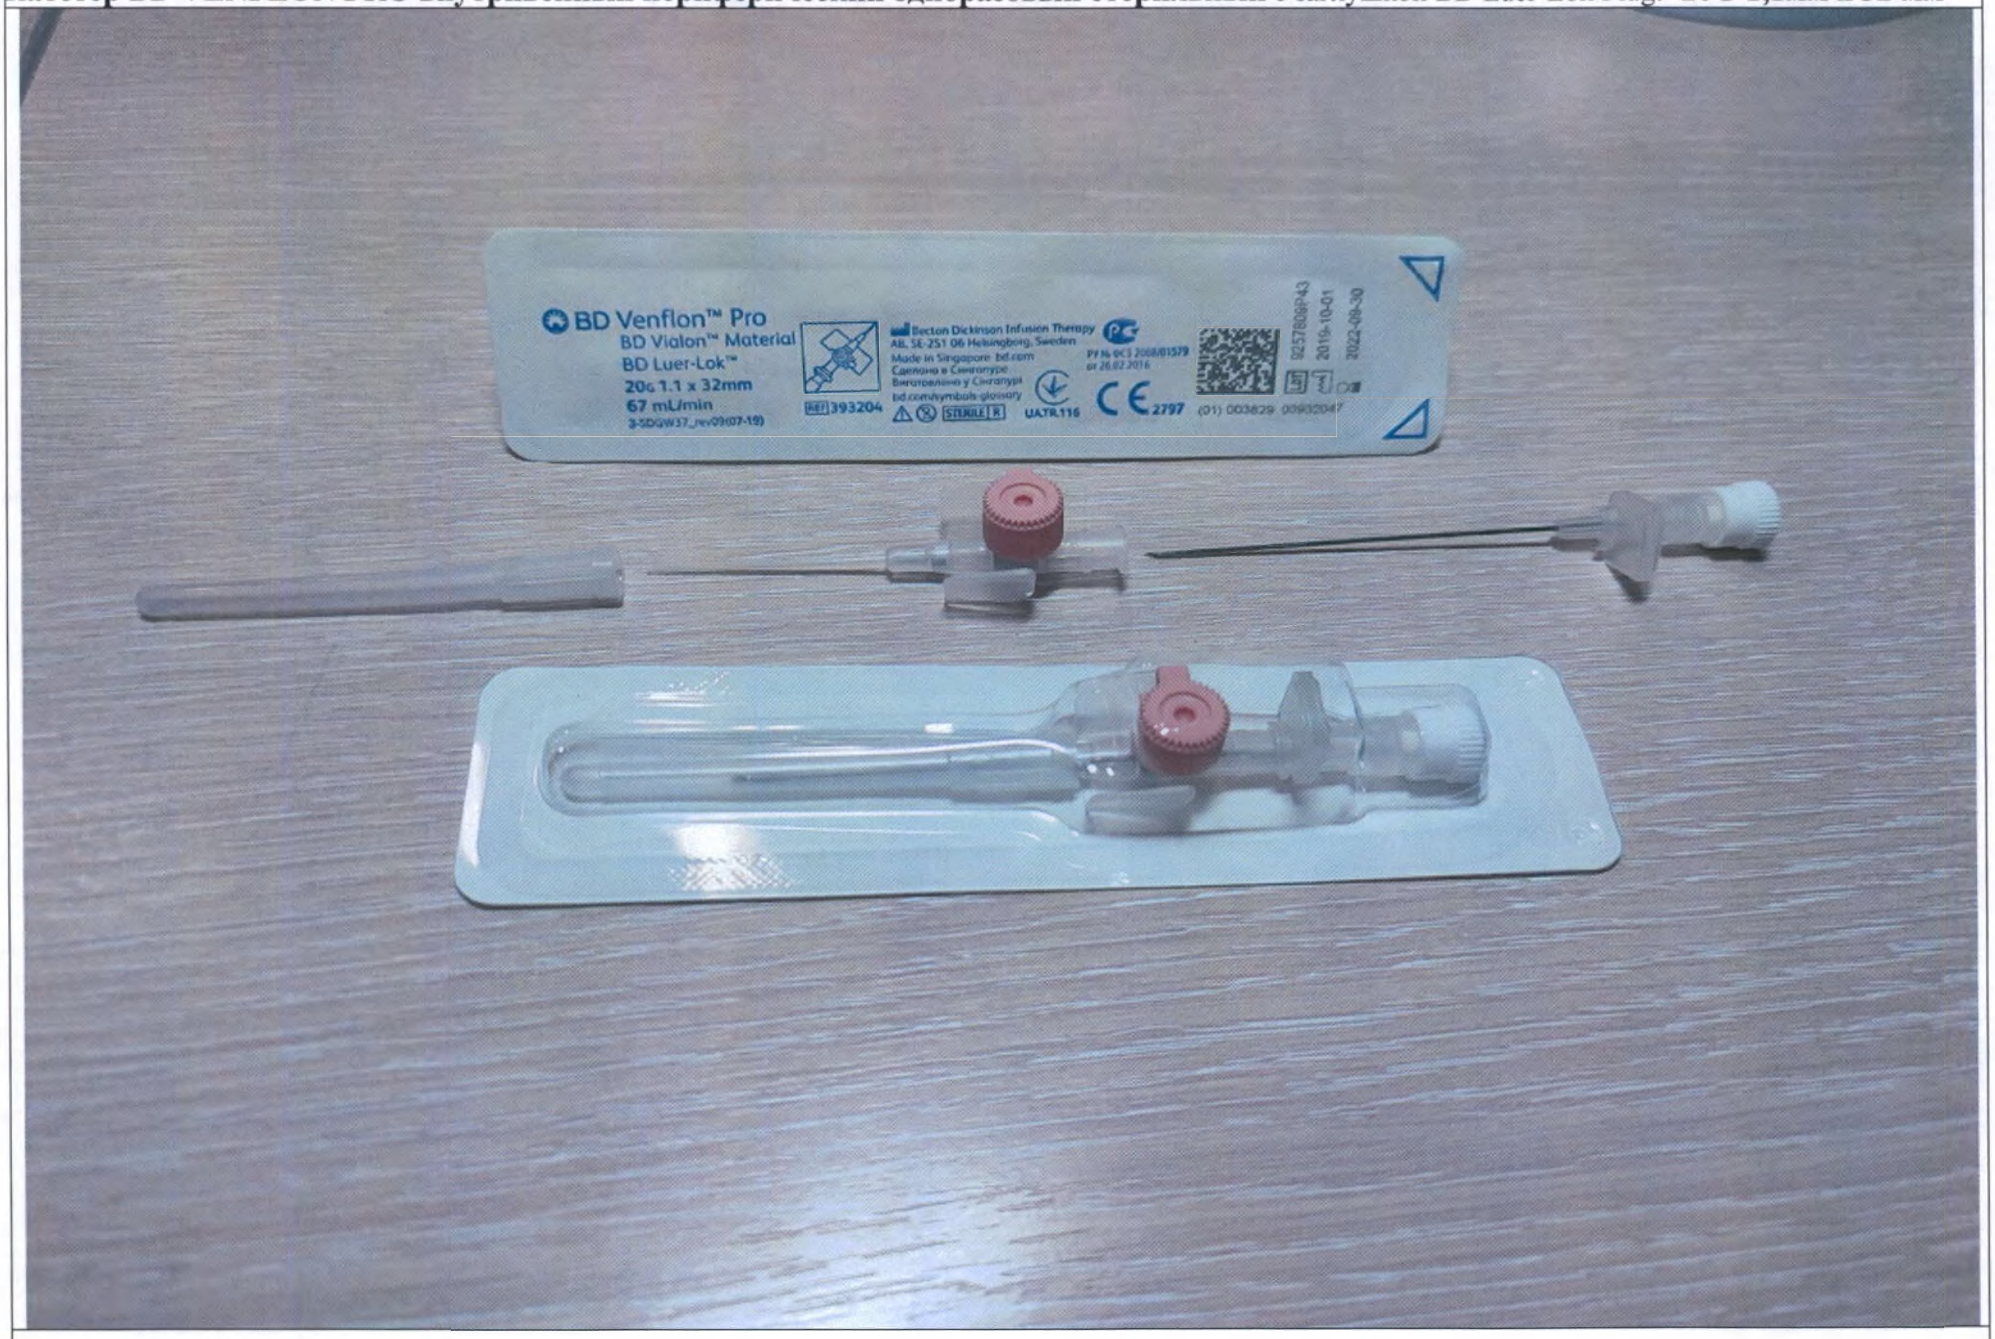

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Катетер BD VENFLON PRO внутривенный периферический одноразовый стерильный с заглушкой BD Luer-Lok Plug: 18G 1,3мм x 32мм

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Катетер BD VENFLON PRO внутривенный периферический одноразовый стерильный с заглушкой BD Luer-Lok Plug: 18G 1,3мм x 45 мм

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Катетер BD VENFLON PRO внутривенный периферический одноразовый стерильный с заглушкой BD Luer-Lok Plug: 17G 1,5мм x 45мм

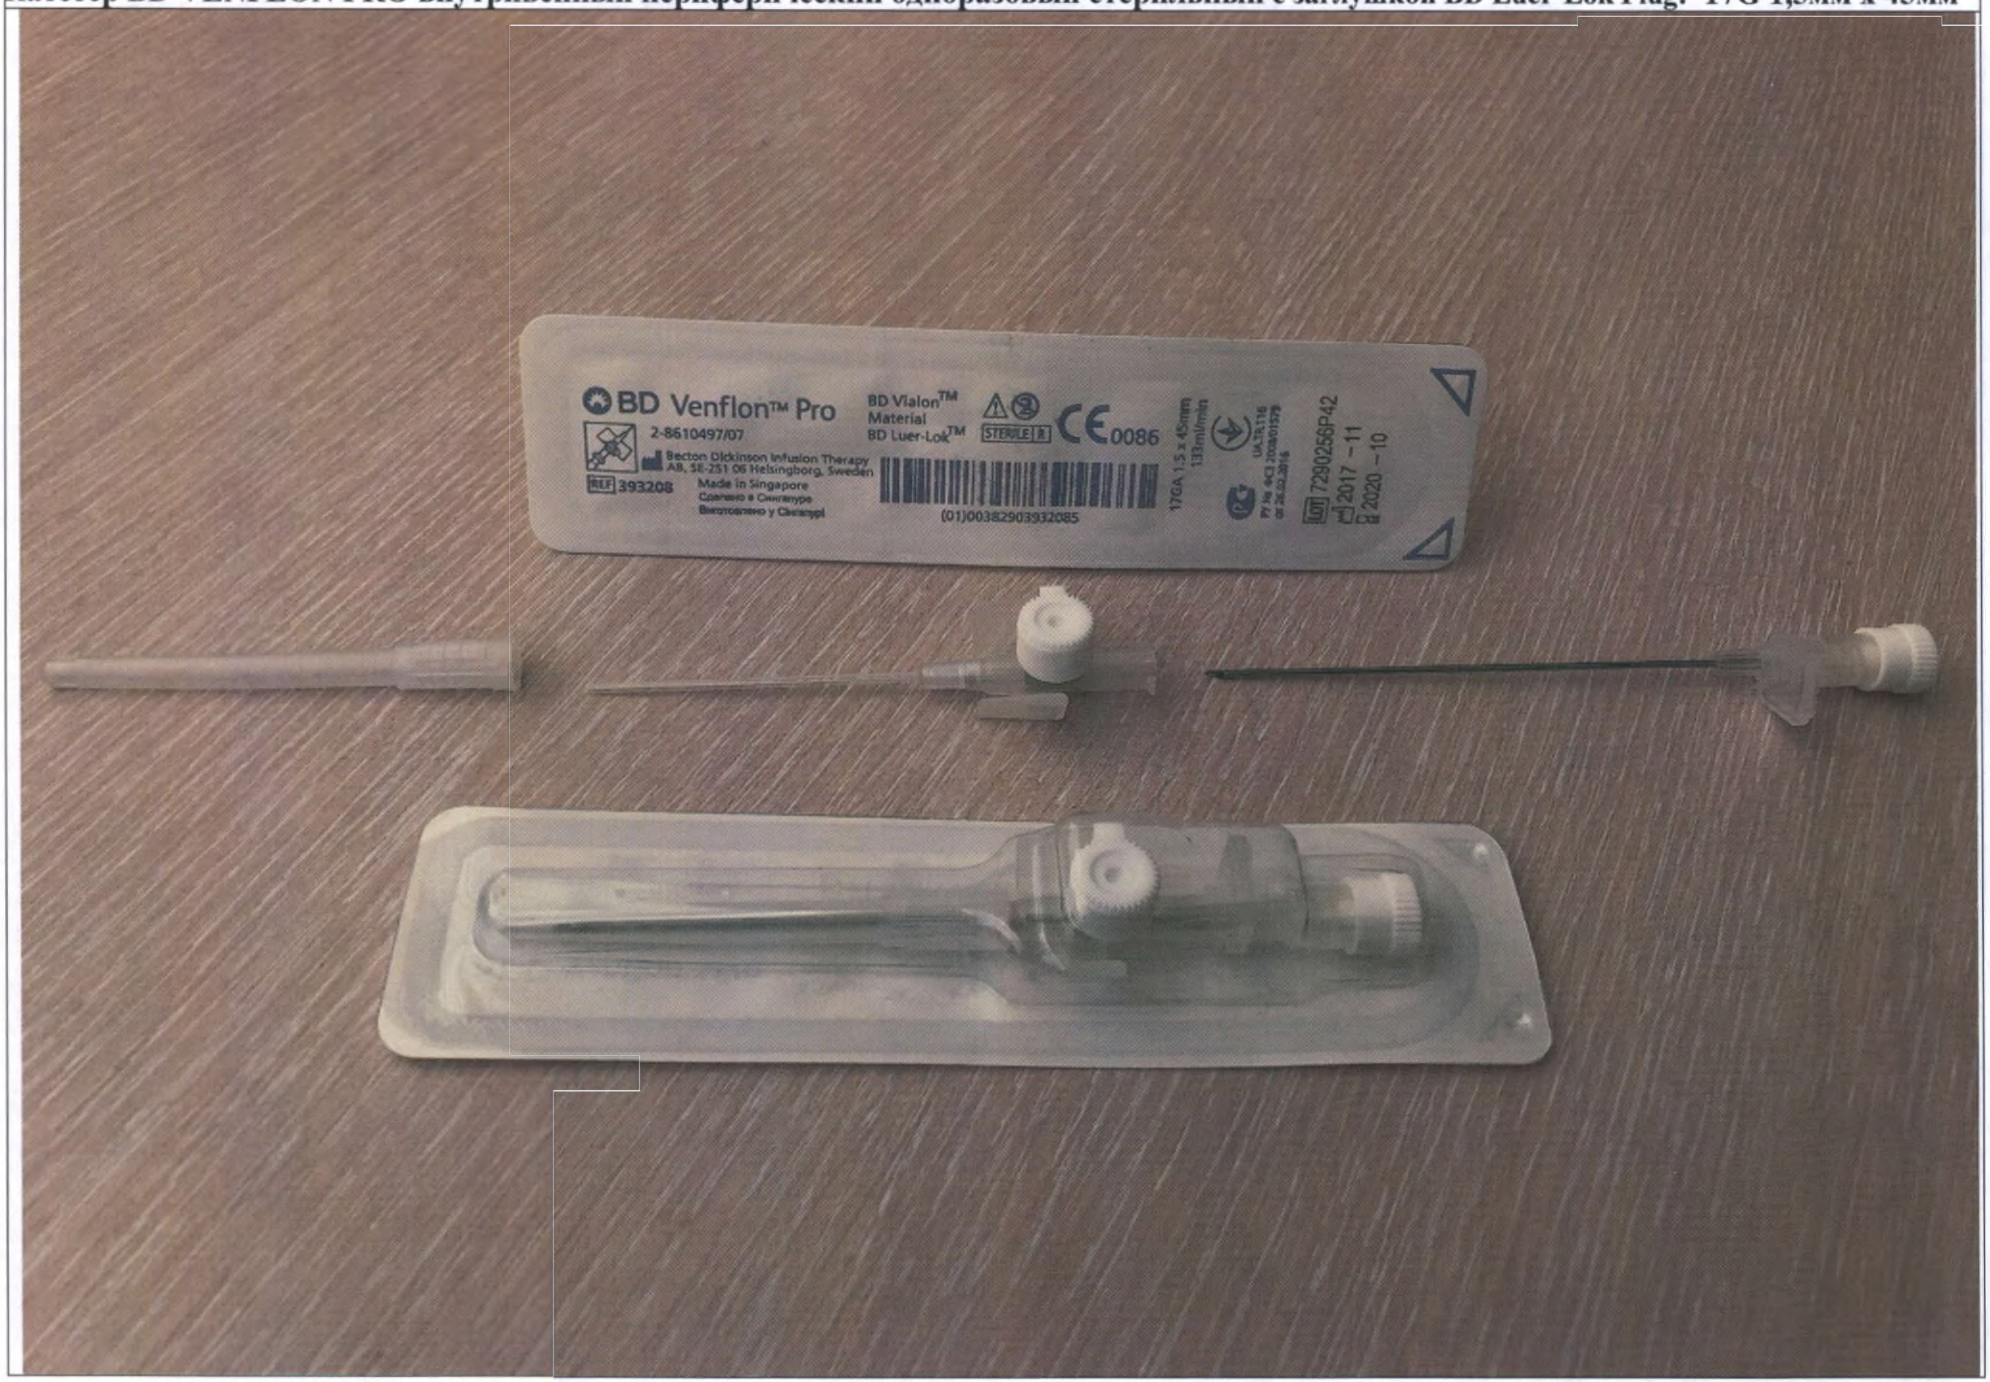

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Катетер BD VENFLON PRO внутривенный периферический одноразовый стерильный с заглушкой BD Luer-Lok Plug: 16G 1,8мм x 45мм

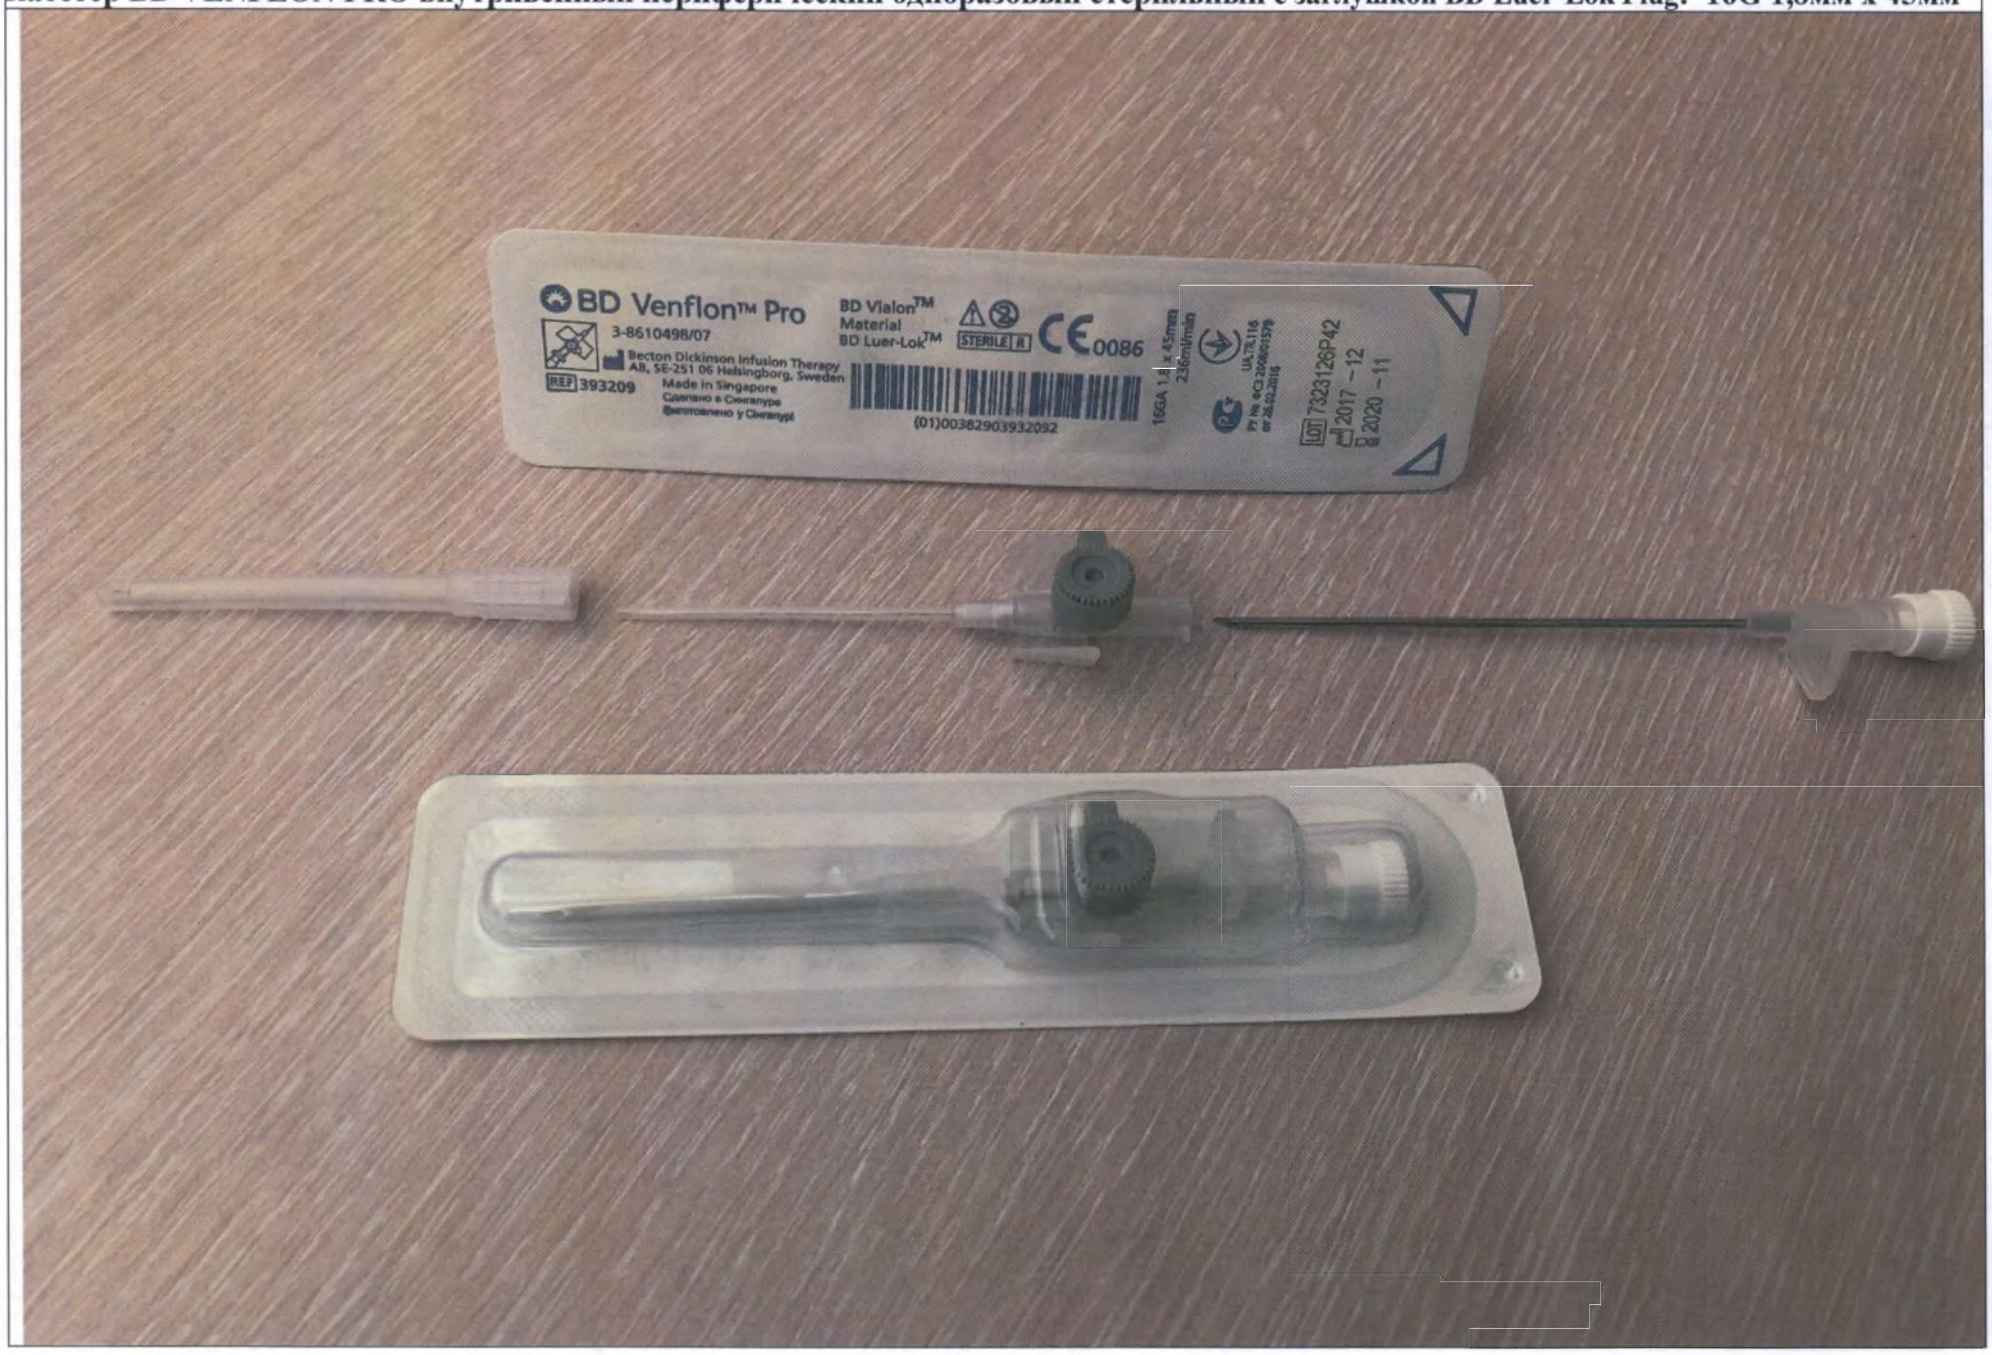

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Катетер BD VENFLON PRO внутривенный периферический одноразовый стерильный с заглушкой BD Luer-Lok Plug: 14G 2,0мм x 45 мм

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Катетер BD VENFLON PRO внутривенный периферический одноразовый стерильный с заглушкой BD Luer-Lok Plug (общий вид групповой упаковки)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Катетер BD VENFLON PRO внутривенный периферический одноразовый стерильный с заглушкой BD Luer-Lok Plug (общий вид групповой упаковки)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Катетер BD VENFLON PRO внутривенный периферический одноразовый стерильный с заглушкой BD Luer-Lok Plug (общий вид транспортной упаковки)

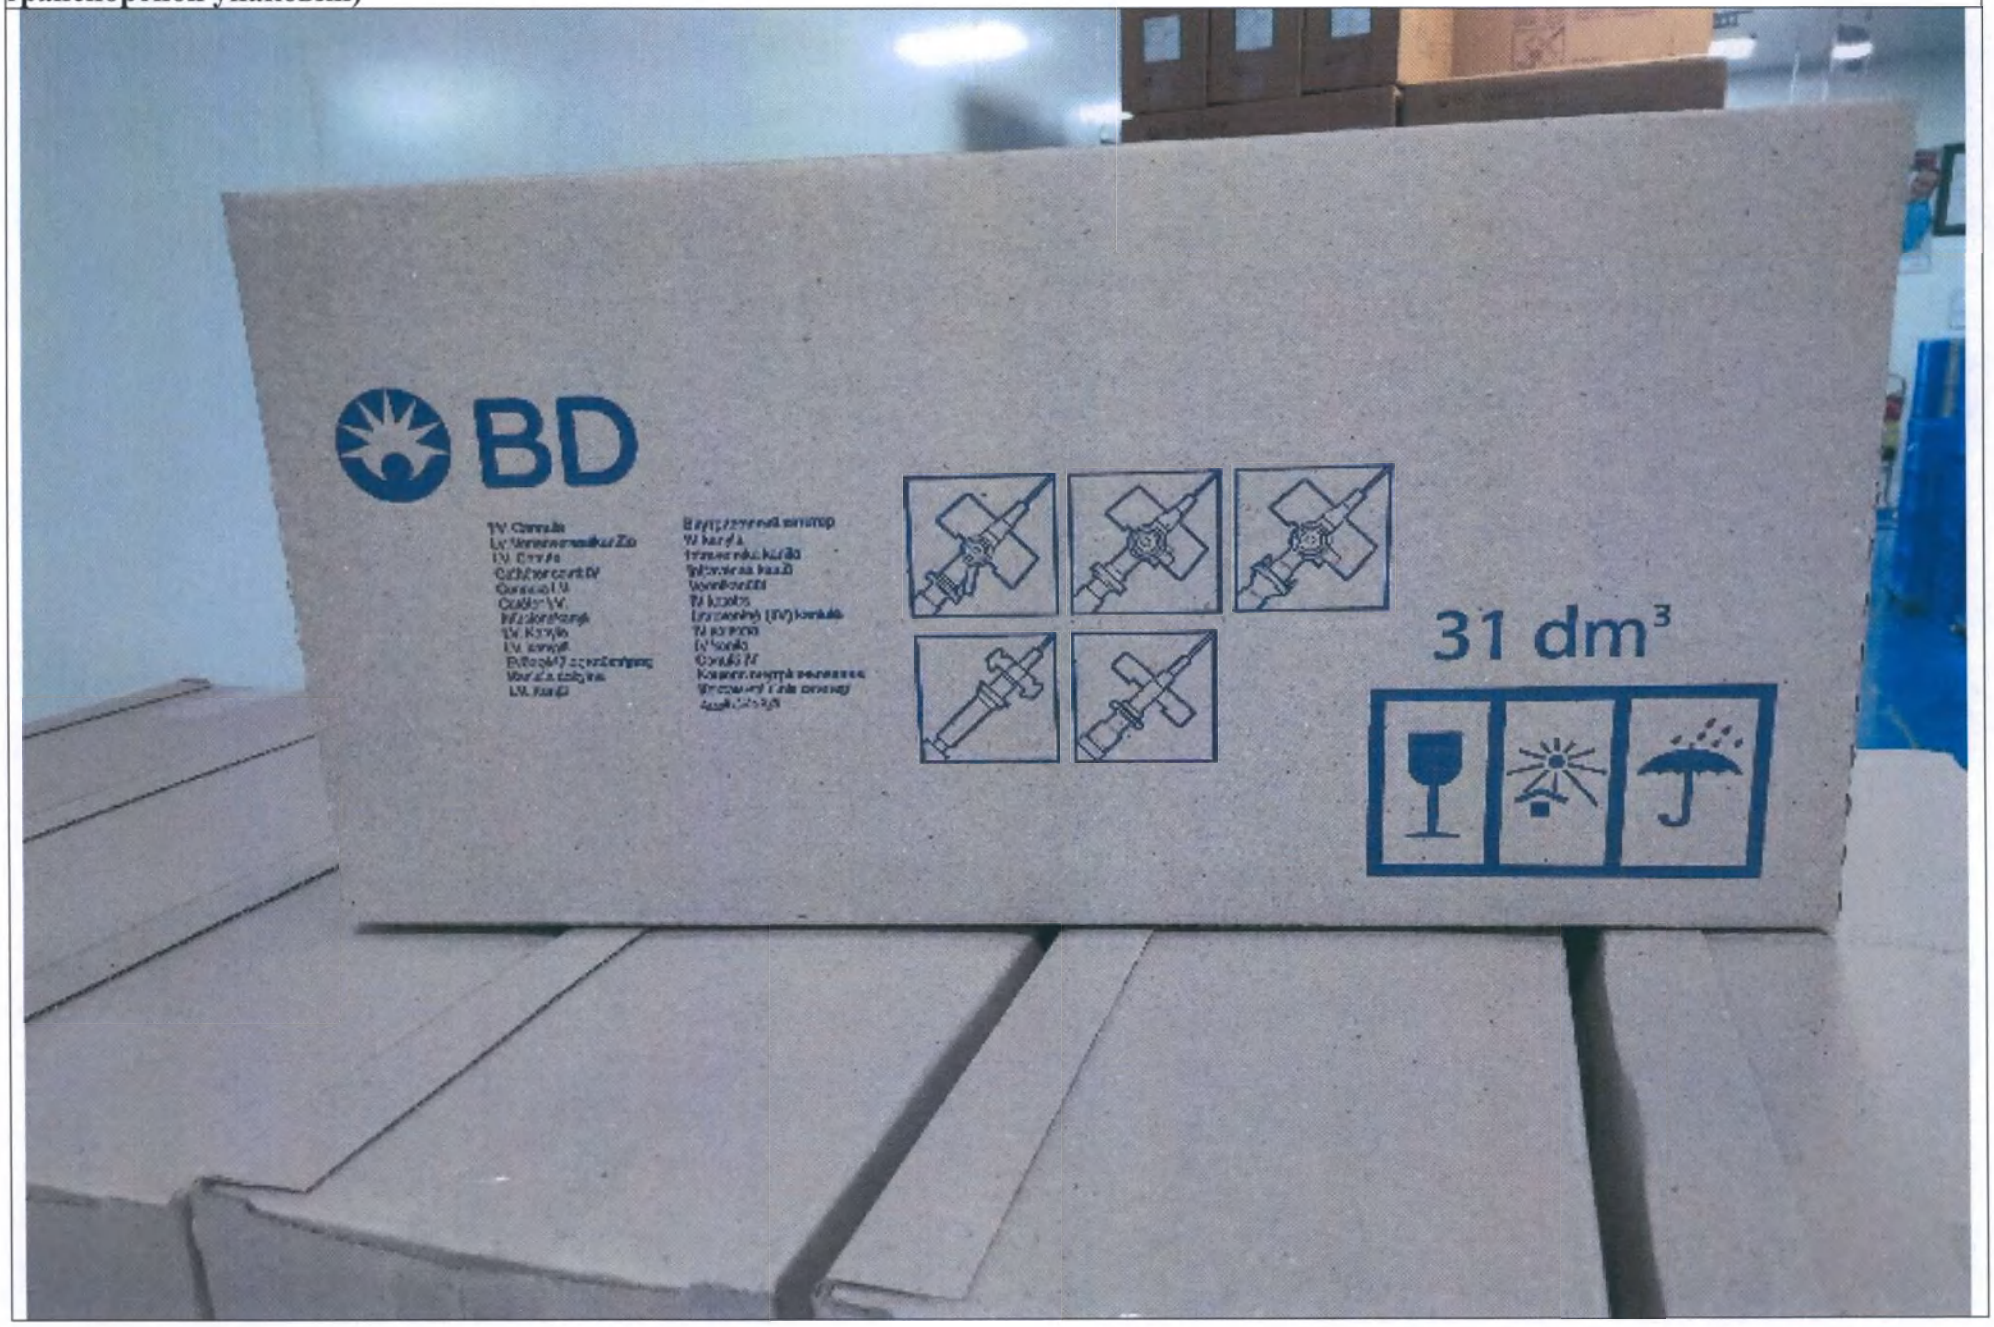

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Катетер BD внутривенный периферический одноразовый стерильный с заглушкой BD Luer-Lok Plug, в вариантах исполнения, с принадлежностями:
Катетер BD VENFLON PRO внутривенный периферический одноразовый стерильный с заглушкой BD Luer-Lok Plug: 22G 0,8 мм x 25 мм

Производитель: Бектон Дикинсон Инфьюжн Терапи АБ, (Becton Dickinson Infusion Therapy AB), Florettgatan 29C, PO Box 631, SE-251 06 Helsingborg, Sweden (Швеция)
Место производства: Becton Dickinson India Pvt. Ltd., Plot No. 1, Sector 3, IMT, Bawal - 123 501, District Rewari, Haryana, India (Индия)

Номер по каталогу REF : см. на упаковке
Код партии LOT : см на упаковке
Использовать до : см. на упаковке
Апирогенно. Нетоксично. Стерильно. Только для однократного применения.
Не использовать, если упаковка повреждена. Не стерилизовать повторно.
Не использовать после истечения срока годности.
Область применения: для обеспечения периферического венозного доступа с целью проведения инфузионной терапии и внутривенных вливаний
Условия хранения: при температуре от +2°С до +35°С.
Не допускать воздействия прямого солнечного света. Беречь от влаги.
Перед применением необходимо проверить целостность упаковки.
Срок годности 3 года.

Уполномоченный представитель производителя:
ООО «Бектон Дикинсон Восток»: 127051 Москва, ул. Садовая-Самотёчная, д. 24/27, 2 этаж, помещение I, комната 18
Тел.: +7 495 775 85 82, email: Complaints_CIS@bd.com.
РУ № ФСЗ 2008/01579 от дд.мм.гг

Информацию на русскоязычном стикере просим считать приоритетной при поставке в РФ.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

3. Катетер BD NEOFLON внутривенный периферический одноразовый стерильный с заглушкой BD Luer-Lok Plug: 26G 0,6мм х 19 мм

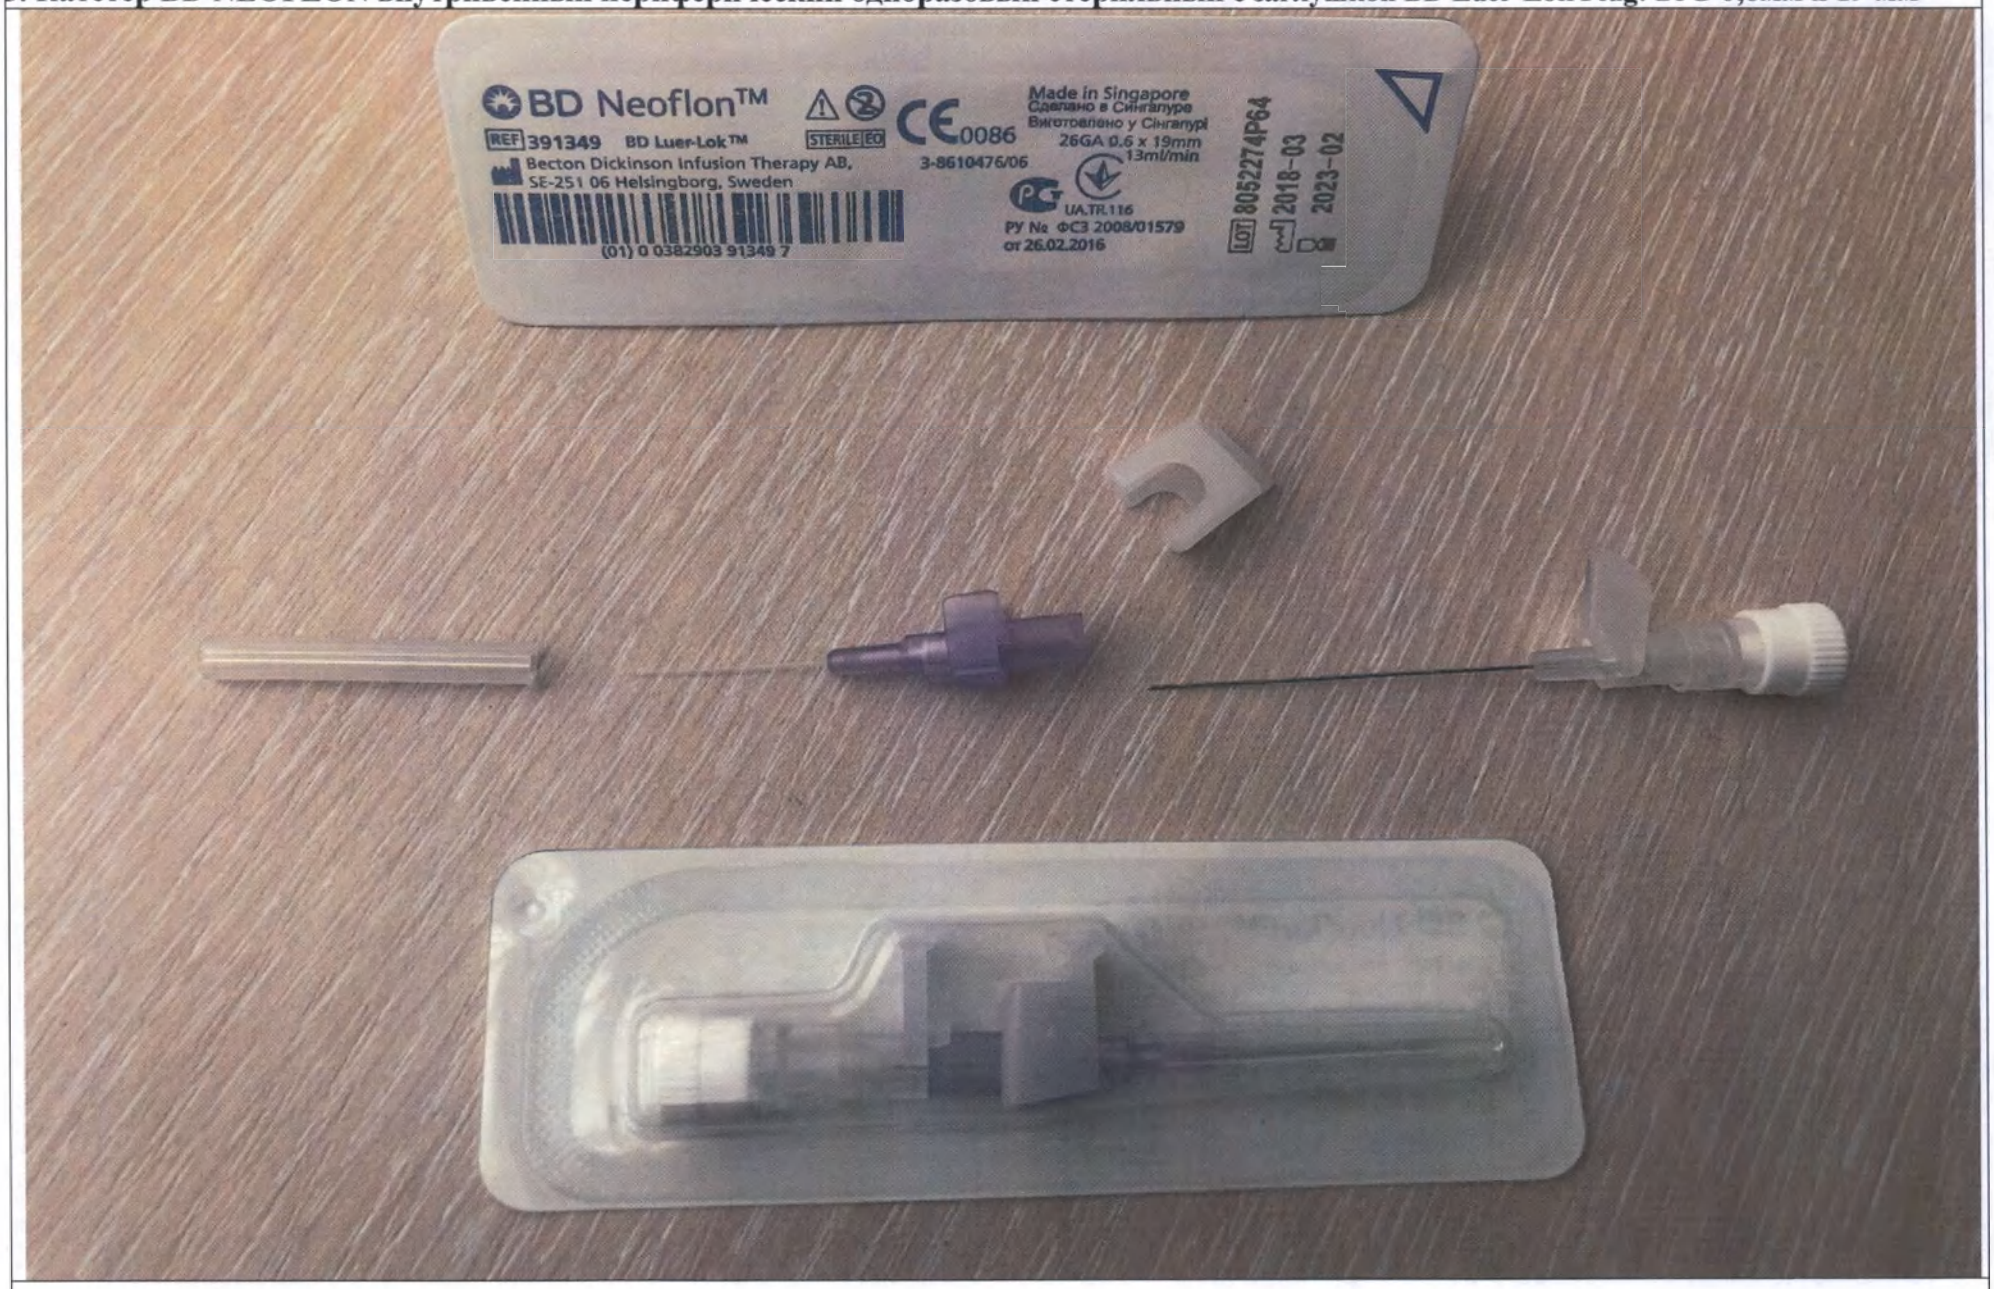

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Катетер BD NEOFLON внутривенный периферический одноразовый стерильный с заглушкой BD Luer-Lok Plug: 24G 0,7мм х 19 мм

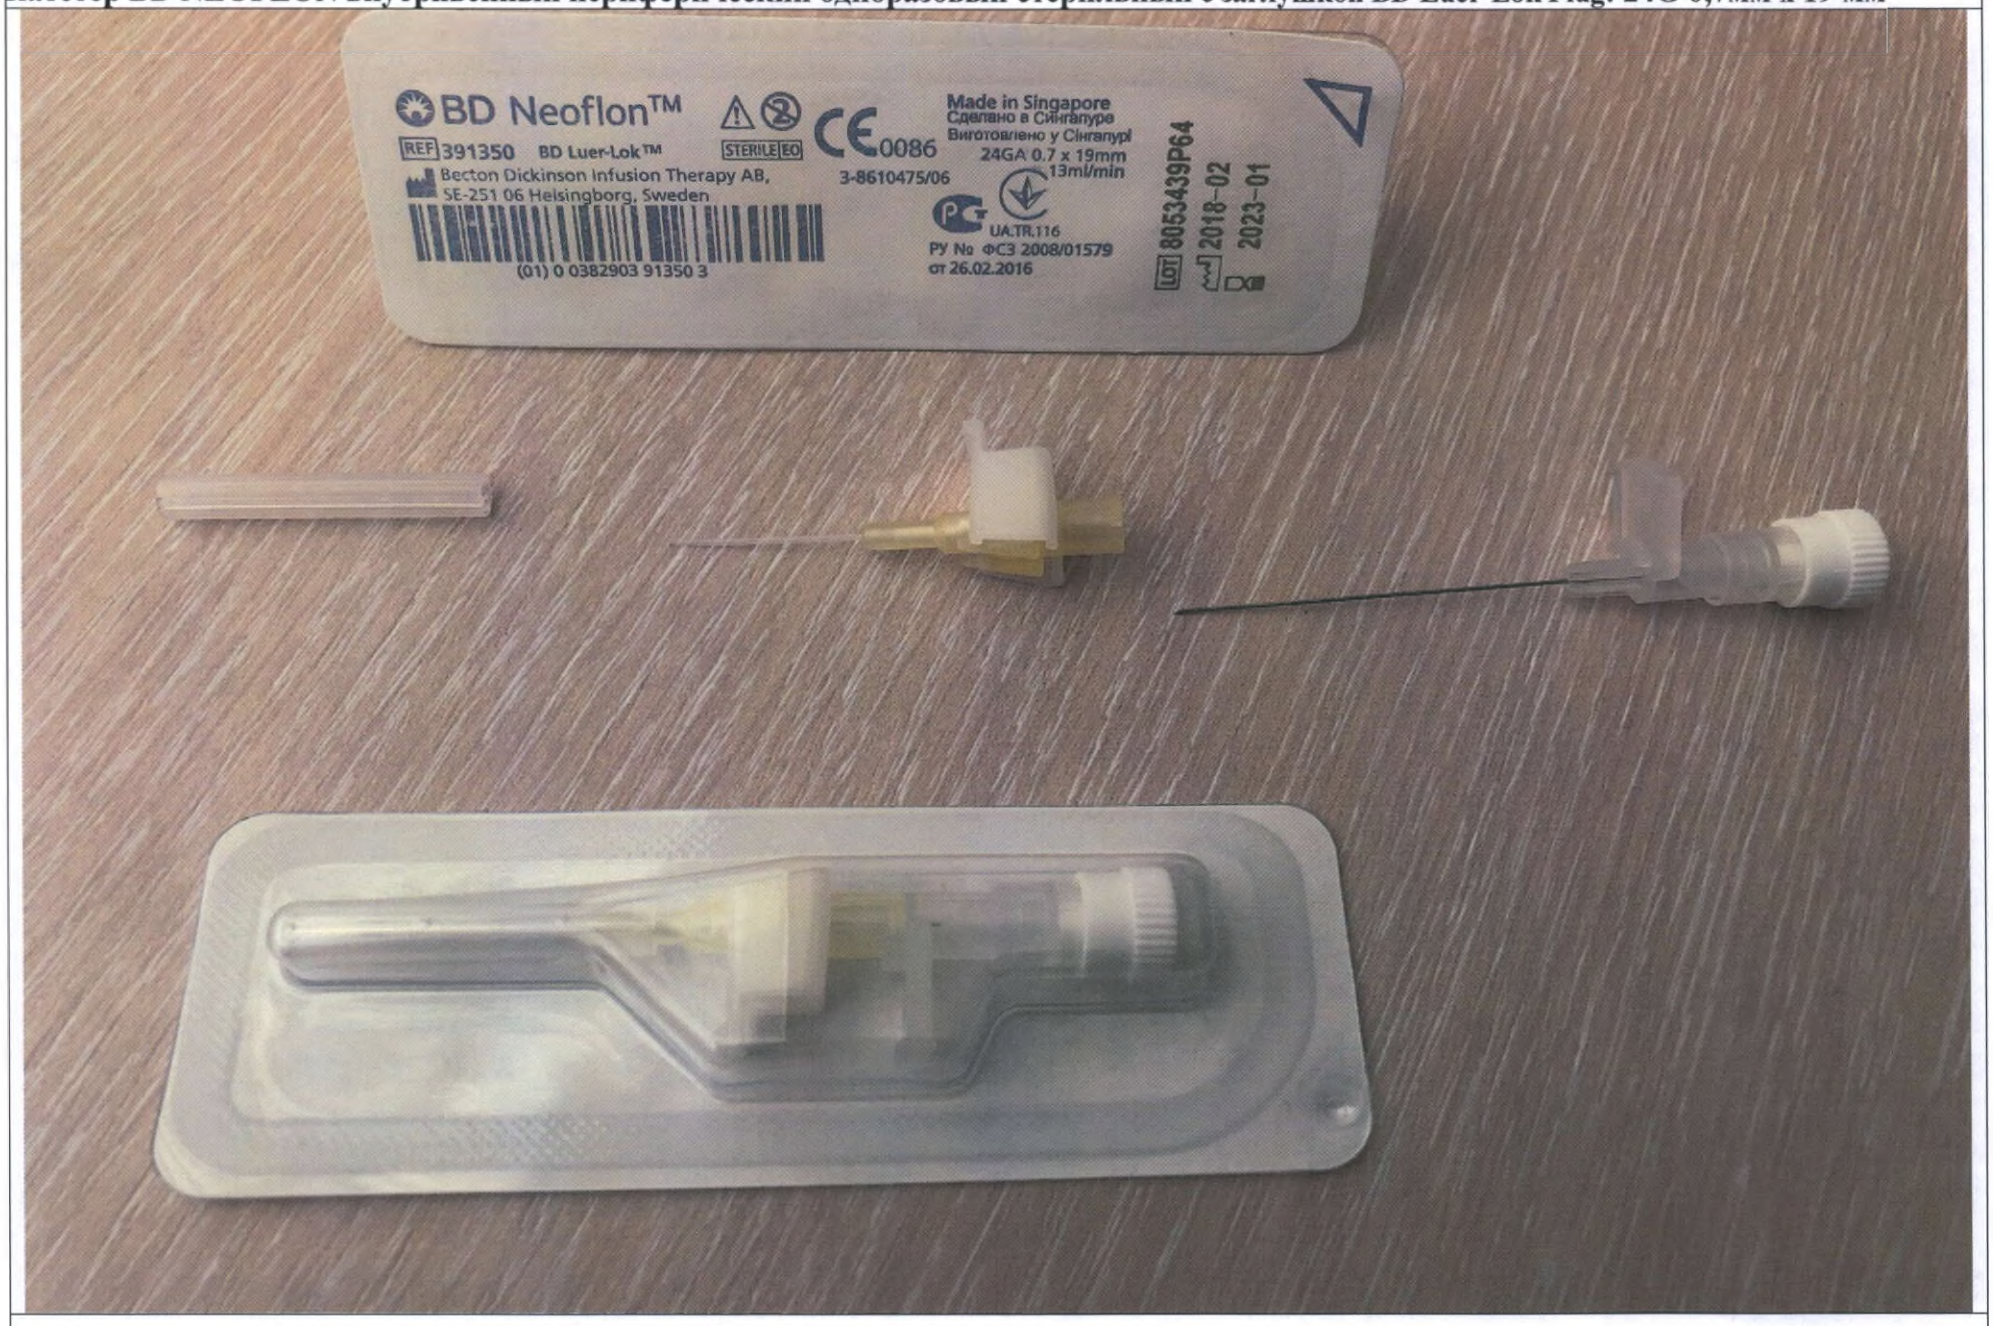

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Катетер BD NEOFLON внутривенный периферический одноразовый стерильный с заглушкой BD Luer-Lok Plug (общий вид групповой упаковки)

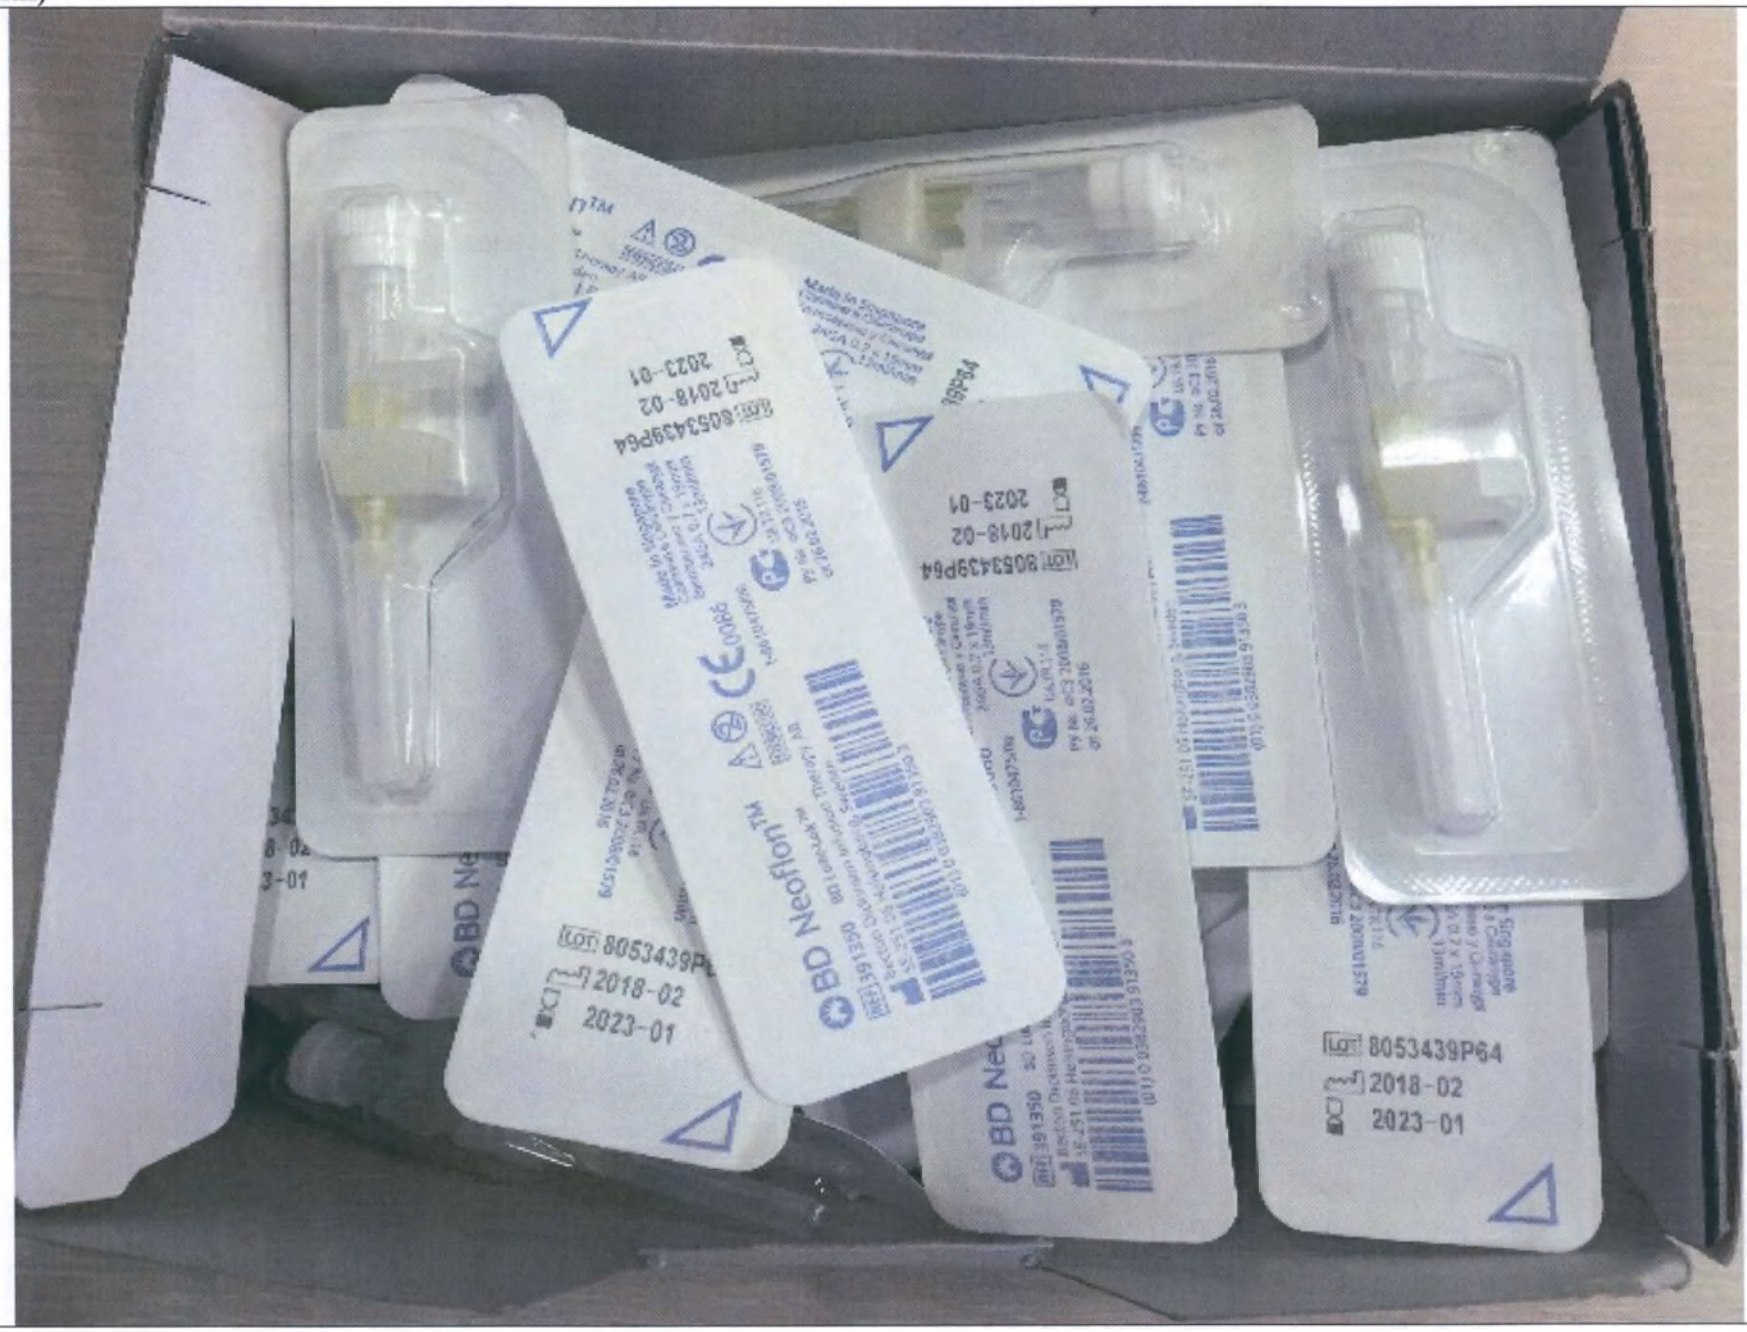

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Катетер BD NEOFLON внутривенный периферический одноразовый стерильный с заглушкой BD Luer-Lok Plug (общий вид групповой упаковки)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Катетер BD NEOFLON внутривенный периферический одноразовый стерильный с заглушкой BD Luer-Lok Plug (общий вид транспортной упаковки)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Катетер BD внутривенный периферический одноразовый стерильный с заглушкой BD Luer-Lok Plug, в вариантах исполнения, с принадлежностями:
Катетер BD NEOFLON внутривенный периферический одноразовый стерильный с заглушкой BD Luer-Lok Plug: 26G 0,6 мм x 19 мм

Производитель: Бектон Дикинсон Инфьюжн Терапи АБ, (Becton Dickinson Infusion Therapy AB), Florettgatan 29C, PO Box 631, SE-251 06 Helsingborg, Sweden (Швеция)
Место производства: Becton Dickinson Medical (S) Pte. Ltd, 30 Tuas Avenue 2, Singapore 639461, Singapore (Сингапур)

Номер по каталогу REF : см. на упаковке
Код партии LOT : см на упаковке
Использовать до : см. на упаковке
Апирогенно. Нетоксично. Стерильно. Только для однократного применения.
Не использовать, если упаковка повреждена. Не стерилизовать повторно.
Не использовать после истечения срока годности.
Область применения: для обеспечения периферического венозного доступа с целью проведения инфузионной терапии и внутривенных вливаний
Условия хранения: при температуре от +2°С до +35°С.
Не допускать воздействия прямого солнечного света. Беречь от влаги.
Перед применением необходимо проверить целостность упаковки.
Срок годности 5 лет.

Уполномоченный представитель производителя:
ООО «Бектон Дикинсон Восток»: 127051 Москва, ул. Садовая-Самотёчная, д. 24/27, 2 этаж, помещение I, комната 18
Тел.: +7 495 775 85 82, email: Complaints_CIS@bd.com.
РУ № ФСЗ 2008/01579 от дд.мм.гг

Информацию на русскоязычном стикере просим считать приоритетной при поставке в РФ.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4. Катетер BD NEOFLON PRO внутривенный периферический одноразовый стерильный с заглушкой BD Luer-Lok Plug:26G 0,6мм x 19мм

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Катетер BD NEOFLON PRO внутривенный периферический одноразовый стерильный с заглушкой BD Luer-Lok Plug: 24G 0,7 мм x 19мм

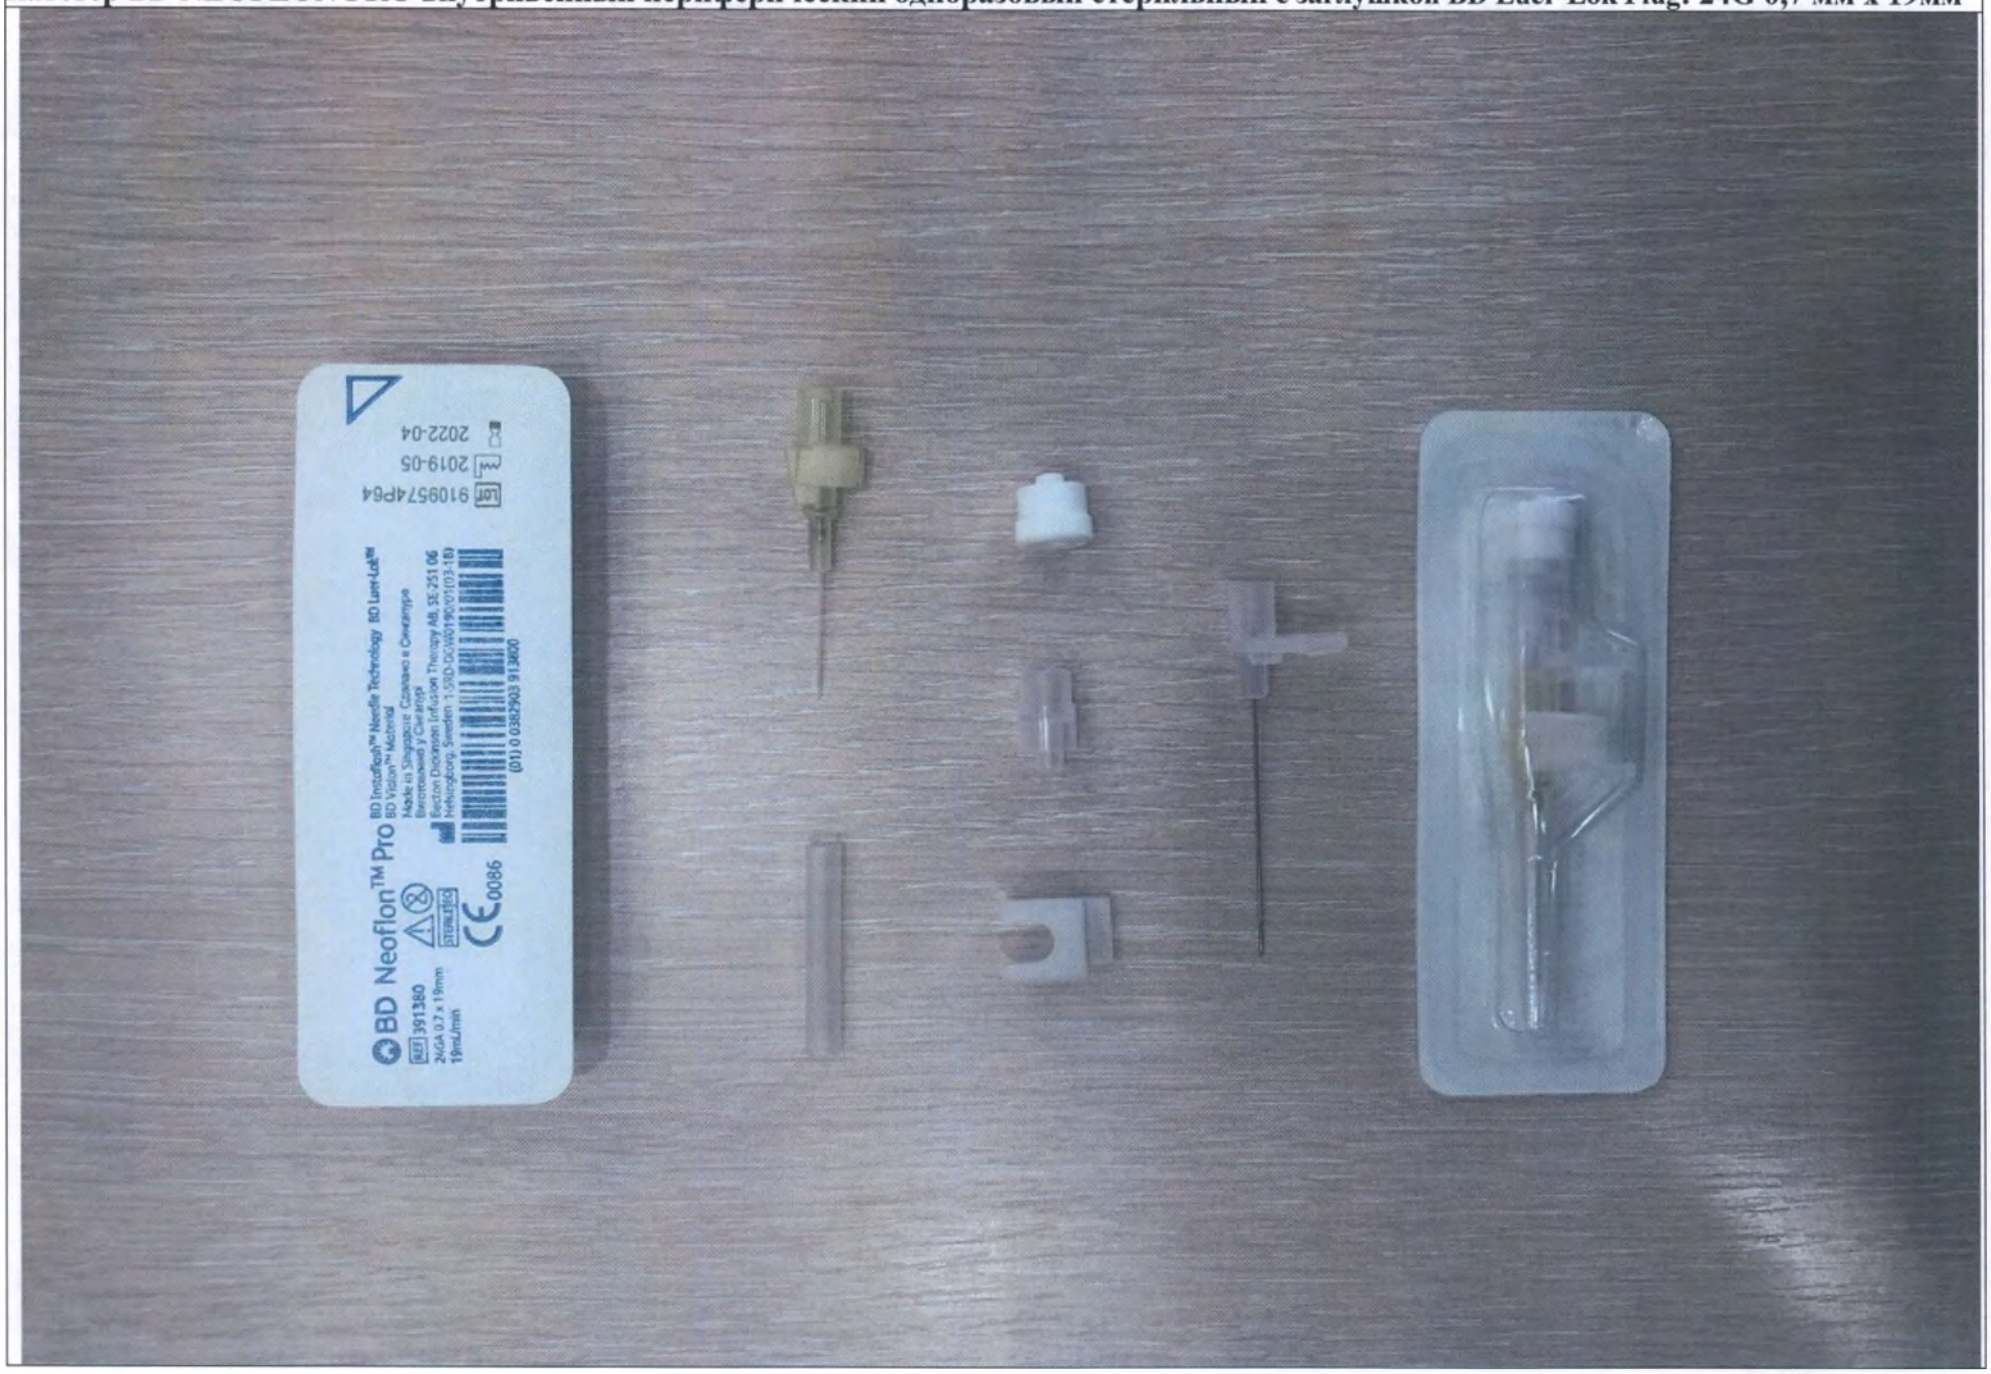

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Катетер BD NEOFLON PRO внутривенный периферический одноразовый стерильный с заглушкой BD Luer-Lok Plug (общий вид групповой упаковки)

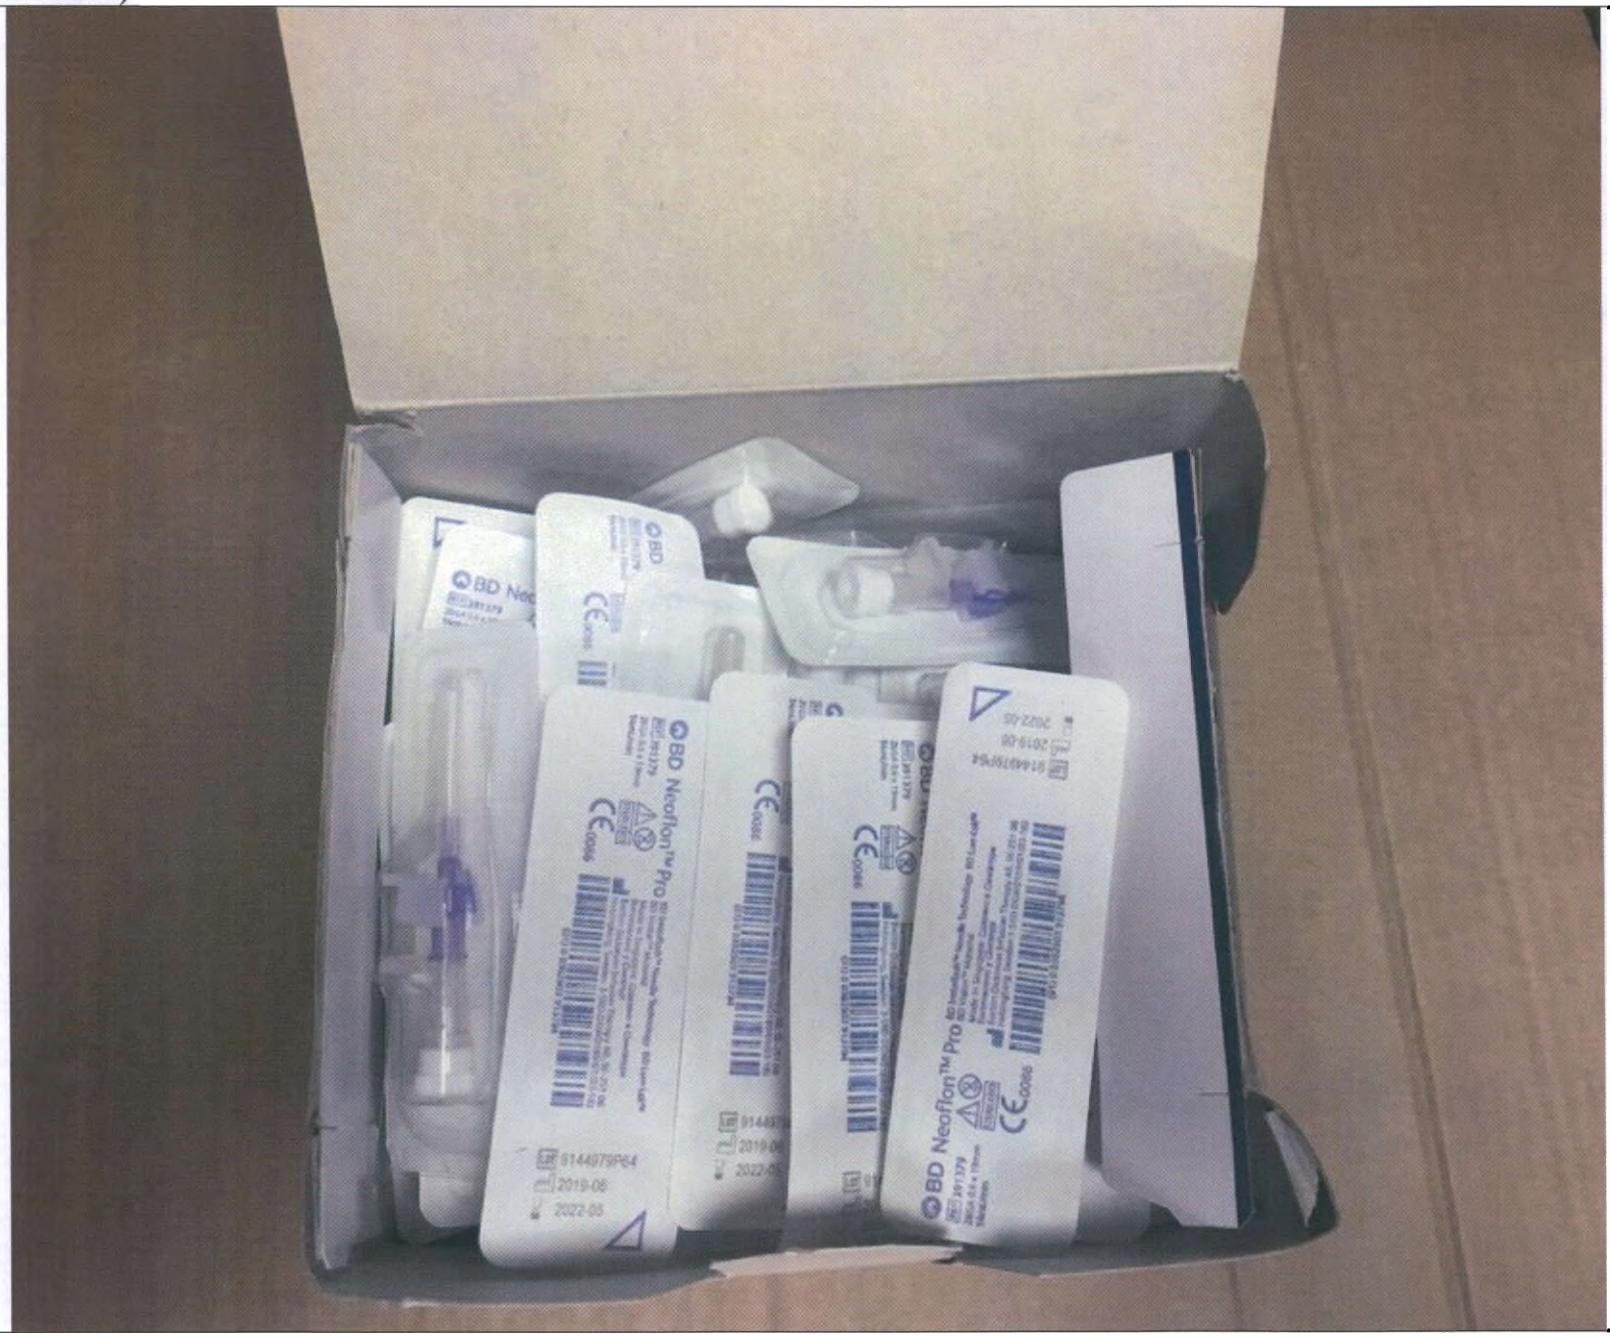

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Катетер BD NEOFLON PRO внутривенный периферический одноразовый стерильный с заглушкой BD Luer-Lok Plug (общий вид групповой упаковки)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Катетер BD NEOFLON PRO внутривенный периферический одноразовый стерильный с заглушкой BD Luer-Lok Plug (общий вид транспортной упаковки)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Катетер BD NEOFLON PRO внутривенный периферический одноразовый стерильный с заглушкой BD Luer-Lok Plug (макет маркировки на русском языке)

Катетер BD внутривенный периферический одноразовый стерильный с заглушкой BD Luer-Lok Plug, в вариантах исполнения, с принадлежностями:
Катетер BD NEOFLON PRO внутривенный периферический одноразовый стерильный с заглушкой BD Luer-Lok Plug: 26G 0,6 мм x 19 мм

Производитель: Бектон Дикинсон Инфьюжн Терапи АБ, (Becton Dickinson Infusion Therapy AB), Florettgatan 29C, PO Box 631, SE-251 06 Helsingborg, Sweden (Швеция)
Место производства: Becton Dickinson Medical (S) Pte. Ltd, 30 Tuas Avenue 2, Singapore 639461, Singapore (Сингапур)

Номер по каталогу REF : см. на упаковке
Код партии LOT : см на упаковке
Использовать до : см. на упаковке
Апирогенно. Нетоксично. Стерильно. Только для однократного применения.
Не использовать, если упаковка повреждена. Не стерилизовать повторно.
Не использовать после истечения срока годности.
Область применения: для обеспечения периферического венозного доступа с целью проведения инфузионной терапии и внутривенных вливаний
Условия хранения: при температуре от +2°С до +35°С.
Не допускать воздействия прямого солнечного света. Беречь от влаги.
Перед применением необходимо проверить целостность упаковки.
Срок годности 5 лет.

Уполномоченный представитель производителя:
ООО «Бектон Дикинсон Восток»: 127051 Москва, ул. Садовая-Самотёчная, д. 24/27, 2 этаж, помещение I, комната 18
Тел.: +7 495 775 85 82, email: Complaints_CIS@bd.com.
РУ № ФСЗ 2008/01579 от дд.мм.гг

Информацию на русскоязычном стикере просим считать приоритетной при поставке в РФ.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Принадлежности: Заглушка BD Luer-Lok Plug

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Заглушка BD Luer-Lok Plug (общий вид групповой упаковки)

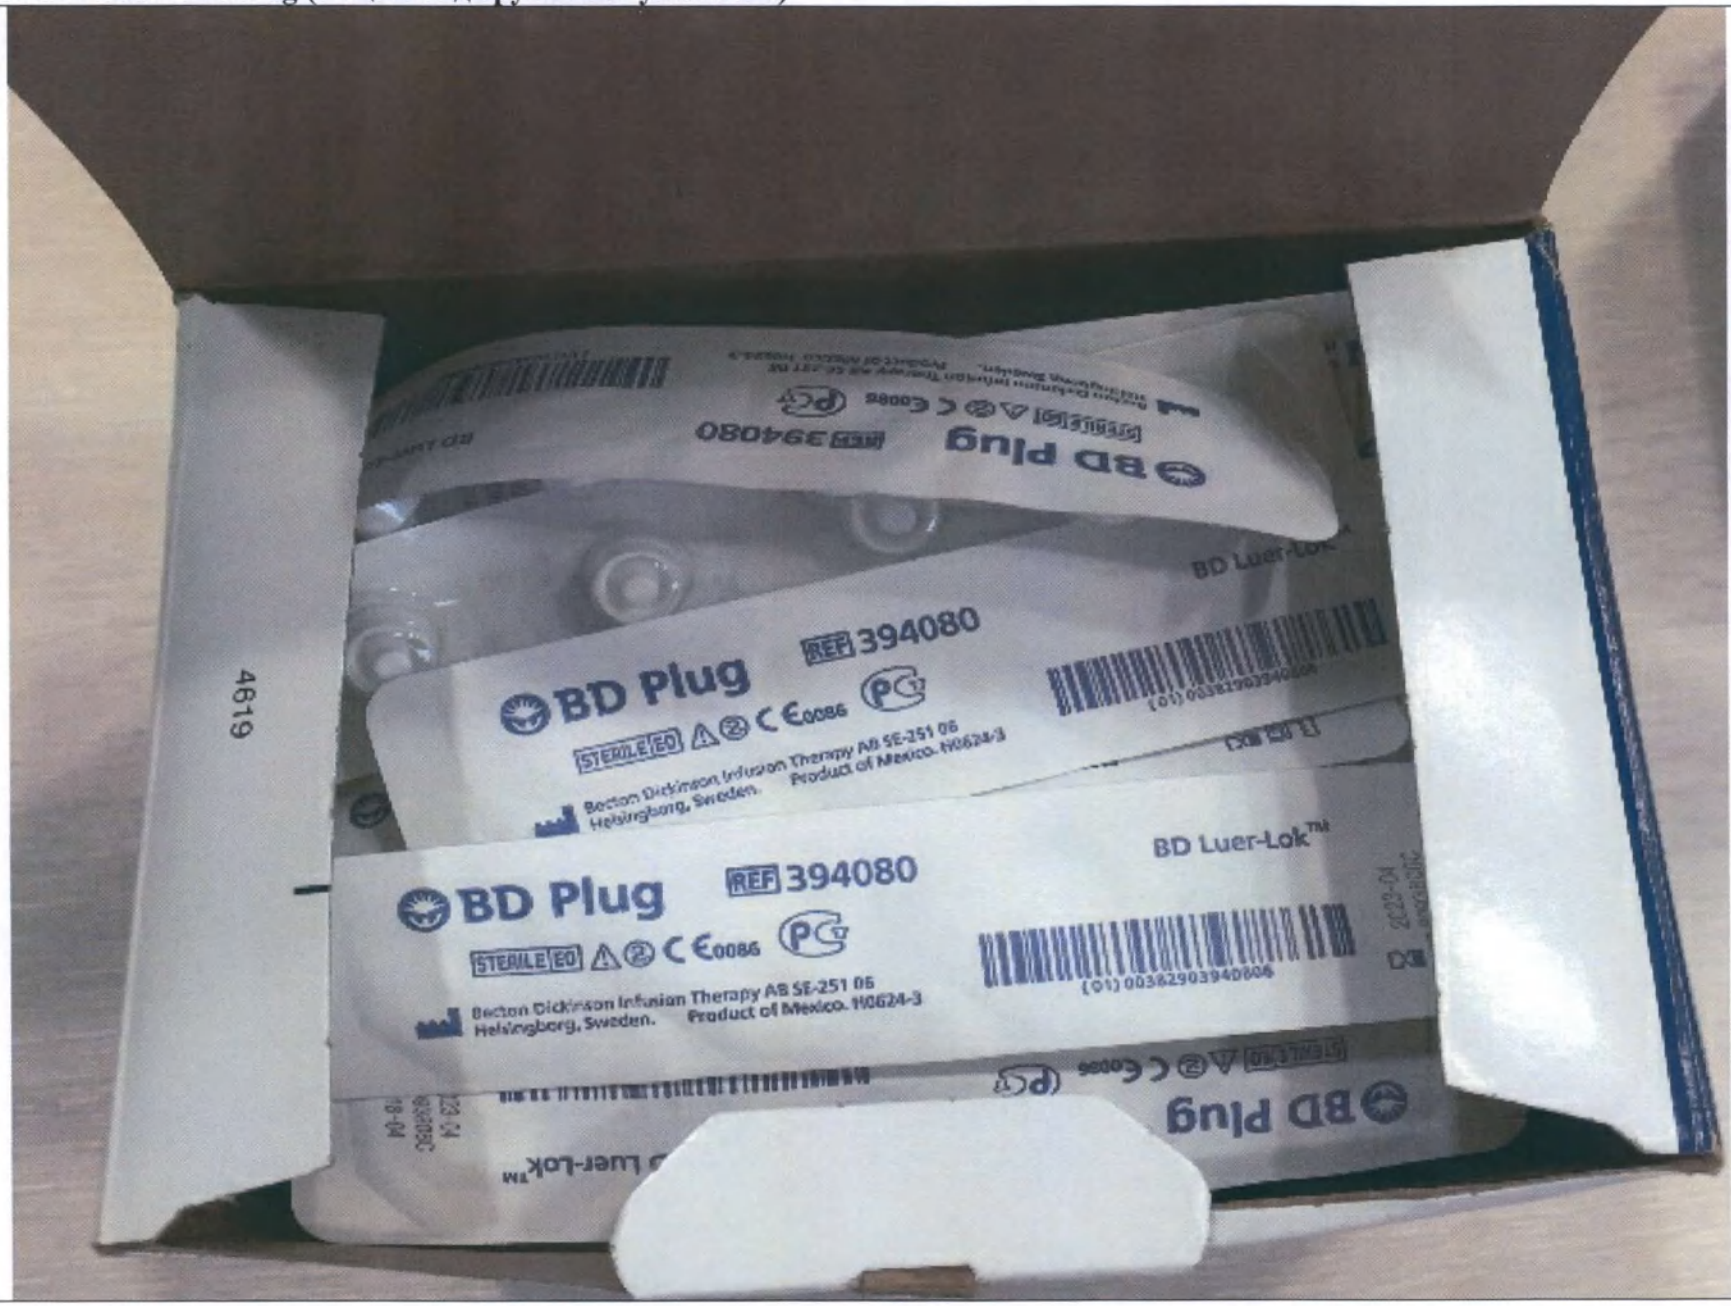

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Заглушка BD Luer-Lok Plug (общий вид транспортной упаковки)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Катетер BD внутривенный периферический одноразовый стерильный с заглушкой BD Luer-Lok Plug, в вариантах исполнения, с принадлежностями:
Принадлежность:
Заглушка BD Luer-Lok Plug

Производитель: Бектон Дикинсон Инфьюжн Терапи АБ, (Becton Dickinson Infusion Therapy AB), Florettgatan 29C, PO Box 631, SE-251 06 Helsingborg, Sweden (Швеция)
Место производства: Becton Dickinson India Pvt. Ltd., Plot No. 1, Sector 3, IMT, Bawal - 123 501, District Rewari, Haryana, India (Индия)

Номер по каталогу REF : см. на упаковке
Код партии LOT : см на упаковке
Использовать до : см. на упаковке
Апирогенно. Нетоксично. Стерильно. Только для однократного применения.
Не использовать, если упаковка повреждена. Не стерилизовать повторно.
Не использовать после истечения срока годности.
Область применения: для обеспечения периферического венозного доступа с целью проведения инфузионной терапии и внутривенных вливаний
Условия хранения: при температуре от +2°С до +35°С.
Не допускать воздействия прямого солнечного света. Беречь от влаги.
Перед применением необходимо проверить целостность упаковки.
Срок годности 5 лет.

Уполномоченный представитель производителя:
ООО «Бектон Дикинсон Восток»: 127051 Москва, ул. Садовая-Самотёчная, д. 24/27, 2 этаж, помещение I, комната 18
Тел.: +7 495 775 85 82, email: Complaints_CIS@bd.com.
РУ № ФСЗ 2008/01579 от дд.мм.гг

Информацию на русскоязычном стикере просим считать приоритетной при поставке в РФ.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью ООО «Бектон
Дикинсон Восток» 34 листа(ов)

КОСОЛАПОВА Е.А.
По доверенности

"Бектон Дикинсон Восток"
LLC Becton Dickinson Vostok

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU