

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Миндрей Медикал Рус»

Сюн Вэй

» декабря 2021 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

«Система ультразвуковой визуализации универсальная серии Hepatus с принадлежностями, варианты исполнения: Hepatus 5, Hepatus 5S, Hepatus 6, Hepatus 6S, Hepatus 6T, Hepatus 7, Hepatus 7S»

Производитель:

Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.
(Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.)

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, 518057
Shenzhen, People's Republic of China

2021 г.

Система ультразвуковой визуализации универсальная серии Hepatus с принадлежностями, варианты исполнения: Hepatus 5, Hepatus 5S, Hepatus 6, Hepatus 6S, Hepatus 6T, Hepatus 7, Hepatus 7S в составе:

1. Основной блок, 1 шт.
2. Кабель питания, 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации, не более 5 шт.
4. Сетевой адаптер (при необходимости), не более 5 шт.
5. Настольное крепление (при необходимости), не более 5 шт. в составе:
 - 5.1 Держатель – 1 шт.
 - 5.2 Основание – 1 шт.
6. Кейс для транспортировки (при необходимости)– не более 5 шт.
7. Внешнее записывающее DVD-устройство (при необходимости) – не более 5 шт.
8. Датчики ультразвуковые, варианты исполнения:
 - 8.1. Датчик ультразвуковой конвексный C5-1s (при необходимости), не более 5 шт.
 - 8.2. Специализированный датчик для проведения исследований методом транзистентной эластографии LFP5-1s (при необходимости), не более 5 шт.
9. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-022 (при необходимости), не более 20 шт.
10. Программное обеспечение, включающее предустановленные параметры, пакет измерений и вычислений:
 - 10.1. Для абдоминальных исследований (Abdomen/General Package) (при необходимости).
 - 10.2. Для акушерских исследований (Obstetrics Package) (при необходимости).
 - 10.3. Для гинекологических исследований (Gynecology Package) (при необходимости).
 - 10.4. Для сосудистых исследований (Vascular Package) (при необходимости).
11. Программное обеспечение:
 - 11.1. Для исследований печени методом транзистентной эластографии (LiSA) (при необходимости).
 - 11.2. ViTE License A-ключ на проведение исследования 500 пациентам (при необходимости).
 - 11.3. ViTE License B-ключ на проведение исследования 1000 пациентам (при необходимости).
 - 11.4. ViTE License Free – постоянный ключ (при необходимости).
 - 11.5. Для анатомического M-режима (Free Xros M) (при необходимости).
 - 11.6. Для исследований с контрастным усилением (Contrast Imaging) (при необходимости).
 - 11.7. Для количественной оценки в режиме исследований с контрастным усилением (Contrast Imaging QA) (при необходимости).
 - 11.8. Для улучшения визуализации биопсийной иглы (iNeedle) (при необходимости).
 - 11.9. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Базовый набор опций DICOM (DICOM Basic) (при необходимости).
 - 11.10. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Загрузка списка задач с DICOM-сервера (DICOM Worklist) (при необходимости).
 - 11.11. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Загрузка на сервер DICOM дополнительной информации об условиях проведения обследования (DICOM MPPS) (при необходимости).
 - 11.12. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Запрос и получение данных пациента и изображений с сервера DICOM (DICOM Query/Retrieve) (при необходимости).
 - 11.13. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Структурированный отчет для сосудистых исследований в формате DICOM (DICOM Vascular SR) (при необходимости).

11.14. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Структурированный отчет для акушерских и гинекологических исследований в формате DICOM (DICOM OB/GYN SR) (при необходимости).

11.15. Для управления голосовыми командами (iVocal) (при необходимости).

11.16. Для автоматизированных рабочих протоколов (iWorks) (при необходимости).

11.17. DVR-модуль (DVR Module) (при необходимости).

11.18. Антивирусное ПО McAfee (McAfee) (при необходимости).

12. Модуль ЭКГ (ECG Module) (при необходимости), не более 5 шт. в составе:

12.1 Модуль ЭКГ – 1 шт.

12.2. Кабель на 5 отведений с разъемом 6Pin – 1 шт.

12.3 Кабель на 3 отведения взрослый/детский – 1 шт.

12.4. DC-IN кабель для модуля ЭКГ, (при необходимости), не более 5 шт.

12.5. DC-IN кабель, (при необходимости), не более 5 шт.

13. Модуль вывода аналоговых аудио/видео сигналов (при необходимости), не более 5 шт. в составе:

13.1 Устройство вывода аналоговых аудио/видео сигналов, не более 5 шт.

13.2. Крепление модуля вывода аналоговых аудио/видео сигналов (при необходимости) не более 5 шт. в составе:

13.2.1 Винт с шайбой – 1 шт.

13.2.2 Винт М3 – 3 шт.

13.2.3 Держатель – 1 шт.

13.2.4 Заглушка – 1 шт.

Принадлежности:

1. Ножной переключатель, 2 клавиши, не более 5 шт.

2. Ножной переключатель, 3 клавиши, не более 5 шт.

3. Тележка мобильная UMT-400 (без втягивающегося кабеля, без регулировки по высоте) – не более 5 шт.

4. Тележка мобильная UMT-400 (без втягивающегося кабеля, с регулировкой по высоте) – не более 5 шт.

5. Тележка мобильная UMT-400 (с втягивающимся кабелем, с регулировкой по высоте) – не более 5 шт.

6. Тележка мобильная НМТ-600 (без втягивающегося кабеля) – не более 5 шт.

7. Тележка мобильная НМТ-600 – не более 5 шт.

8. Контейнер для хранения – не более 5 шт.

9. Держатель датчиков – не более 15 шт.

10. Заглушка – не более 20 шт.

11. Идентификационная пленка – не более 5 шт.

12. Защитная пленка для клавиатуры – не более 5 шт.

13. Шлицевая отвертка – не более 5 шт.

14. Контейнер навесной – не более 5 шт.

15. Держатель датчиков большой – не более 10 шт.

16. Держатель датчиков малый – не более 10 шт.

17. Комплект для подключения беспроводного микрофона – не более 5 шт. в составе:

17.1 USB-кабель – 1 шт.

17.2 USB-кабель удлинительный – 1 шт. (при необходимости)

17.3 Микрофон беспроводной – 1 шт.

17.4 Передатчик – 1 шт.

17.5 Приемник – 1 шт.


18. Li-ion батарея, не более 10 шт.


19. USB-кабель (В-А тип), не более 10 шт.

20. Кабель питания 3,5 м., не более 5 шт.

21. Дополнительный кабель питания, не более 5 шт.

Основной блок

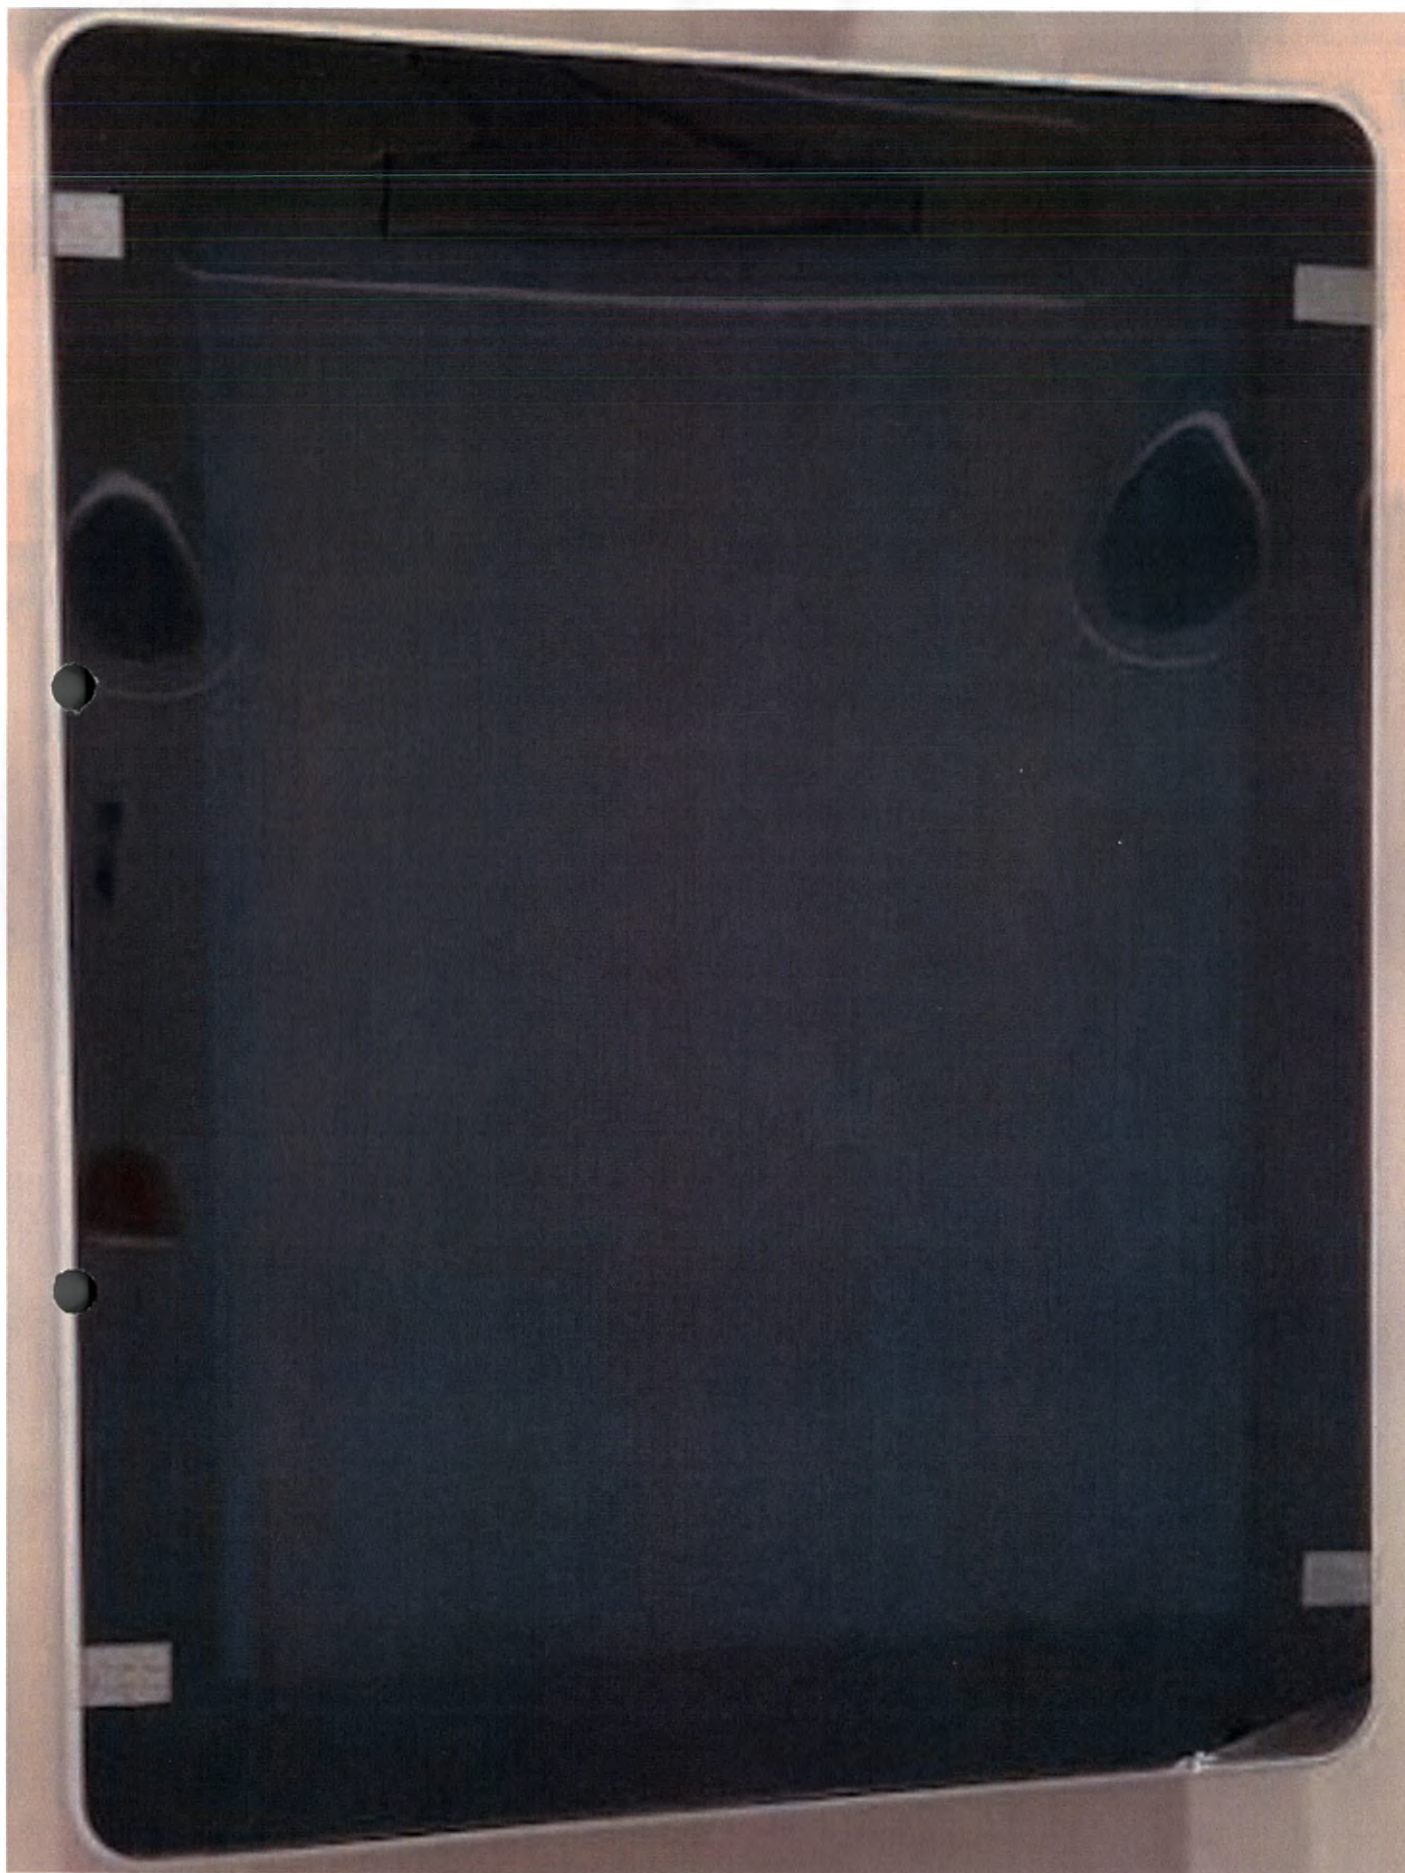

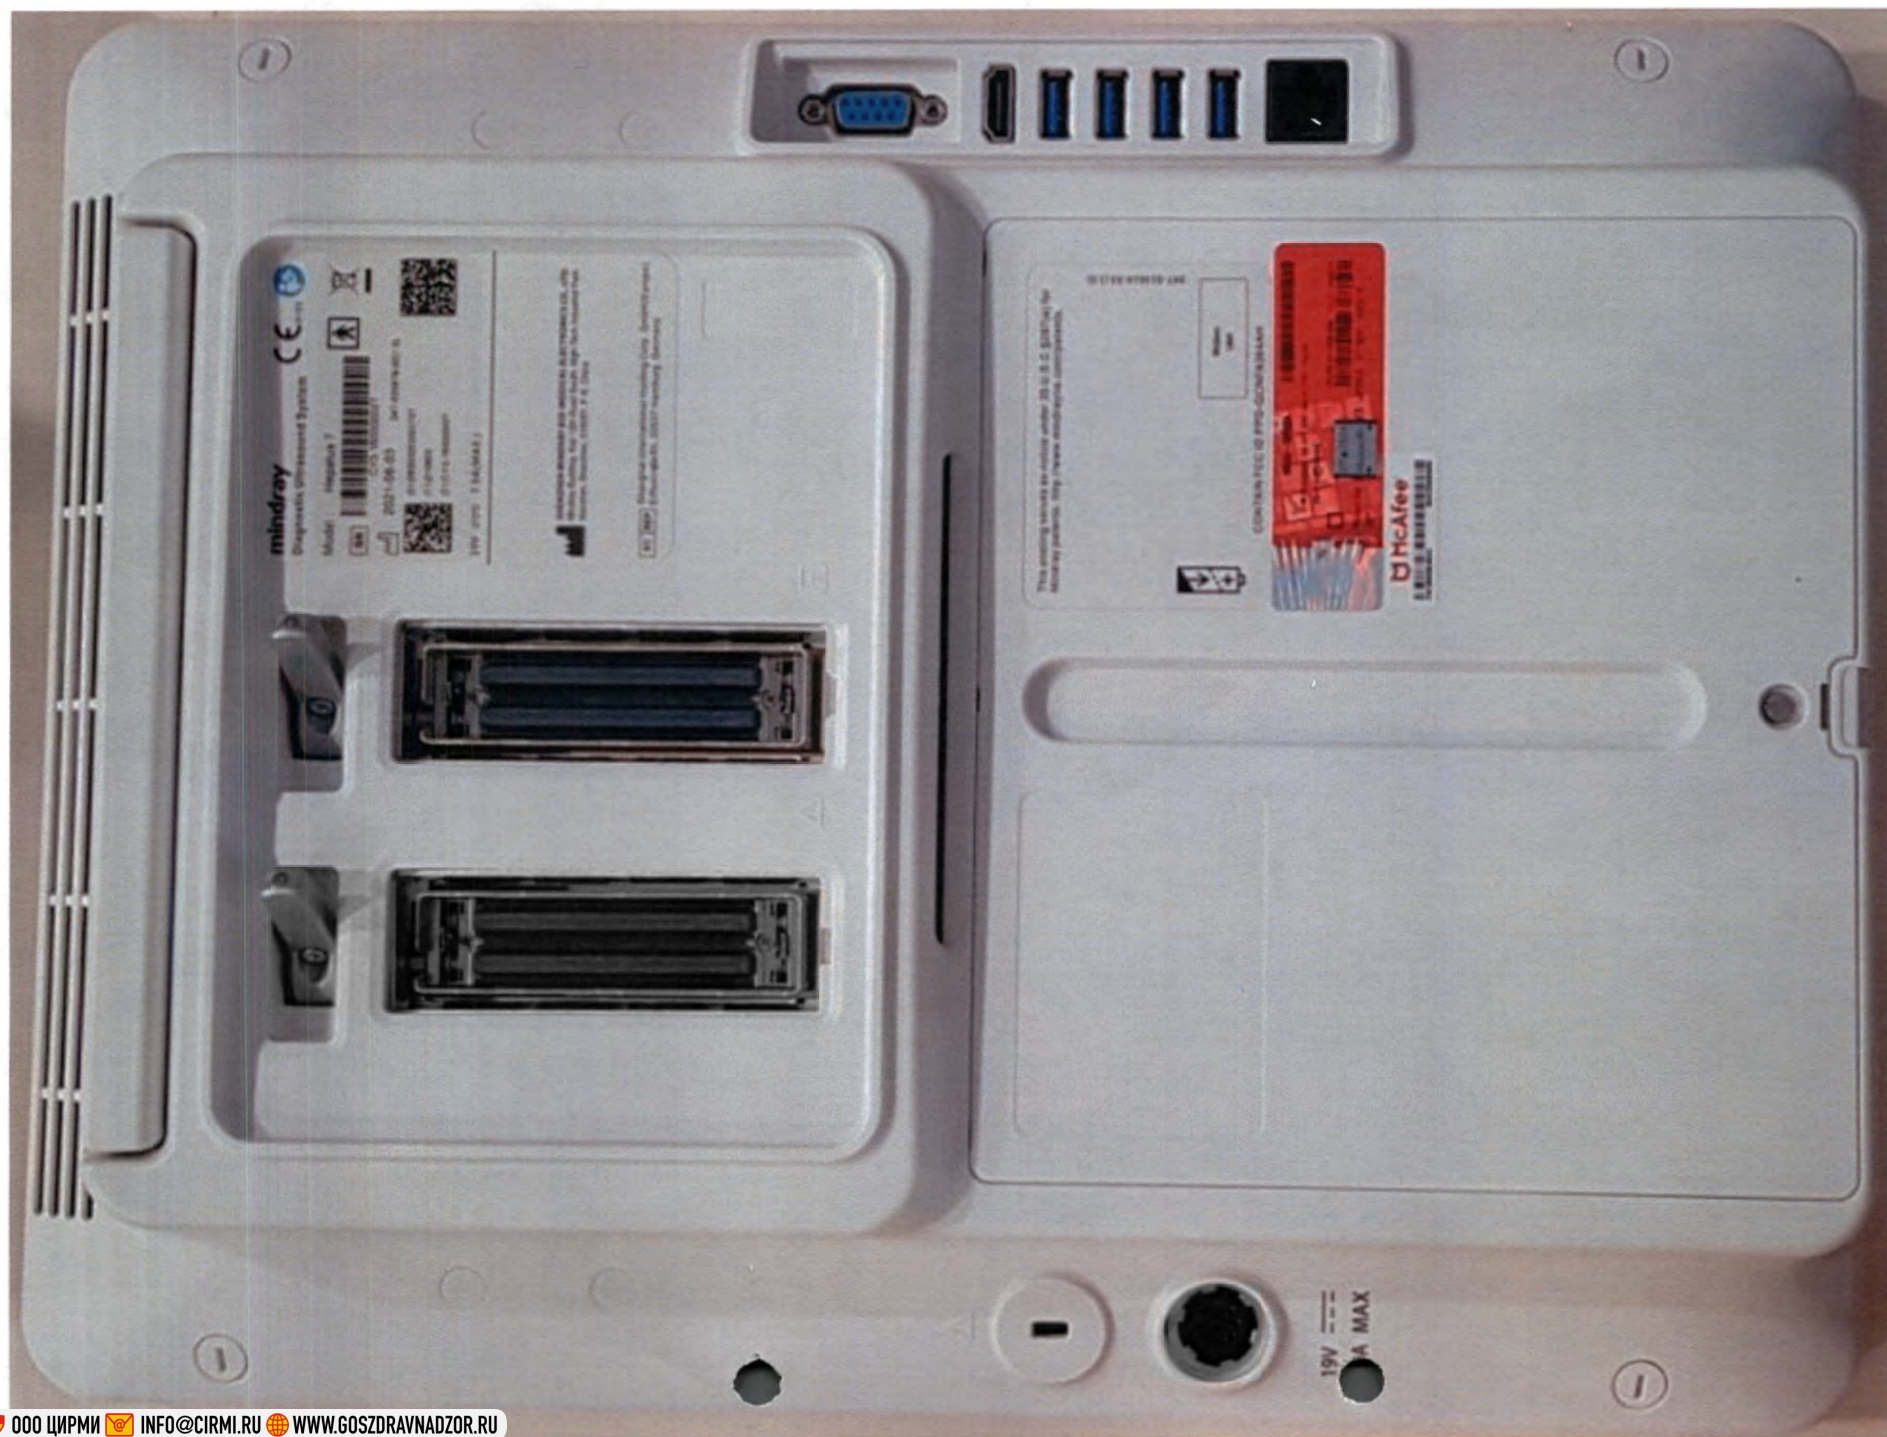

Кабель питания




Сетевой адаптер



Настольное крепление




Держатель

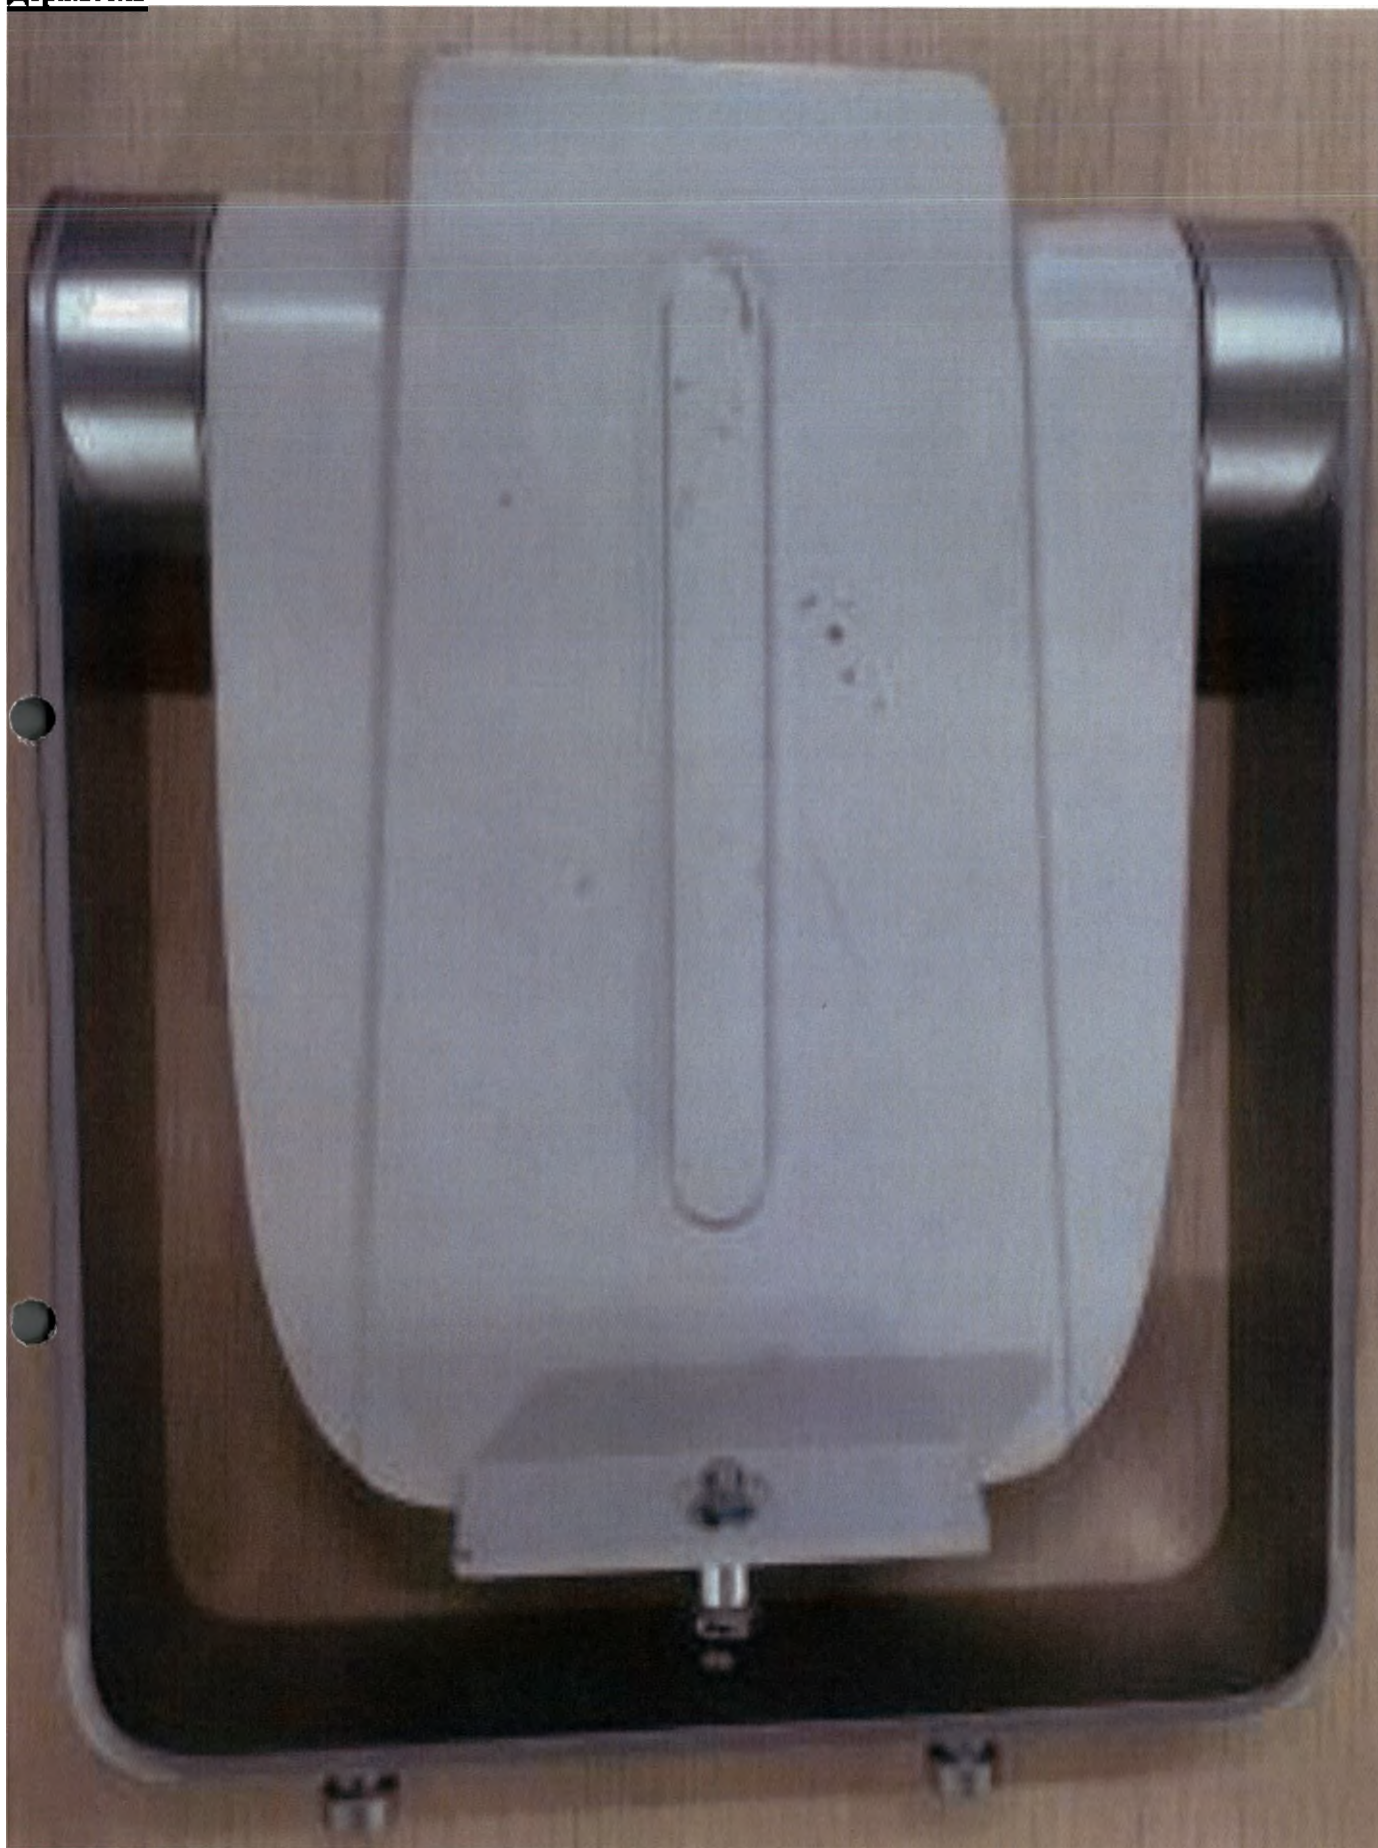




Кейс для транспортировки




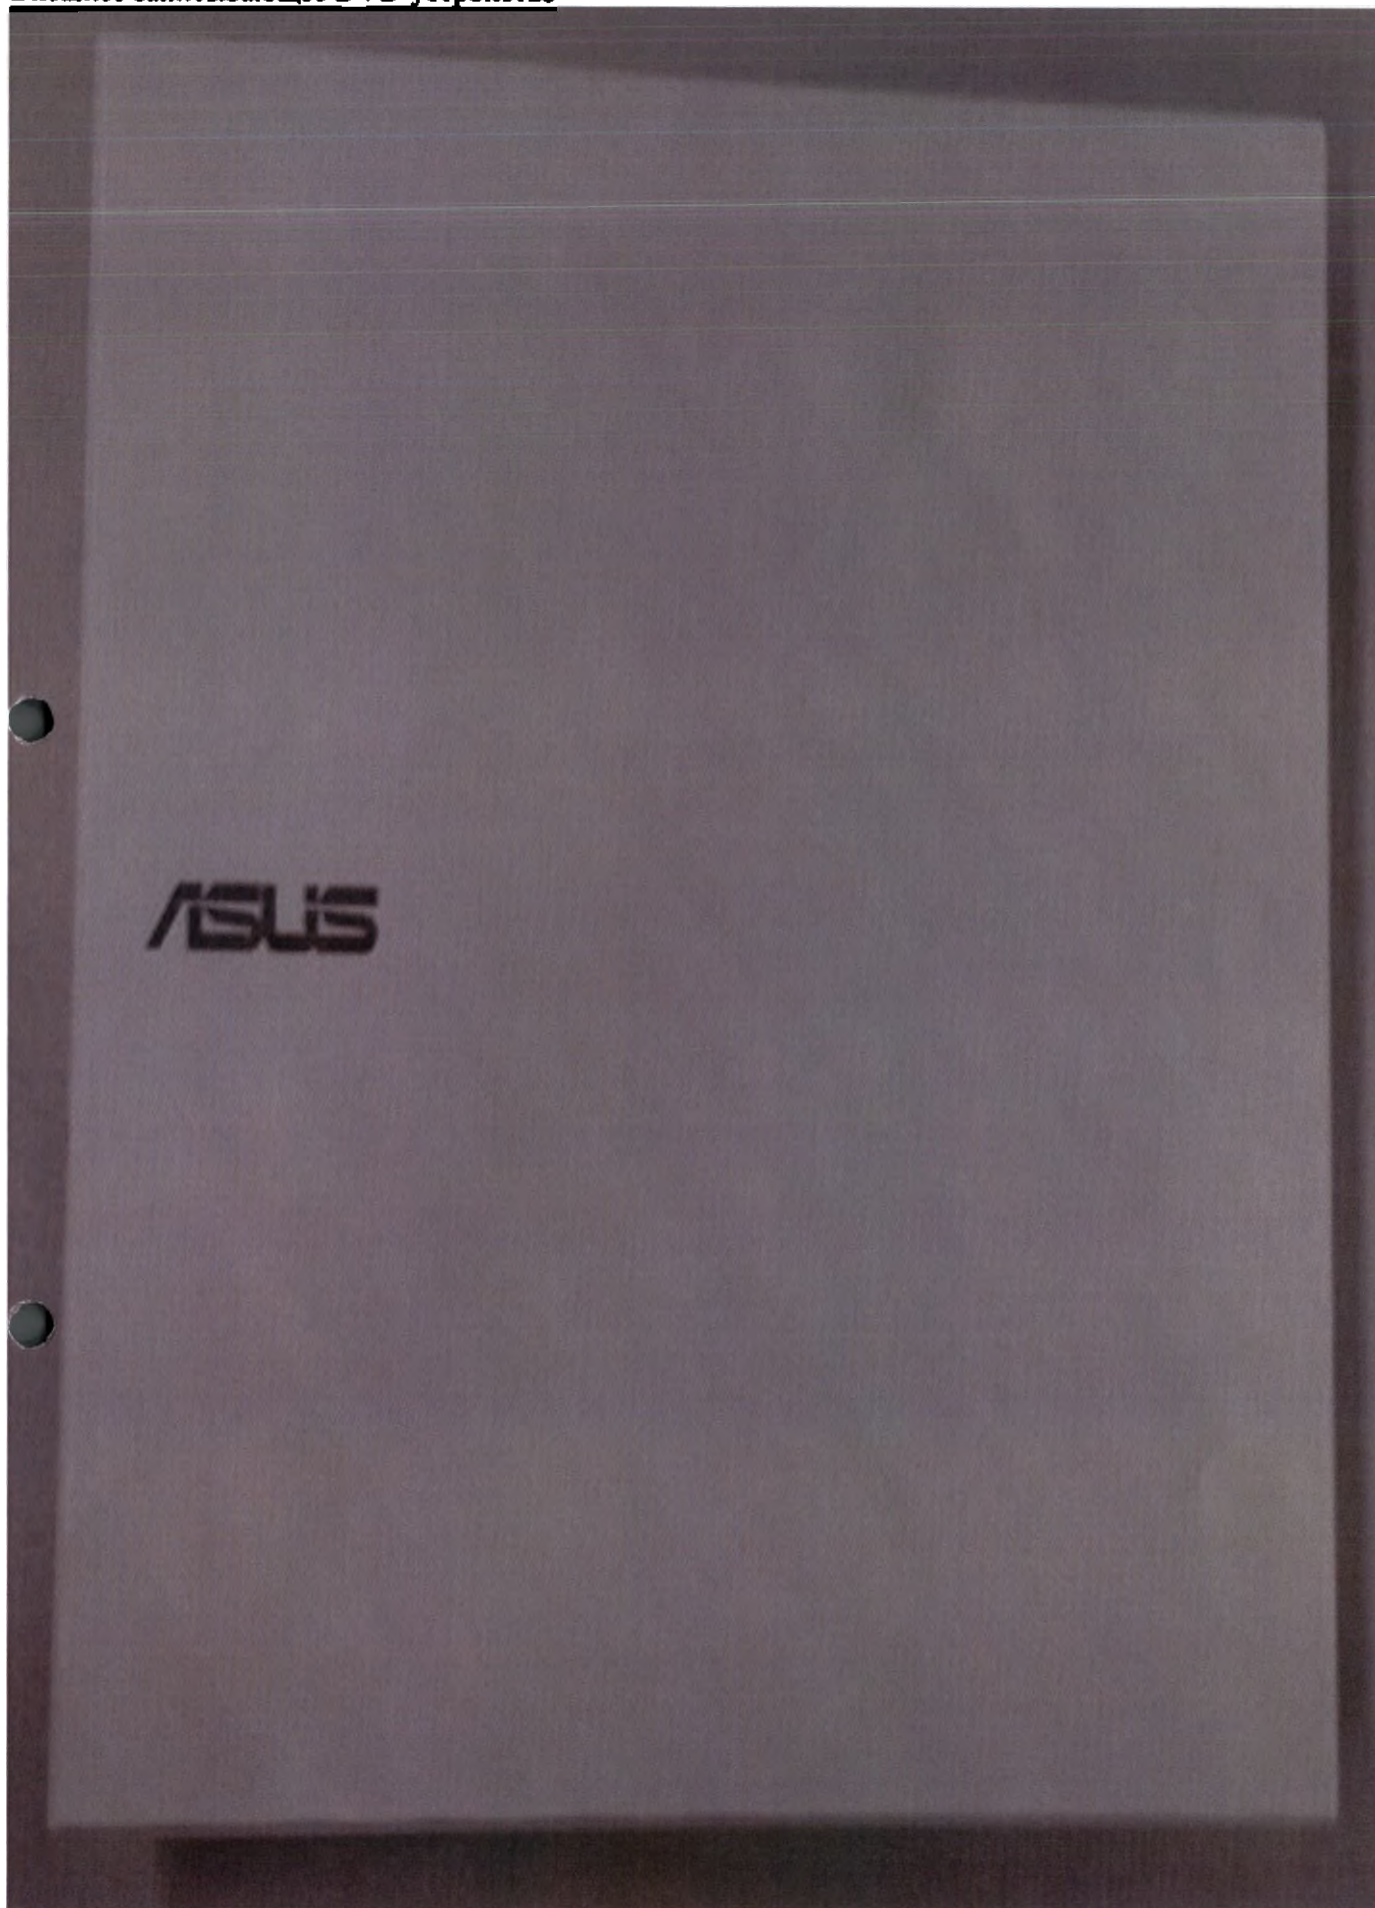

Датчик ультразвуковой конвексный C5-1s

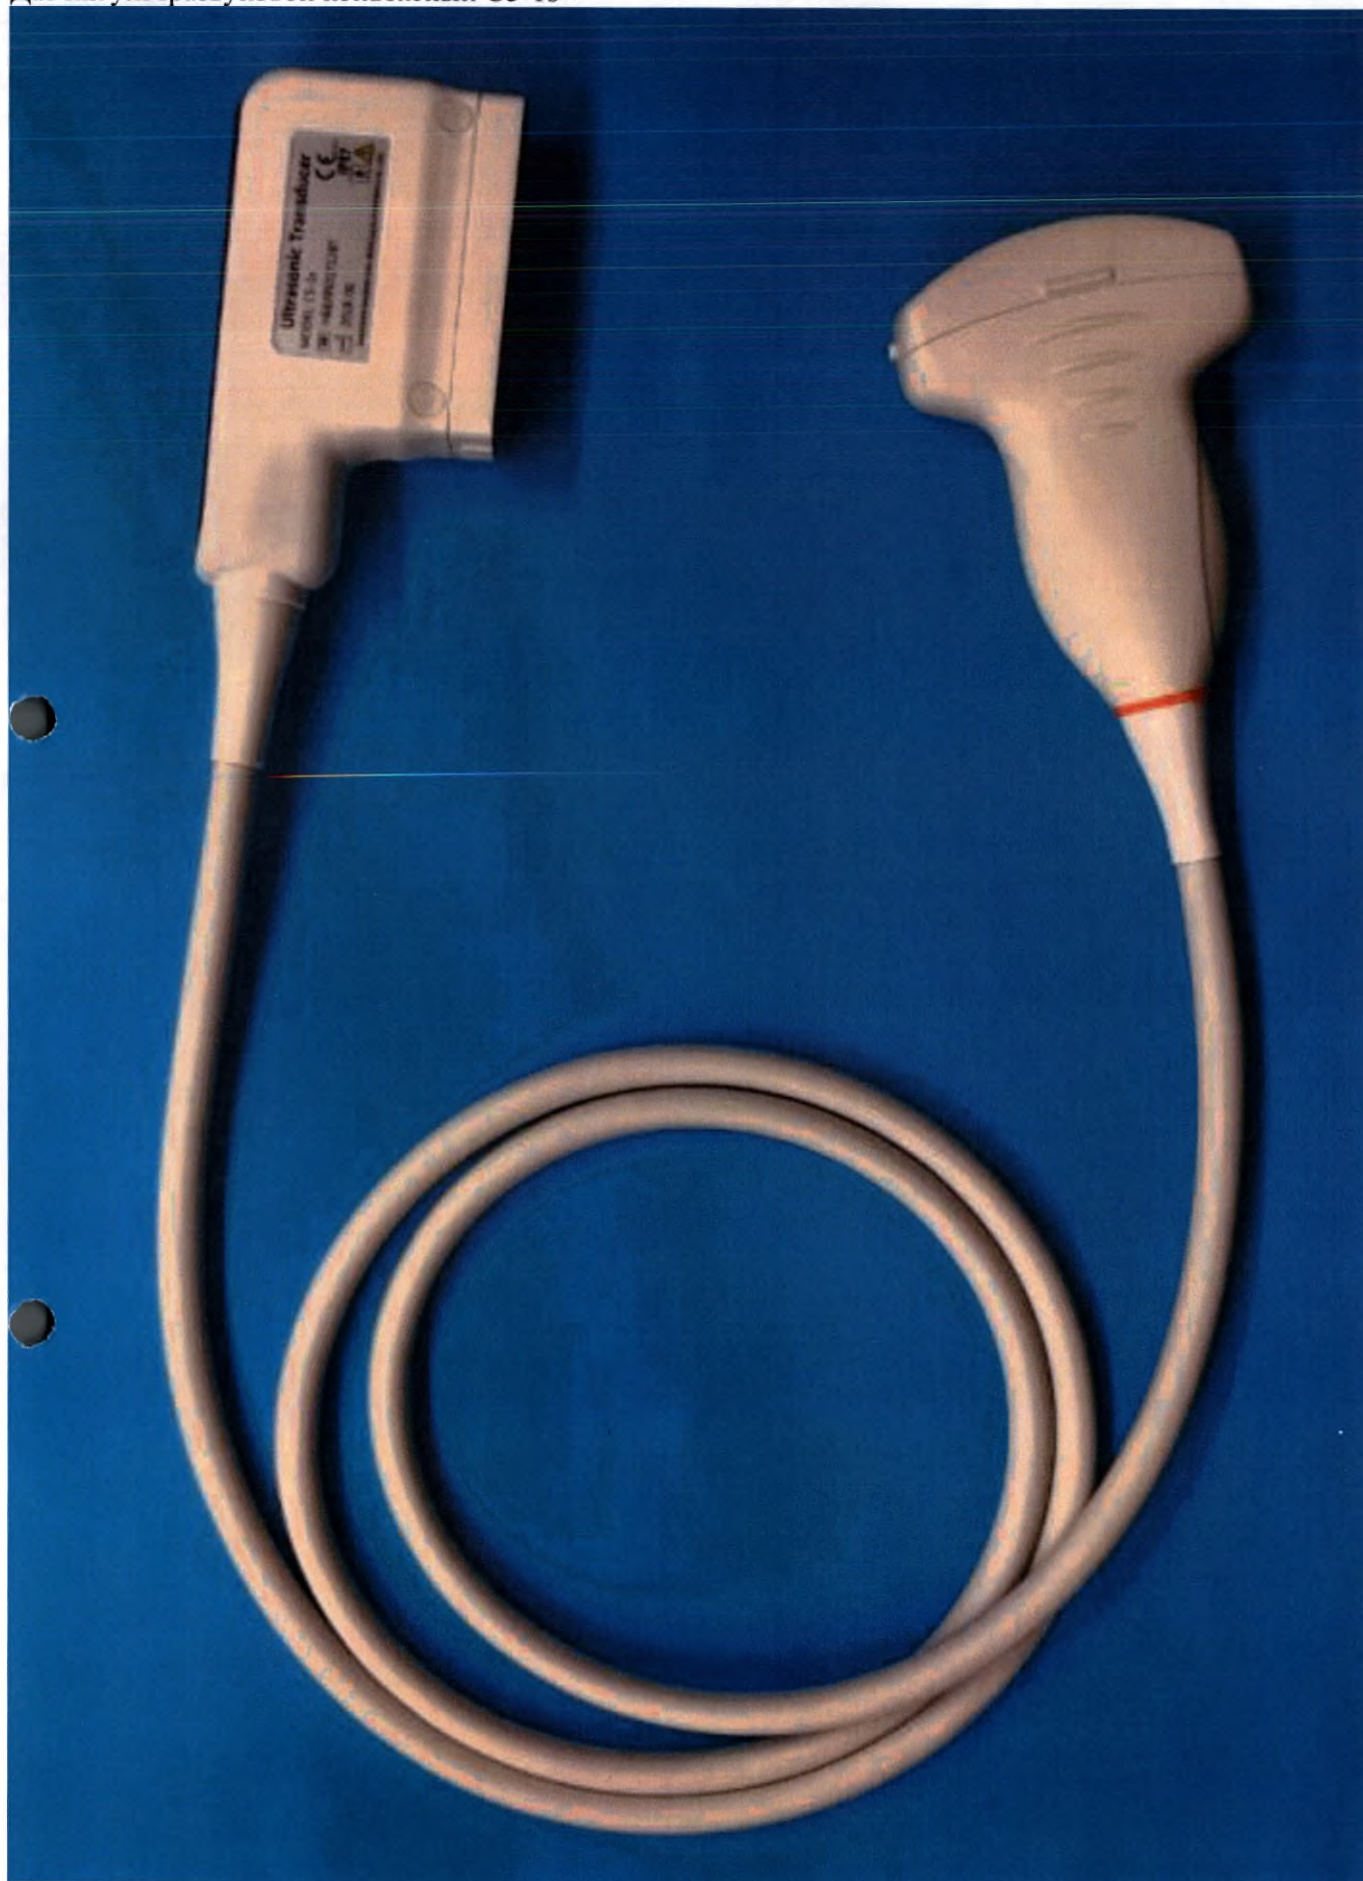

Специализированный датчик для проведения исследований методом транзисентной эластографии LFP5-1s

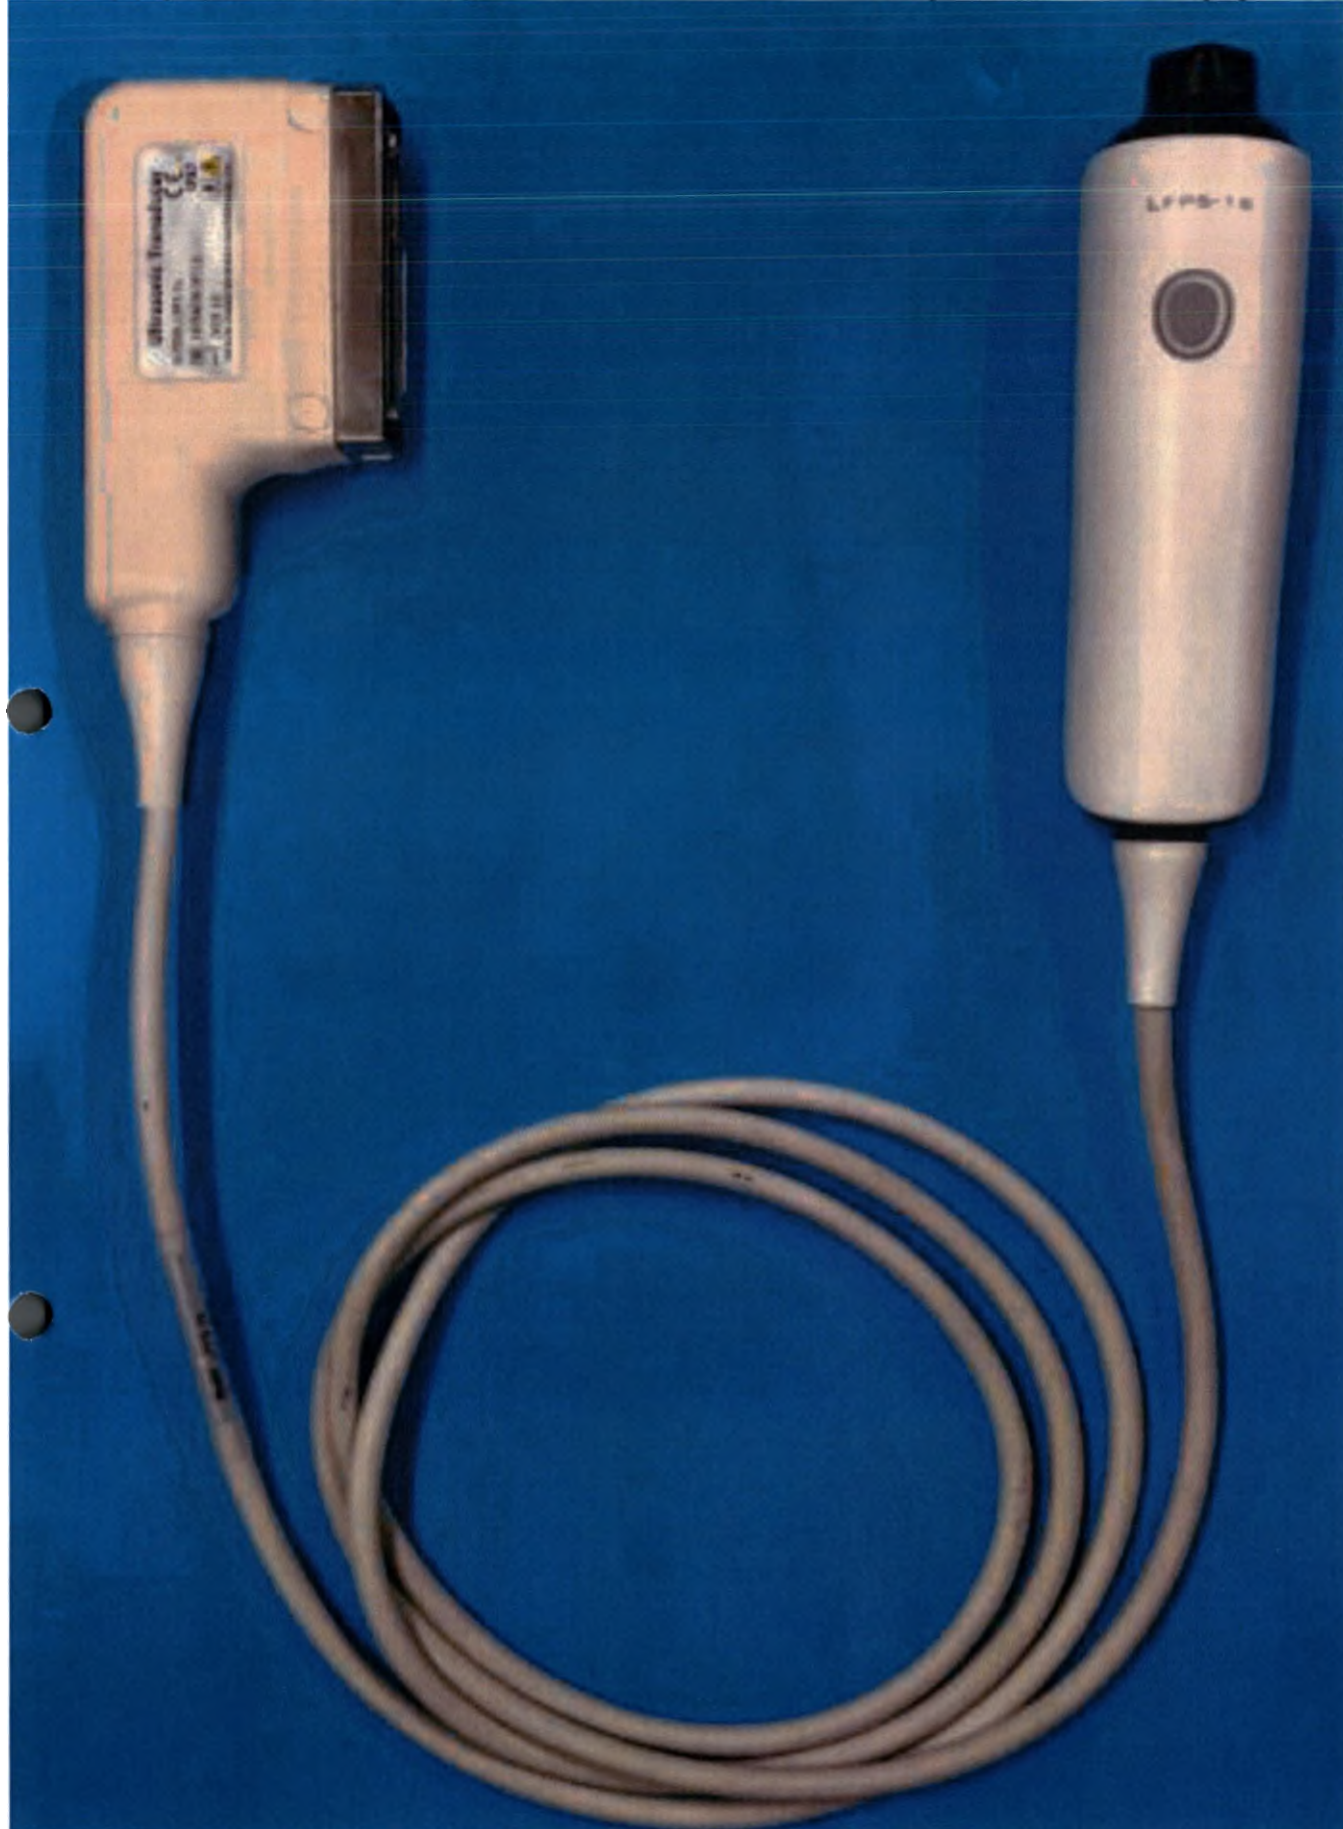

Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-022



Модуль ЭКГ (ECG Module) (при необходимости), не более 5 шт. в составе:


12.1 Модуль ЭКГ – 1 шт.

12.2. Кабель на 5 отведений с разъемом 6Pin – 1 шт.


12.3 Кабель на 3 отведения взрослый/детский – 1 шт.

12.4. DC – IN кабель для модуля ЭКГ, (при необходимости), не более 5 шт.


12.5. DC-IN кабель, (при необходимости), не более 5 шт.

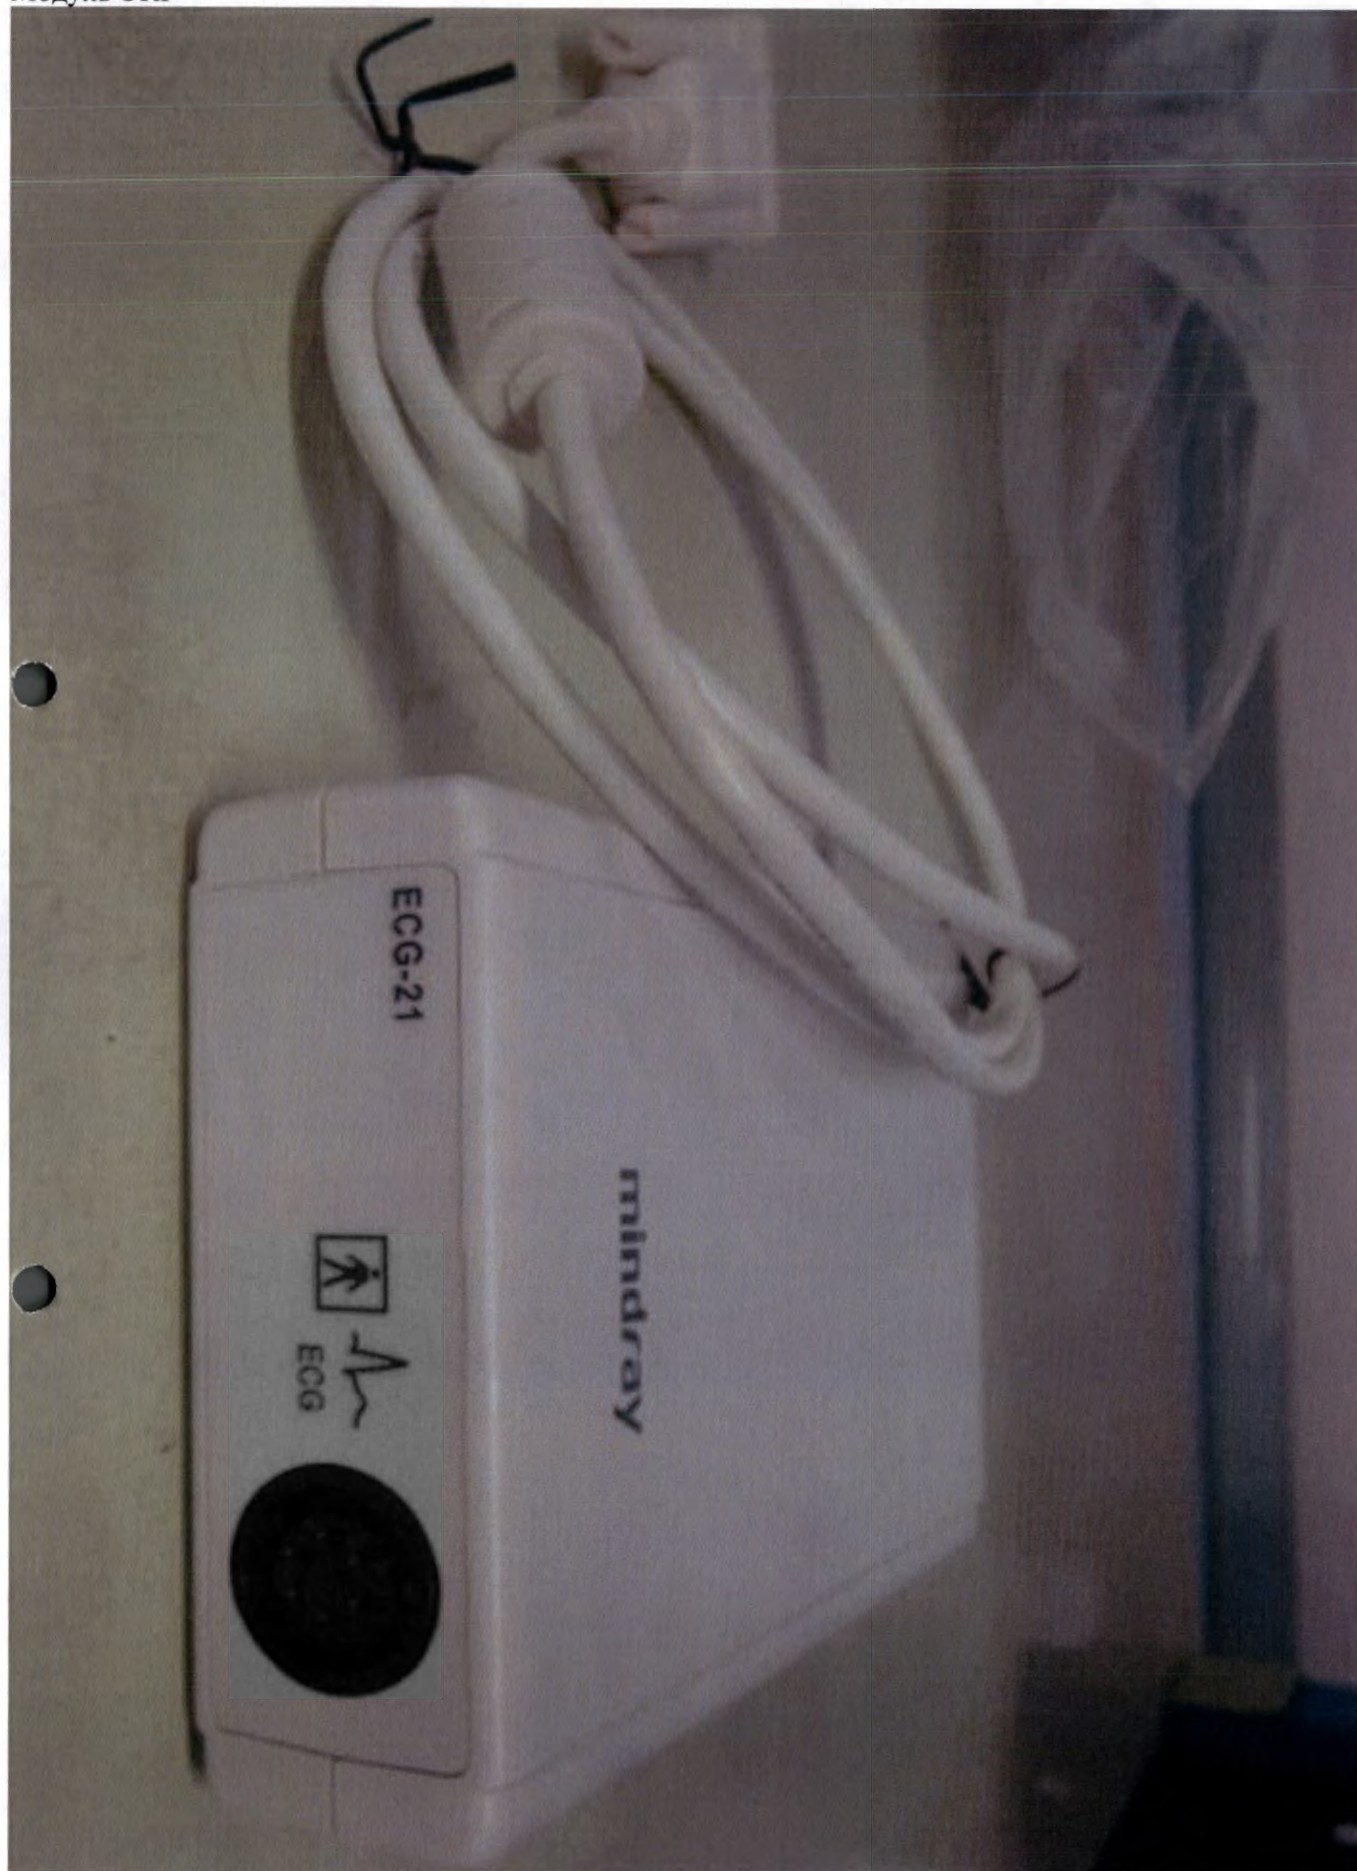

Кабель на 5 отведений с разъемом 6Pin

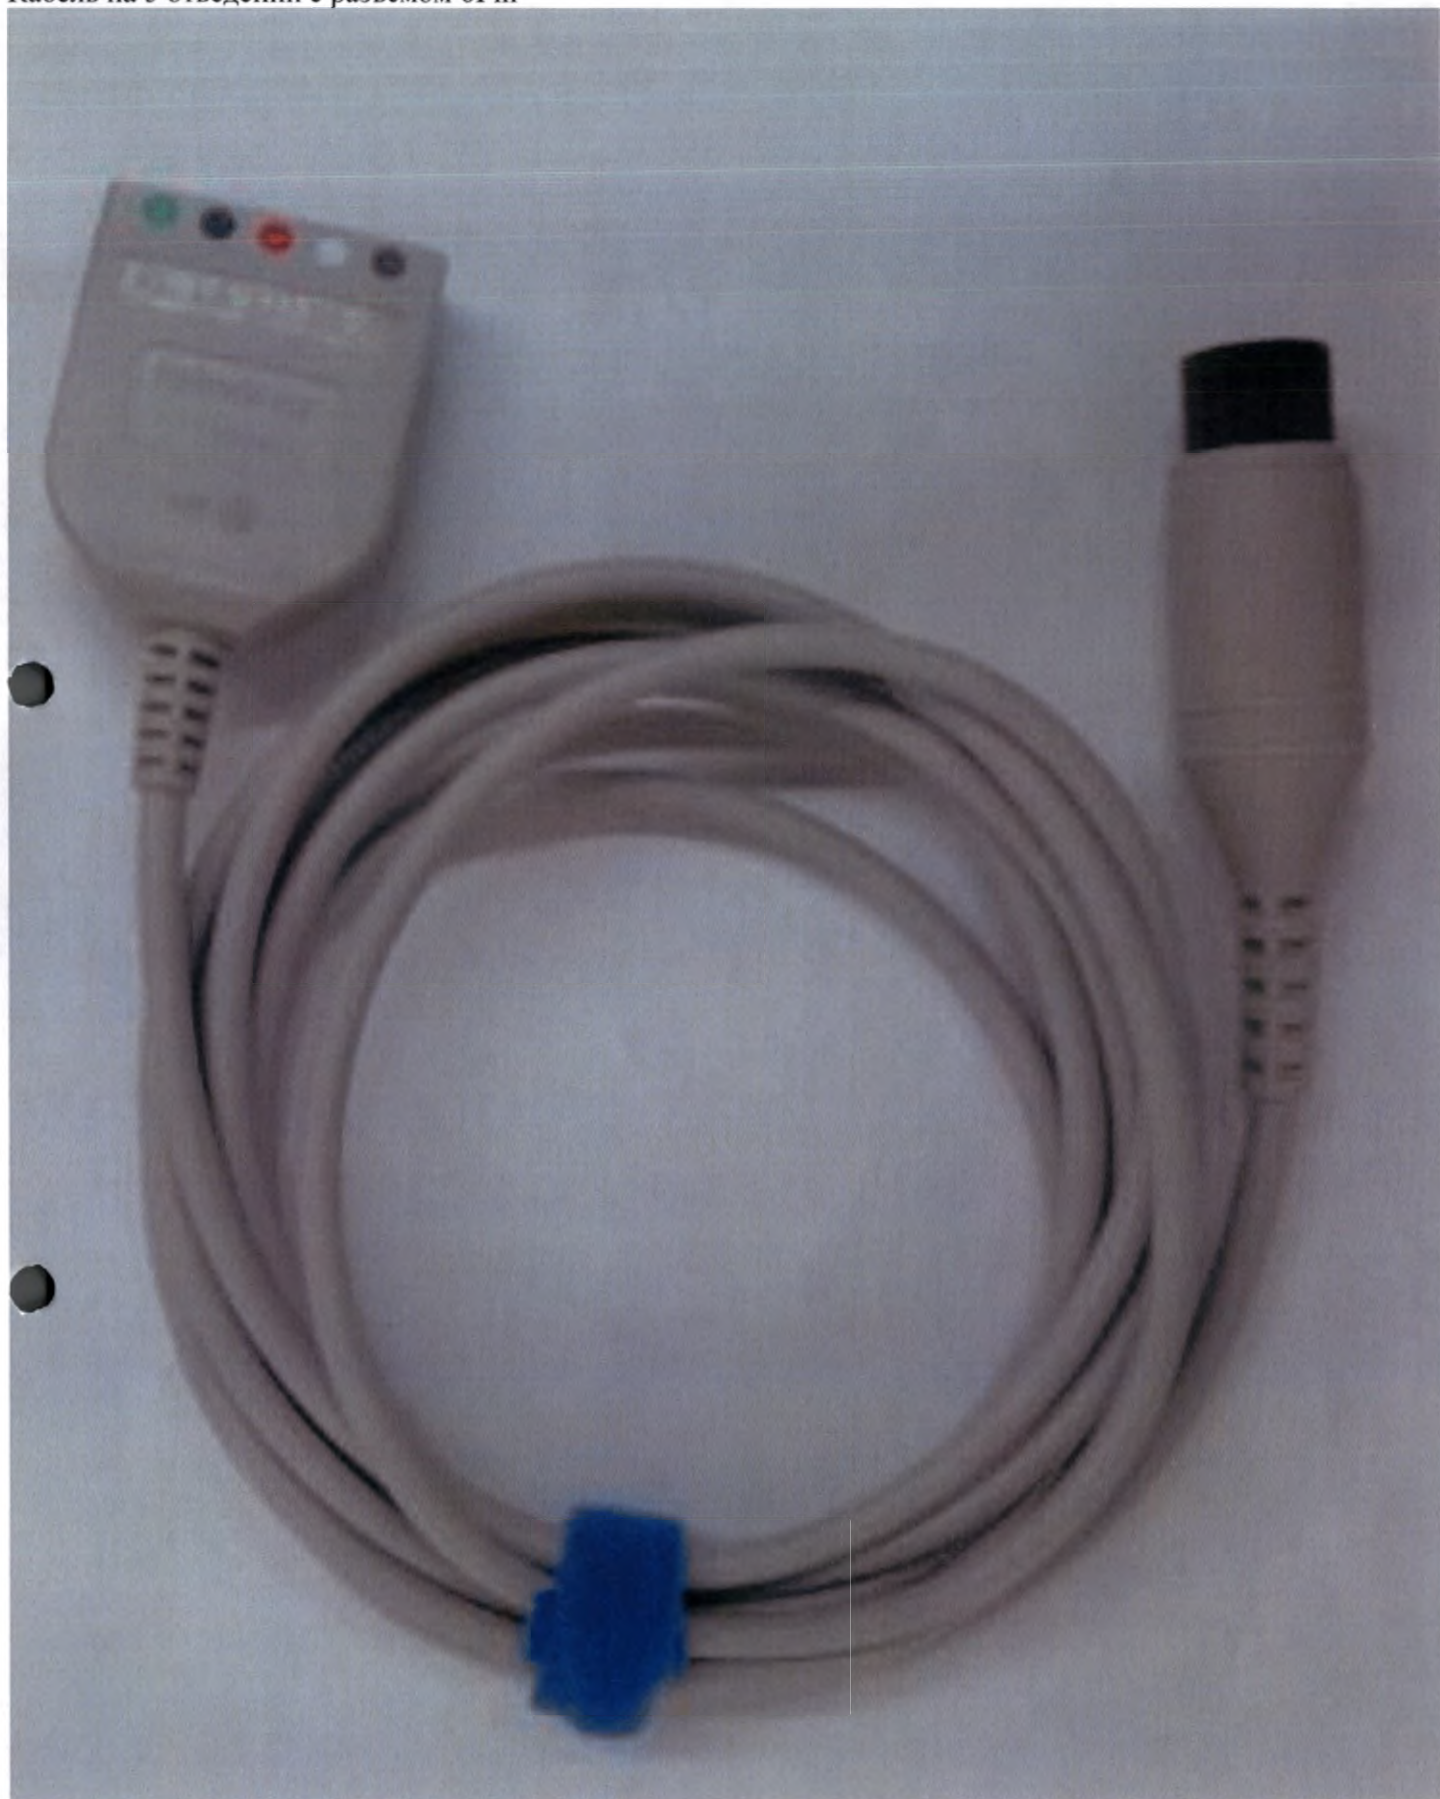

Кабель на 3 отведения взрослый/детский

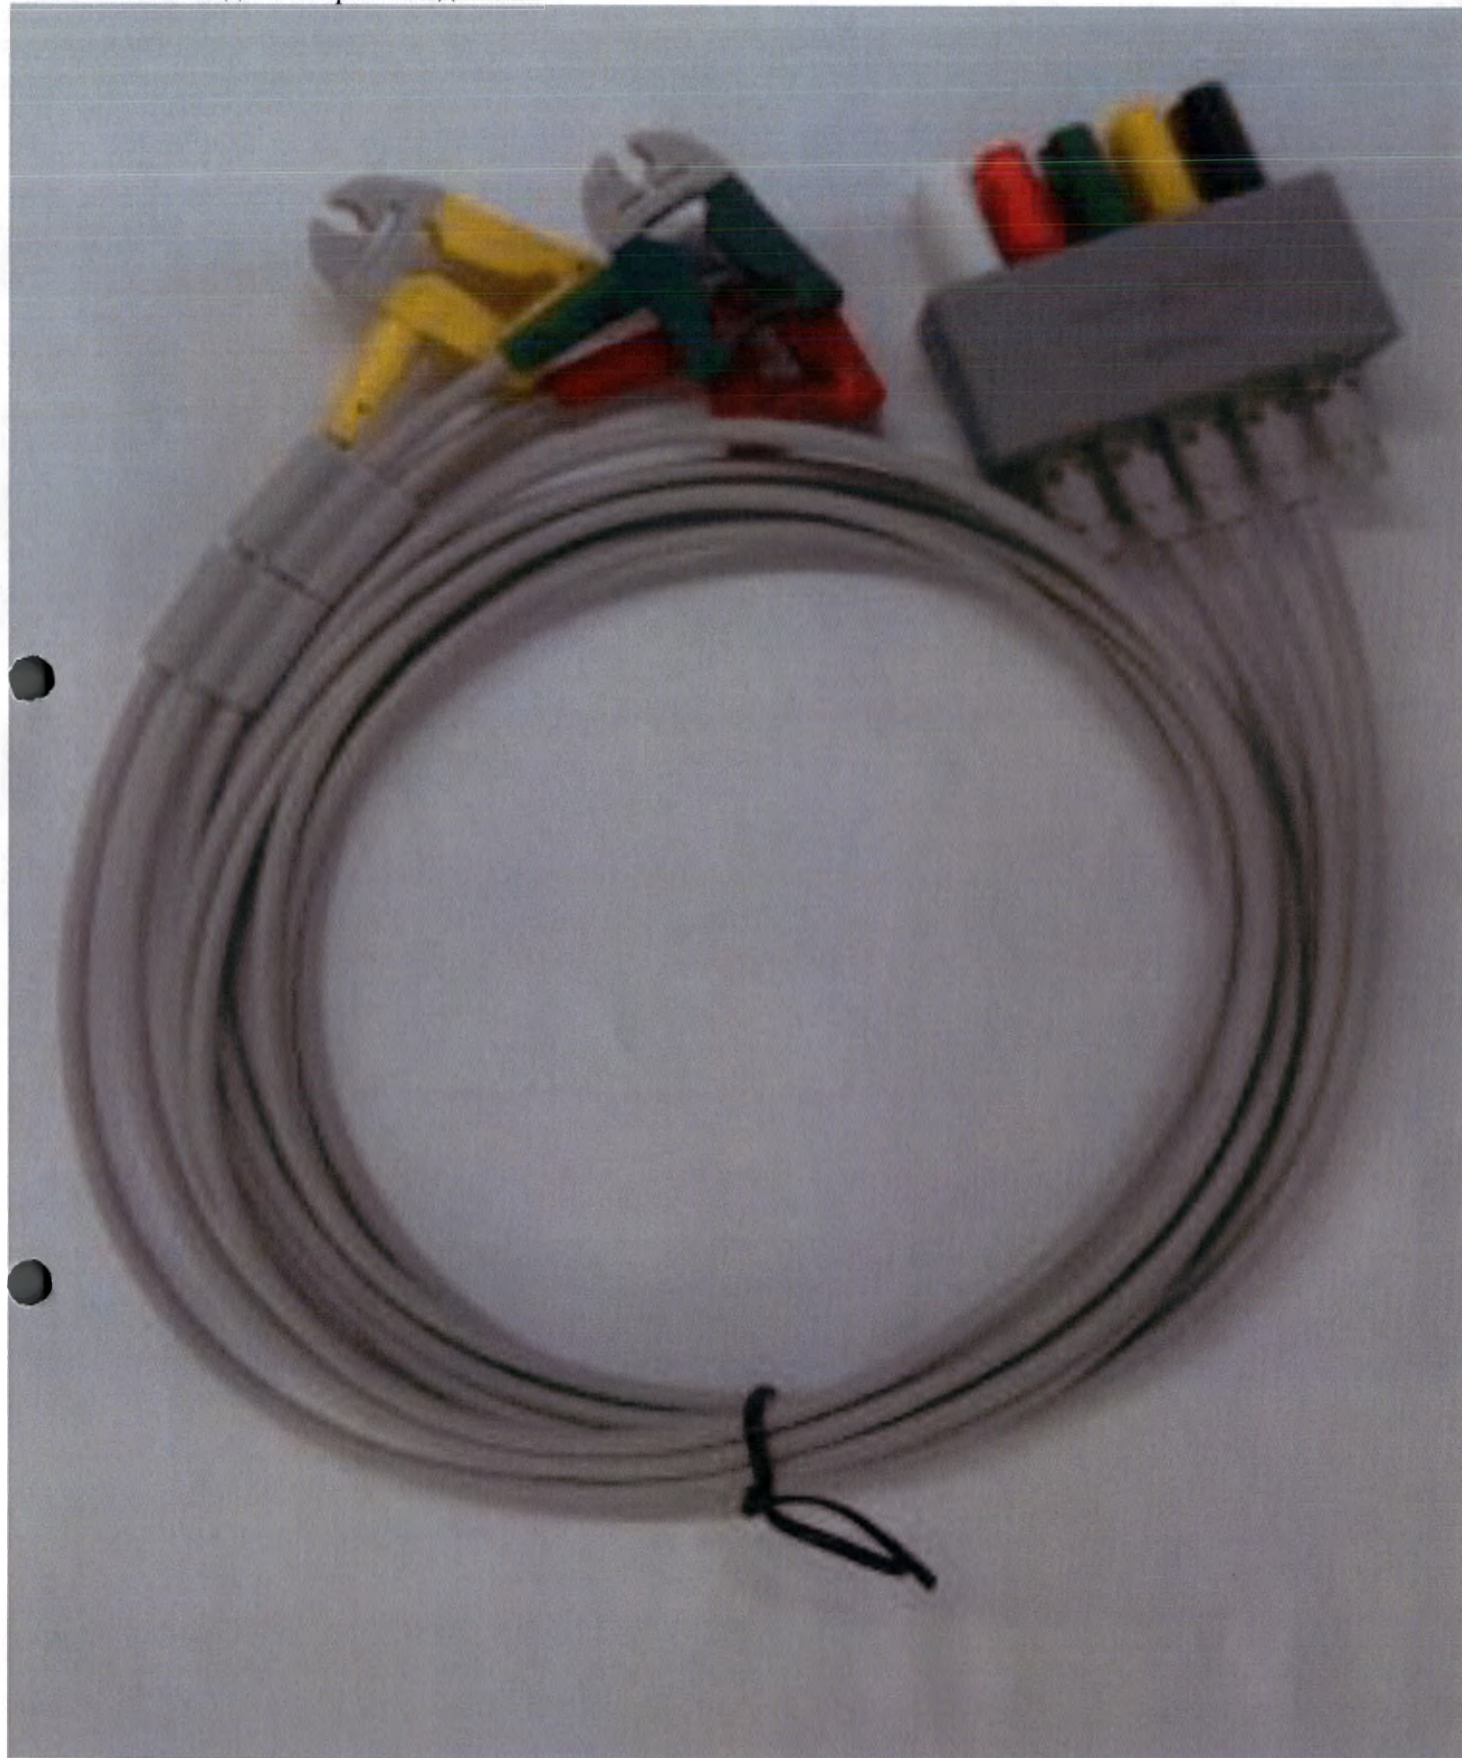

DC—IN кабель для модуля ЭКГ



DC-IN кабель



13. Модуль вывода аналоговых аудио/видео сигналов (при необходимости), не более 5 шт. в составе:

13.1 Устройство вывода аналоговых аудио/видео сигналов, не более 5 шт.

13.2. Крепление модуля вывода аналоговых аудио/видео сигналов (при необходимости) не более 5 шт. в составе:

13.2.1 Винт с шайбой – 1 шт.


13.2.2 Винт М3 – 3 шт.

13.2.3 Держатель – 1 шт.

13.2.4 Заглушка – 1 шт.





Винт с шайбой

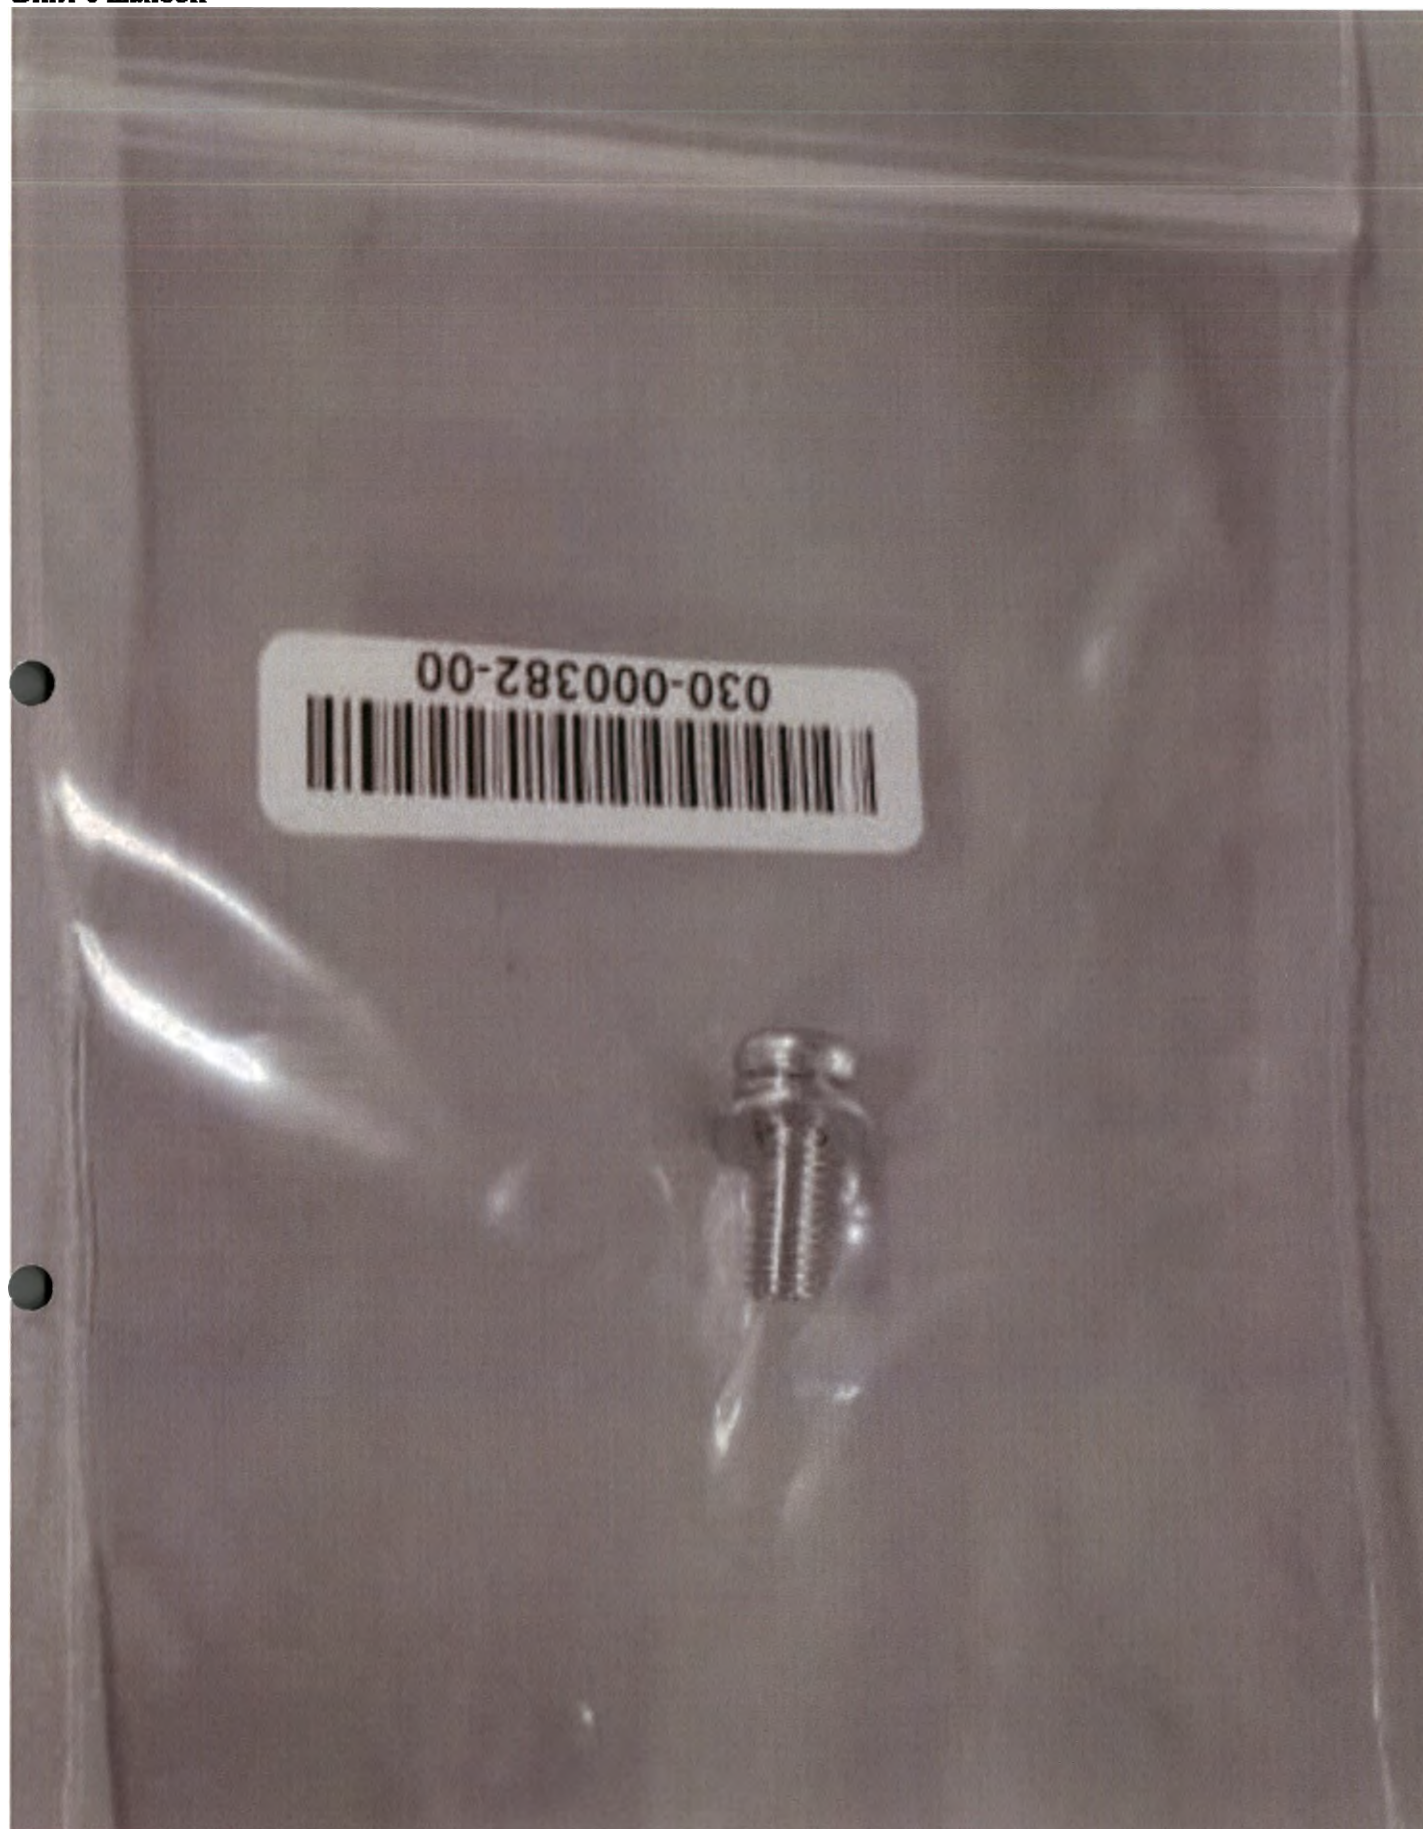

Винт М3



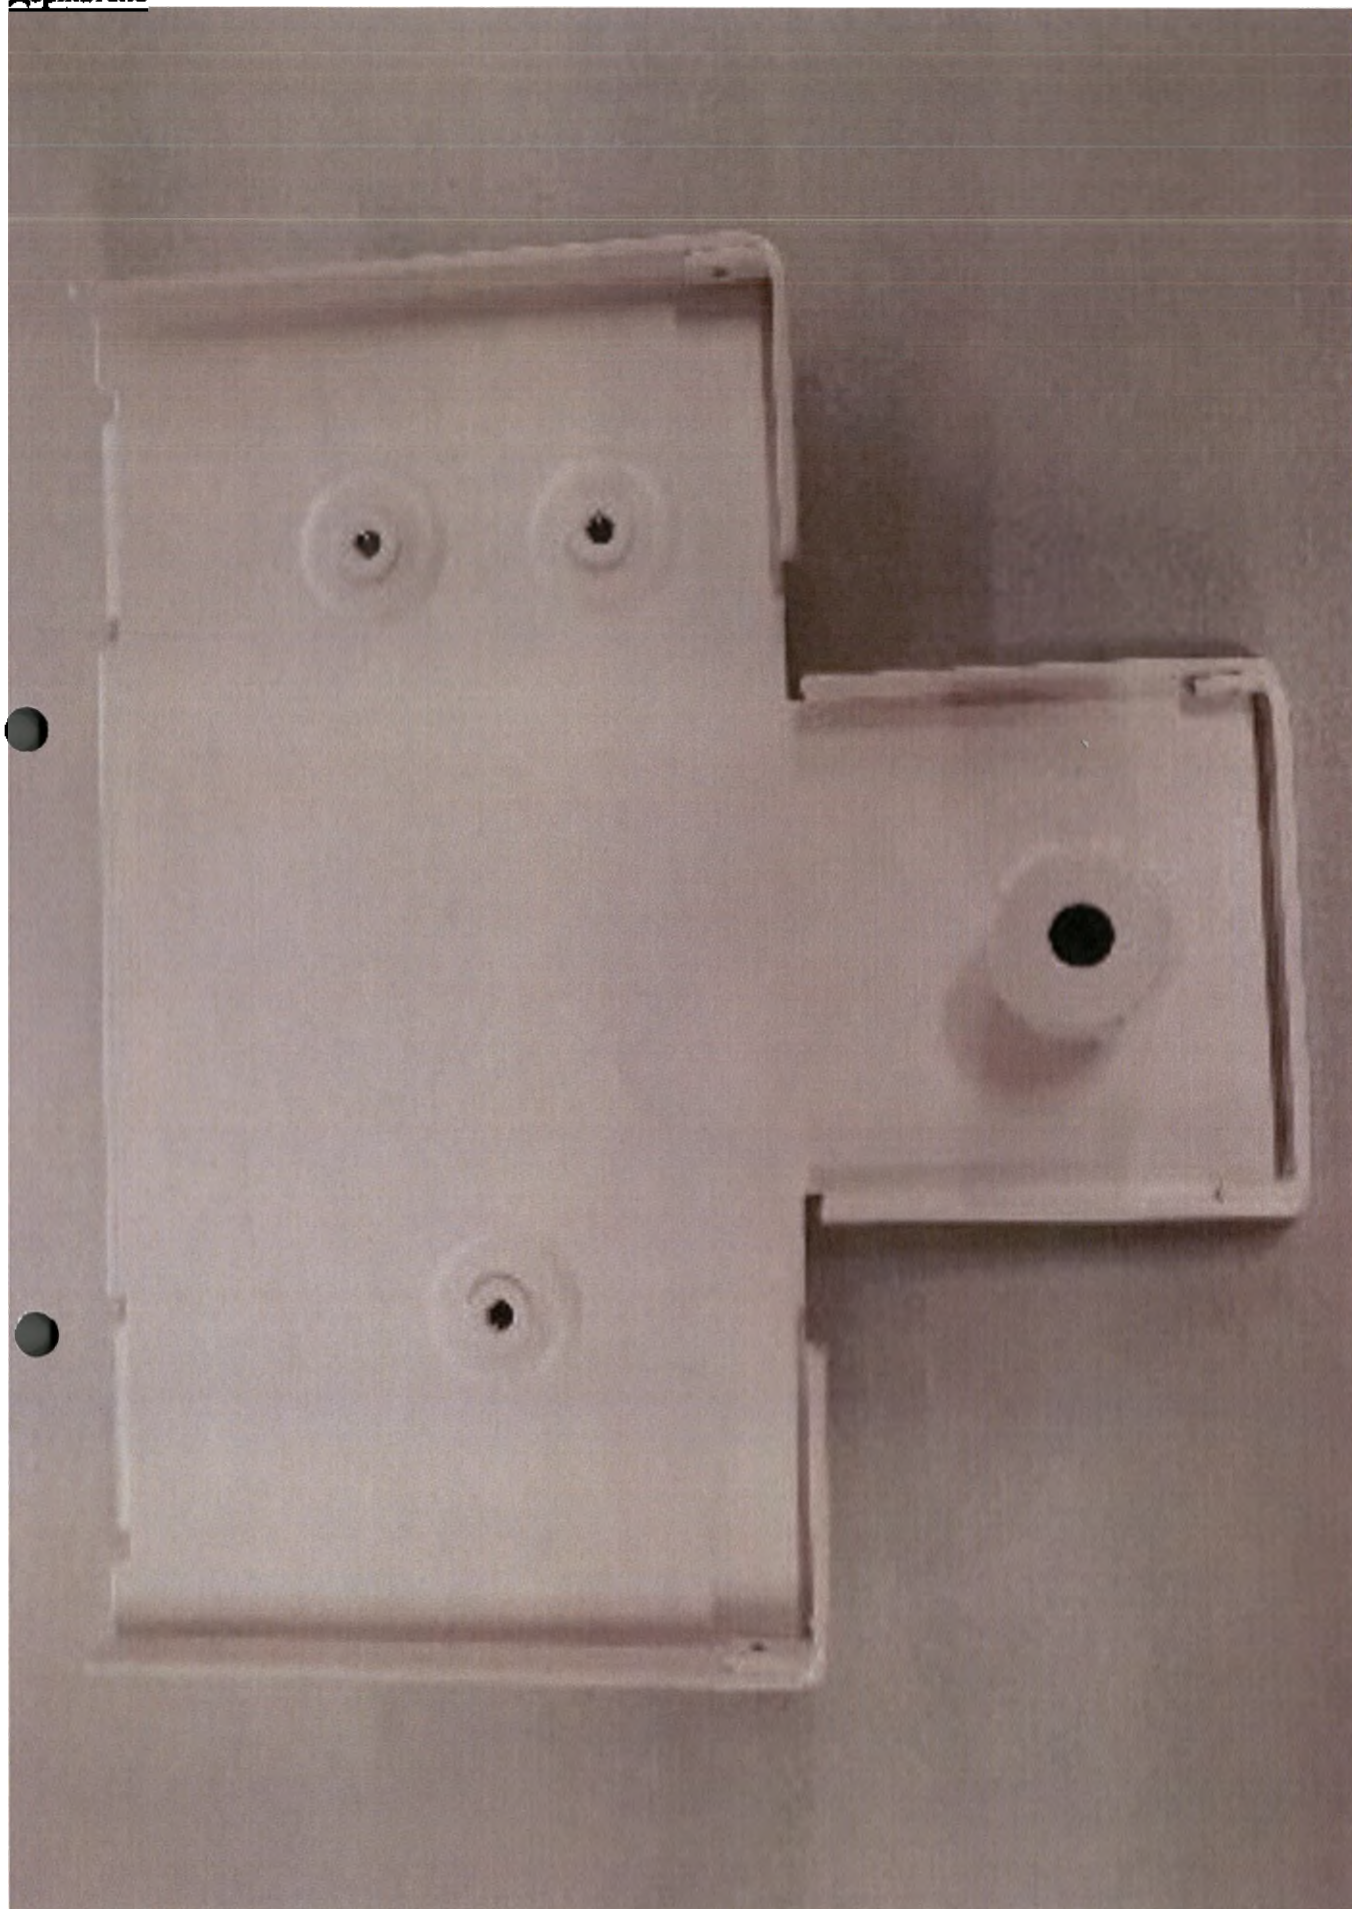


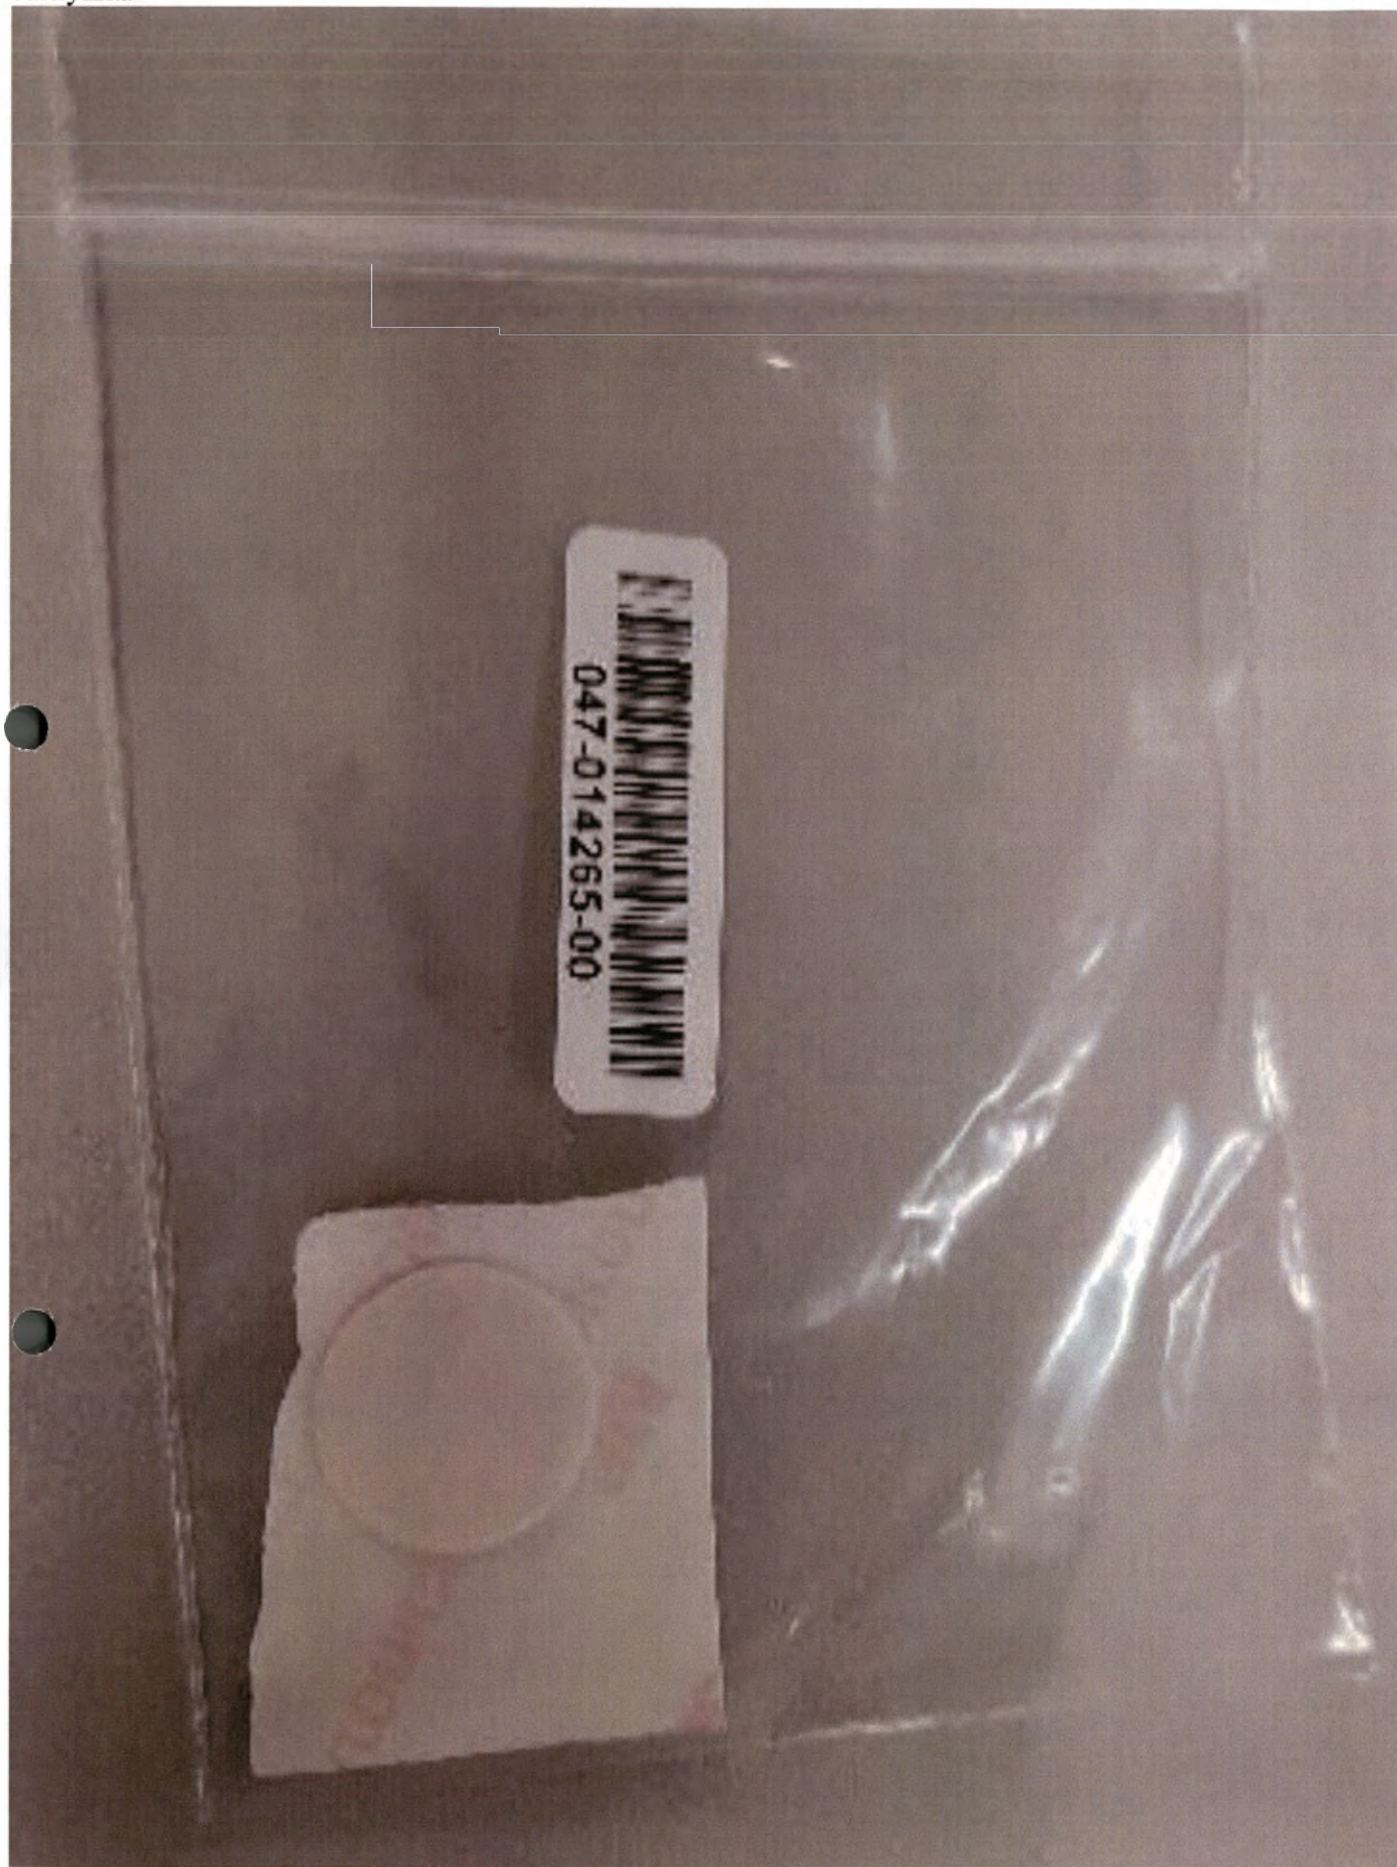

Принадлежности:

1. Ножной переключатель, 2 клавиши, не более 5 шт.
2. Ножной переключатель, 3 клавиши, не более 5 шт.
3. Тележка мобильная UMT-400 (без втягивающегося кабеля, без регулировки по высоте) – не более 5 шт.
4. Тележка мобильная UMT-400 (без втягивающегося кабеля, с регулировкой по высоте) – не более 5 шт.
5. Тележка мобильная UMT-400 (с втягивающимся кабелем, с регулировкой по высоте) – не более 5 шт.
6. Тележка мобильная HMT-600 (без втягивающегося кабеля) – не более 5 шт.
7. Тележка мобильная HMT-600 – не более 5 шт.
8. Контейнер для хранения – не более 5 шт.
9. Держатель датчиков – не более 15 шт.
10. Заглушка – не более 20 шт.
11. Идентификационная пленка – не более 5 шт.
12. Защитная пленка для клавиатуры – не более 5 шт.
13. Шлицевая отвертка – не более 5 шт.
14. Контейнер навесной – не более 5 шт.
15. Держатель датчиков большой – не более 10 шт.
16. Держатель датчиков малый – не более 10 шт.
17. Комплект для подключения беспроводного микрофона – не более 5 шт. в составе:
 - 17.1 USB-кабель – 1 шт.
 - 17.2 USB-кабель удлинительный – 1 шт. (при необходимости)
 - 17.3 Микрофон беспроводной – 1 шт.
 - 17.4 Передатчик – 1 шт.
 - 17.5 Приемник – 1 шт.
18. Li-ion батарея, не более 10 шт.
19. USB-кабель (B-A тип), не более 10 шт.
20. Кабель питания 3,5 м., не более 5 шт.
21. Дополнительный кабель питания, не более 5 шт.

Ножной переключатель, 2 клавиши

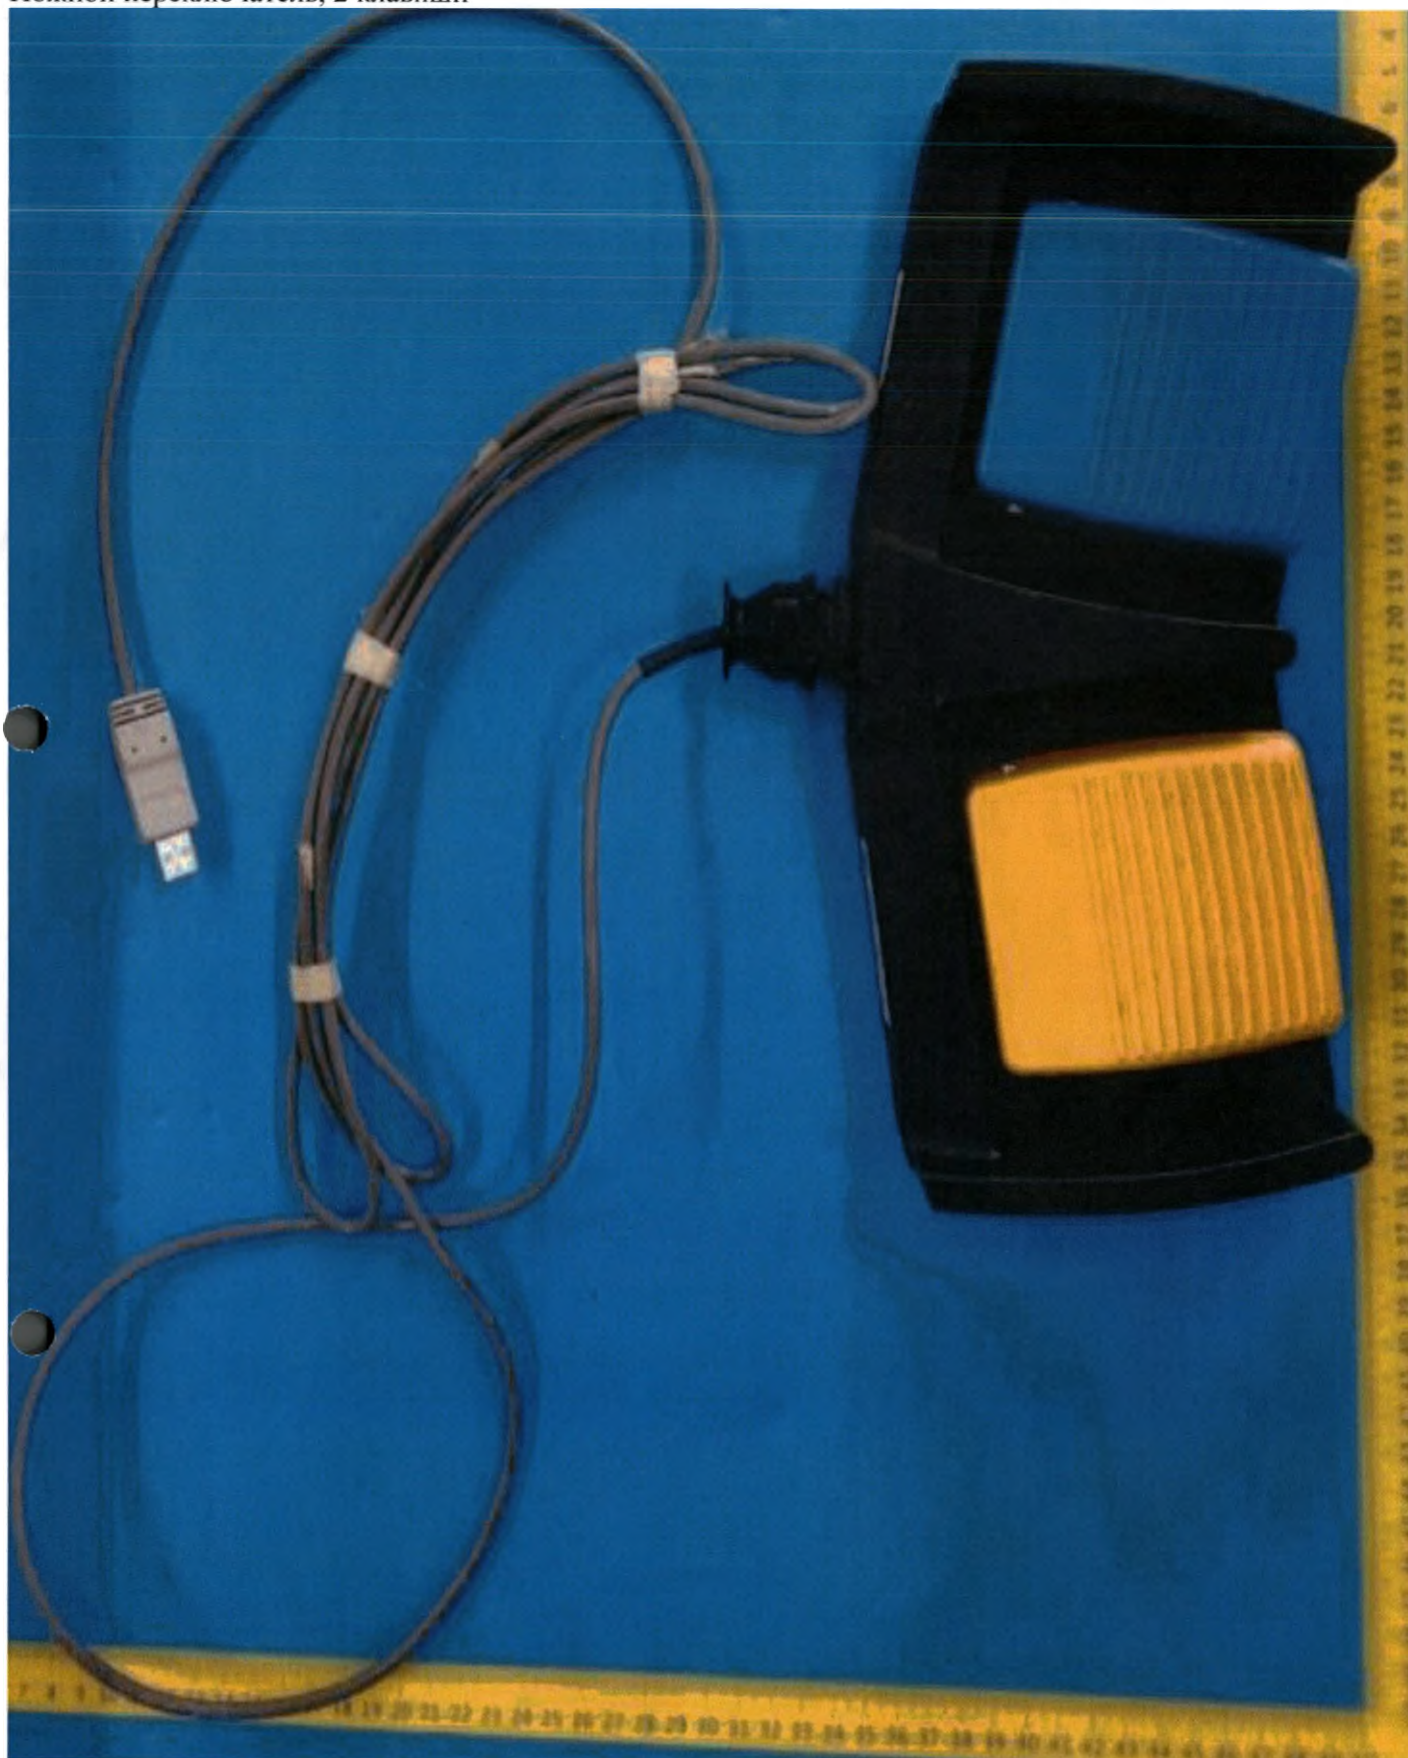


Ножной переключатель, 3 клавиши



Тележка мобильная UMT-400




Тележка мобильная UMT-400

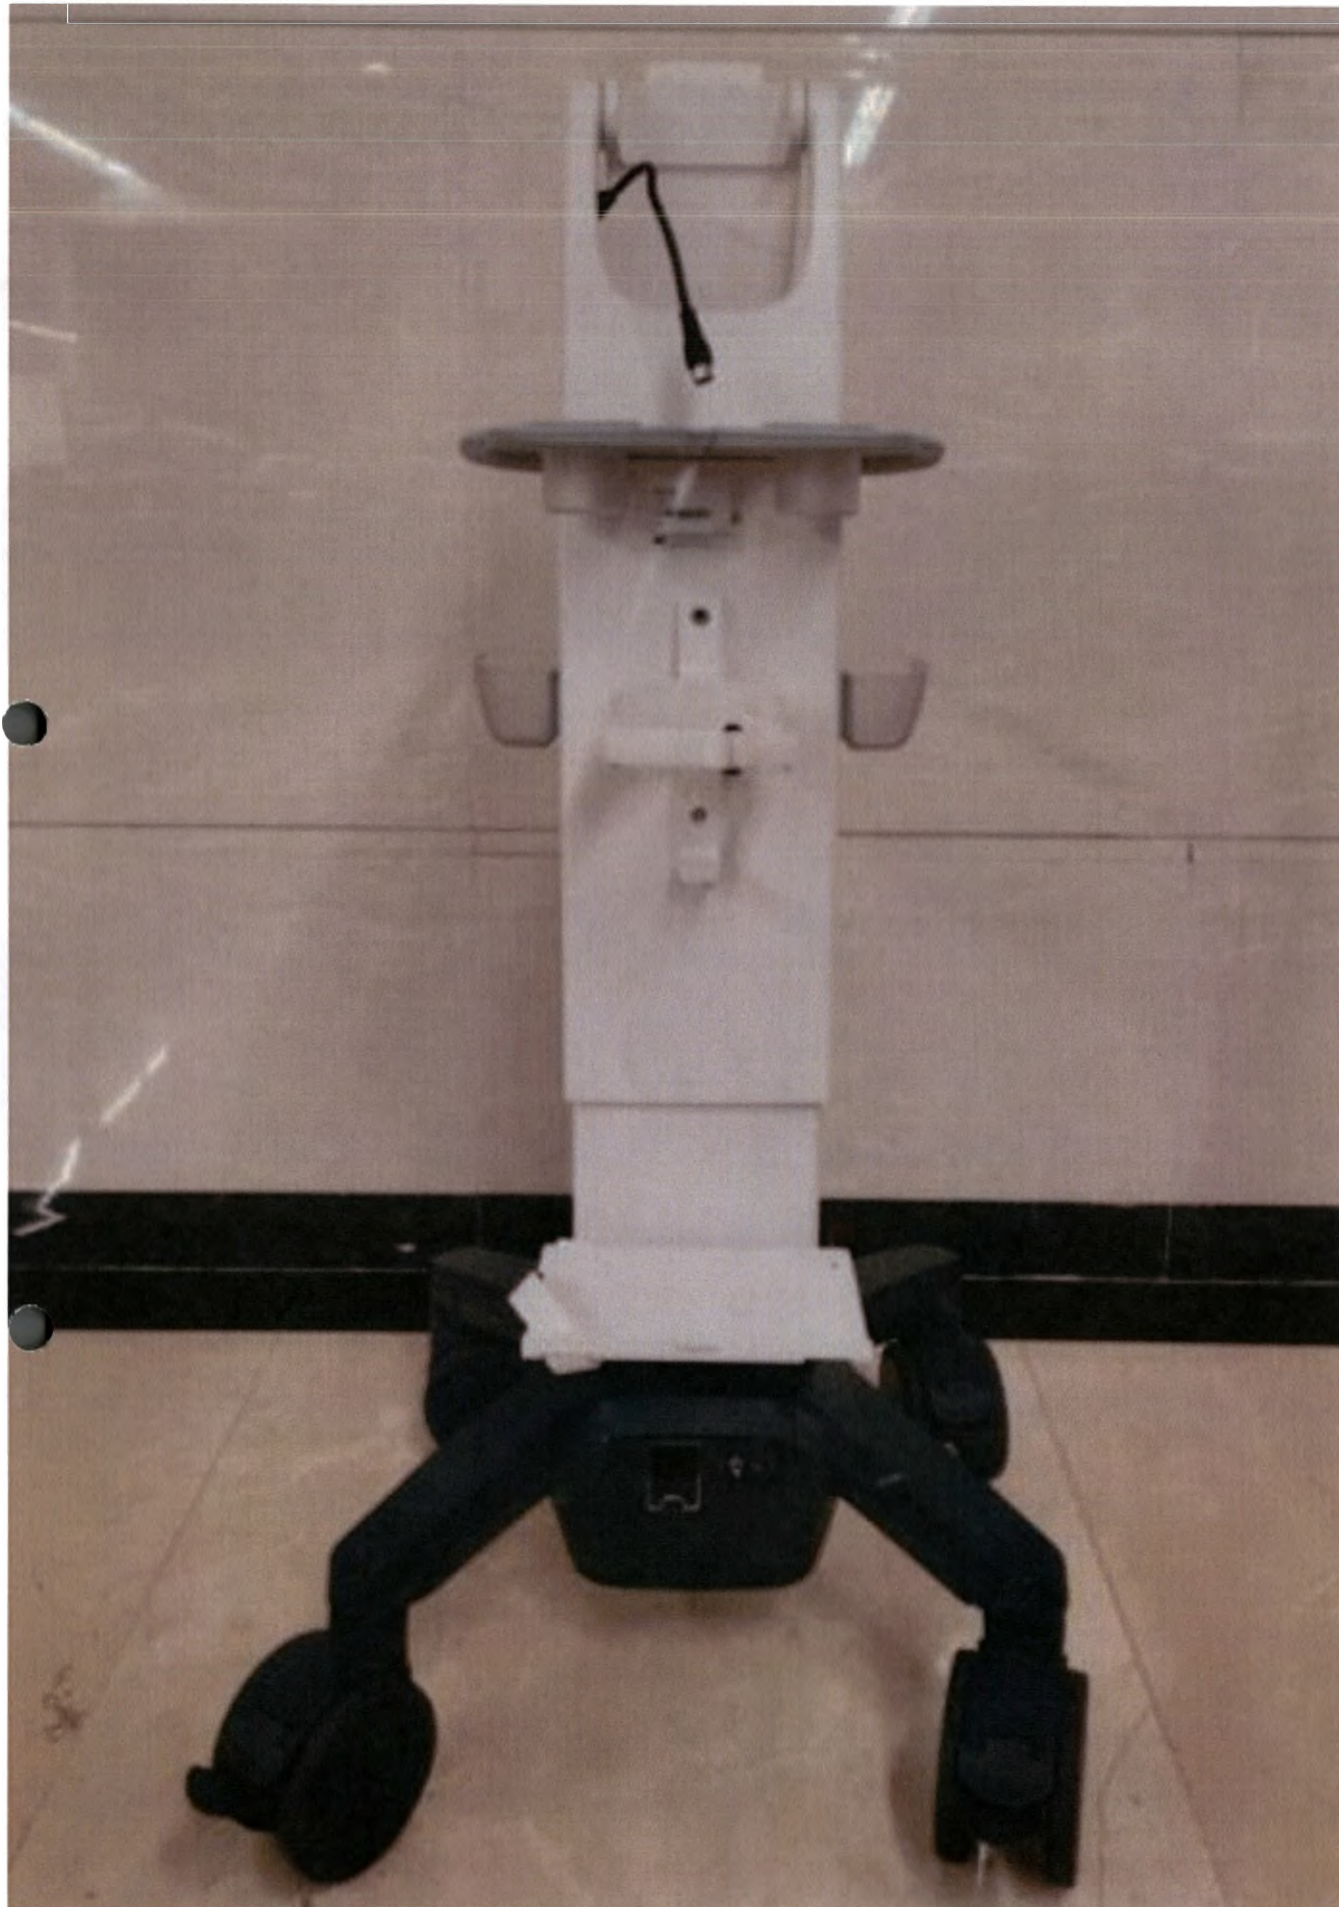

Тележка мобильная НМТ-600



Тележка мобильная НМТ-600

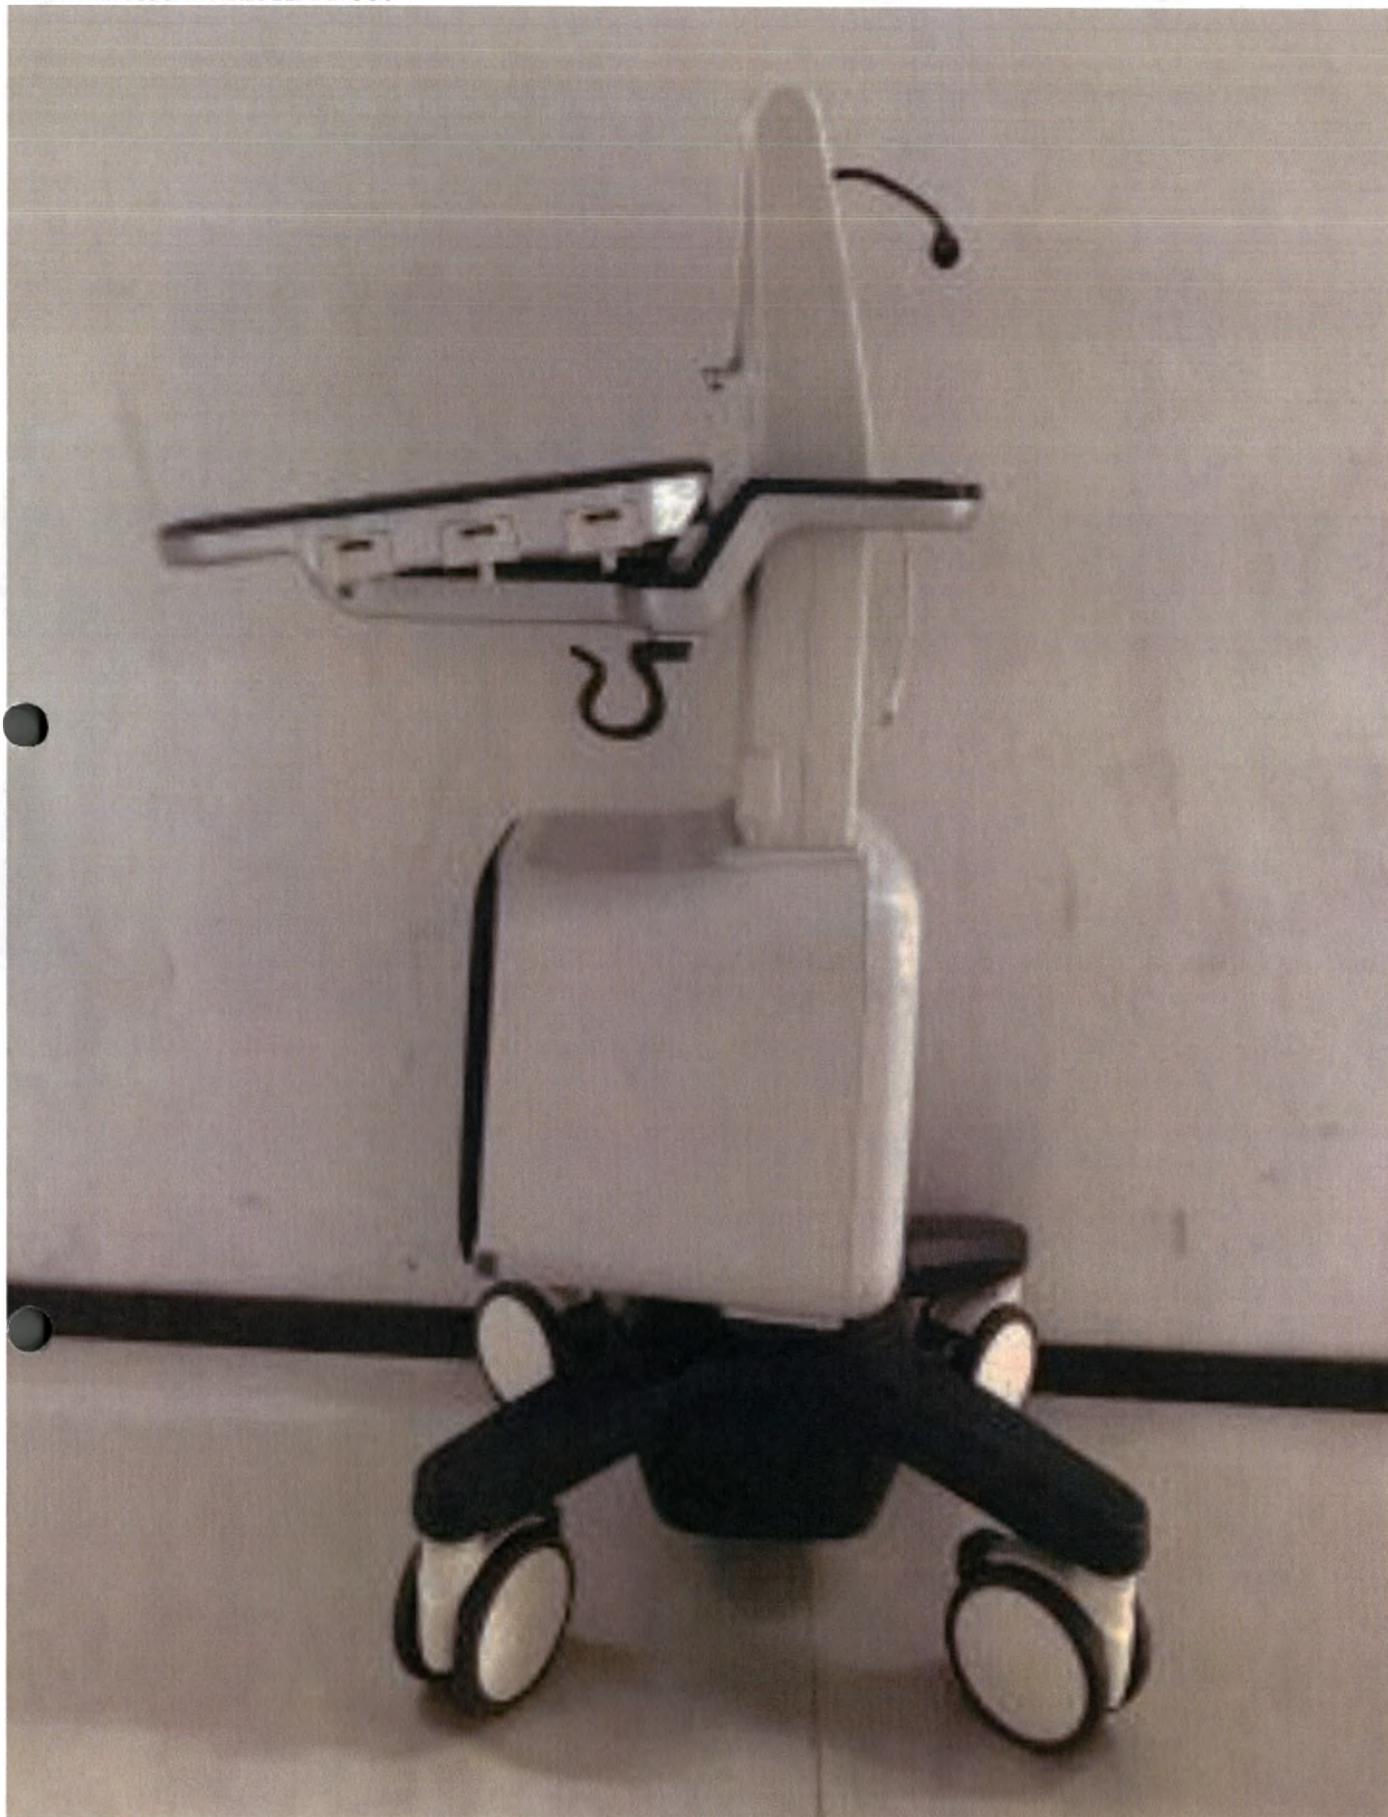

Контейнер для хранения




Держатель датчиков







Защитная пленка для клавиатуры

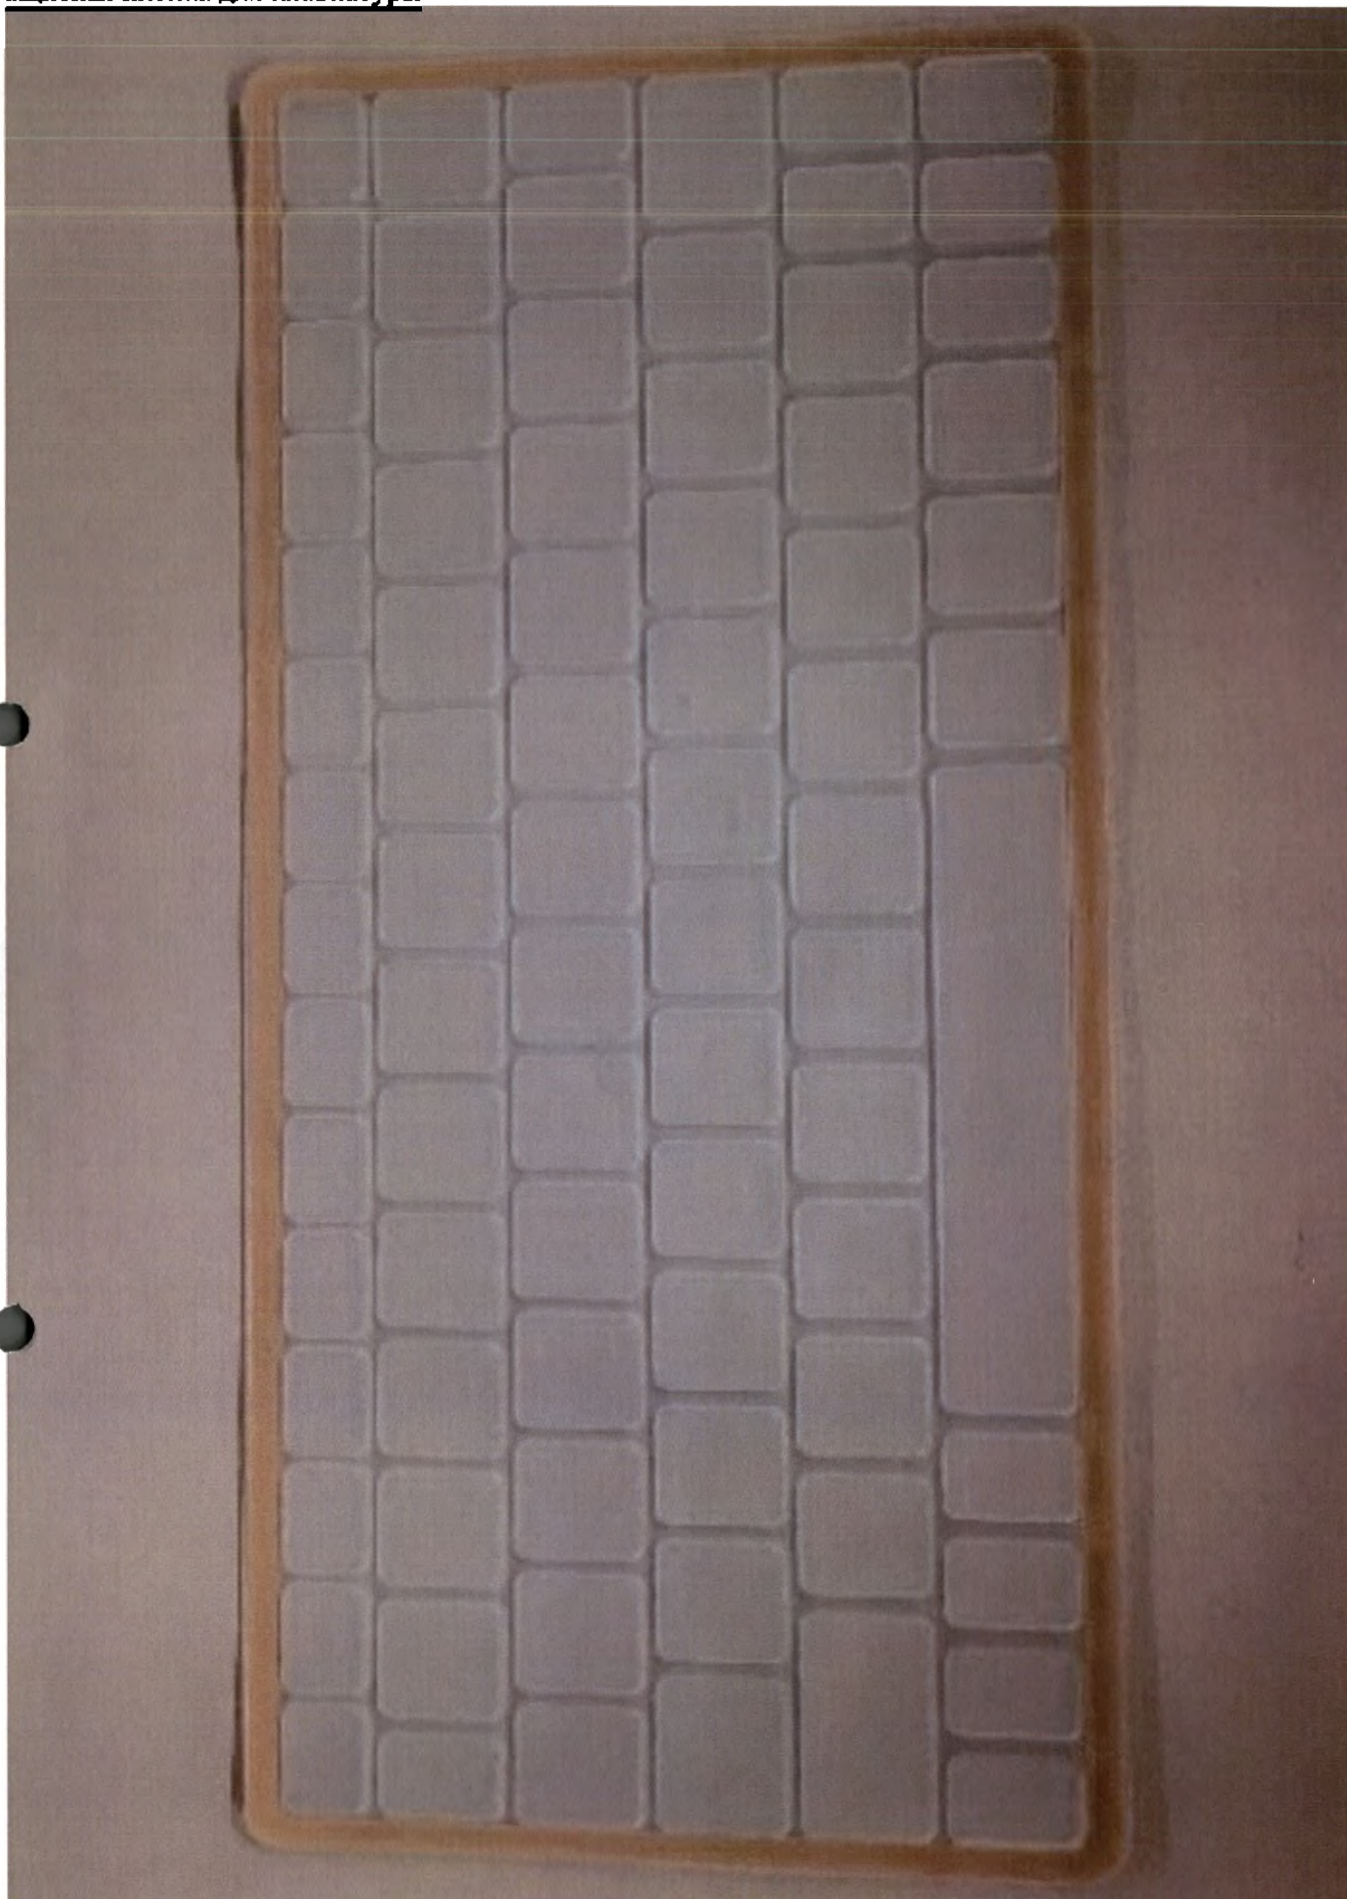



Шлицевая отвертка





Держатель датчиков большой

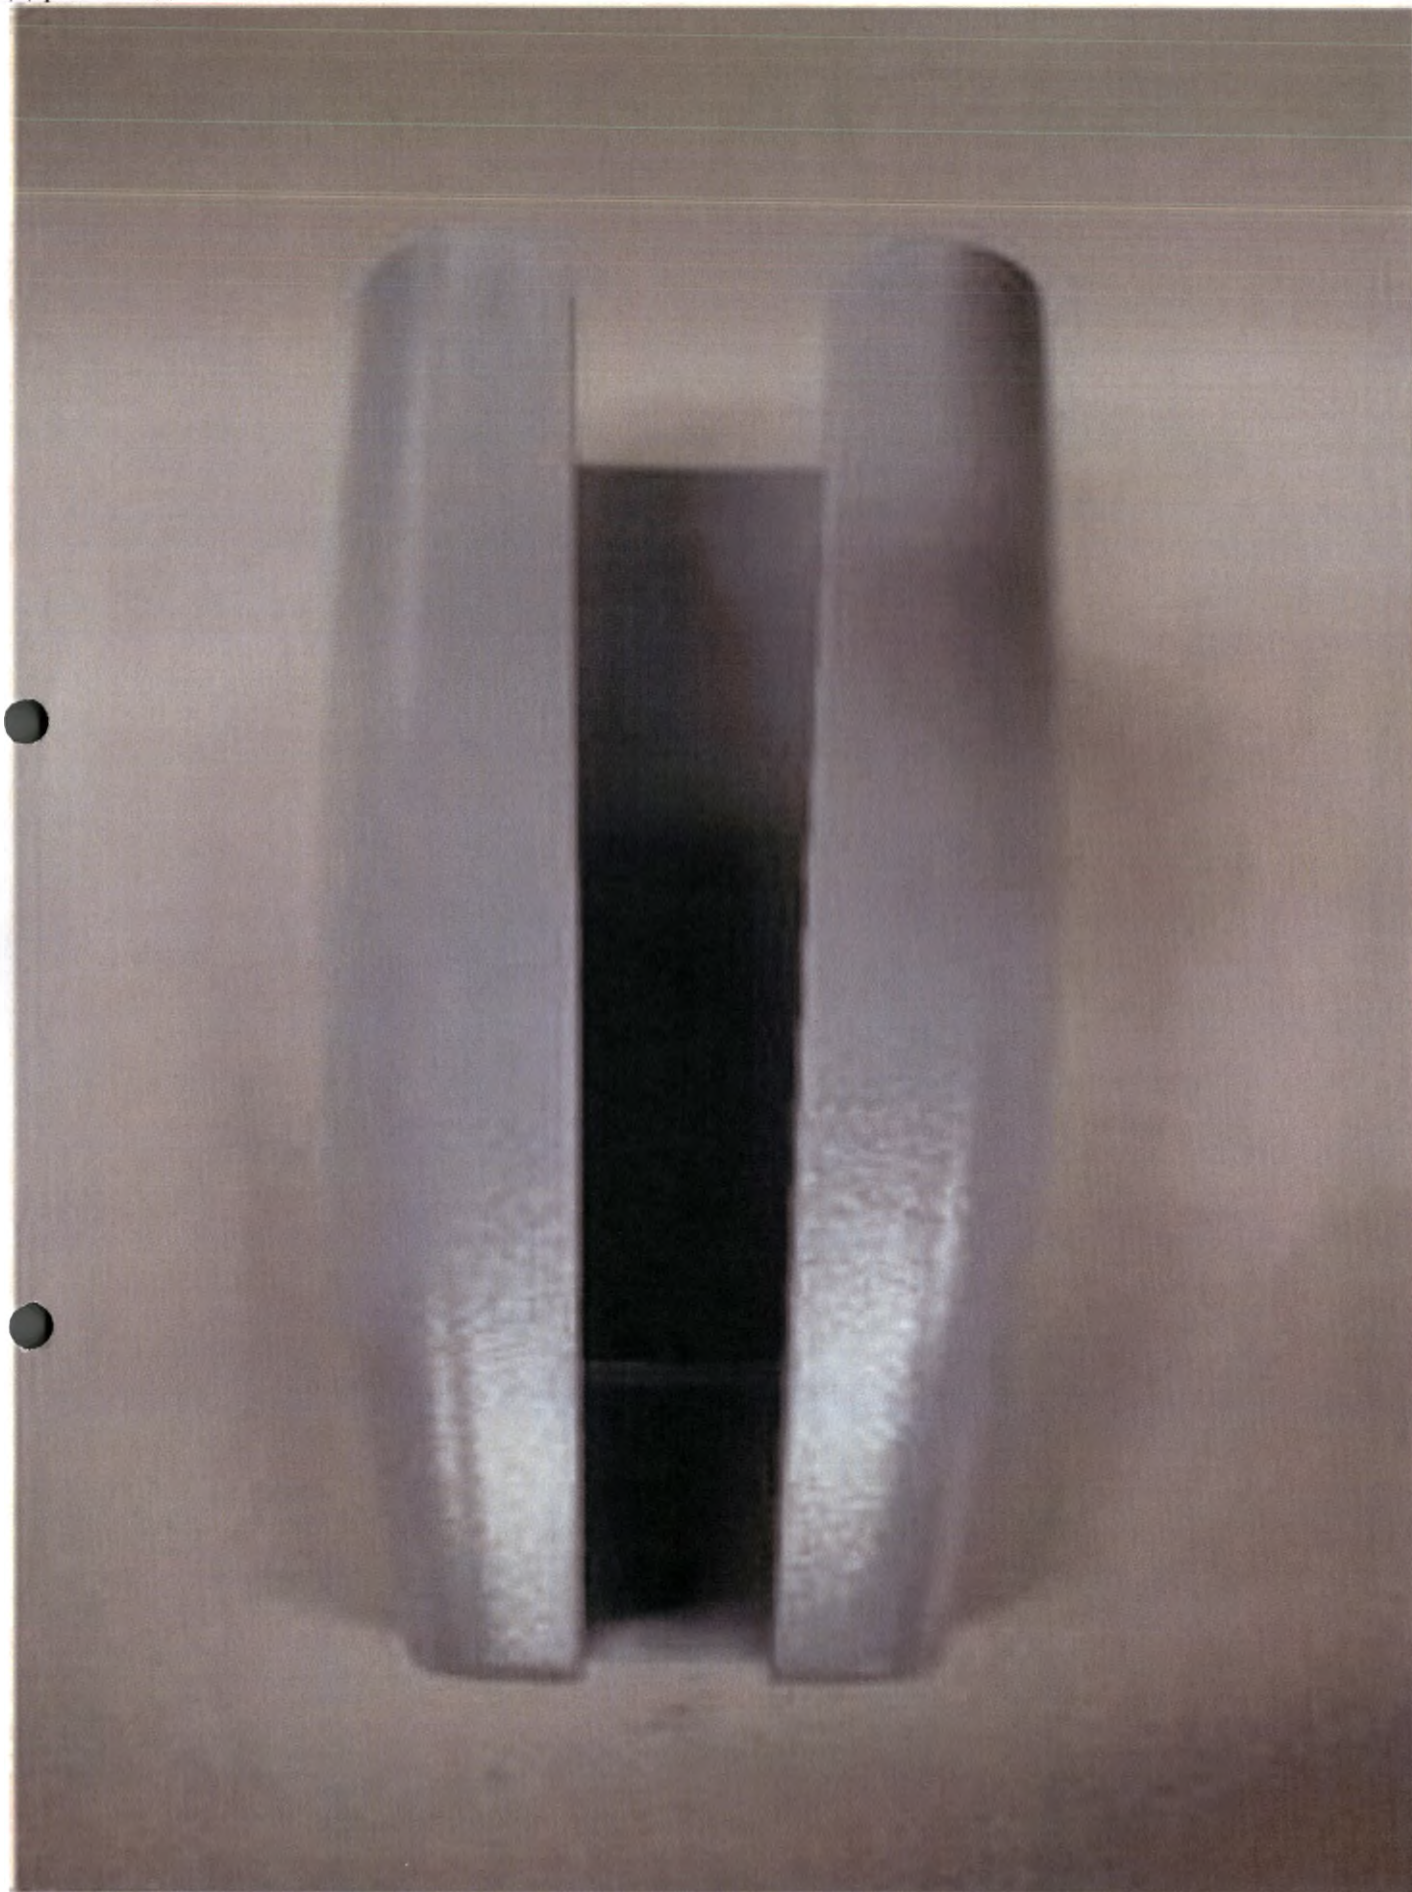

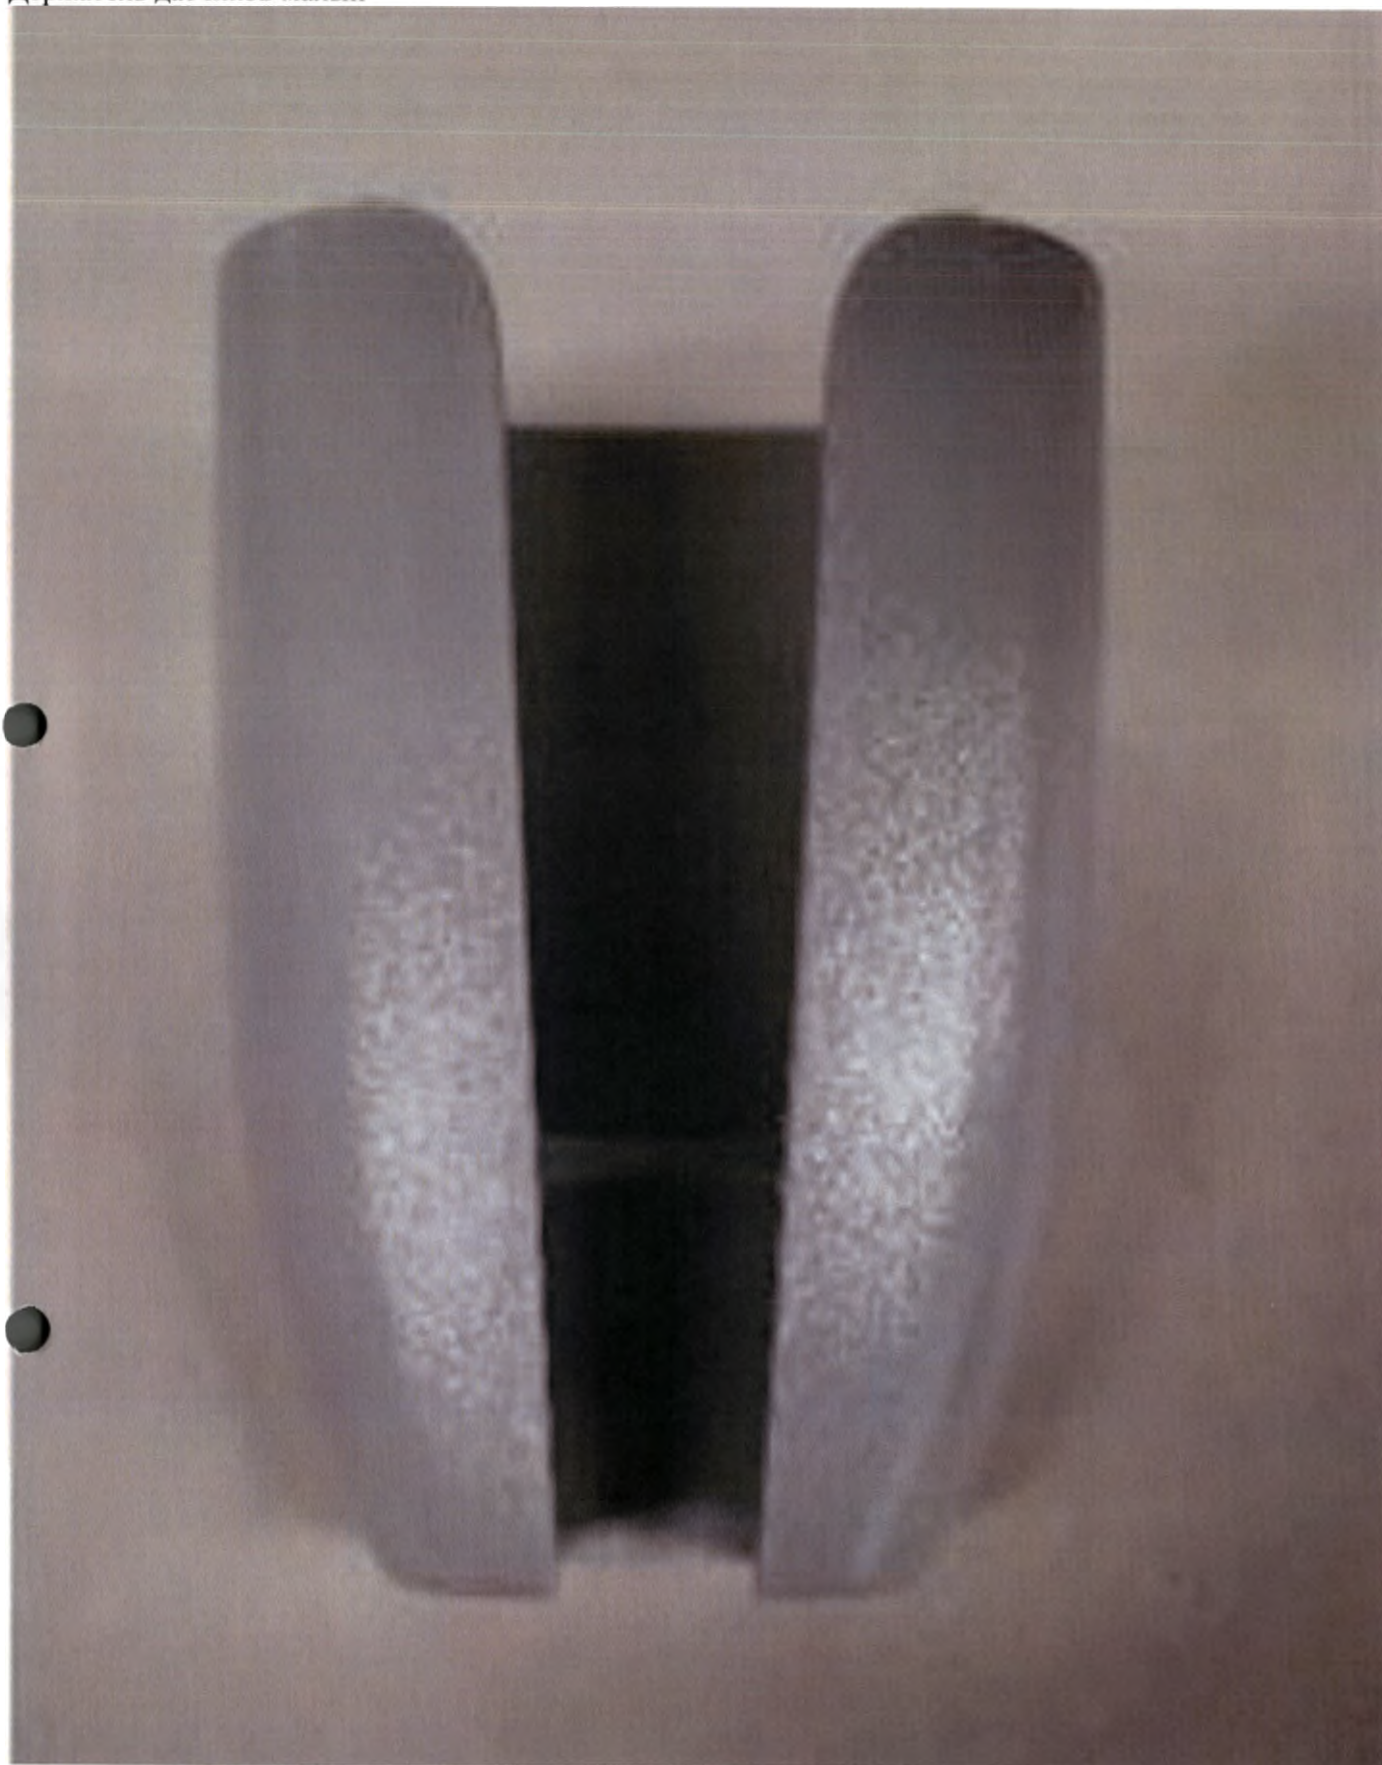








USB-кабель (B-A тип)

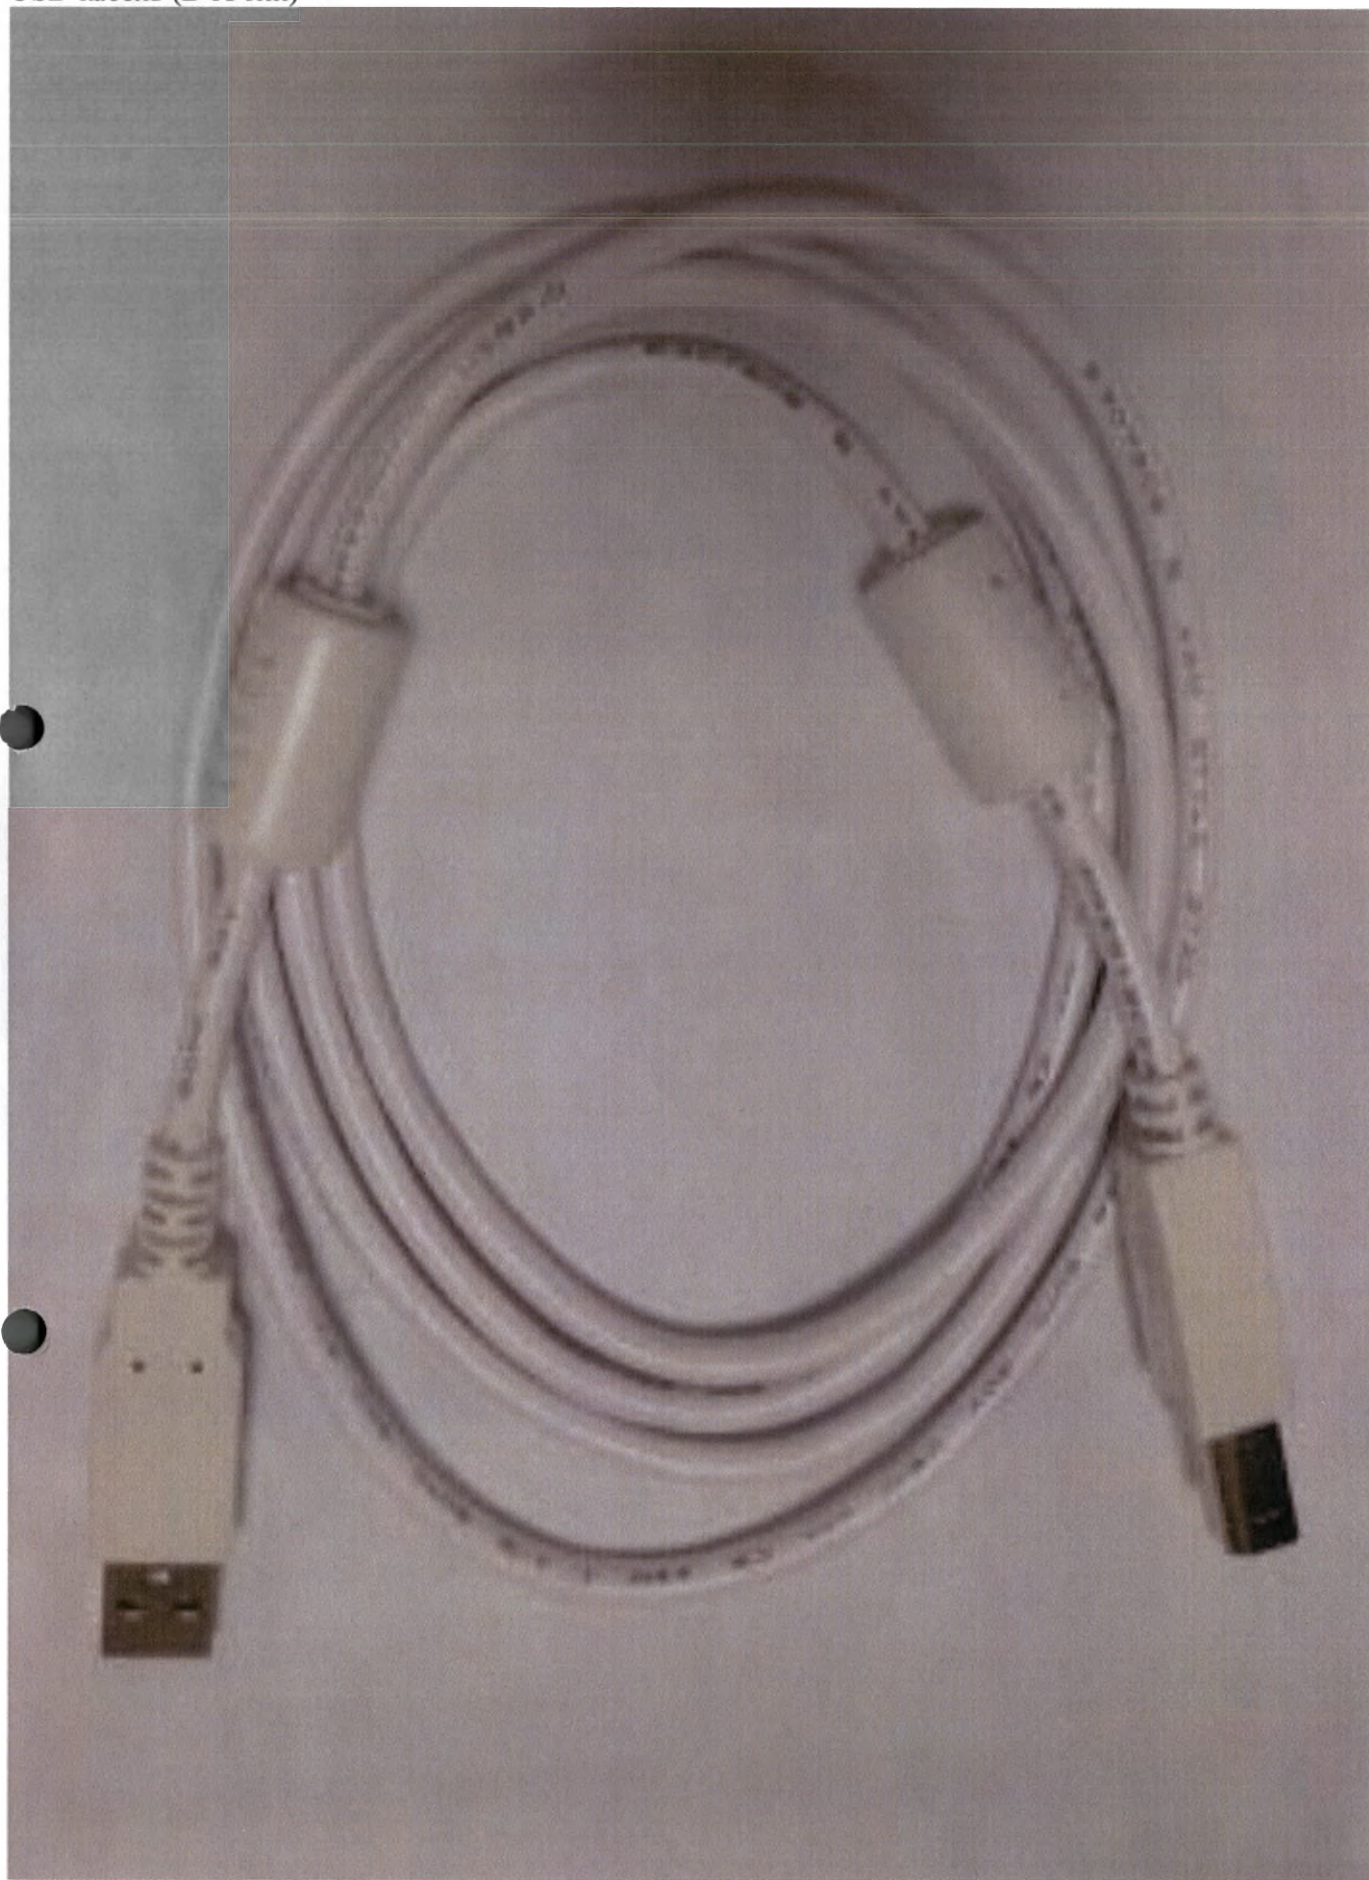

Кабель питания 3,5 м.



Дополнительный кабель питания



Прошито и скреплено

печатью 49 листов

по доверенности
СЫСоева Н.В.

