



ООО «АрПи Канон Медикал Системз»

Made For life

Фотографические изображения
медицинского изделия

***Система компьютерной томографии Aquilion
Lightning (TSX-035A) с принадлежностями***

Производства

Canon Medical Systems Corporation, Япония

1385 Shimoishigami, Otawara-shi,

Tochigi, 324-8550, Japan, Япония


1. Гентри компьютерного томографа (с громкоговорителем).



Процедурный стол для исследования пациента, вариант исполнения: - процедурный стол для исследования пациента СВТВ-033В; - процедурный стол для исследования пациента СВТВ-032А; - процедурный стол для исследования пациента СВТВ-032В.




2. Процедурный стол для исследования пациента, варианты исполнения: - Процедурный стол для исследования пациента СВТВ-033А; - Процедурный стол для исследования пациента СВТВ-033В; - Процедурный стол для исследования пациента СВТВ-032А; - Процедурный стол для исследования пациента СВТВ-032В.

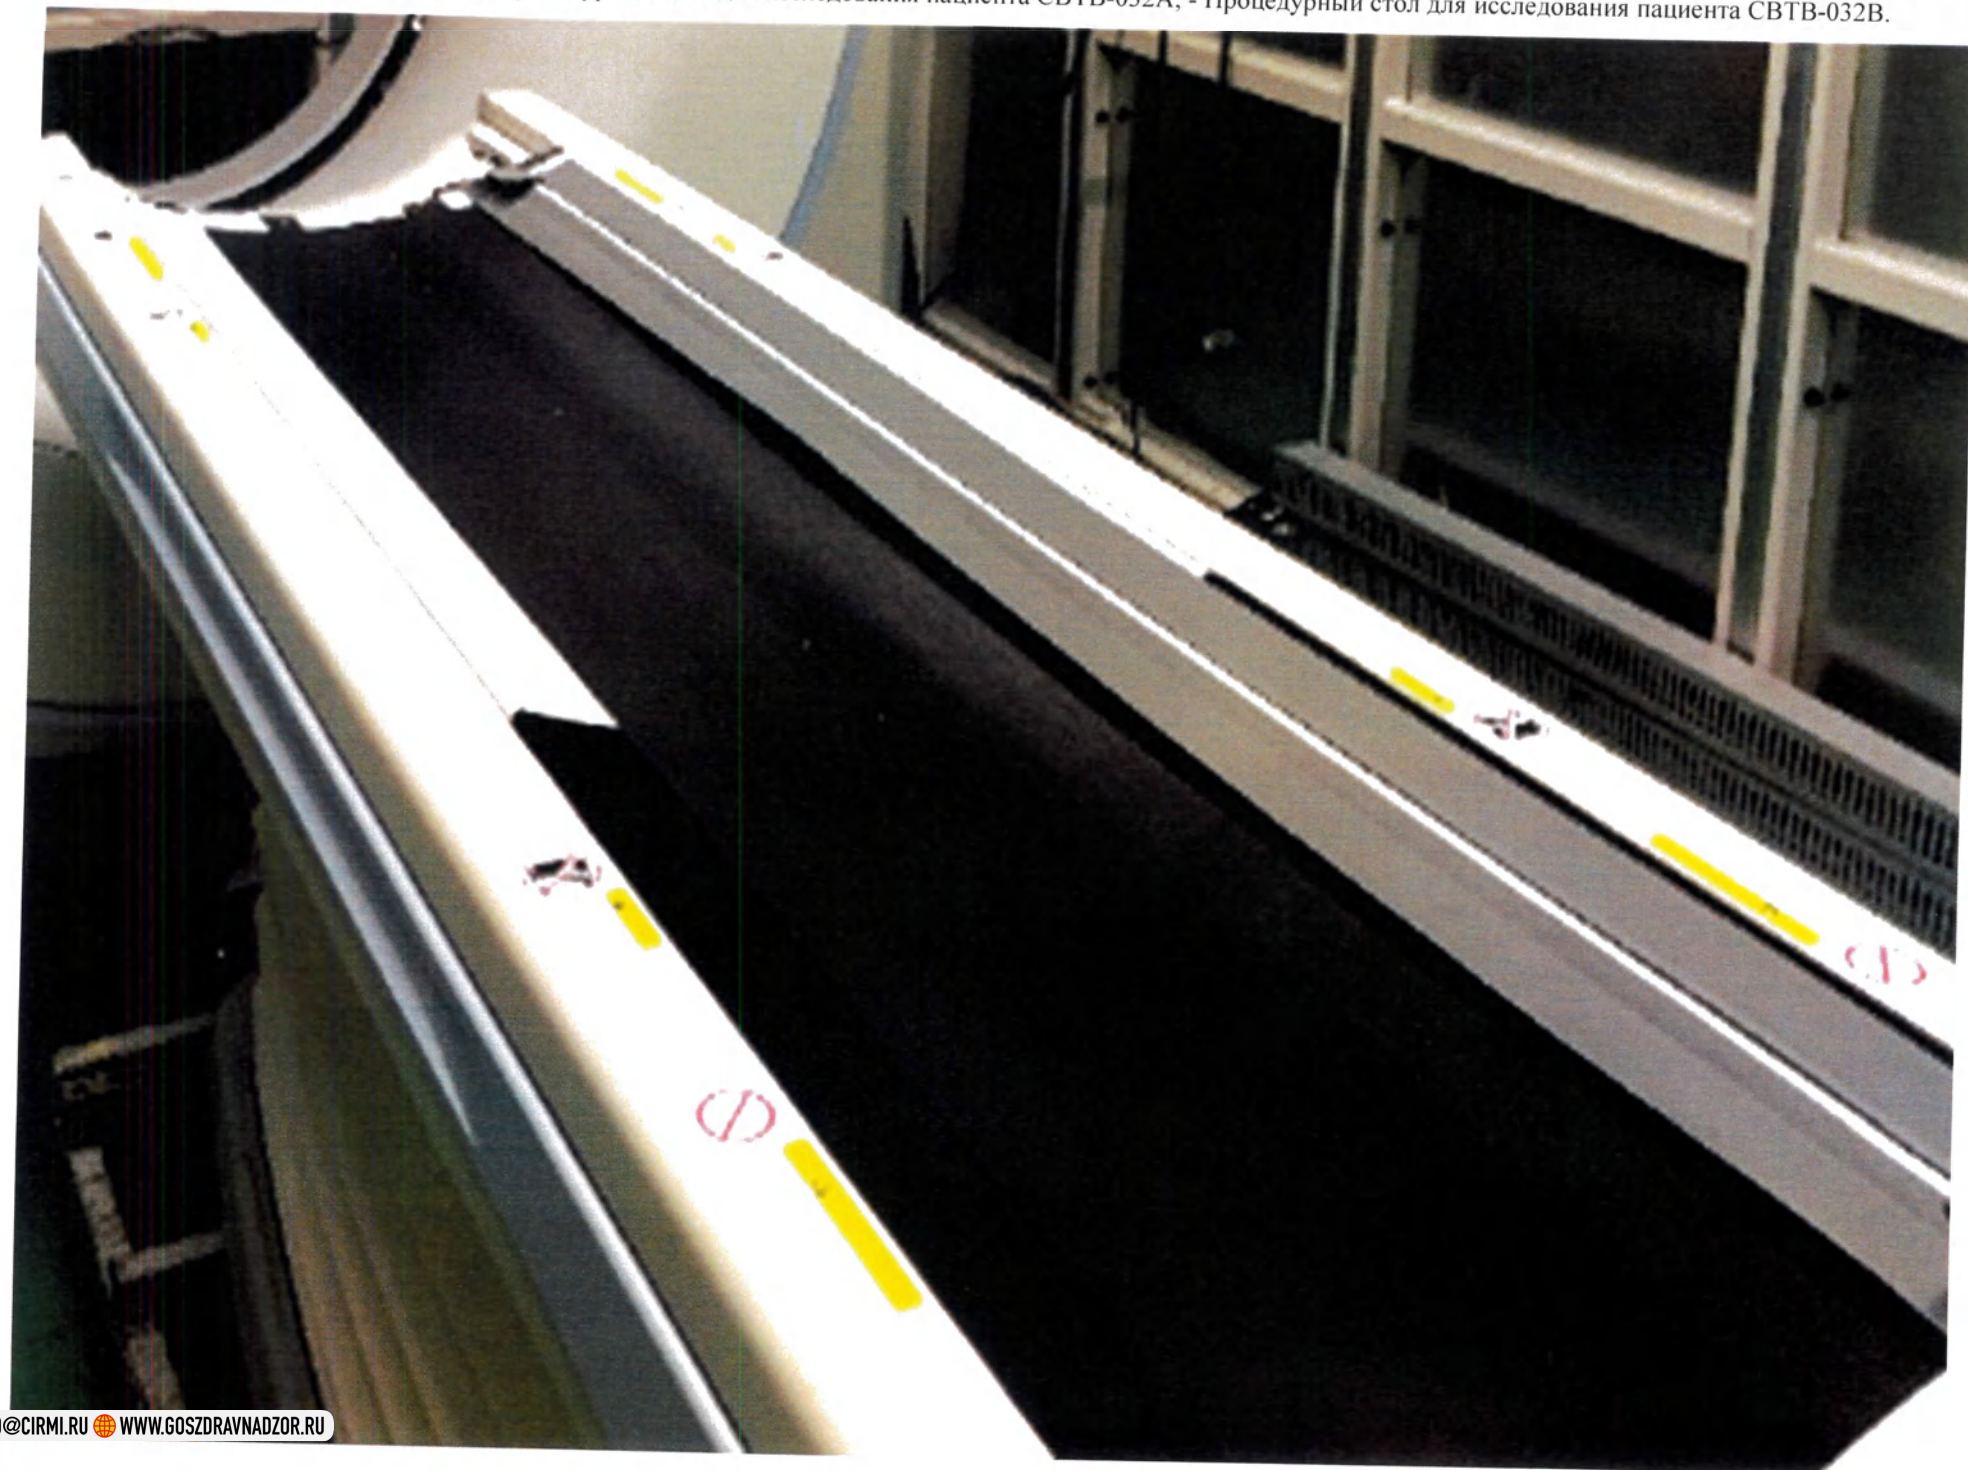

3. Консоль

3



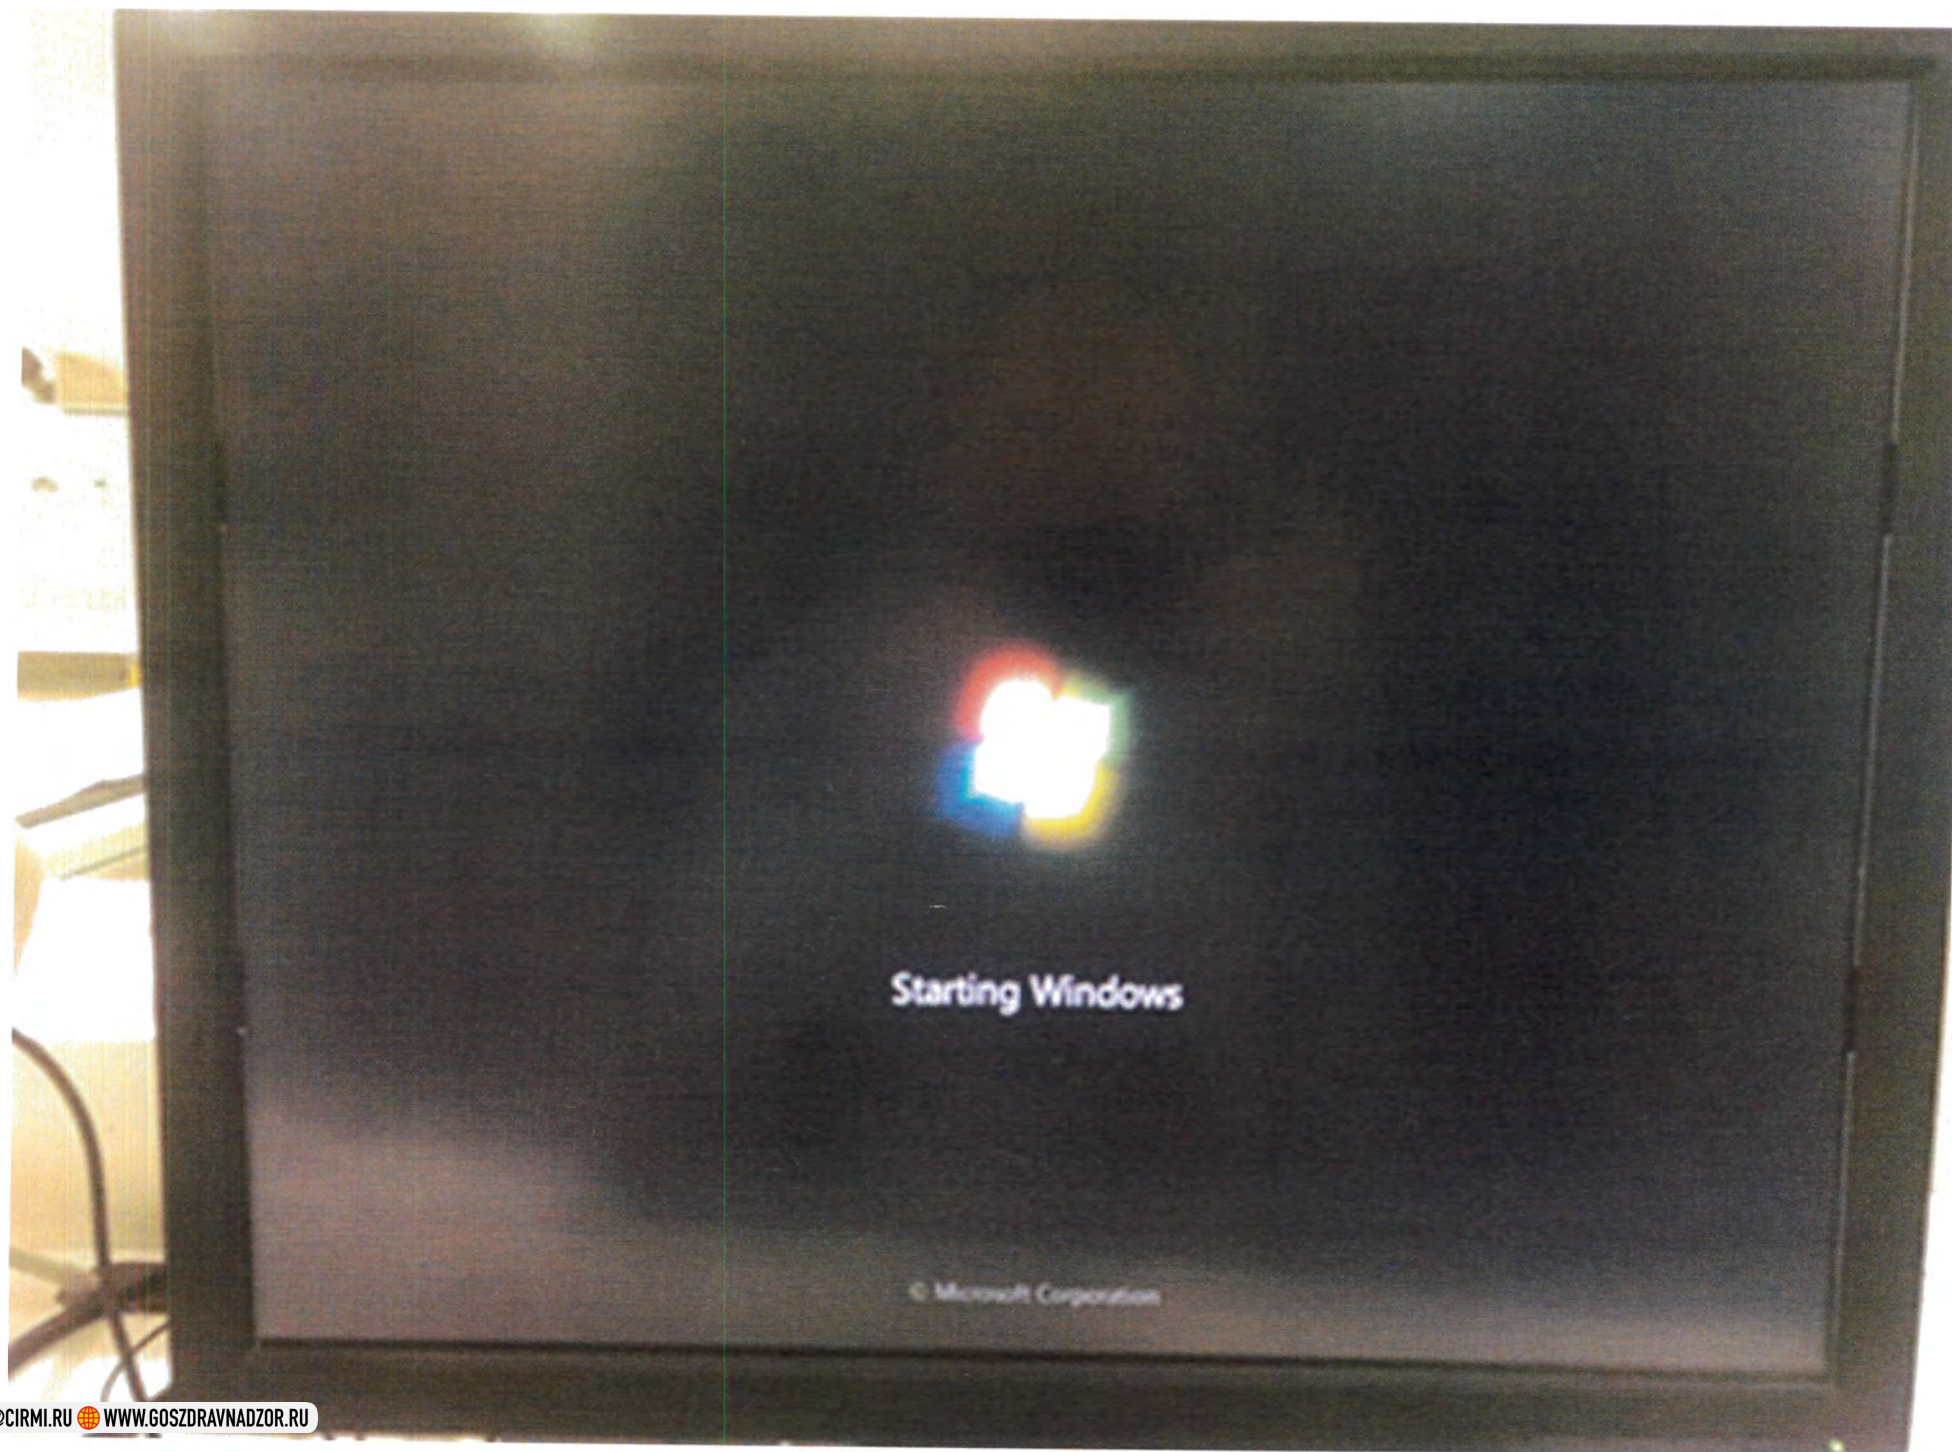


- Блок ЦИТ (шкаф NAVI BOX)



- Клавиатура.

0

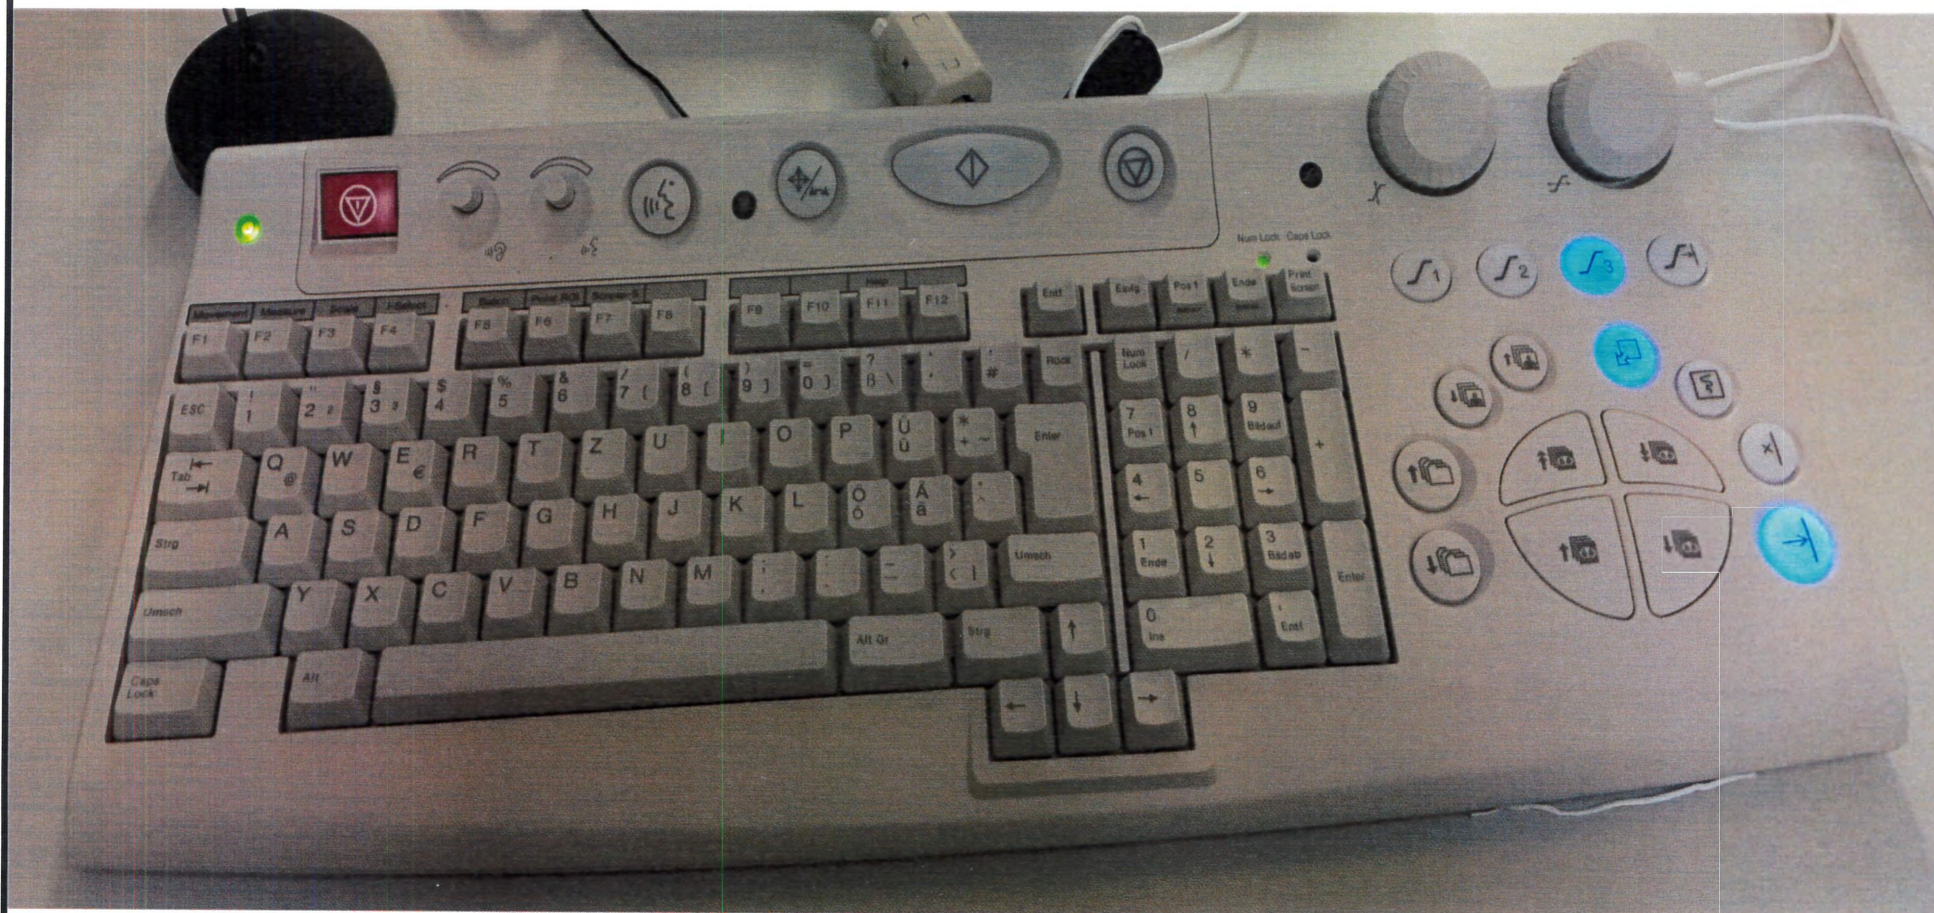

- Мышь компьютерная.

9




- Громкоговоритель.

10



- Микрофон.

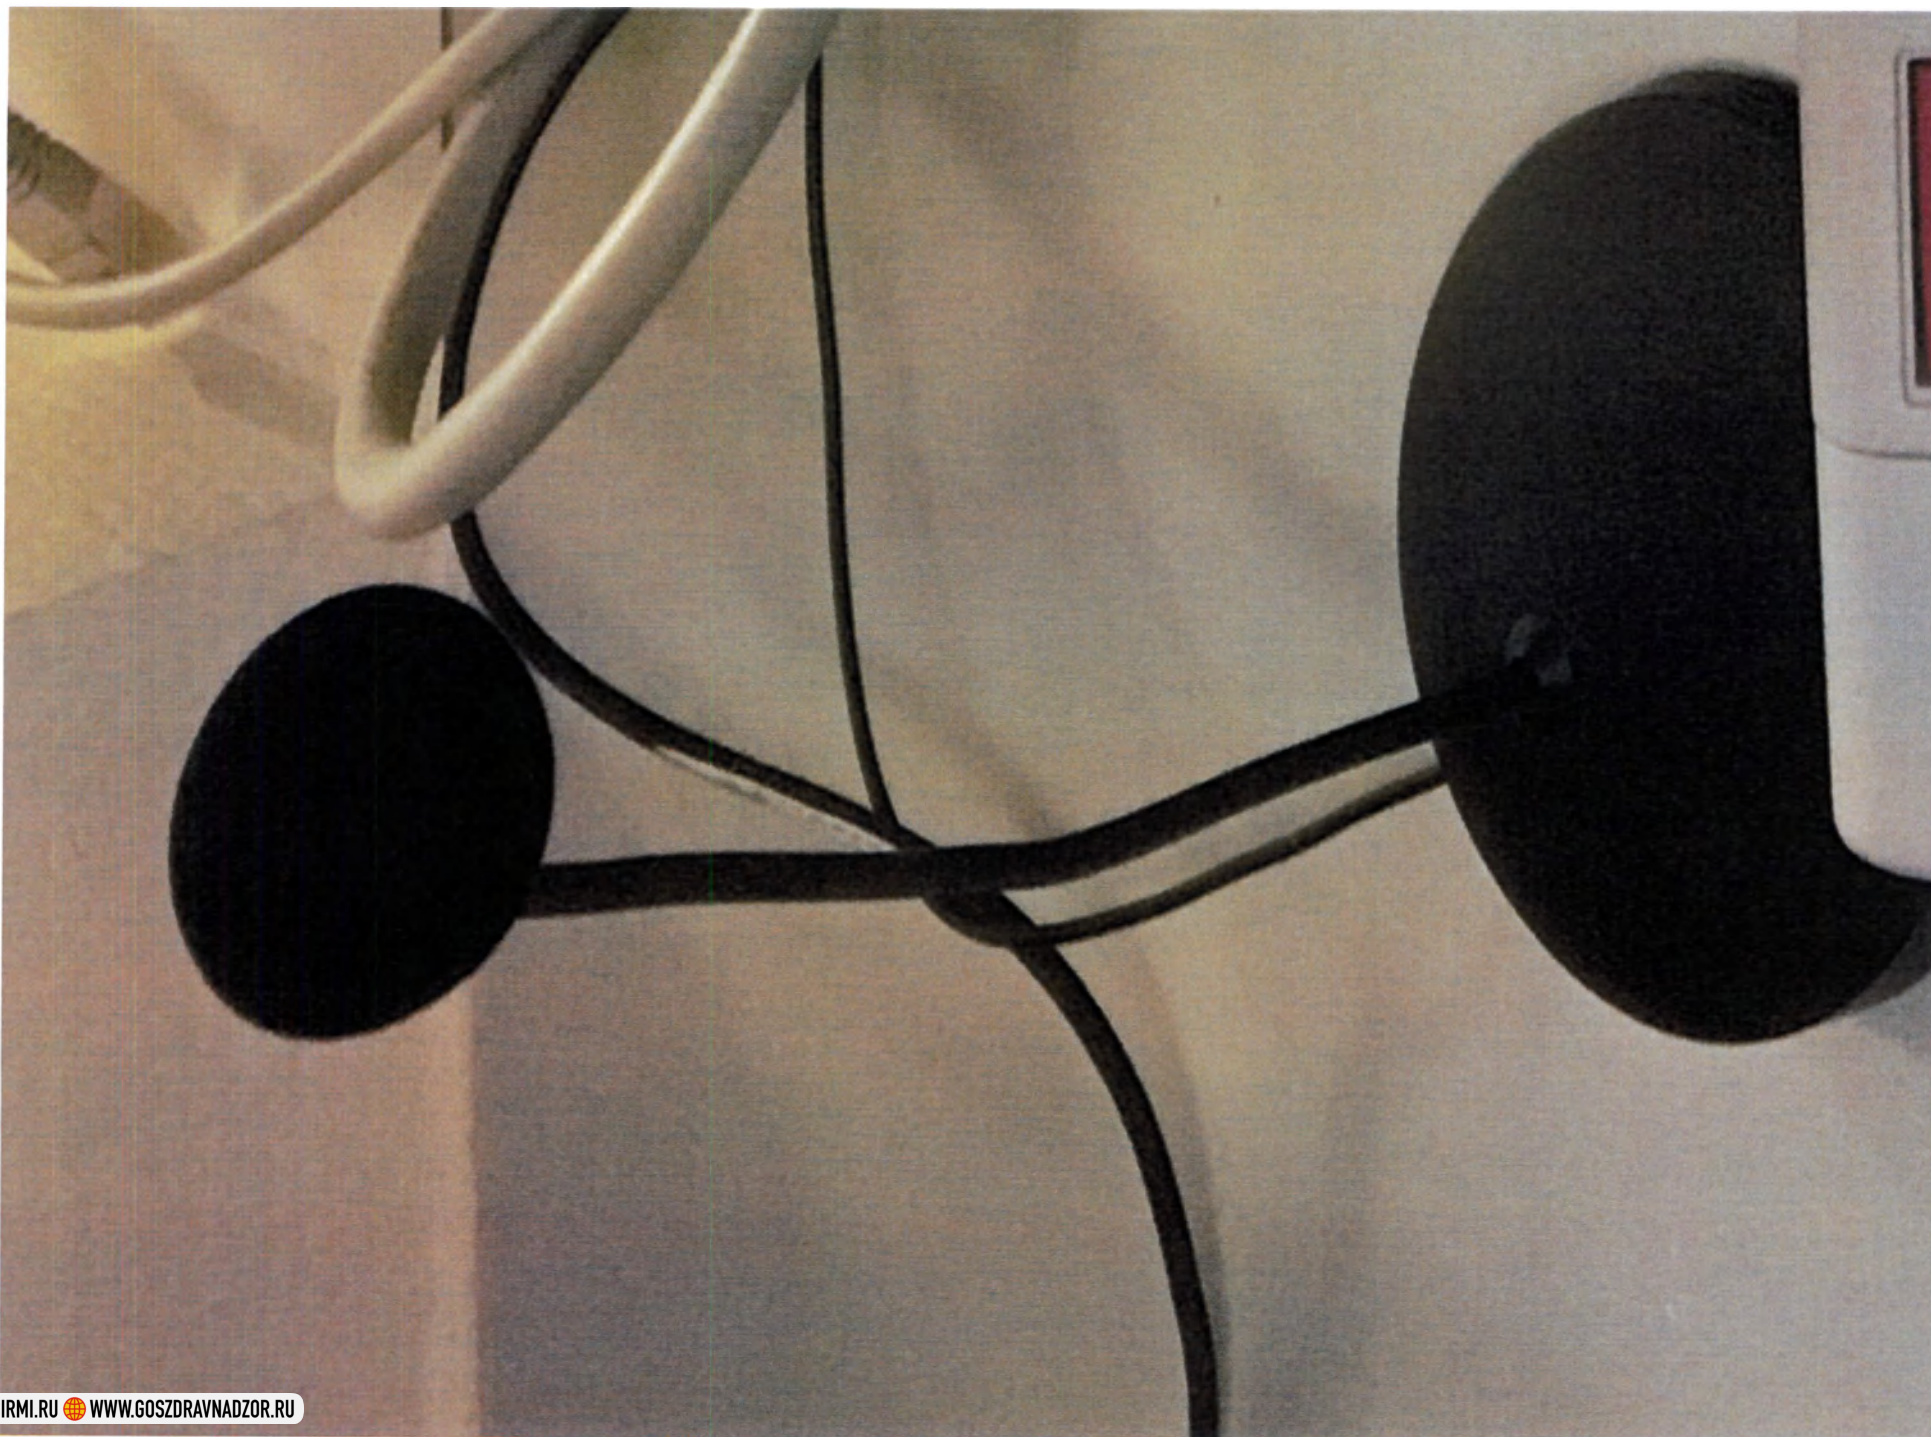


- Основное ПО системы.




4. Распределитель питания.





5. Комплект для позиционирования: - матрас для стола.

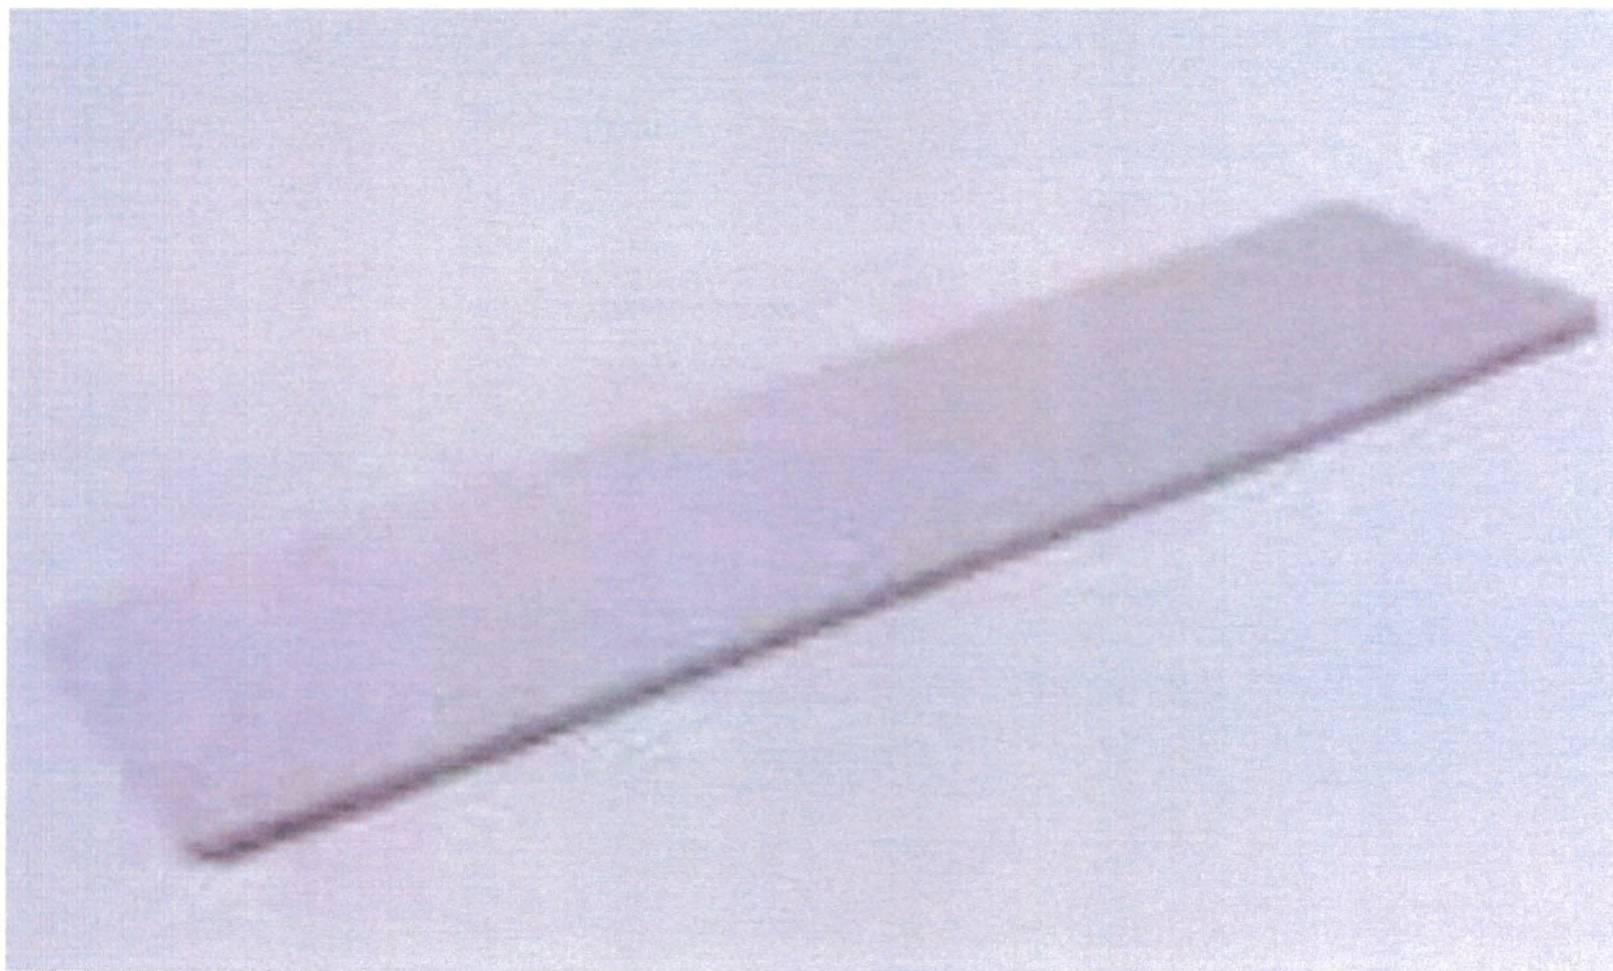


- фиксатор ремня для тела на деке стола, не менее 2 шт.

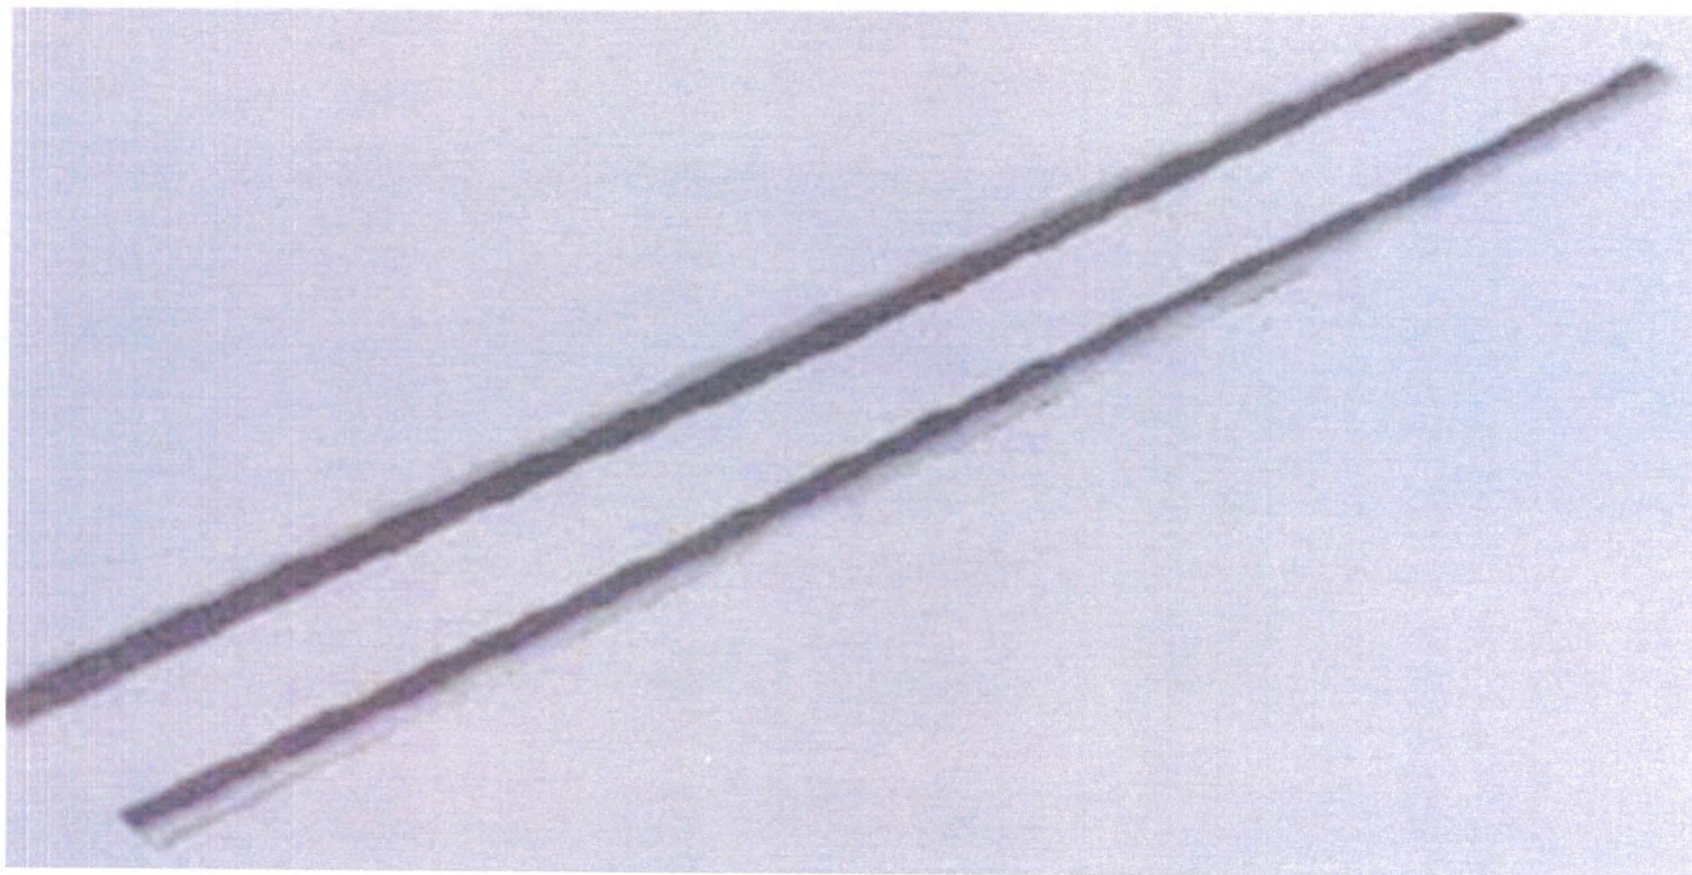


- фиксатор ремня (длинного типа, шириной 200 мм) для тела пациента, не менее 2 шт.

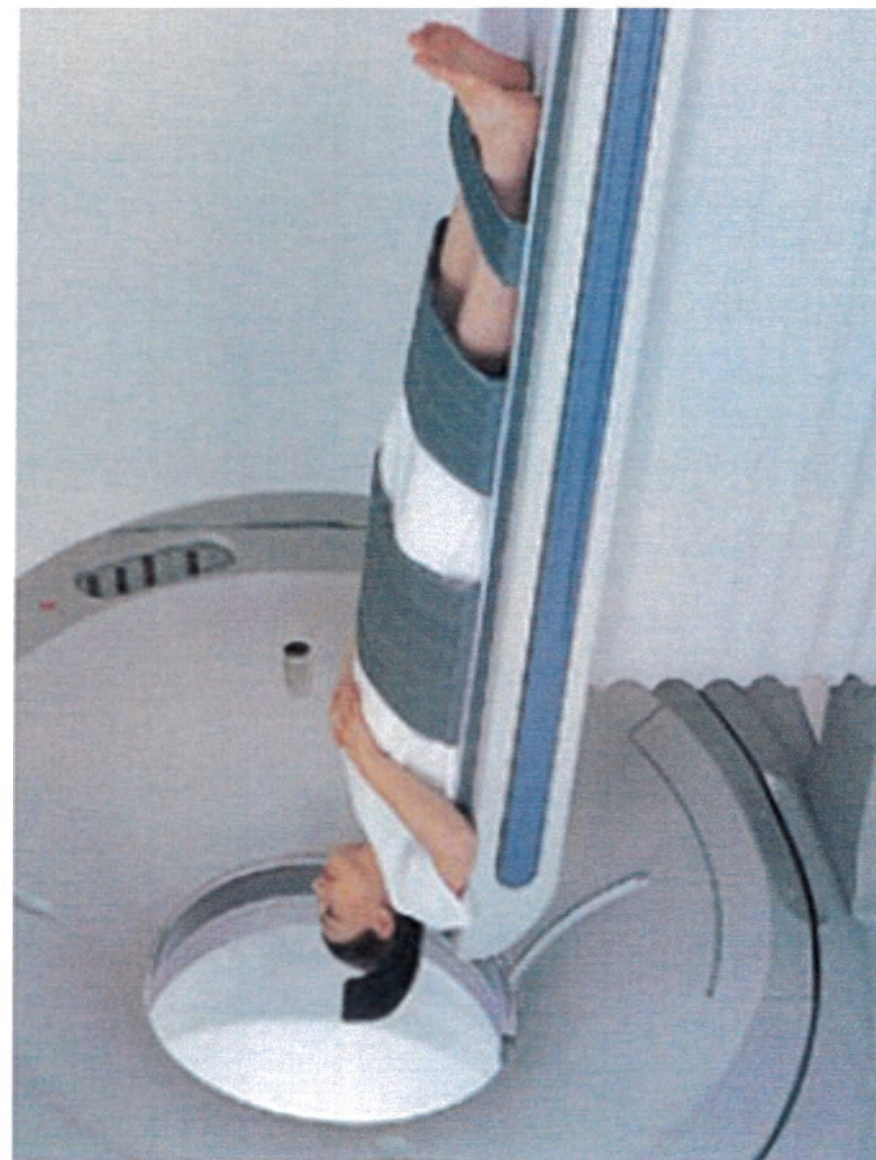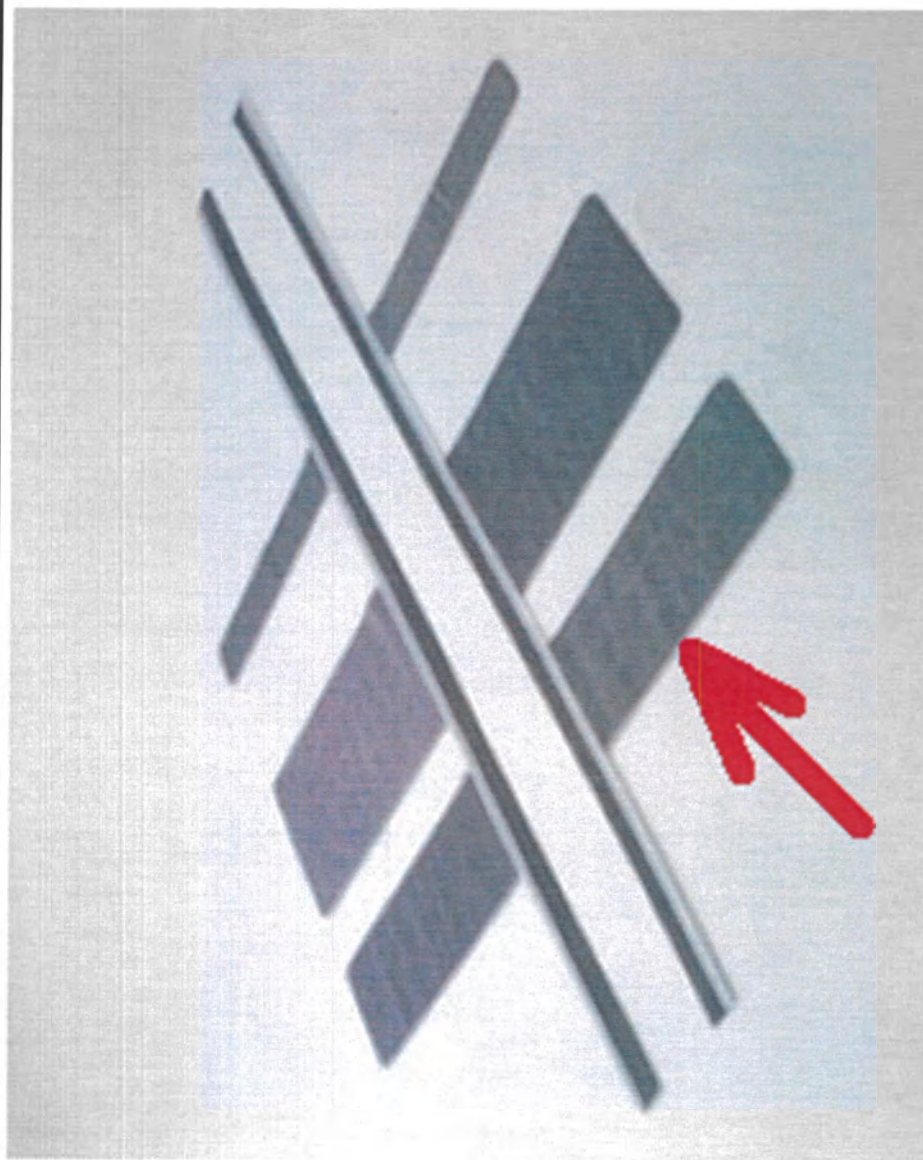


- фиксатор ремня (короткого типа, шириной 200 мм) для тела пациента, не менее 2 шт.

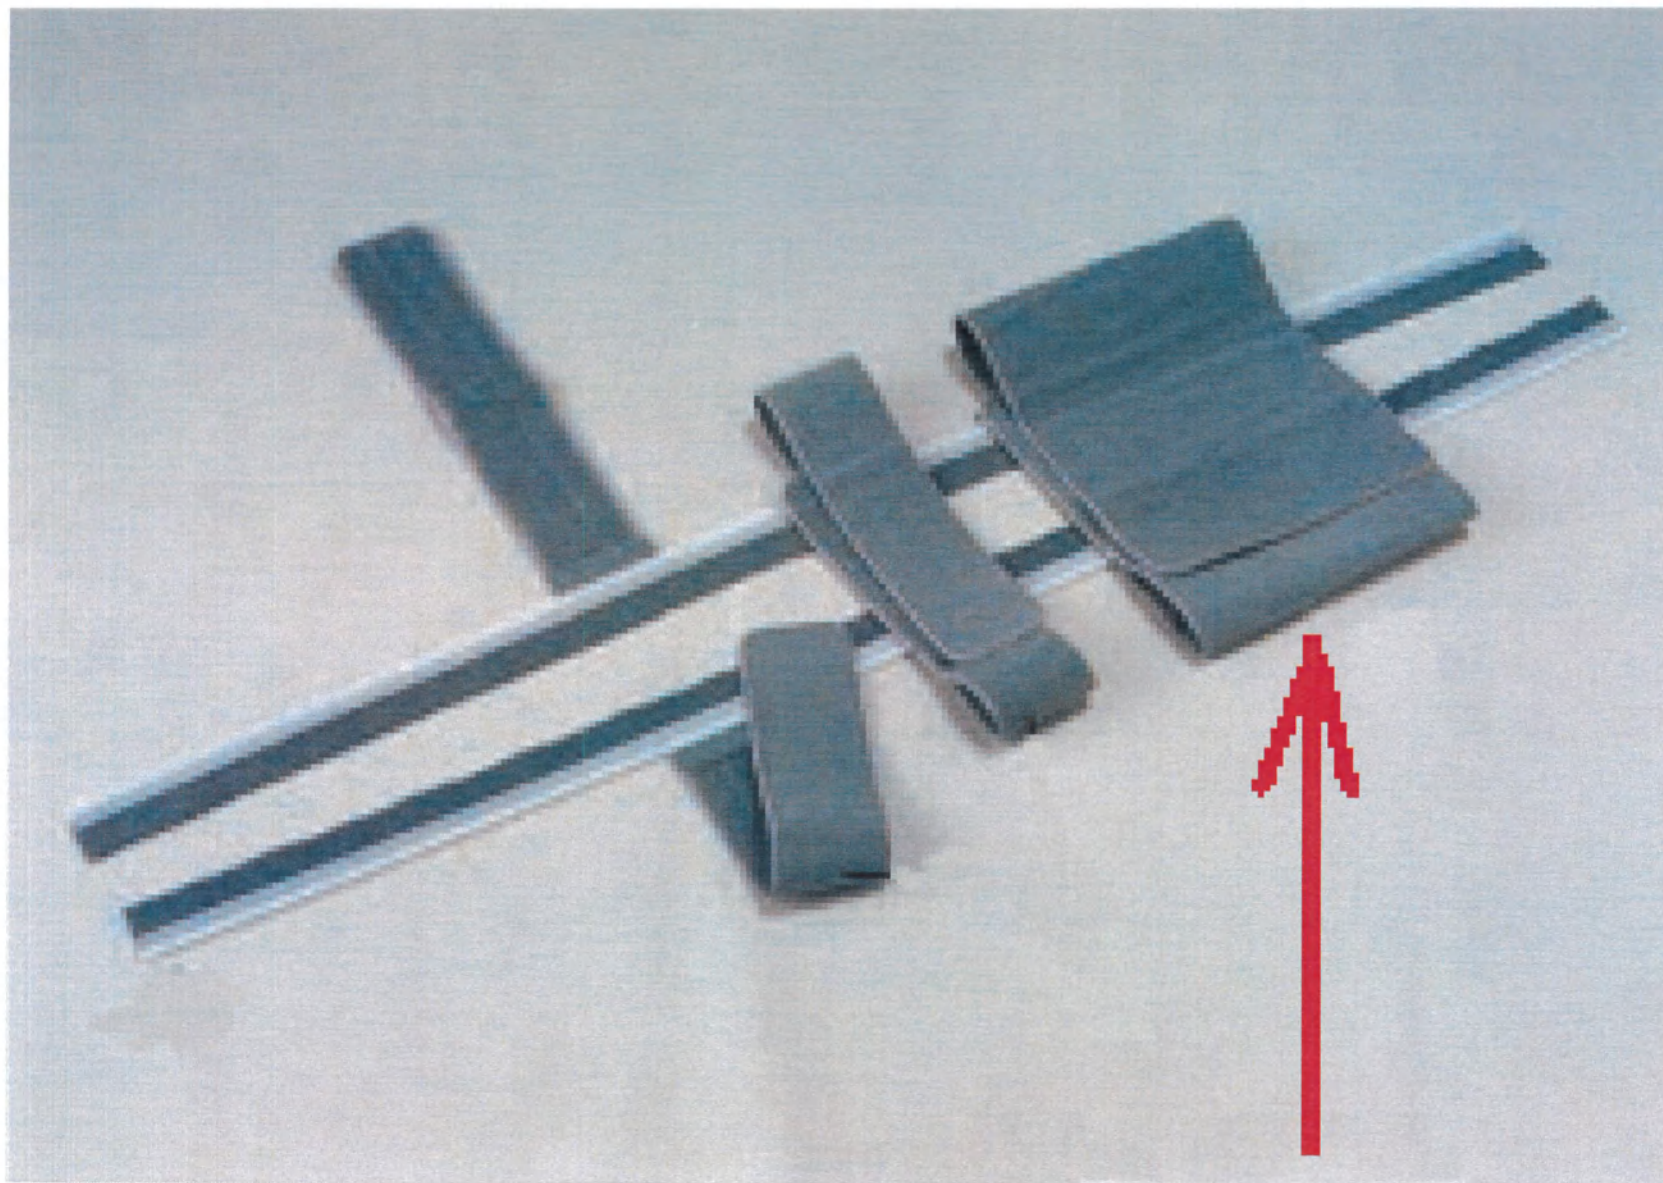


- фиксатор ремня (300 мм) для тела пациента, не менее 2 шт.

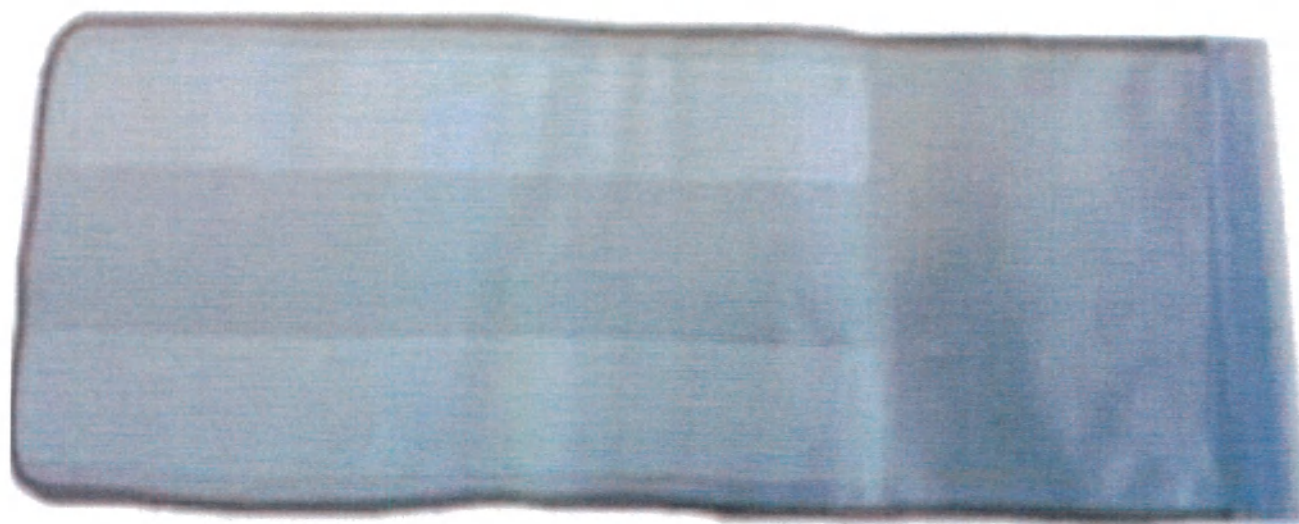

- подставка под голову.

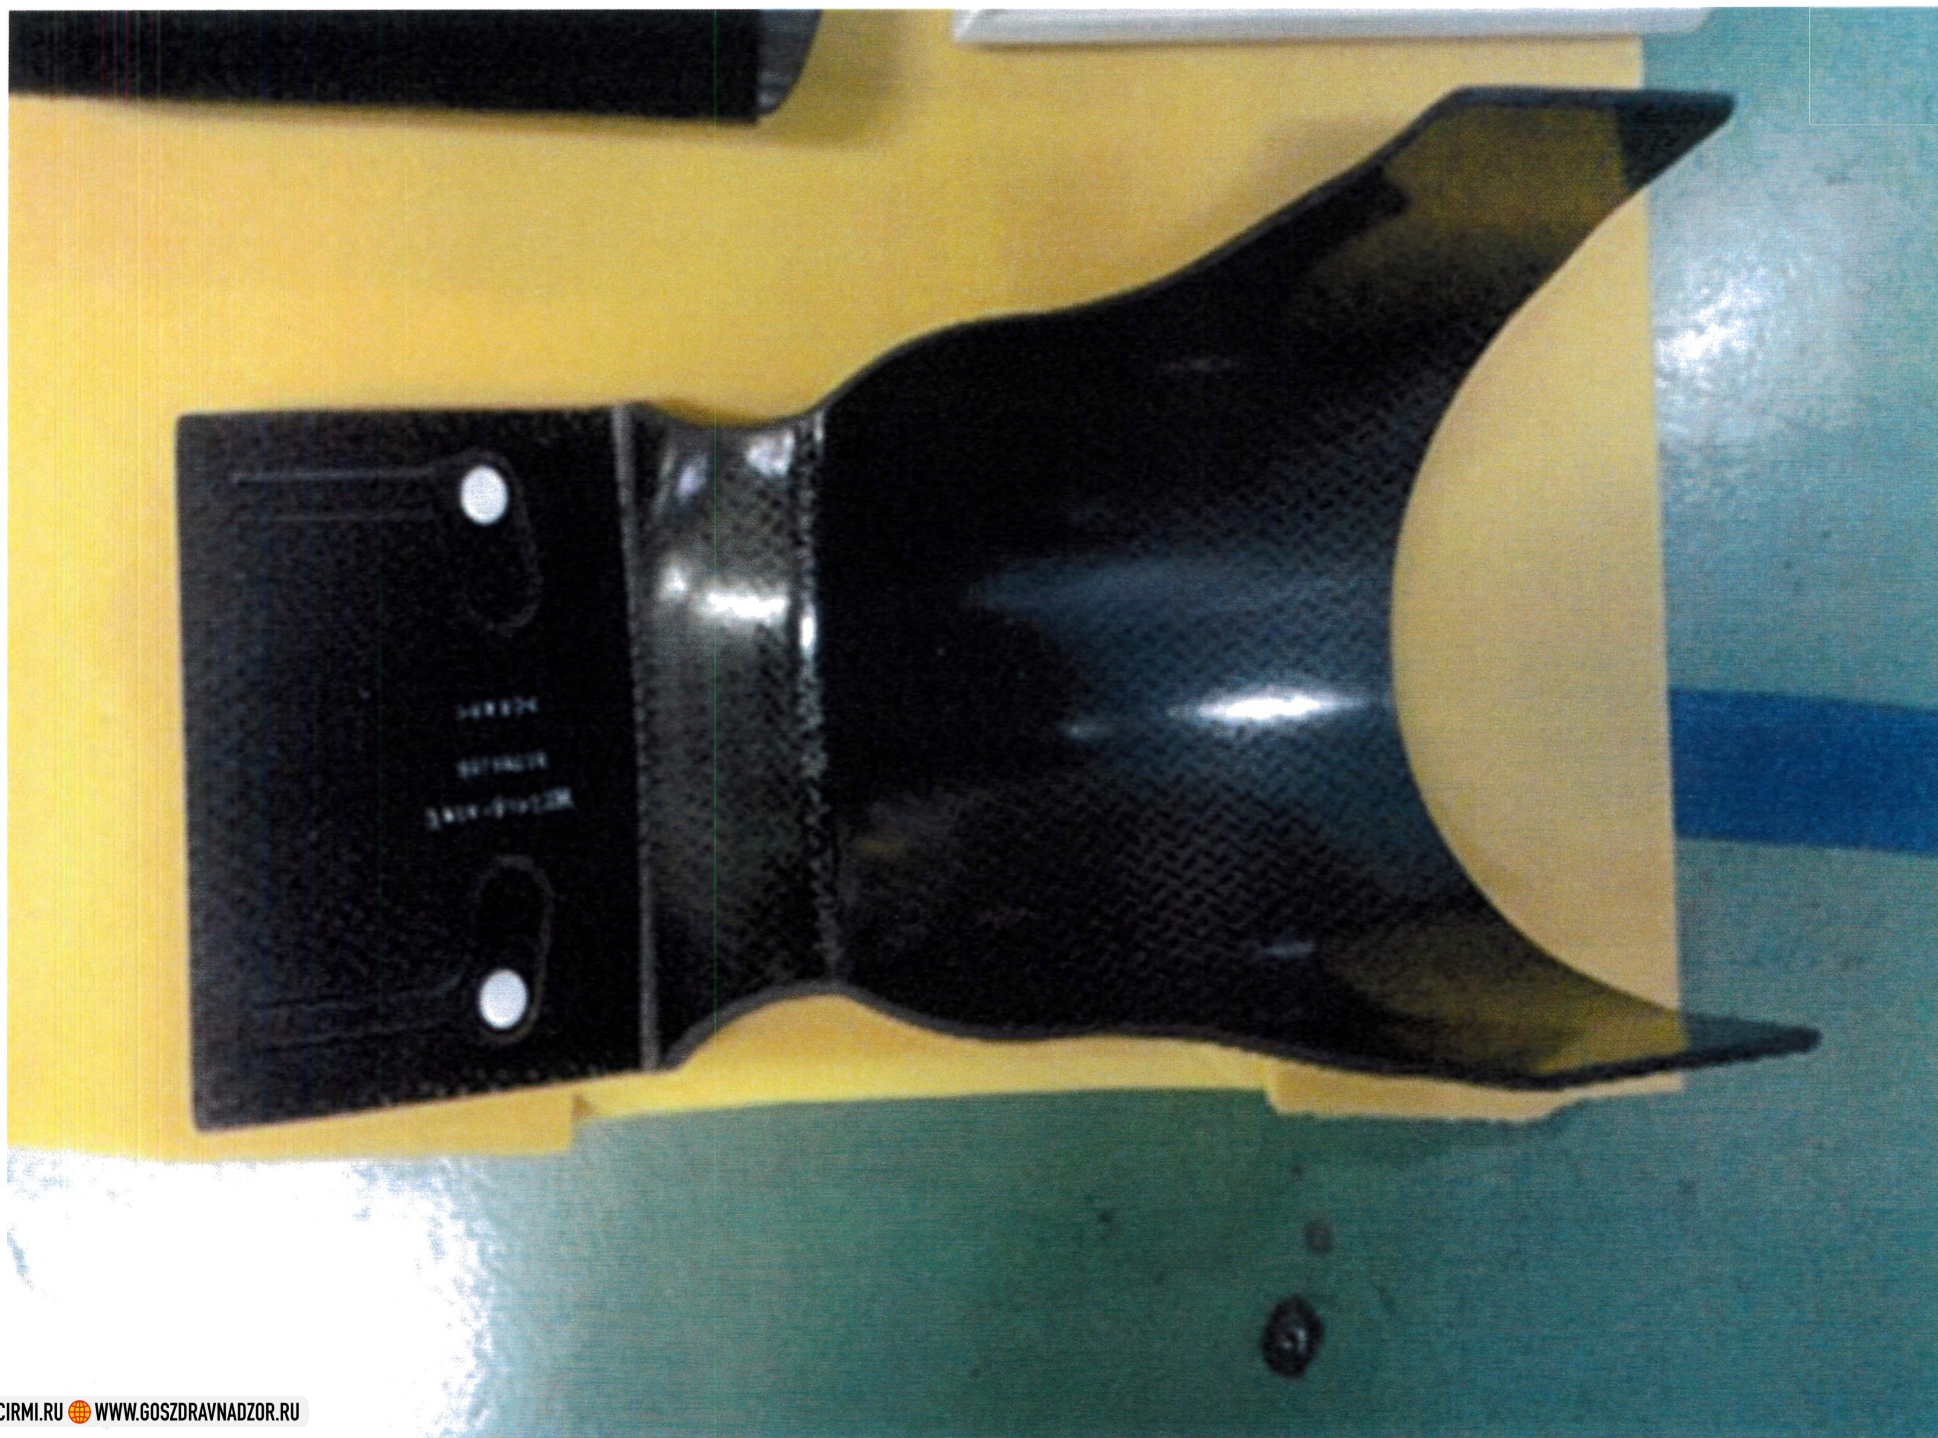

- подушка под голову.

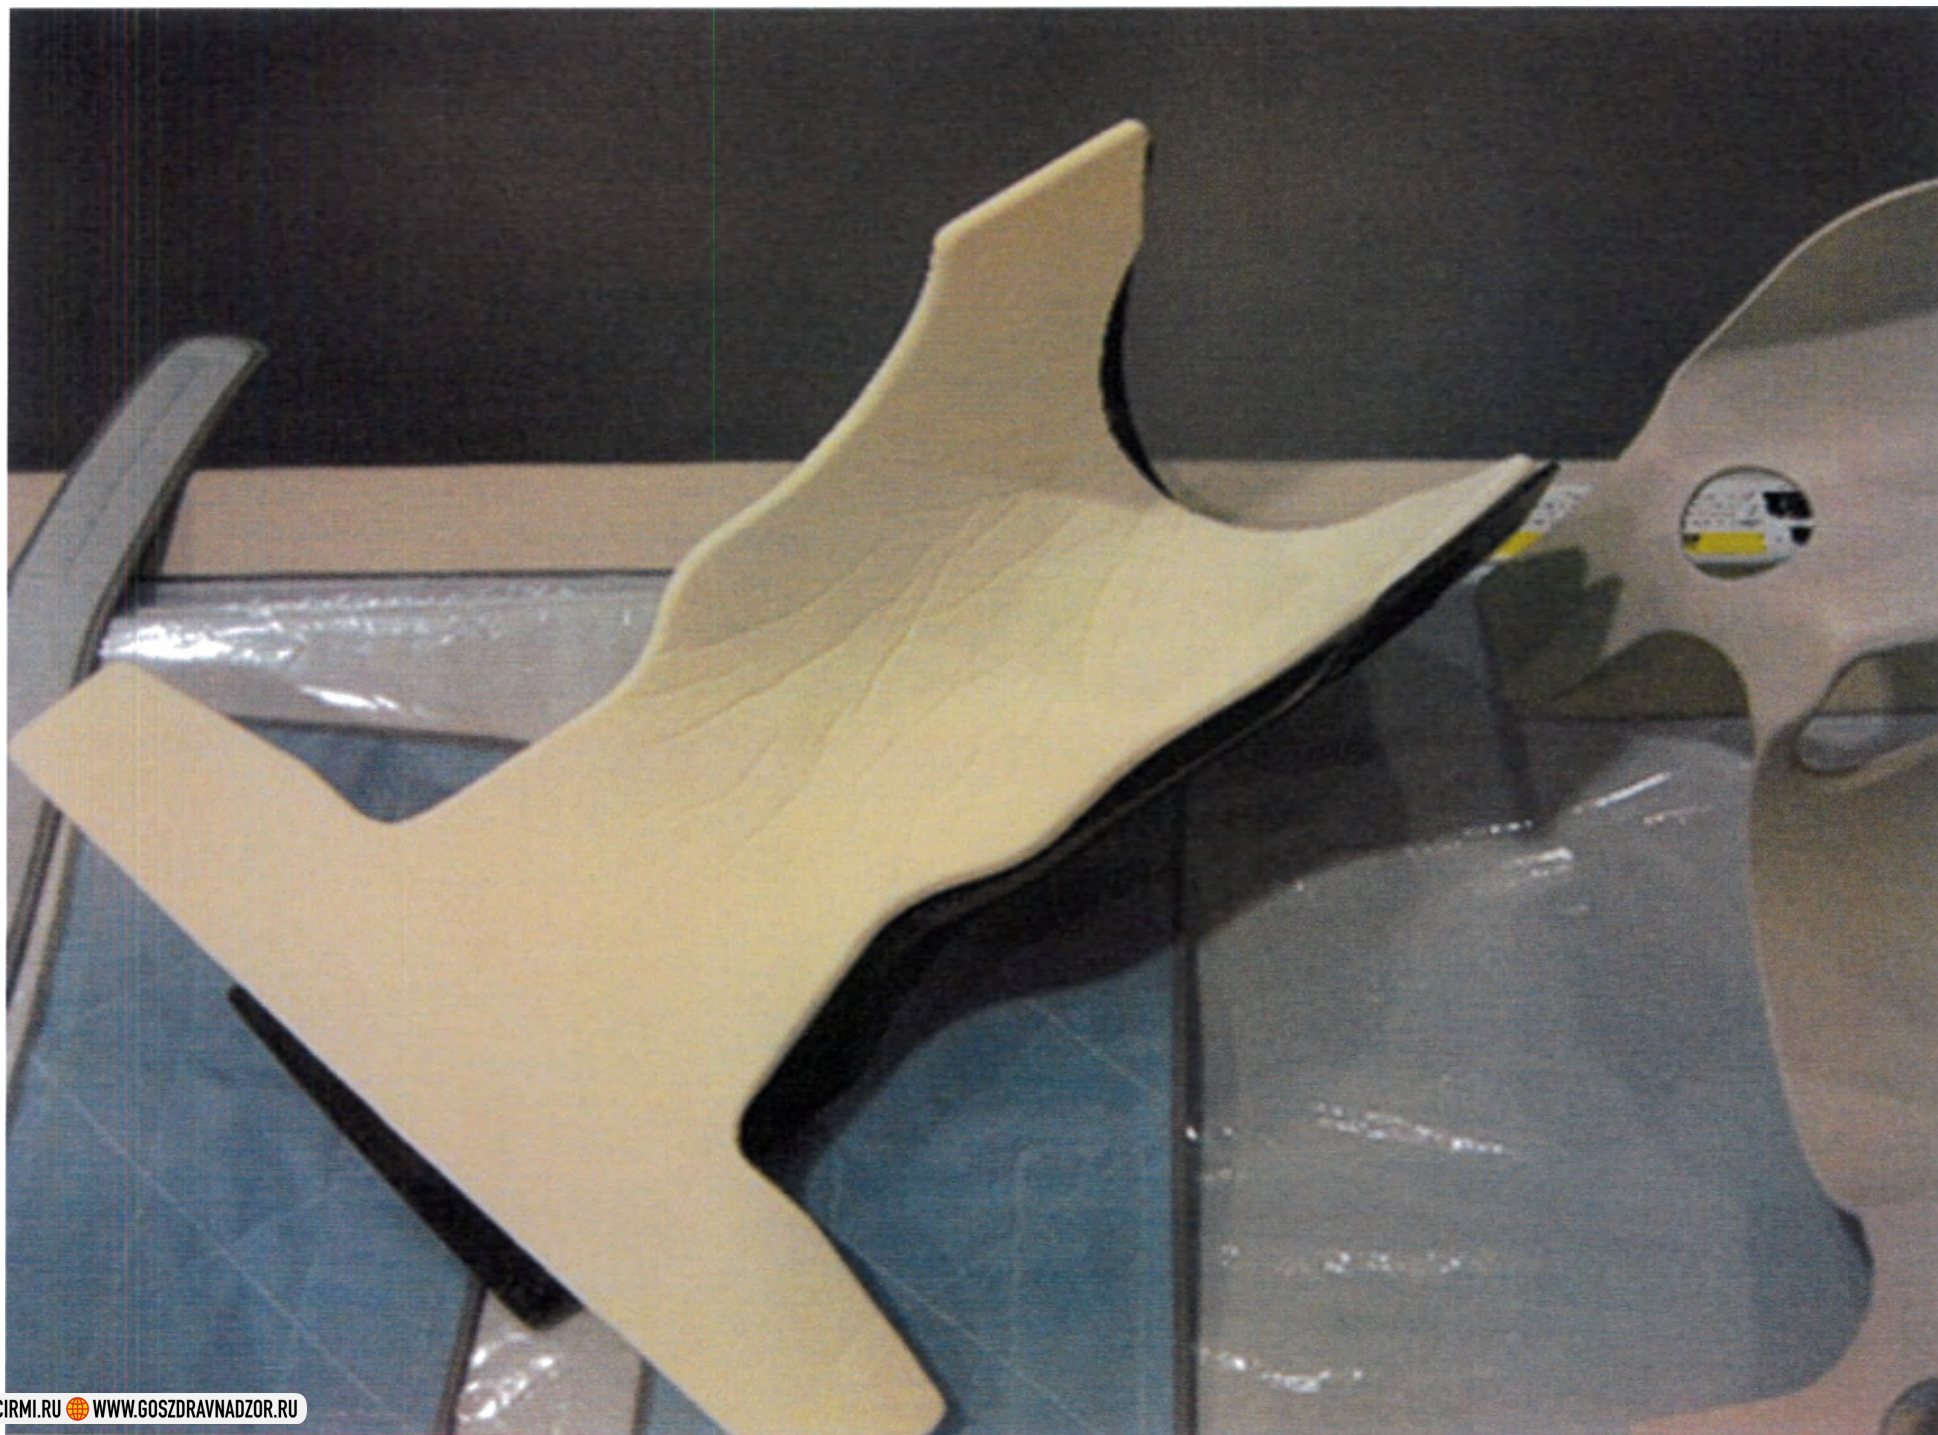


- клиновидная подушка.




- фиксатор головы.


22

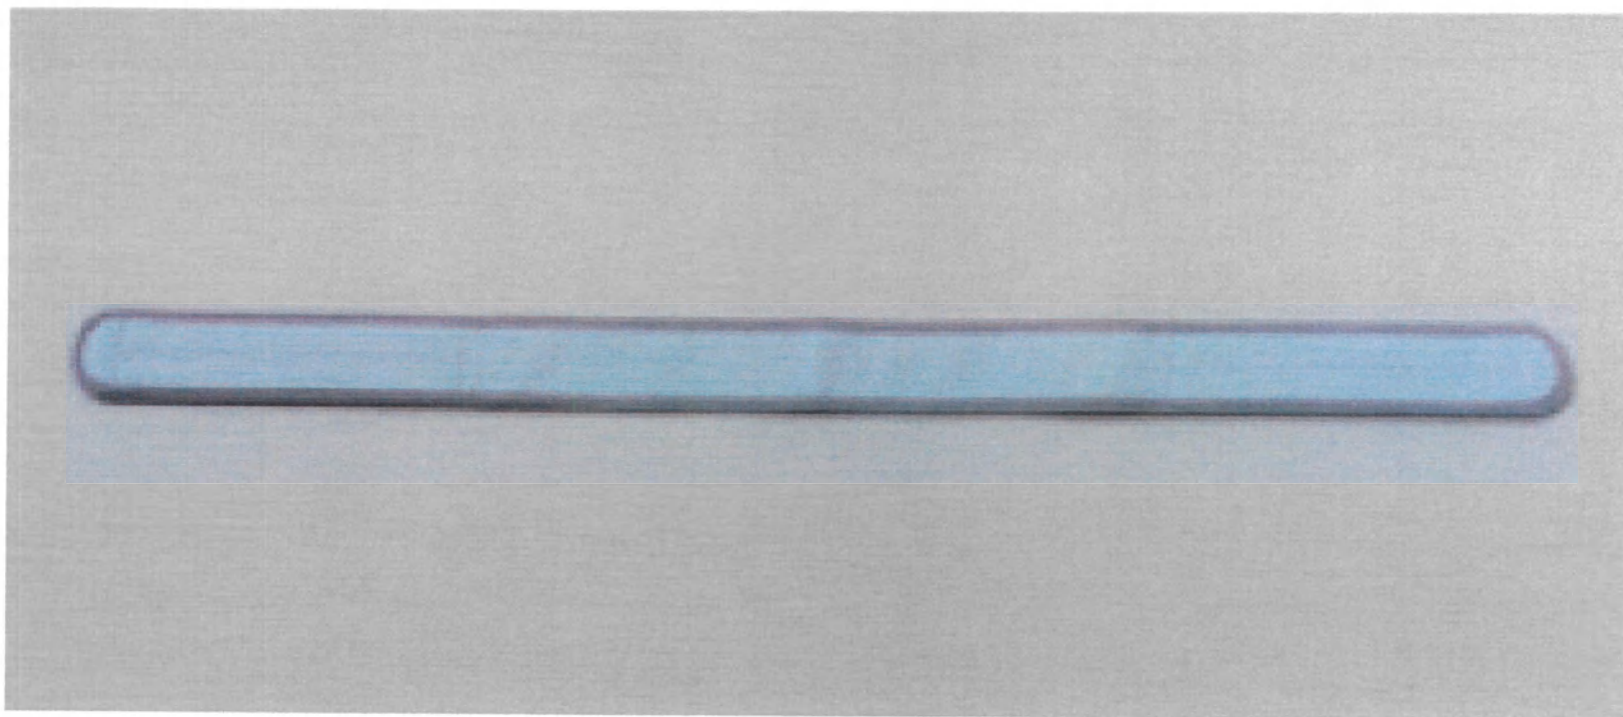


- фиксатор подбородка.

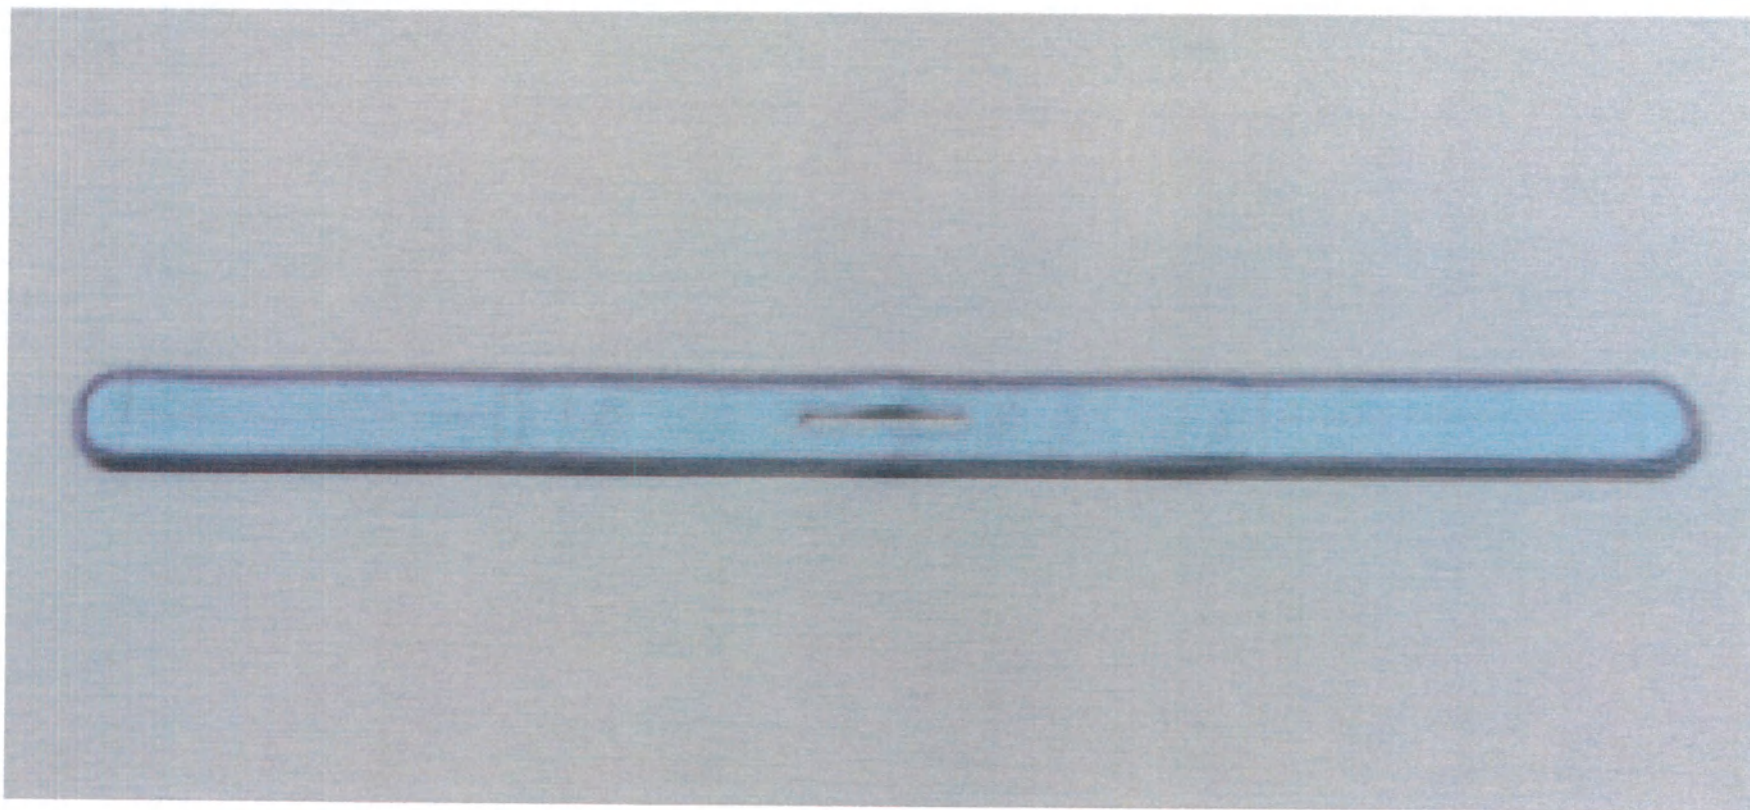


- адаптер.

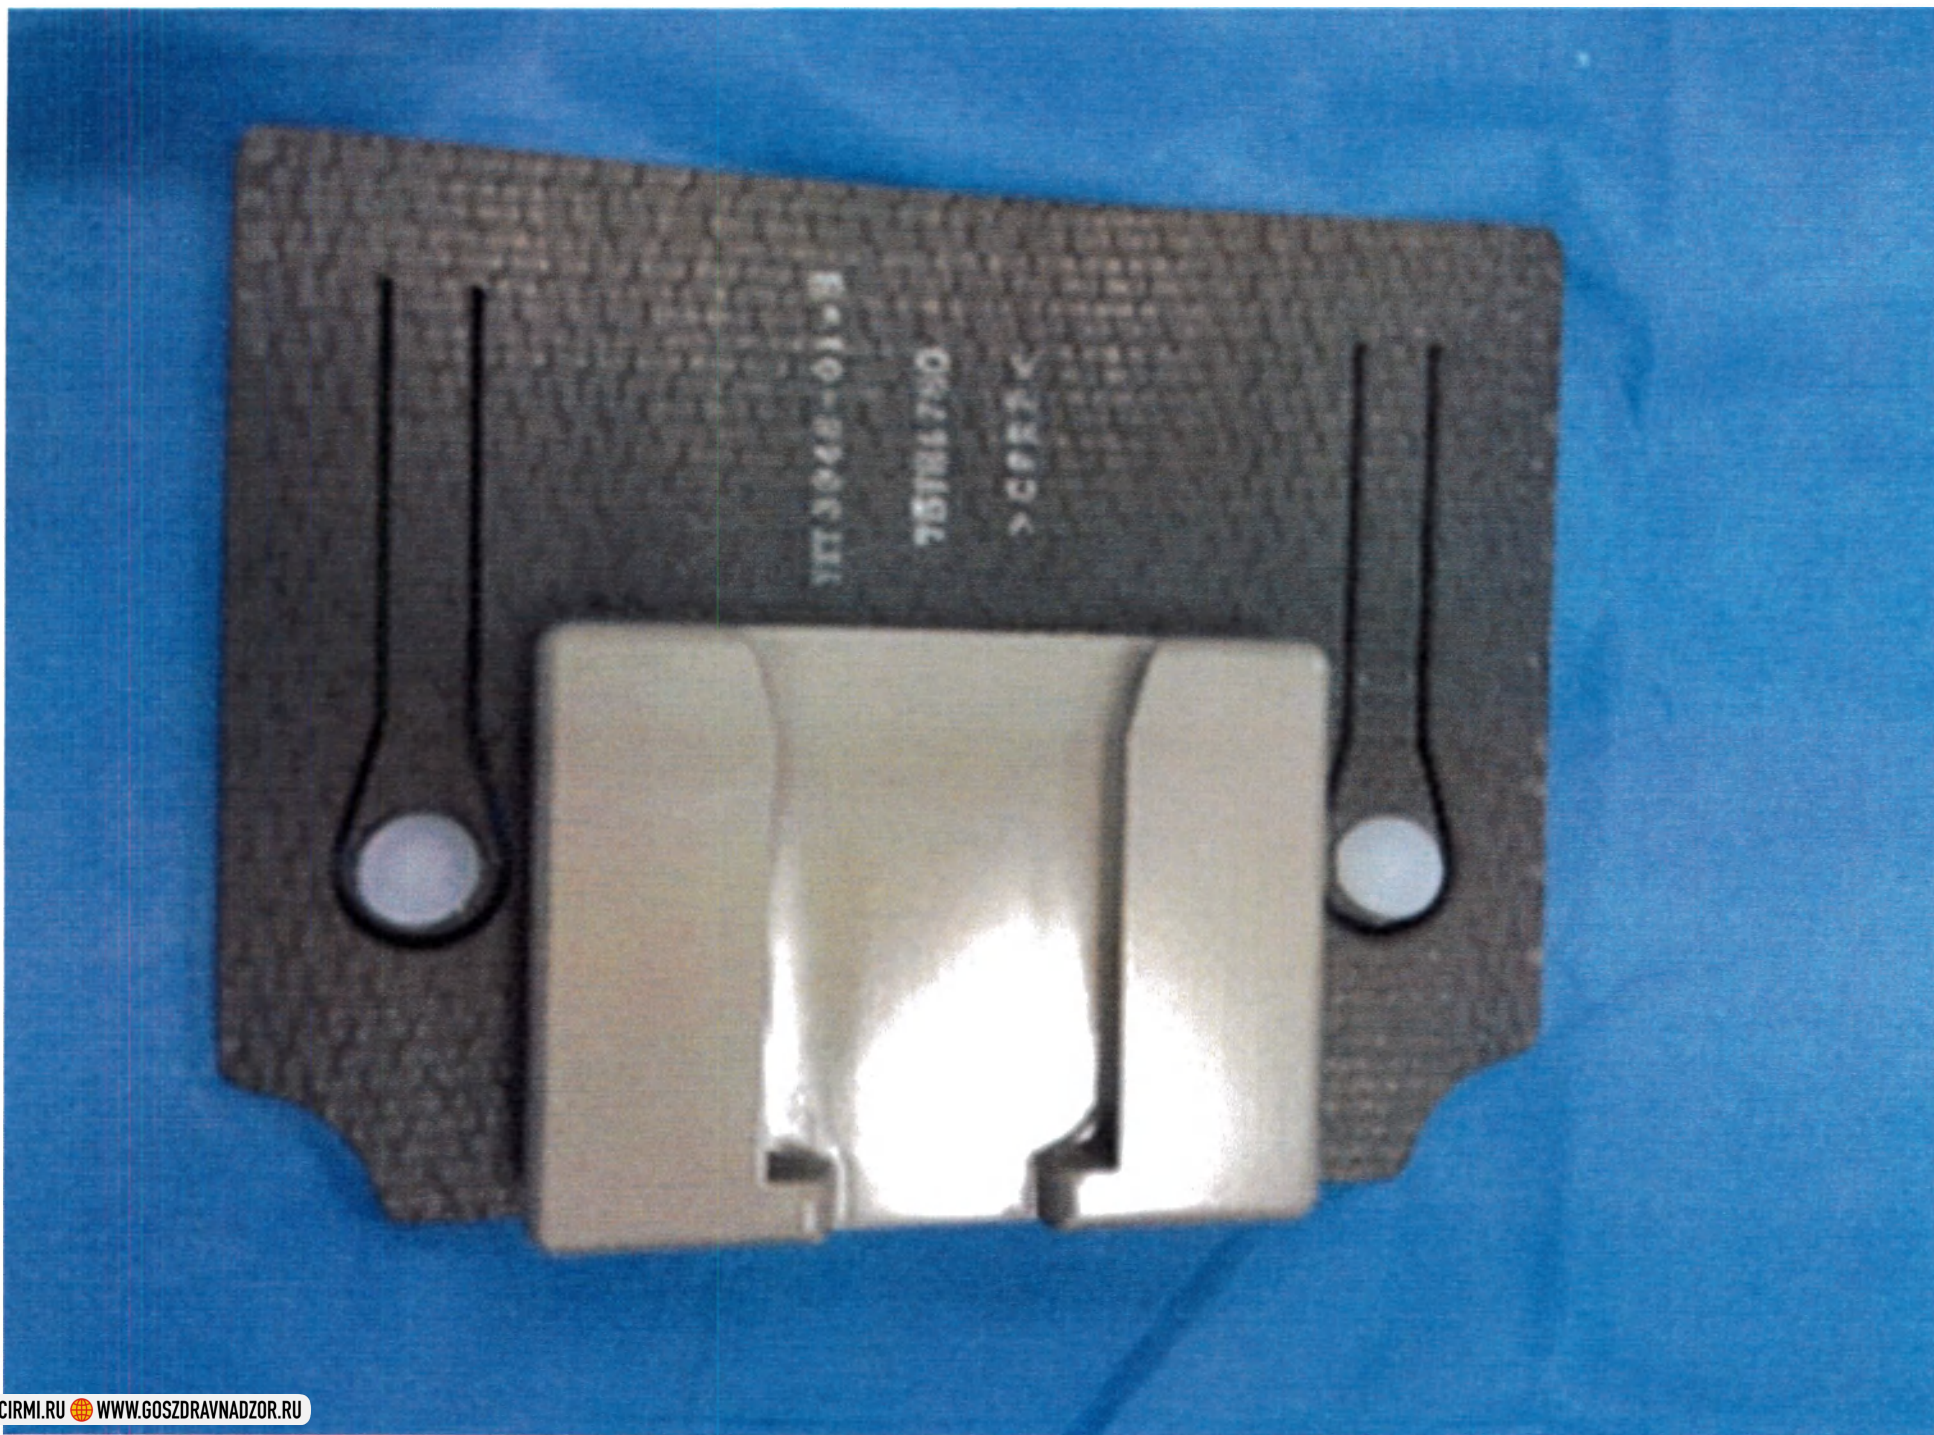


- держатель фантома.

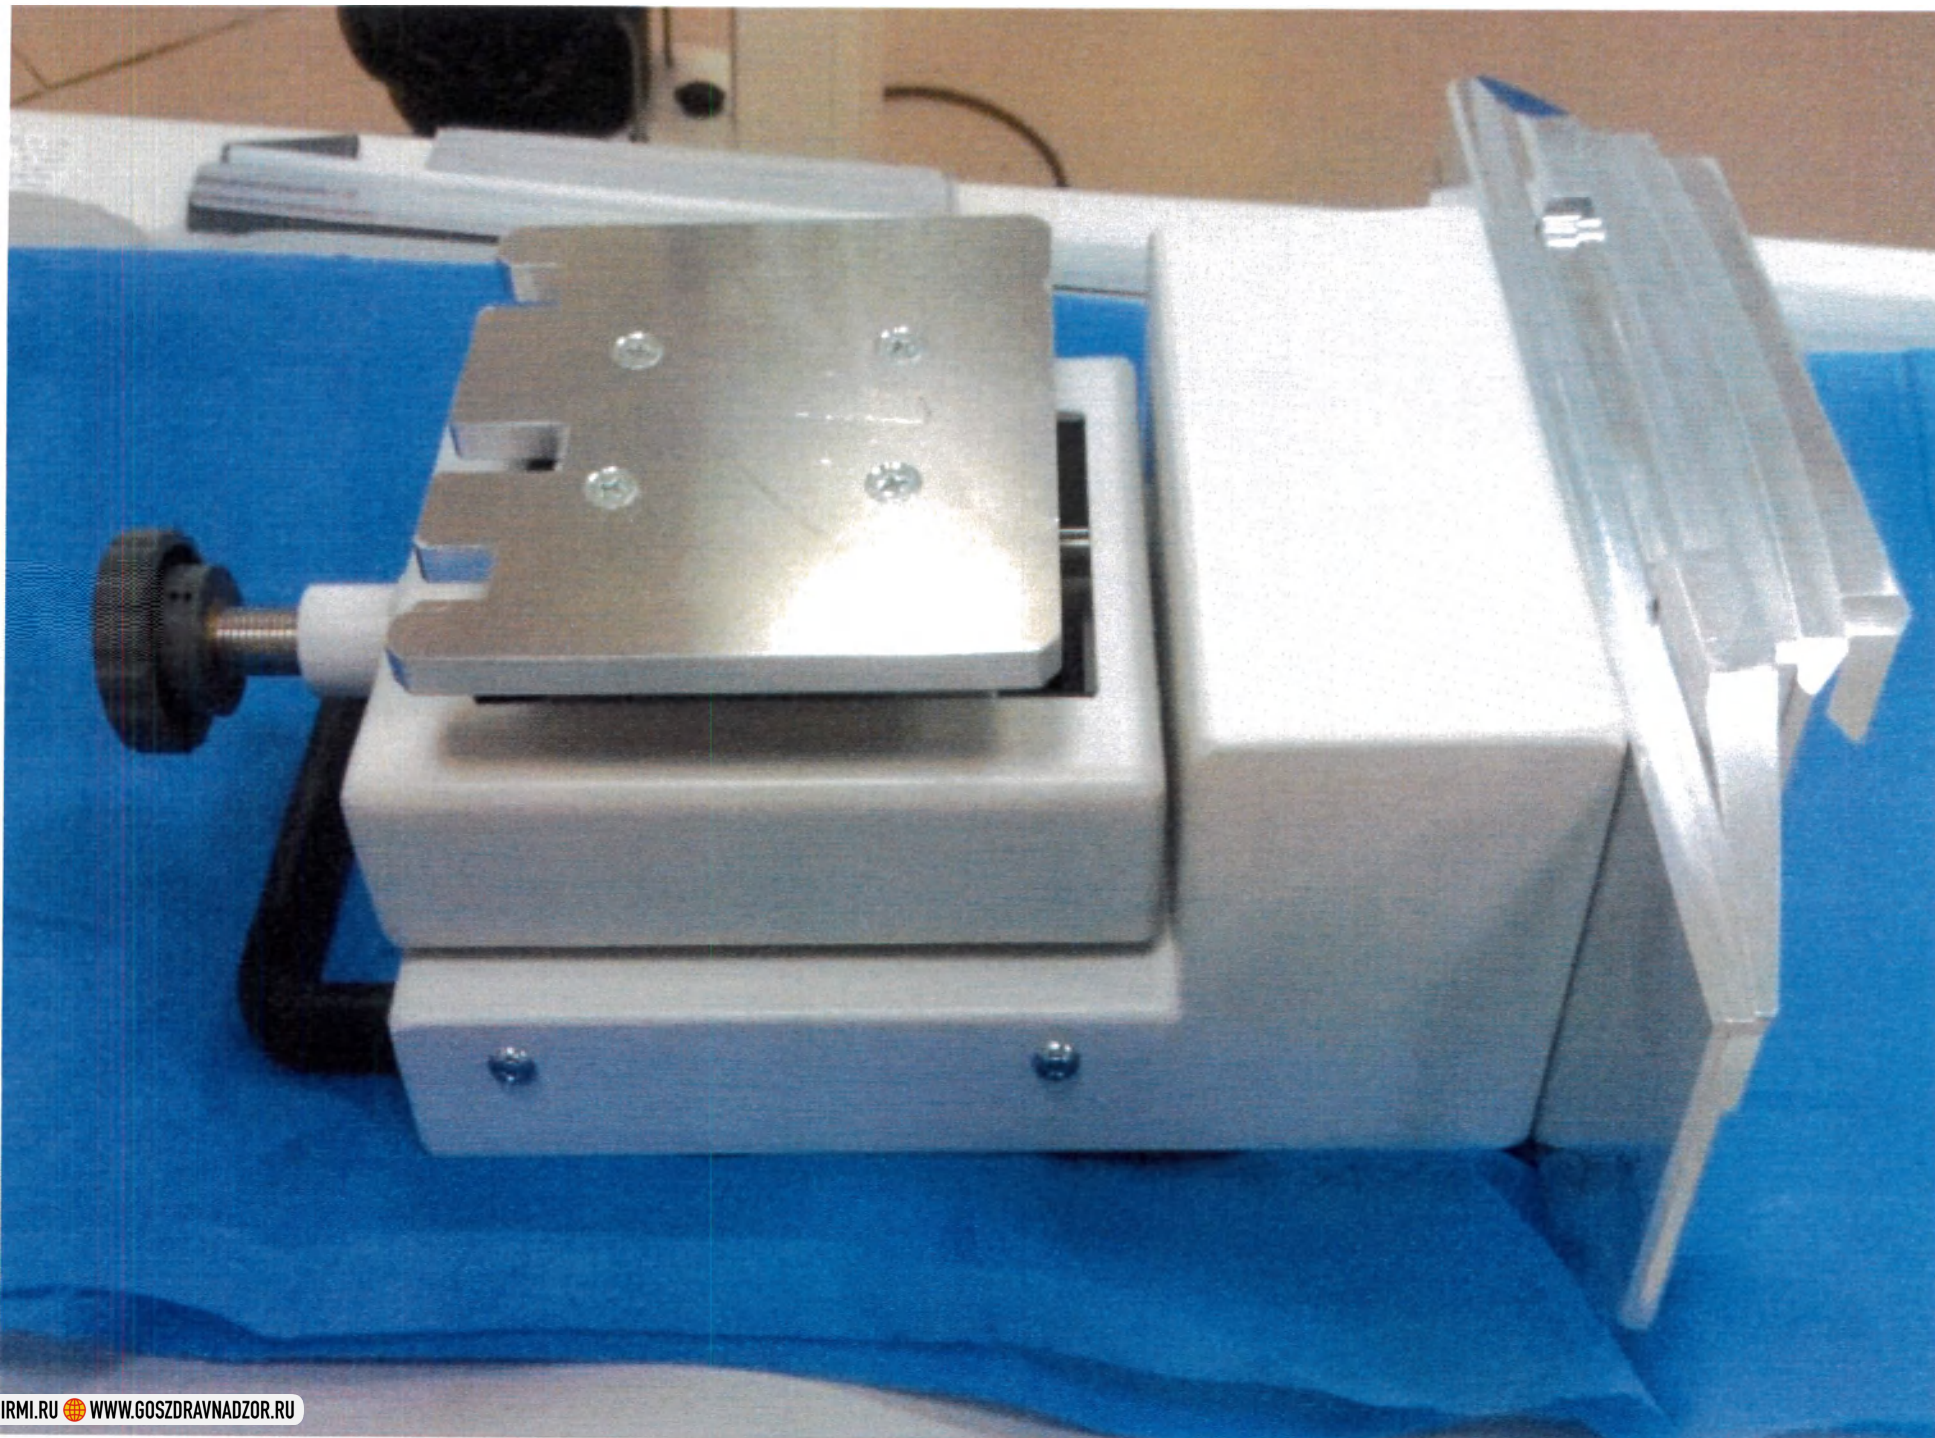


- фантомы, не менее 4 шт.

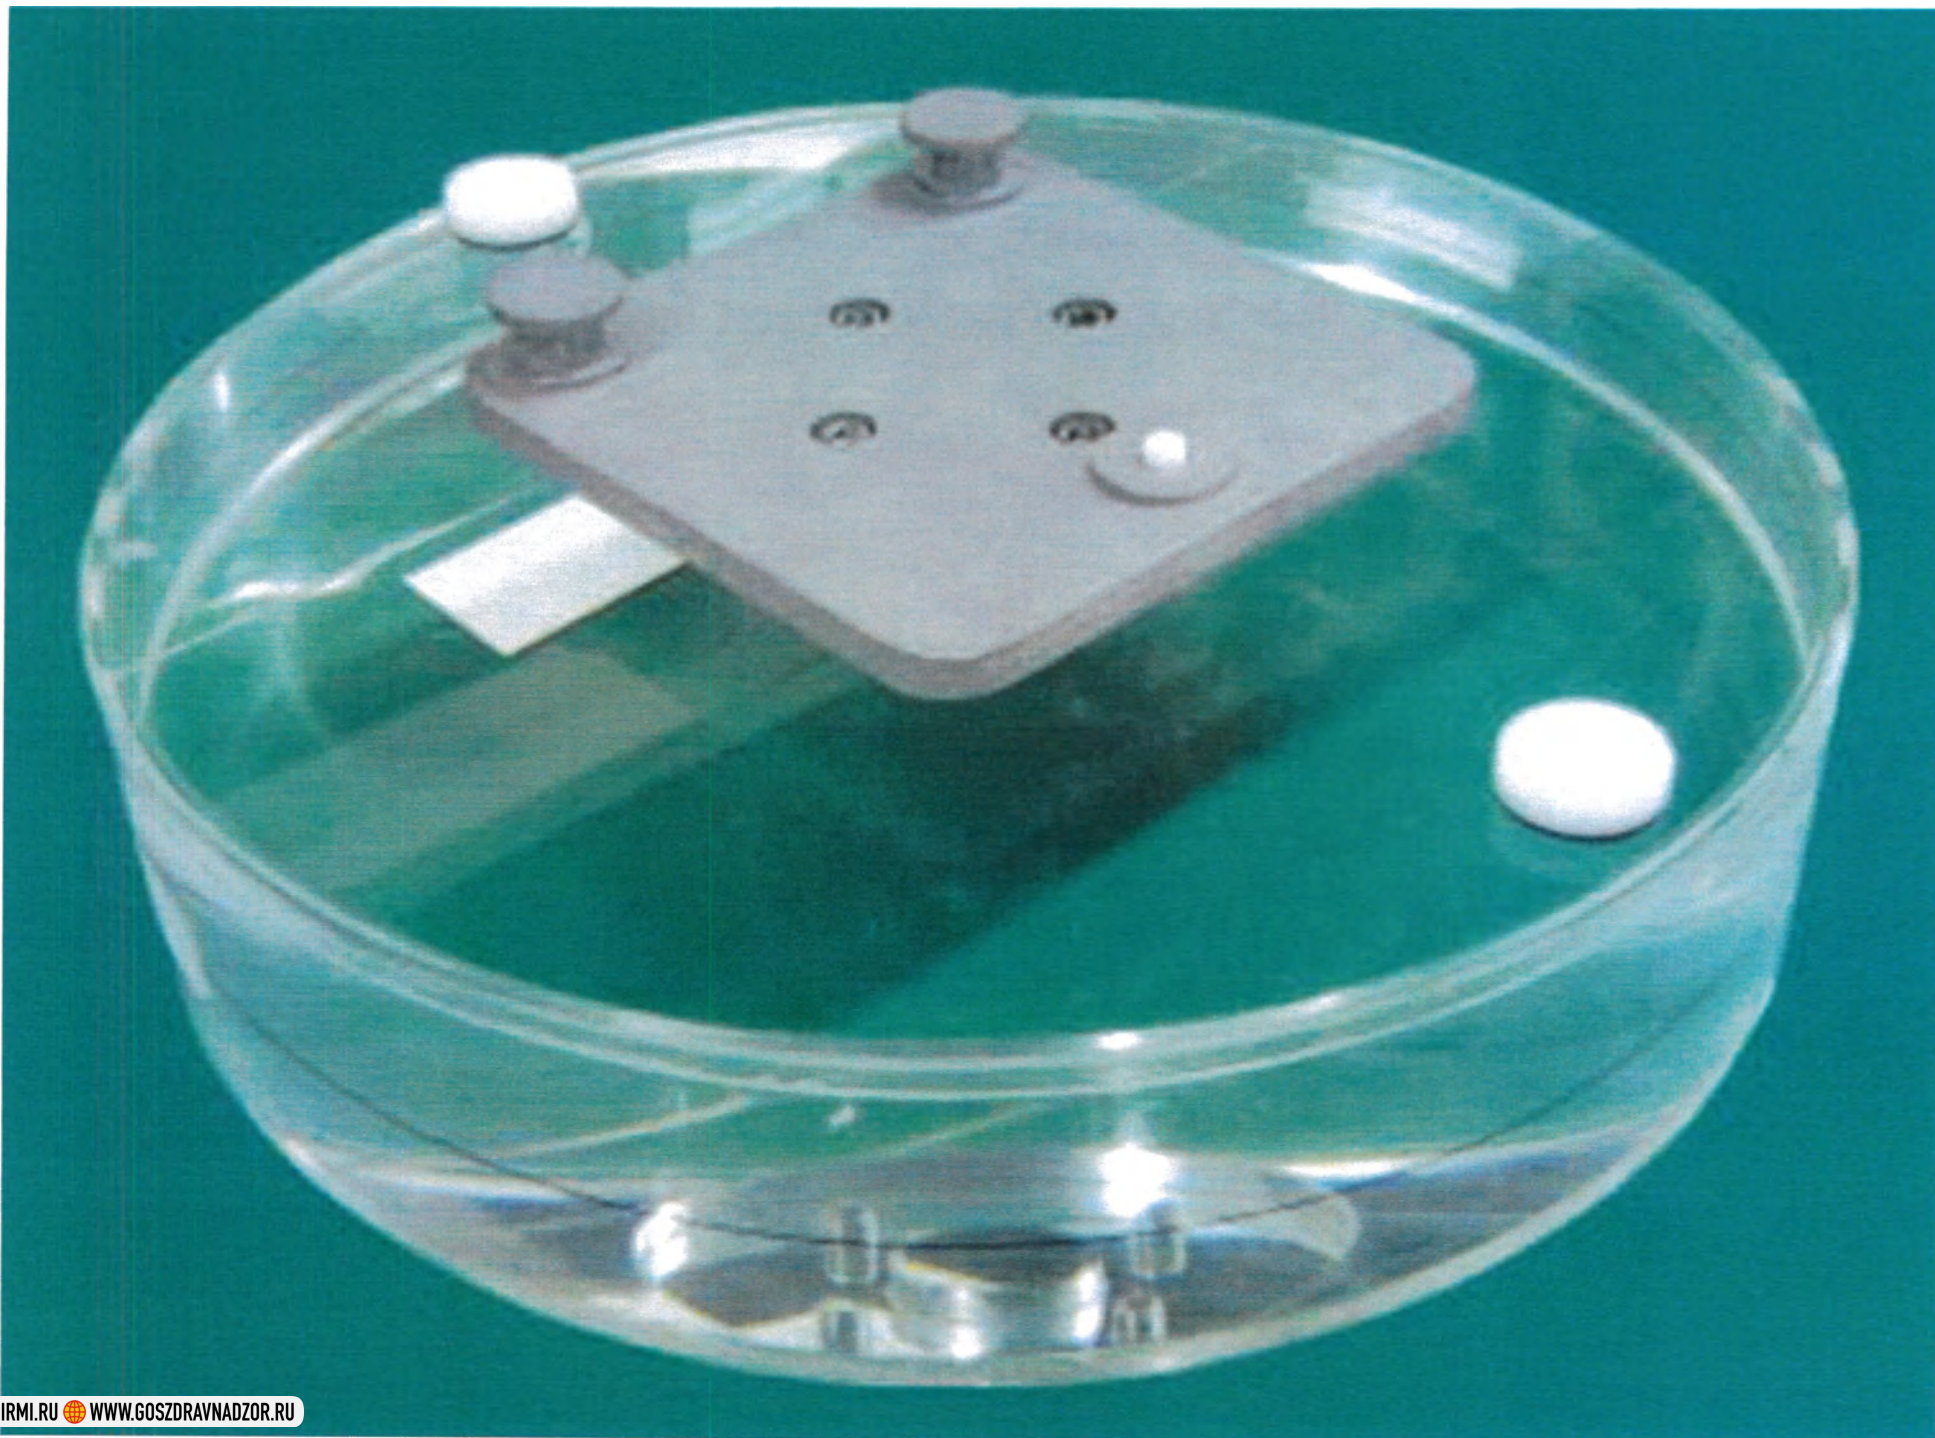

- стойка для внутривенных вливаний (при необходимости).

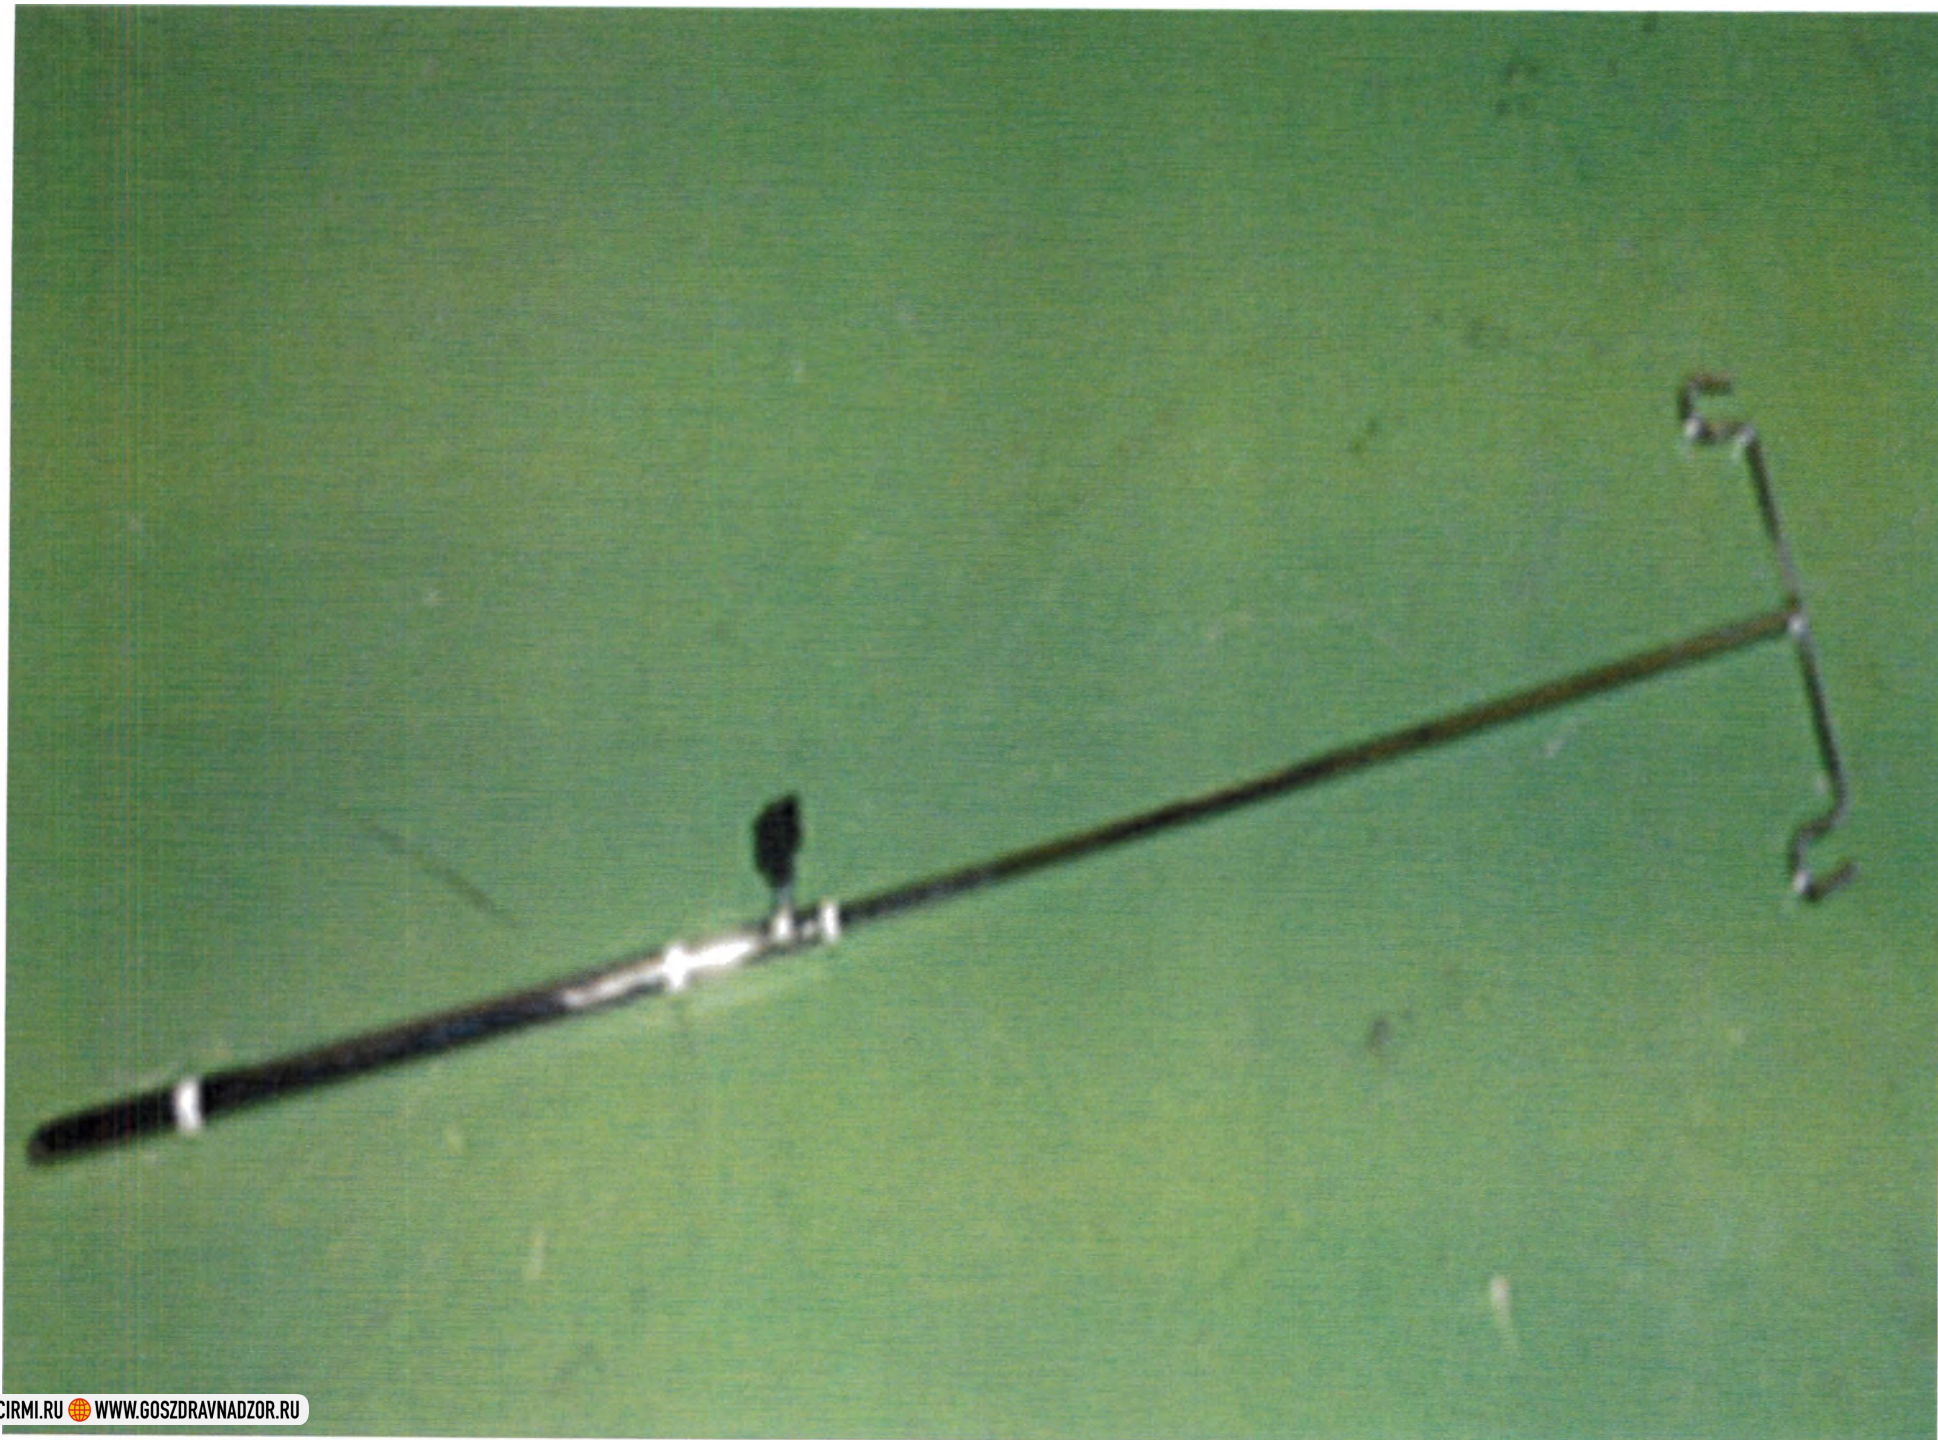


6. Трубка рентгеновская теплоёмкостью 5,0 млн ТЕ, производства "Canon electron tubes & devices co. Ltd.", Япония.

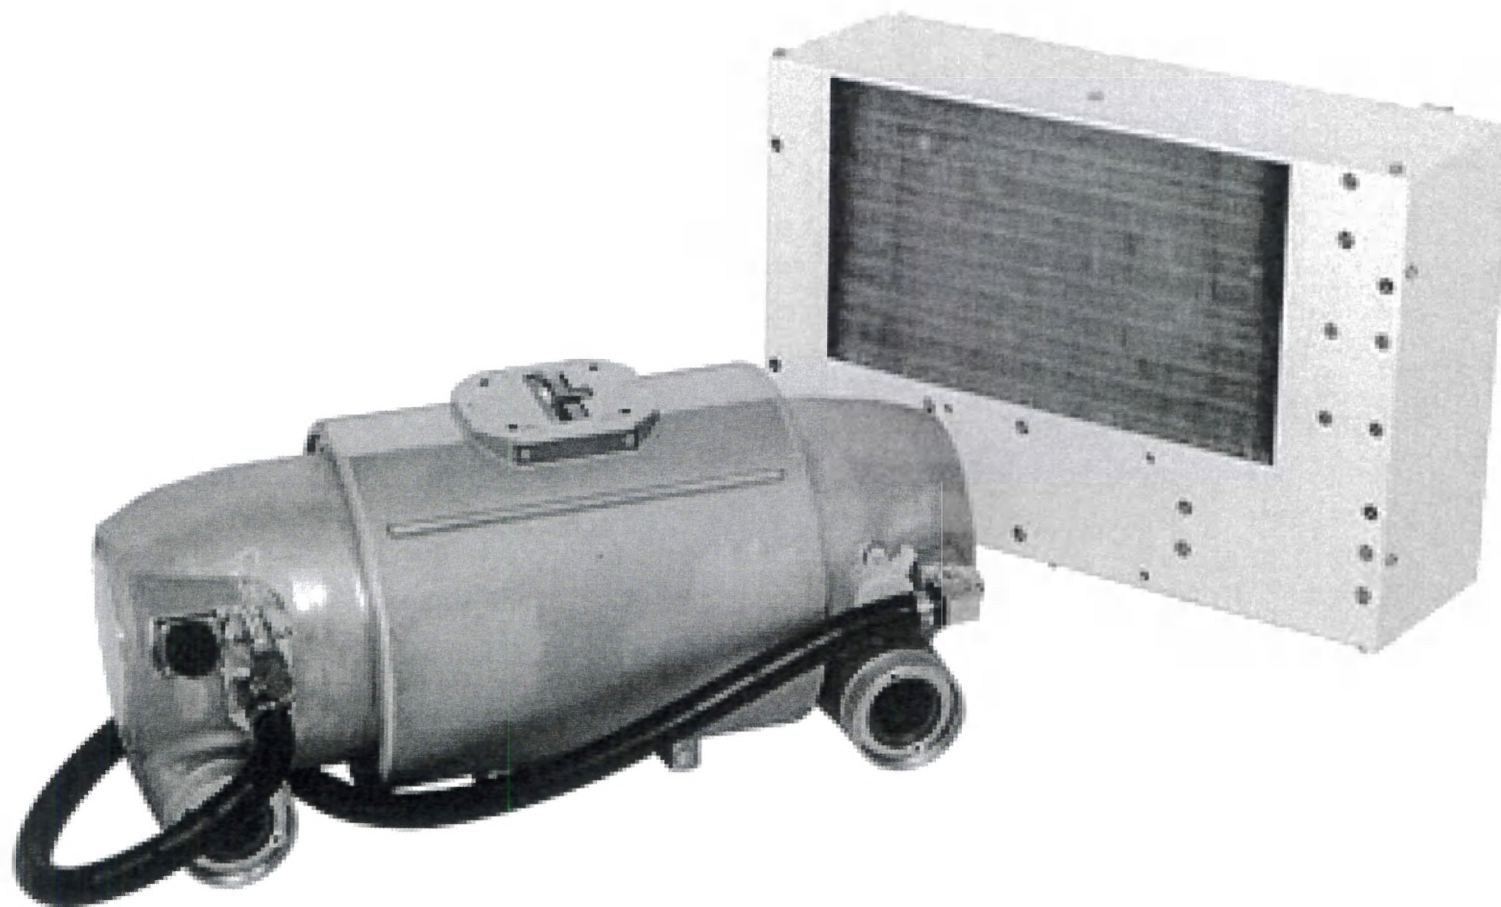

7. Кабели соединительные, не более 100 шт.



7. Кабели соединительные, не более 100 шт.

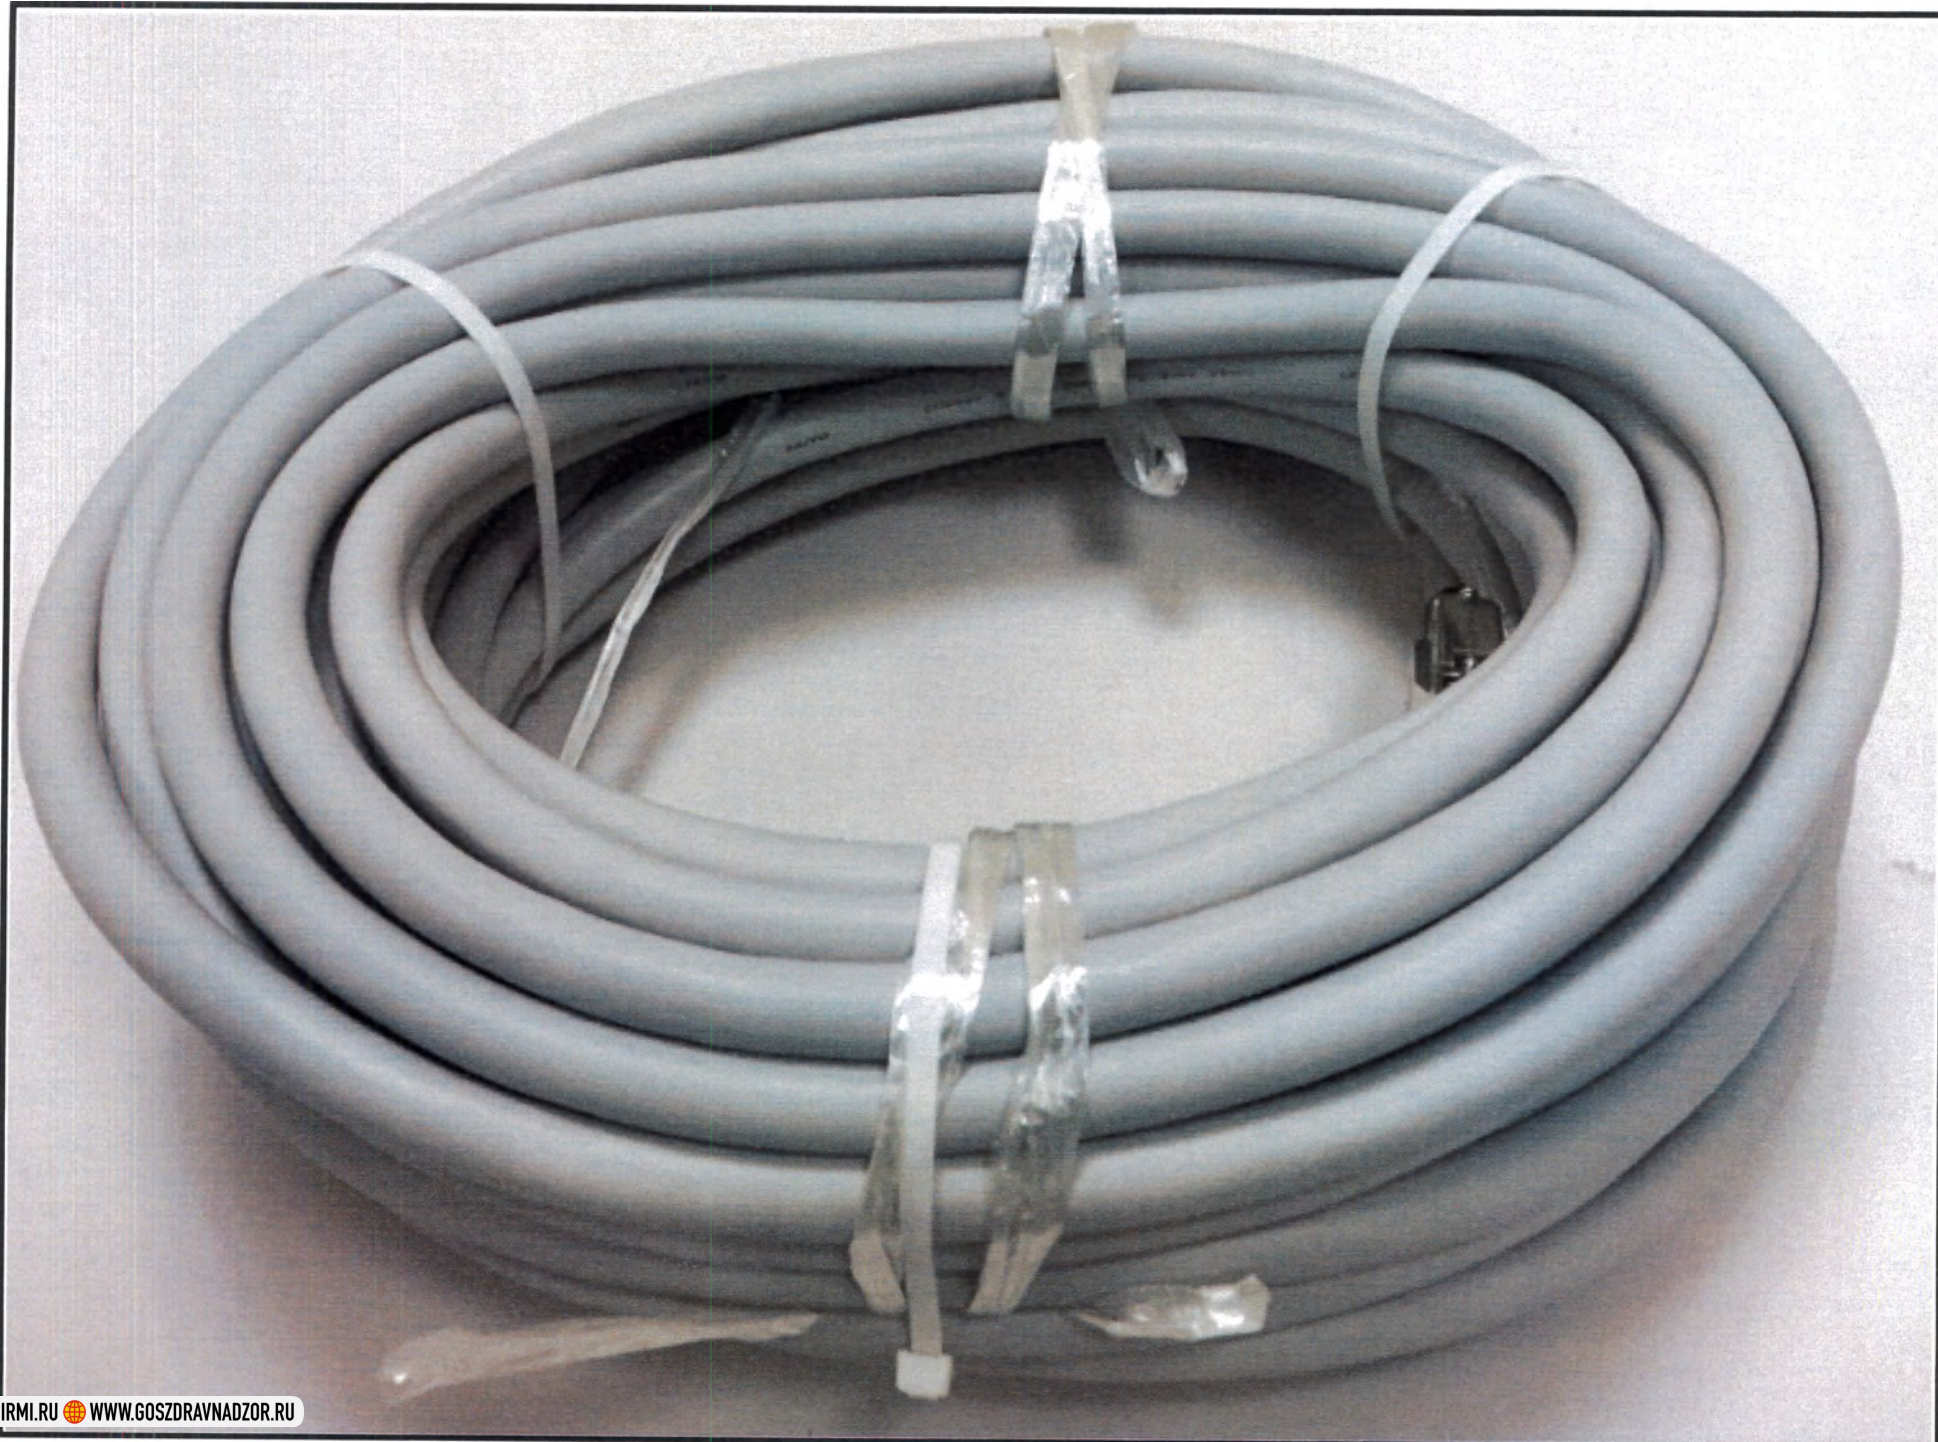

8. ЭКГ электроды, не более 1000 шт. (при необходимости)




9. Руководства по эксплуатации на разных языках, печатные.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
для
сканера КТ
Aquilion *Lightning*
TSX-035A
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ


1. Программное обеспечение для функционального анализа сердца.



2. Программное обеспечение для анализа перфузии головного мозга.

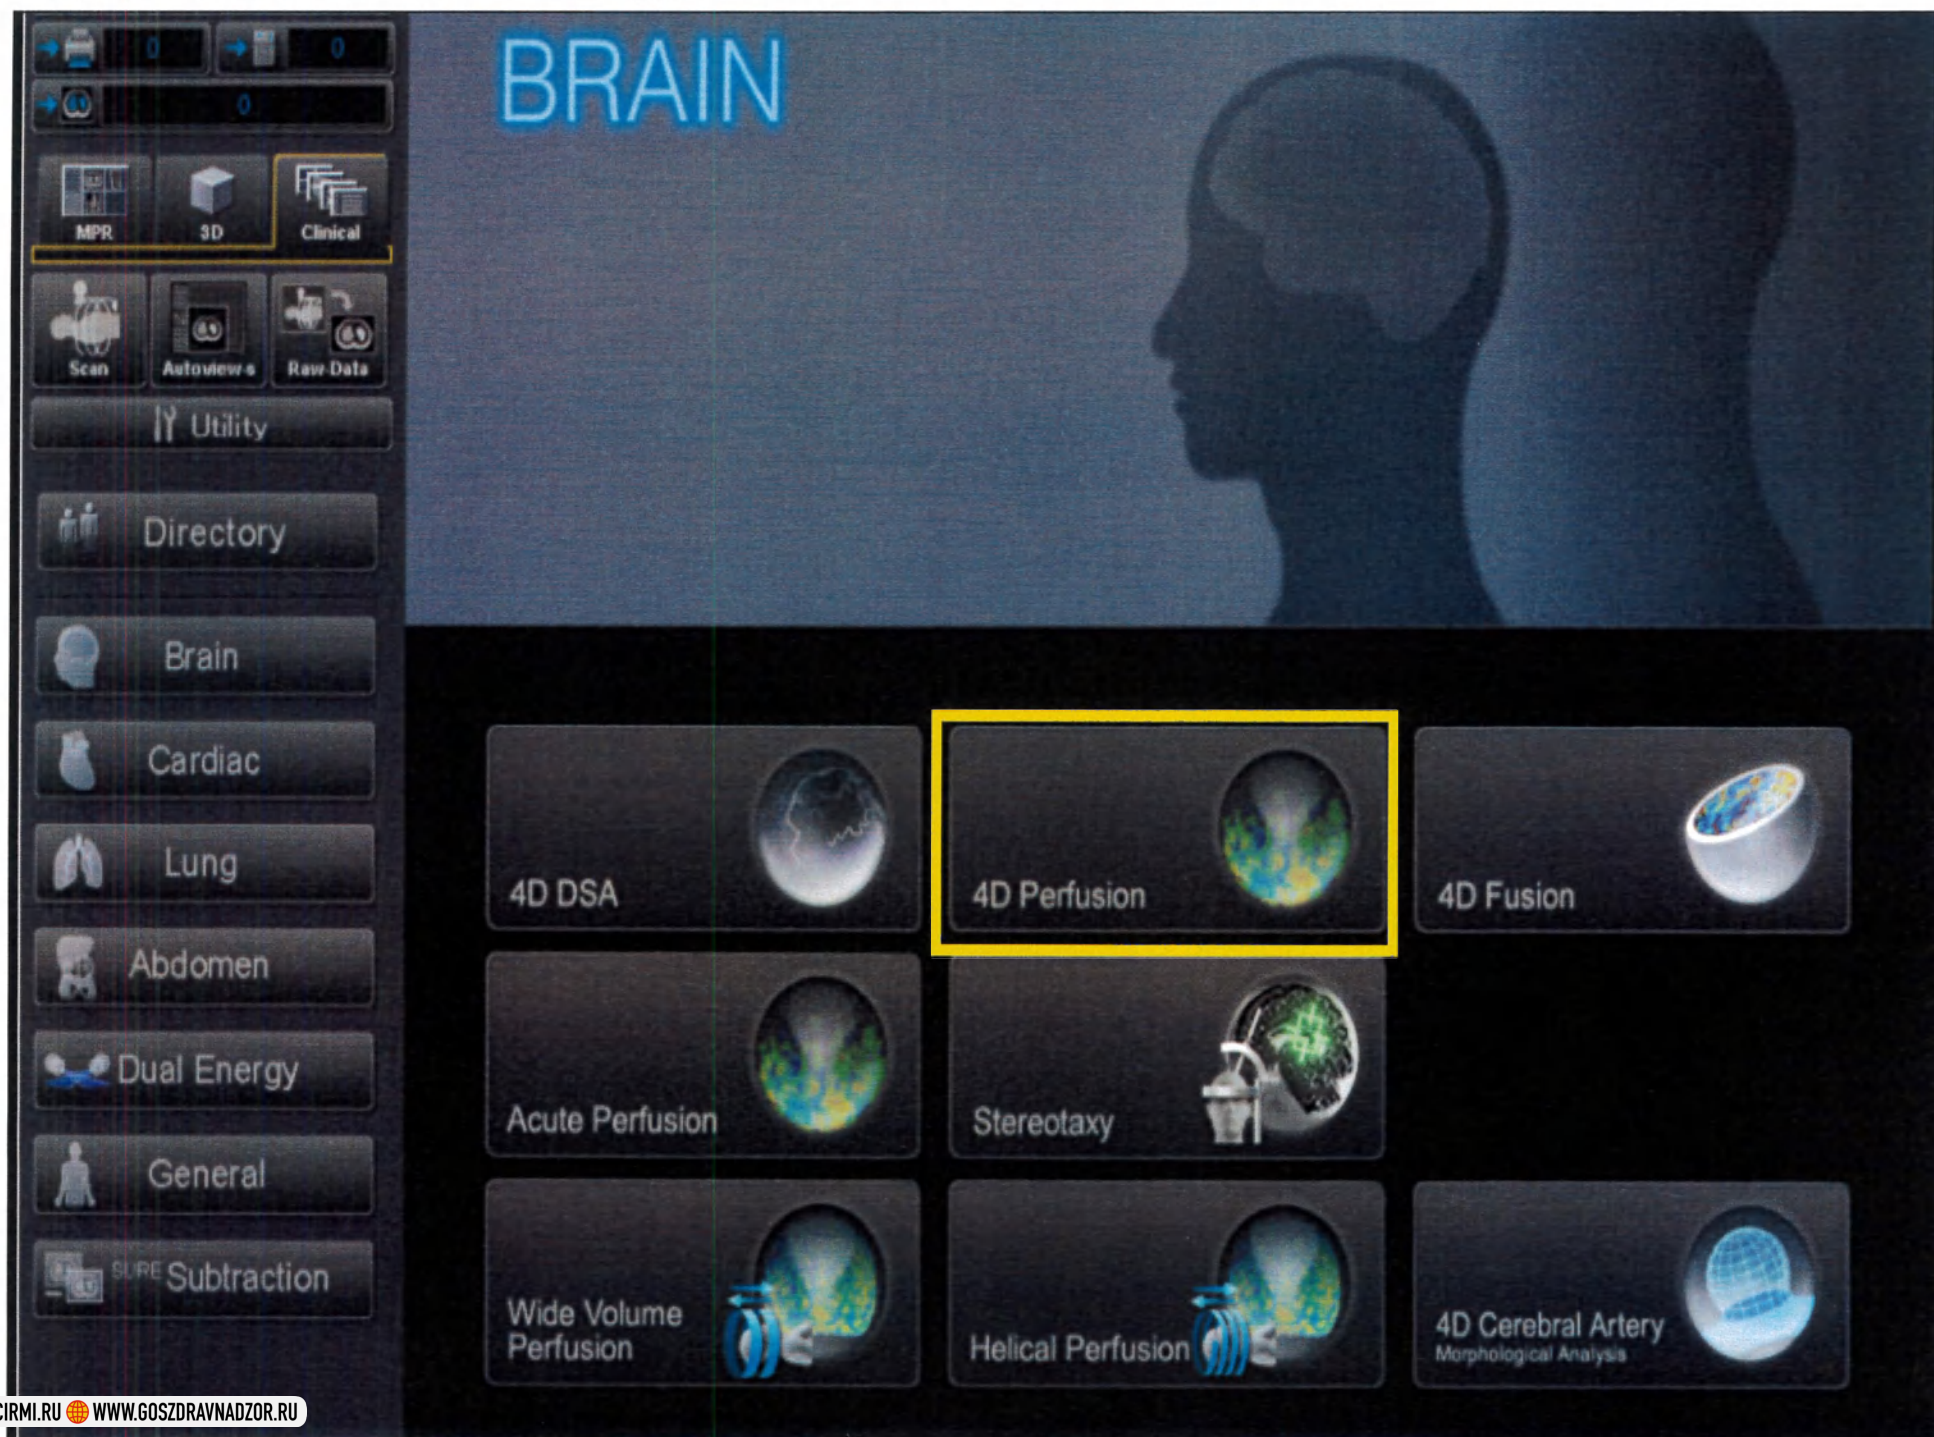

2. Программное обеспечение для анализа перфузии головного мозга.

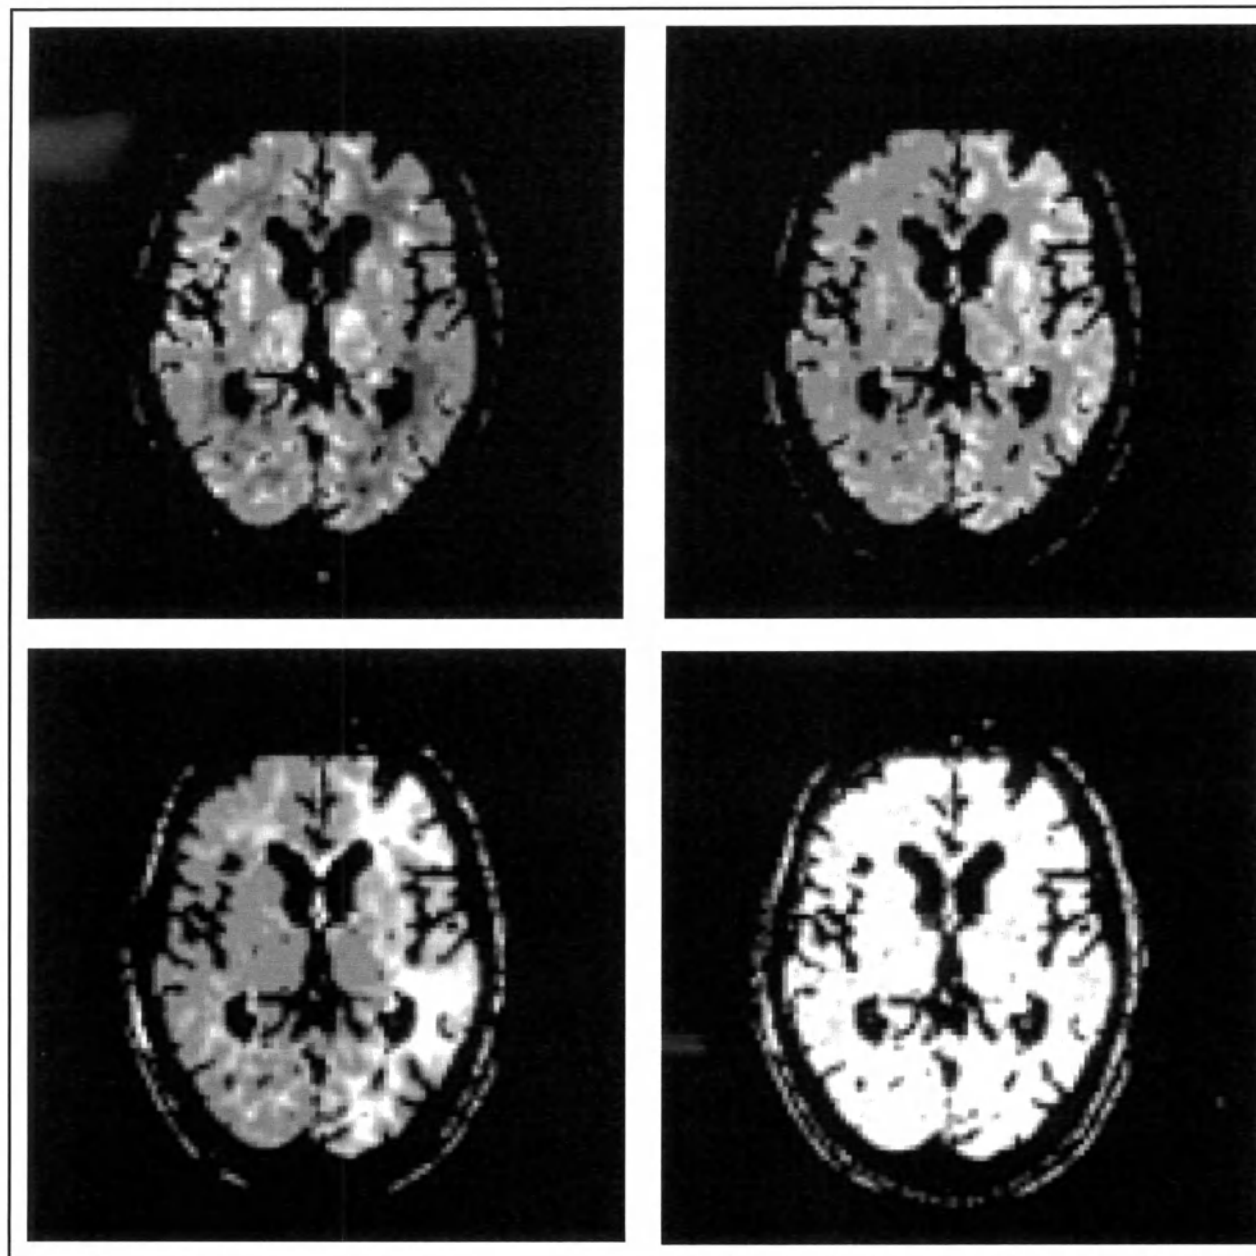

3. Программное обеспечение для виртуальной колоноскопии.




3. Программное обеспечение для виртуальной колоноскопии.



4. Программное обеспечение для стоматологического анализа.




4. Программное обеспечение для стоматологического анализа.

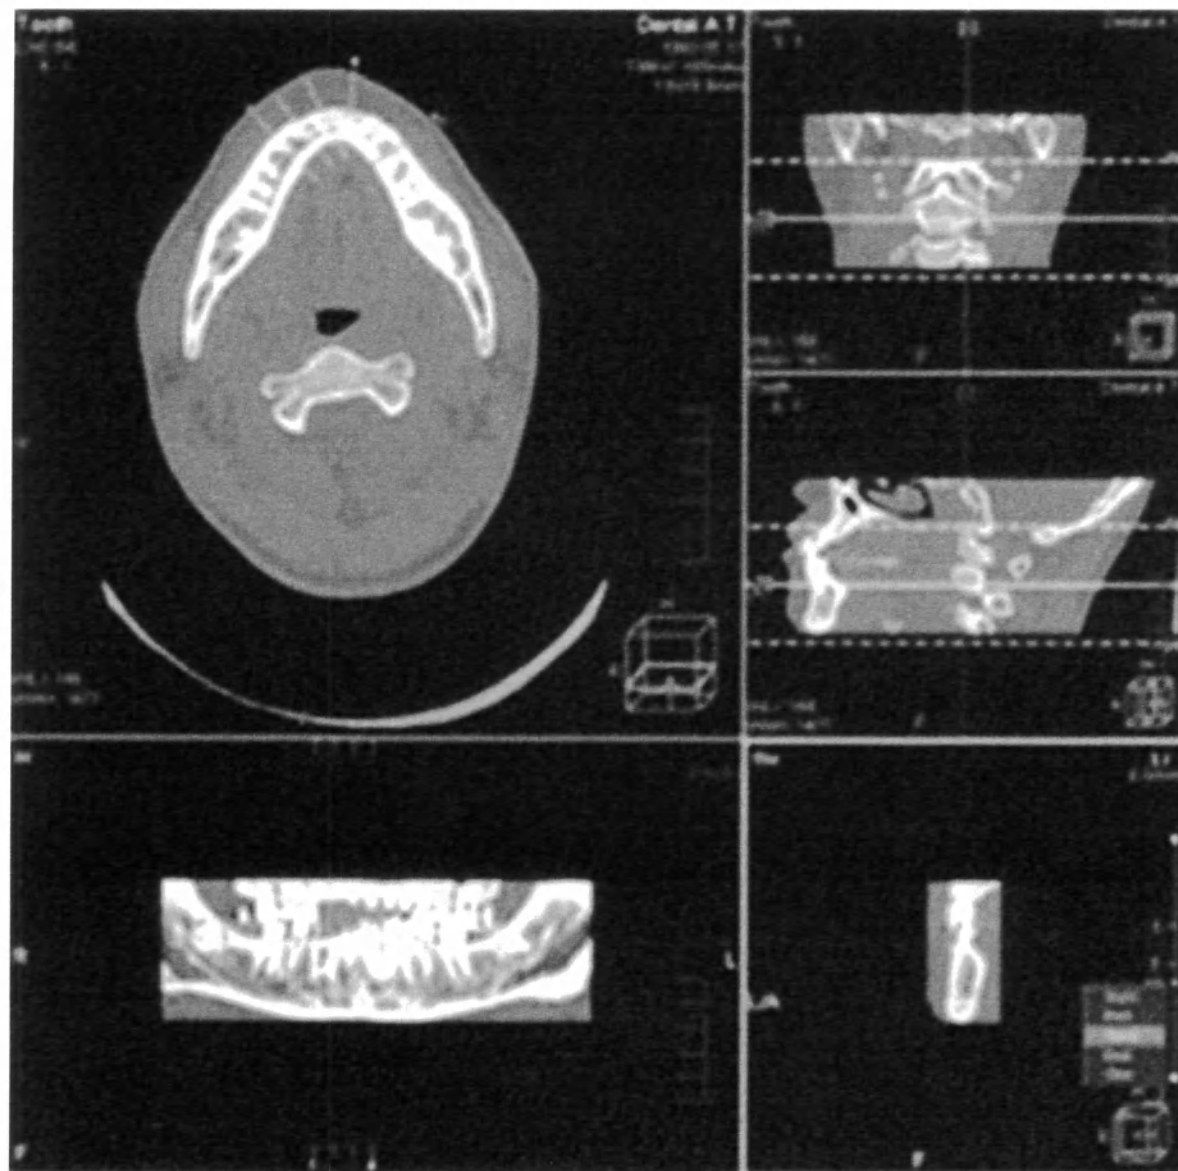

5. Программное обеспечение для оценки жирового индекса.




5. Программное обеспечение для оценки жирового индекса.

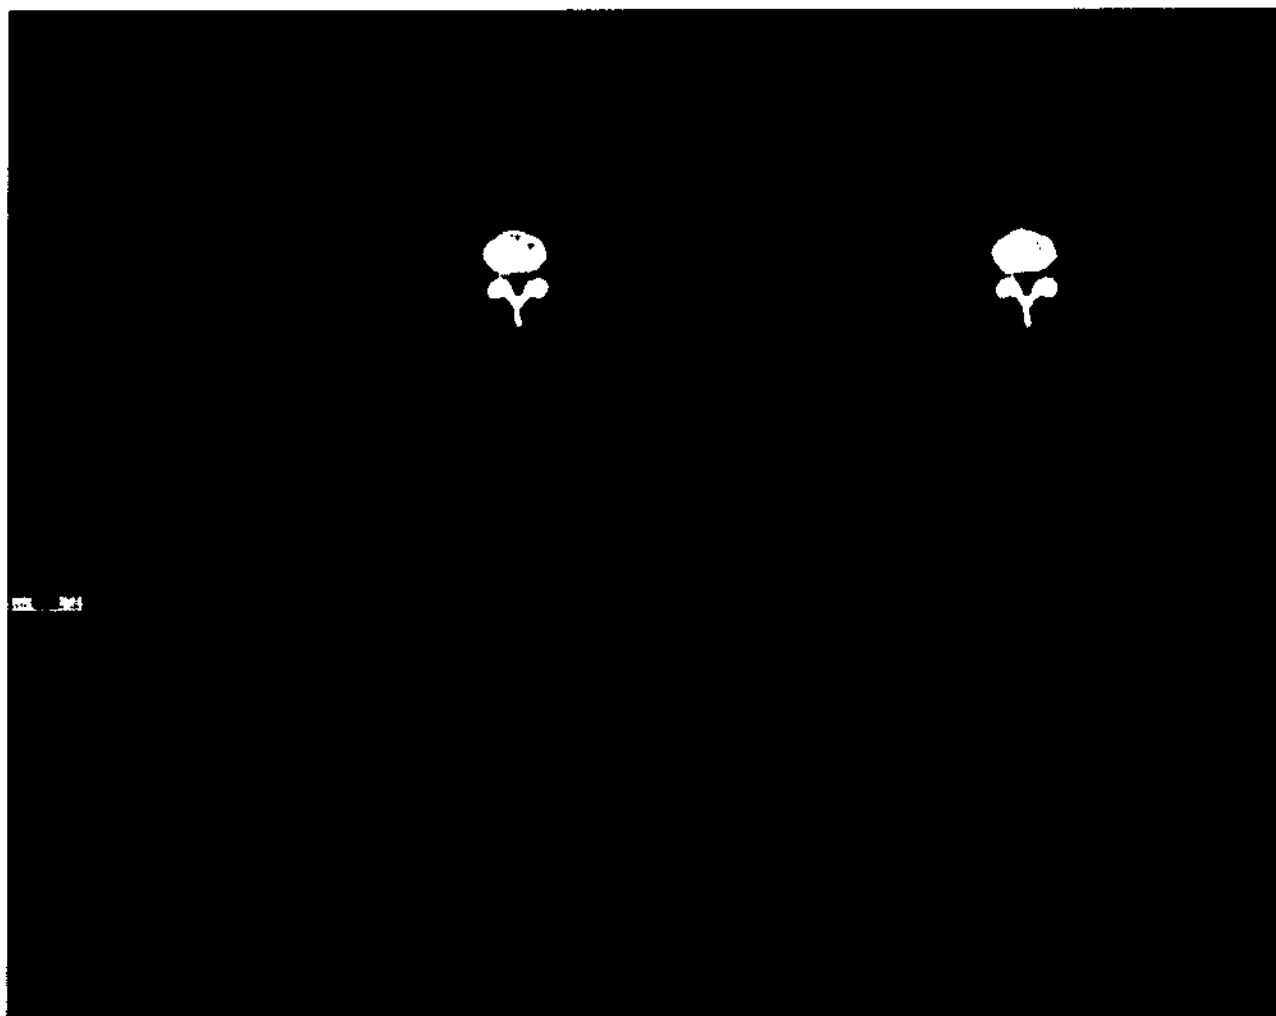

6. Программное обеспечение для виртуальной эндоскопии.



6. Программное обеспечение для виртуальной эндоскопии.

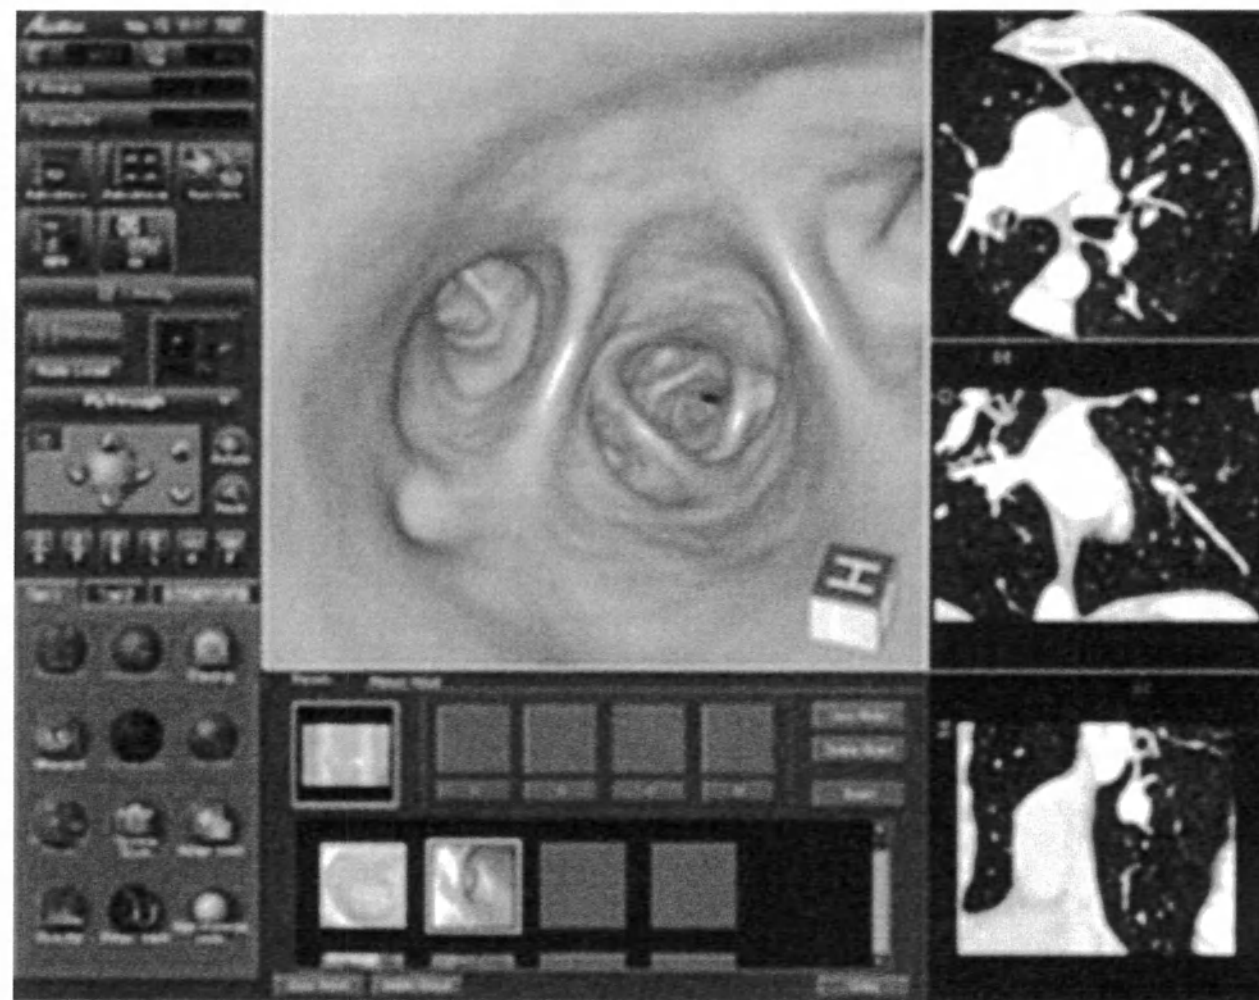

7. Программное обеспечение для оценки объема легких.



7. Программное обеспечение для оценки объема легких.



8. Программное обеспечение для расчета кальциевого индекса.




Patient Information		Insurance Information	
Study ID	0000	Plan Name	ABC-DEF
Patient ID	000001	Group Name	ABC-DEF
Patient Name	John Doe	Effective Date	01-01-2020
Referring Physician	Dr. Smith	Termination Date	01-01-2025
Operator	John	Age	45
Gender	M	Height	180
Weight	80	Weight	180
Contract Agent	ABC	Old Name	ABC

Region	# locations	Agencies	Volunteers	Hours	Costs
North	7	1000	1000	1000	1000
South	1	1000	1000	1000	1000
East	10	1000	1000	1000	1000
West	5	1000	1000	1000	1000
Central	10	1000	1000	1000	1000
Other	10	1000	1000	1000	1000


© The Author(s) 2015

Company Culture Score is Regressor, $R^2 = 0.0000$

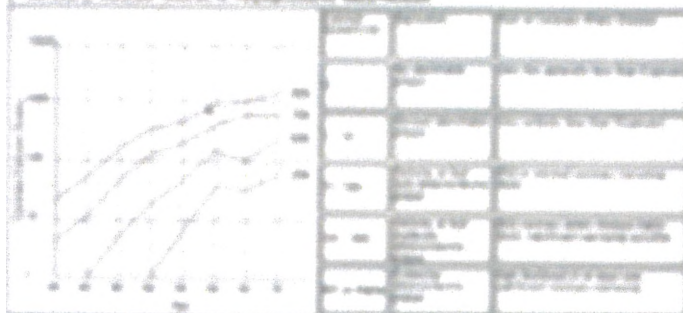

Abstract


10-11-68
10-12-68
10-13-68
10-14-68
10-15-68
10-16-68
10-17-68
10-18-68
10-19-68
10-20-68
10-21-68
10-22-68
10-23-68
10-24-68
10-25-68
10-26-68
10-27-68
10-28-68
10-29-68
10-30-68
10-31-68
11-1-68
11-2-68
11-3-68
11-4-68
11-5-68
11-6-68
11-7-68
11-8-68
11-9-68
11-10-68
11-11-68
11-12-68
11-13-68
11-14-68
11-15-68
11-16-68
11-17-68
11-18-68
11-19-68
11-20-68
11-21-68
11-22-68
11-23-68
11-24-68
11-25-68
11-26-68
11-27-68
11-28-68
11-29-68
11-30-68
12-1-68
12-2-68
12-3-68
12-4-68
12-5-68
12-6-68
12-7-68
12-8-68
12-9-68
12-10-68
12-11-68
12-12-68
12-13-68
12-14-68
12-15-68
12-16-68
12-17-68
12-18-68
12-19-68
12-20-68
12-21-68
12-22-68
12-23-68
12-24-68
12-25-68
12-26-68
12-27-68
12-28-68
12-29-68
12-30-68
12-31-68
1969
1-1-69
1-2-69
1-3-69
1-4-69
1-5-69
1-6-69
1-7-69
1-8-69
1-9-69
1-10-69
1-11-69
1-12-69
1-13-69
1-14-69
1-15-69
1-16-69
1-17-69
1-18-69
1-19-69
1-20-69
1-21-69
1-22-69
1-23-69
1-24-69
1-25-69
1-26-69
1-27-69
1-28-69
1-29-69
1-30-69
1-31-69
2-1-69
2-2-69
2-3-69
2-4-69
2-5-69
2-6-69
2-7-69
2-8-69
2-9-69
2-10-69
2-11-69
2-12-69
2-13-69
2-14-69
2-15-69
2-16-69
2-17-69
2-18-69
2-19-69
2-20-69
2-21-69
2-22-69
2-23-69
2-24-69
2-25-69
2-26-69
2-27-69
2-28-69
2-29-69
2-30-69
3-1-69
3-2-69
3-3-69
3-4-69
3-5-69
3-6-69
3-7-69
3-8-69
3-9-69
3-10-69
3-11-69
3-12-69
3-13-69
3-14-69
3-15-69
3-16-69
3-17-69
3-18-69
3-19-69
3-20-69
3-21-69
3-22-69
3-23-69
3-24-69
3-25-69
3-26-69
3-27-69
3-28-69
3-29-69
3-30-69
3-31-69
4-1-69
4-2-69
4-3-69
4-4-69
4-5-69
4-6-69
4-7-69
4-8-69
4-9-69
4-10-69
4-11-69
4-12-69
4-13-69
4-14-69
4-15-69
4-16-69
4-17-69
4-18-69
4-19-69
4-20-69
4-21-69
4-22-69
4-23-69
4-24-69
4-25-69
4-26-69
4-27-69
4-28-69
4-29-69
4-30-69
5-1-69
5-2-69
5-3-69
5-4-69
5-5-69
5-6-69
5-7-69
5-8-69
5-9-69
5-10-69
5-11-69
5-12-69
5-13-69
5-14-69
5-15-69
5-16-69
5-17-69
5-18-69
5-19-69
5-20-69
5-21-69
5-22-69
5-23-69
5-24-69
5-25-69
5-26-69
5-27-69
5-28-69
5-29-69
5-30-69
5-31-69
6-1-69
6-2-69
6-3-69
6-4-69
6-5-69
6-6-69
6-7-69
6-8-69
6-9-69
6-10-69
6-11-69
6-12-69
6-13-69
6-14-69
6-15-69
6-16-69
6-17-69
6-18-69
6-19-69
6-20-69
6-21-69
6-22-69
6-23-69
6-24-69
6-25-69
6-26-69
6-27-69
6-28-69
6-29-69
6-30-69
7-1-69
7-2-69
7-3-69
7-4-69
7-5-69
7-6-69
7-7-69
7-8-69
7-9-69
7-10-69
7-11-69
7-12-69
7-13-69
7-14-69
7-15-69
7-16-69
7-17-69
7-18-69
7-19-69
7-20-69
7-21-69
7-22-69
7-23-69
7-24-69
7-25-69
7-26-69
7-27-69
7-28-69
7-29-69
7-30-69
7-31-69
8-1-69
8-2-69
8-3-69
8-4-69
8-5-69
8-6-69
8-7-69
8-8-69
8-9-69
8-10-69
8-11-69
8-12-69
8-13-69
8-14-69
8-15-69
8-16-69
8-17-69
8-18-69
8-19-69
8-20-69
8-21-69
8-22-69
8-23-69
8-24-69
8-25-69
8-26-69
8-27-69
8-28-69
8-29-69
8-30-69
8-31-69
9-1-69
9-2-69
9-3-69
9-4-69
9-5-69
9-6-69
9-7-69
9-8-69
9-9-69
9-10-69
9-11-69
9-12-69
9-13-69
9-14-69
9-15-69
9-16-69
9-17-69
9-18-69
9-19-69
9-20-69
9-21-69
9-22-69
9-23-69
9-24-69
9-25-69
9-26-69
9-27-69
9-28-69
9-29-69
9-30-69
10-1-69
10-2-69
10-3-69
10-4-69
10-5-69
10-6-69
10-7-69
10-8-69
10-9-69
10-10-69
10-11-69
10-12-69
10-13-69
10-14-69
10-15-69
10-16-69
10-17-69
10-18-69
10-19-69
10-20-69
10-21-69
10-22-69
10-23-69
10-24-69
10-25-69
10-26-69
10-27-69
10-28-69
10-29-69
10-30-69
10-31-69
11-1-69
11-2-69
11-3-69
11-4-69
11-5-69
11-6-69
11-7-69
11-8-69
11-9-69
11-10-69
11-11-69
11-12-69
11-13-69
11-14-69
11-15-69
11-16-69
11-17-69
11-18-69
11-19-69
11-20-69
11-21-69
11-22-69
11-23-69
11-24-69
11-25-69
11-26-69
11-27-69
11-28-69
11-29-69
11-30-69
12-1-69
12-2-69
12-3-69
12-4-69
12-5-69
12-6-69
12-7-69
12-8-69
12-9-69
12-10-69
12-11-69
12-12-69
12-13-69
12-14-69
12-15-69
12-16-69
12-17-69
12-18-69
12-19-69
12-20-69
12-21-69
12-22-69
12-23-69
12-24-69
12-25-69
12-26-69
12-27-69
12-28-69
12-29-69
12-30-69
12-31-69

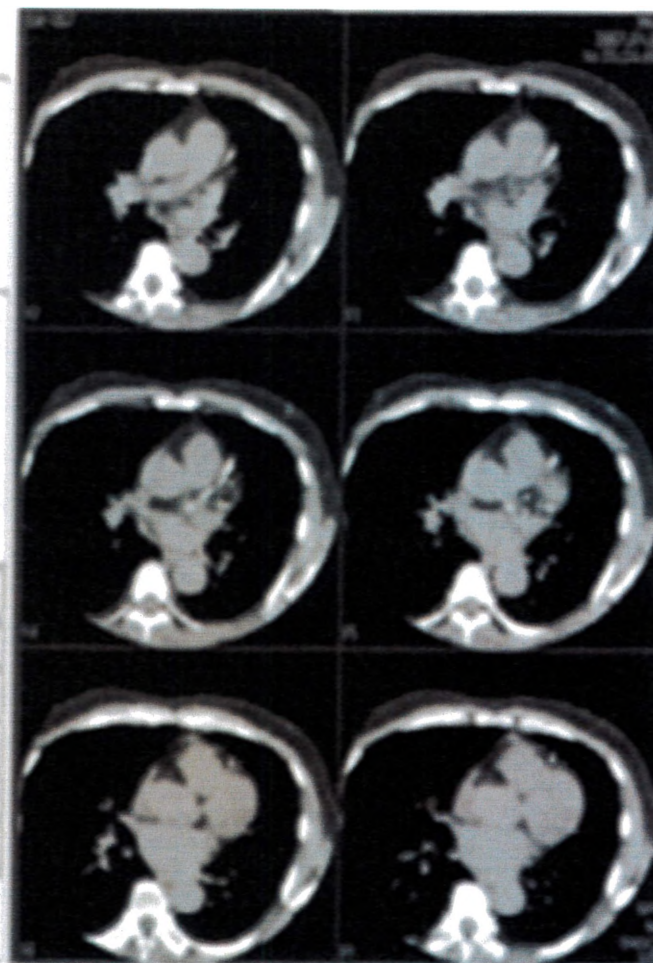


9. Программное обеспечение для анализа атеросклеротических бляшек.




9. Программное обеспечение для анализа атеросклеротических бляшек.

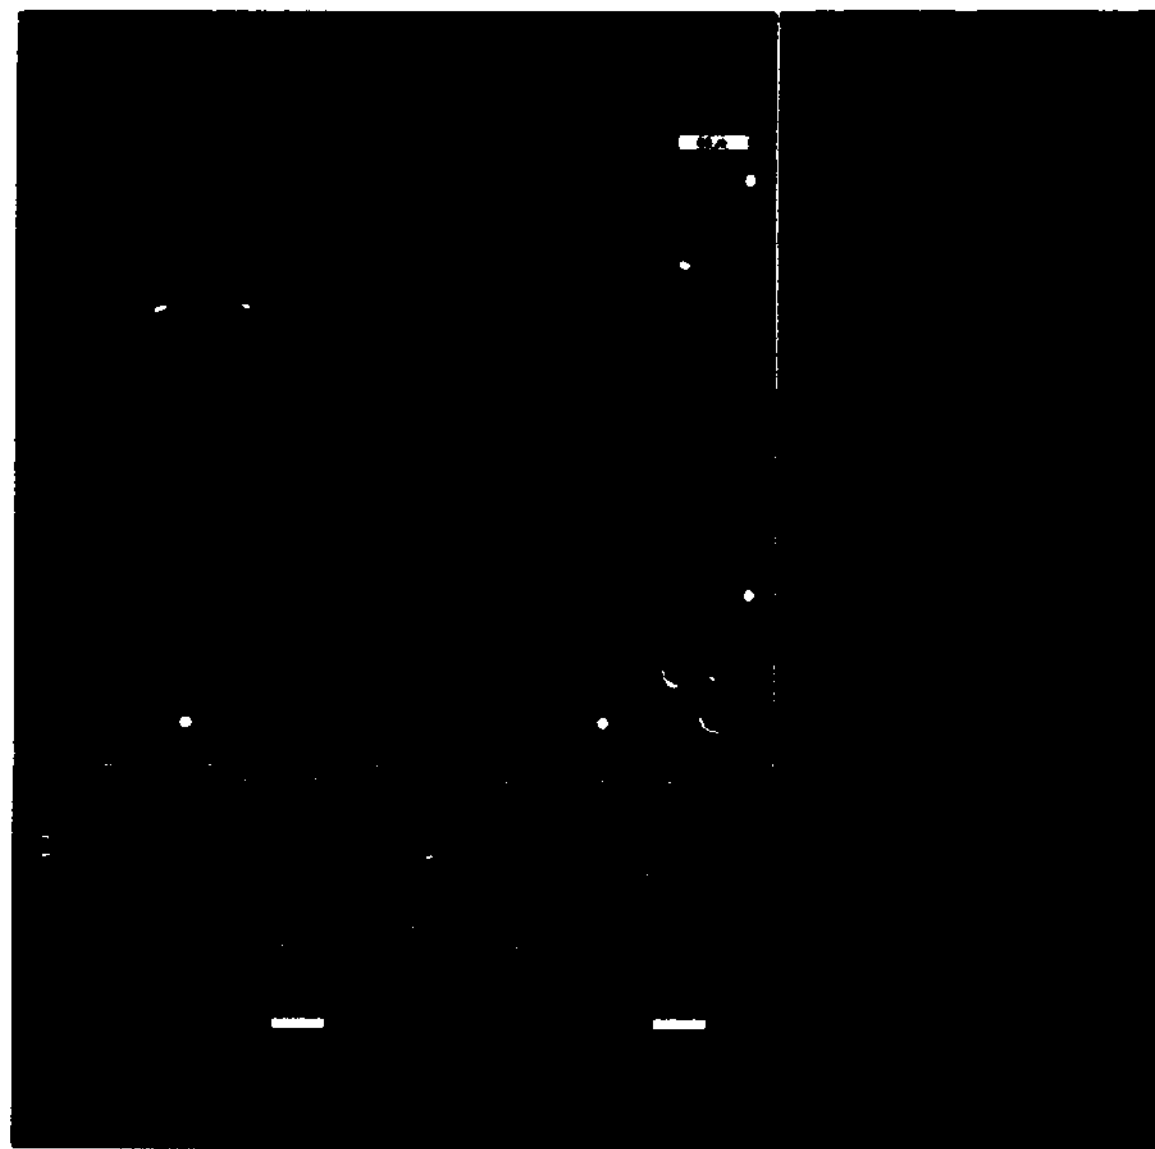


10. Программное обеспечение для субтракции костных структур.

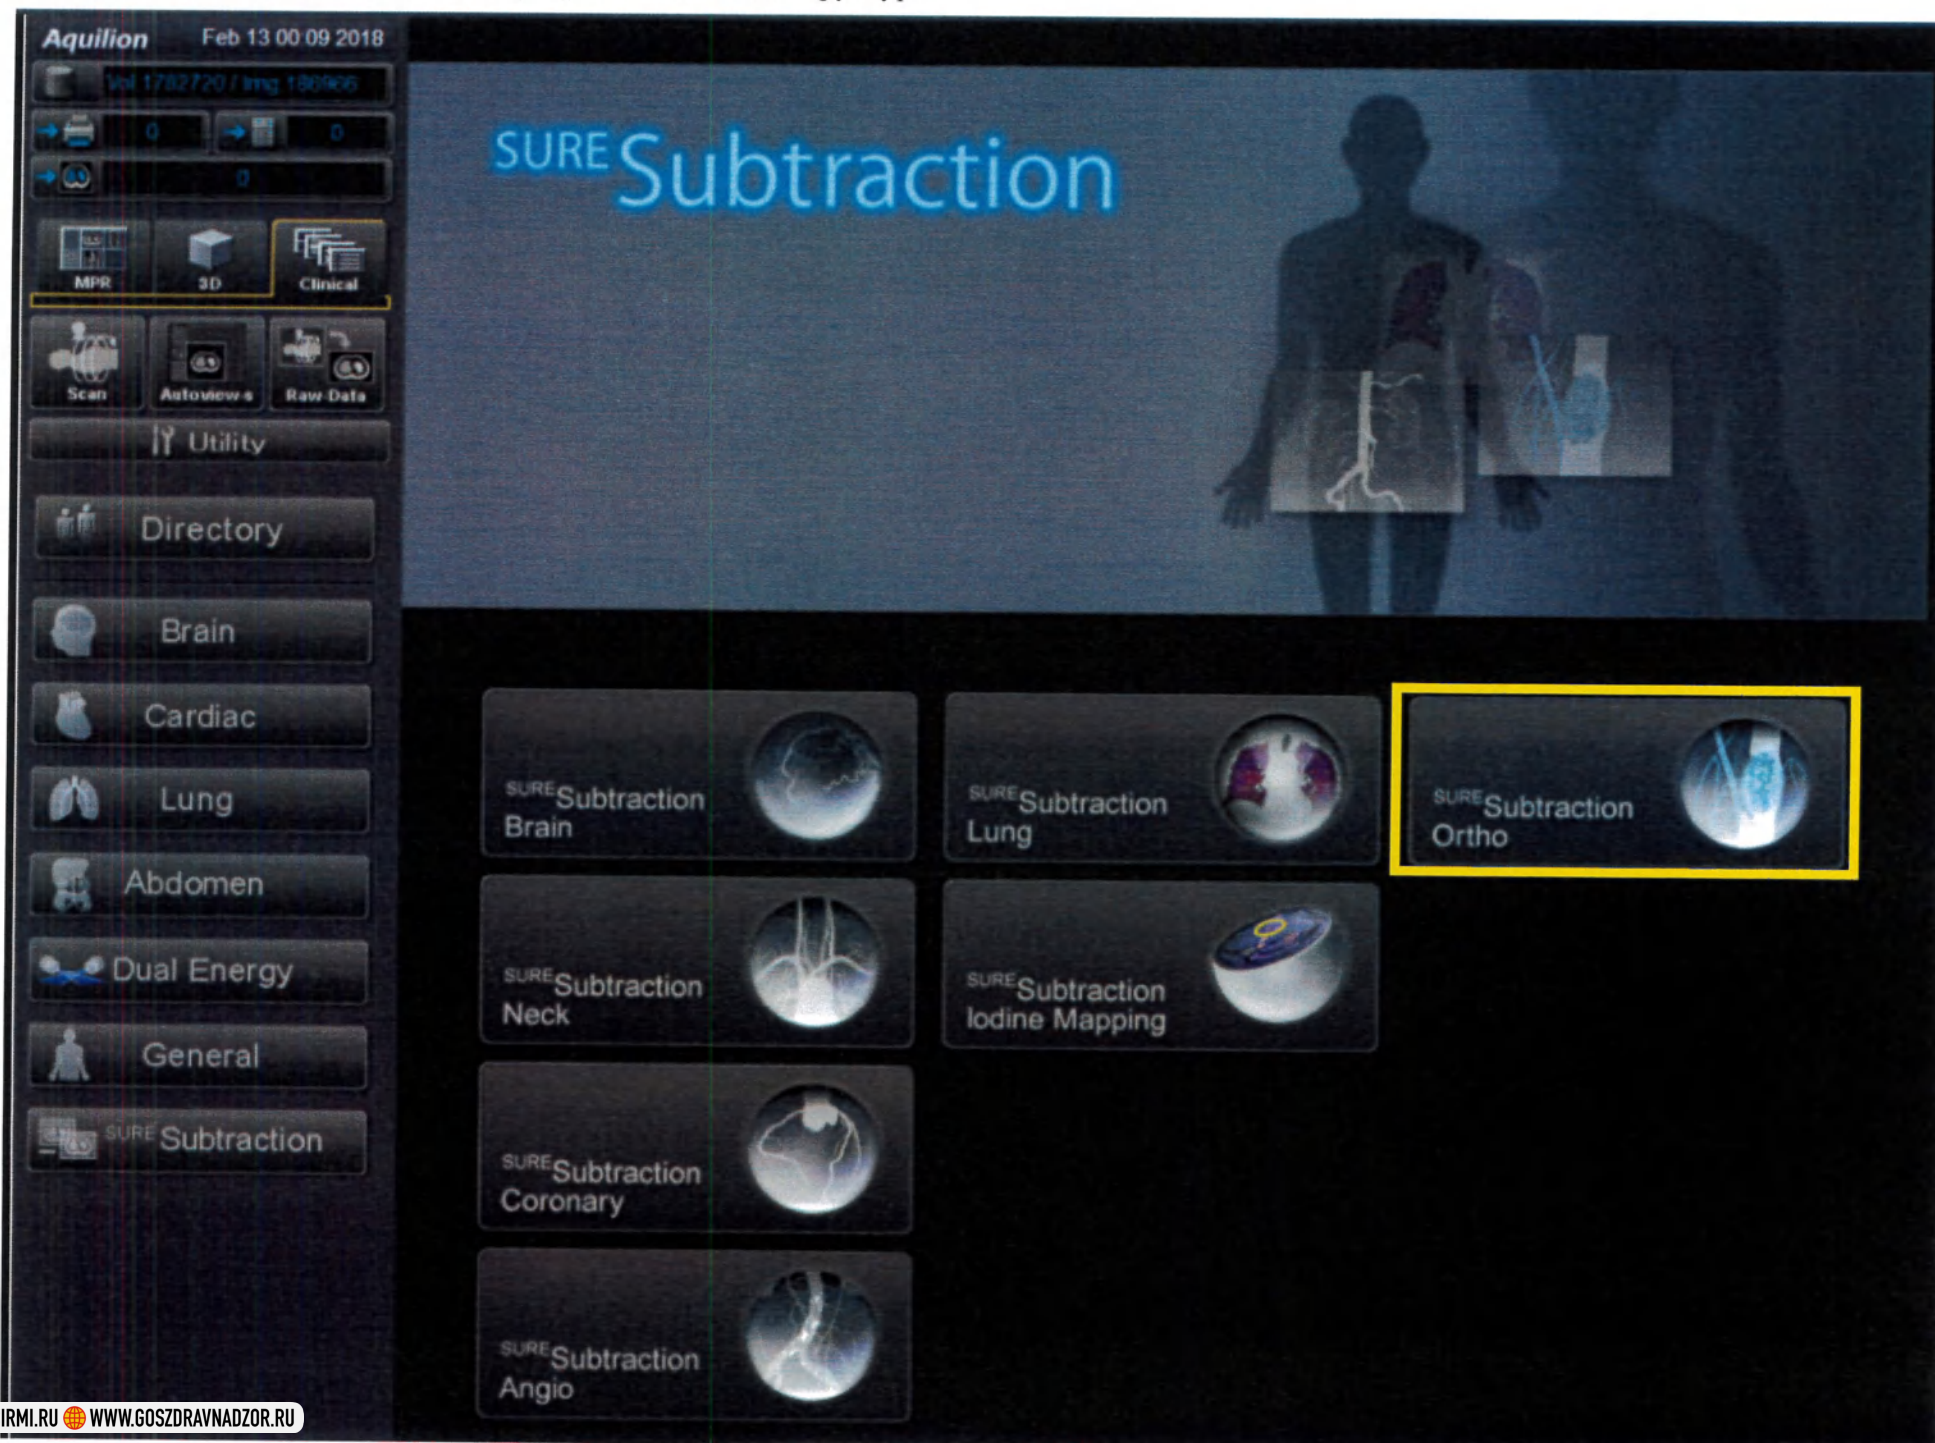


10. Программное обеспечение для субтракции костных структур.

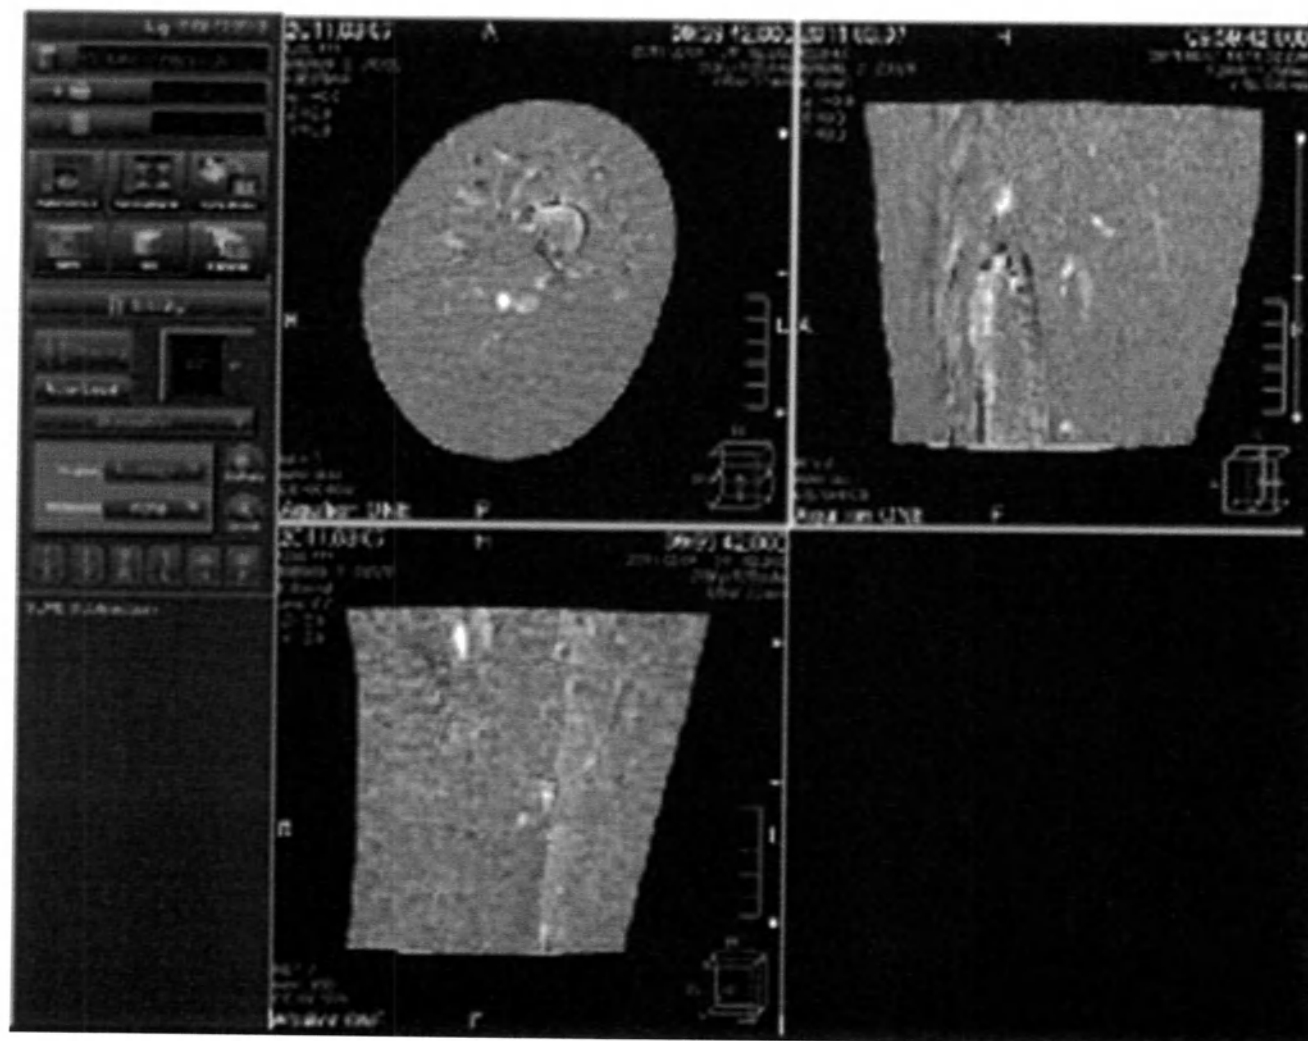


11. Программное обеспечение для субтракции легких.

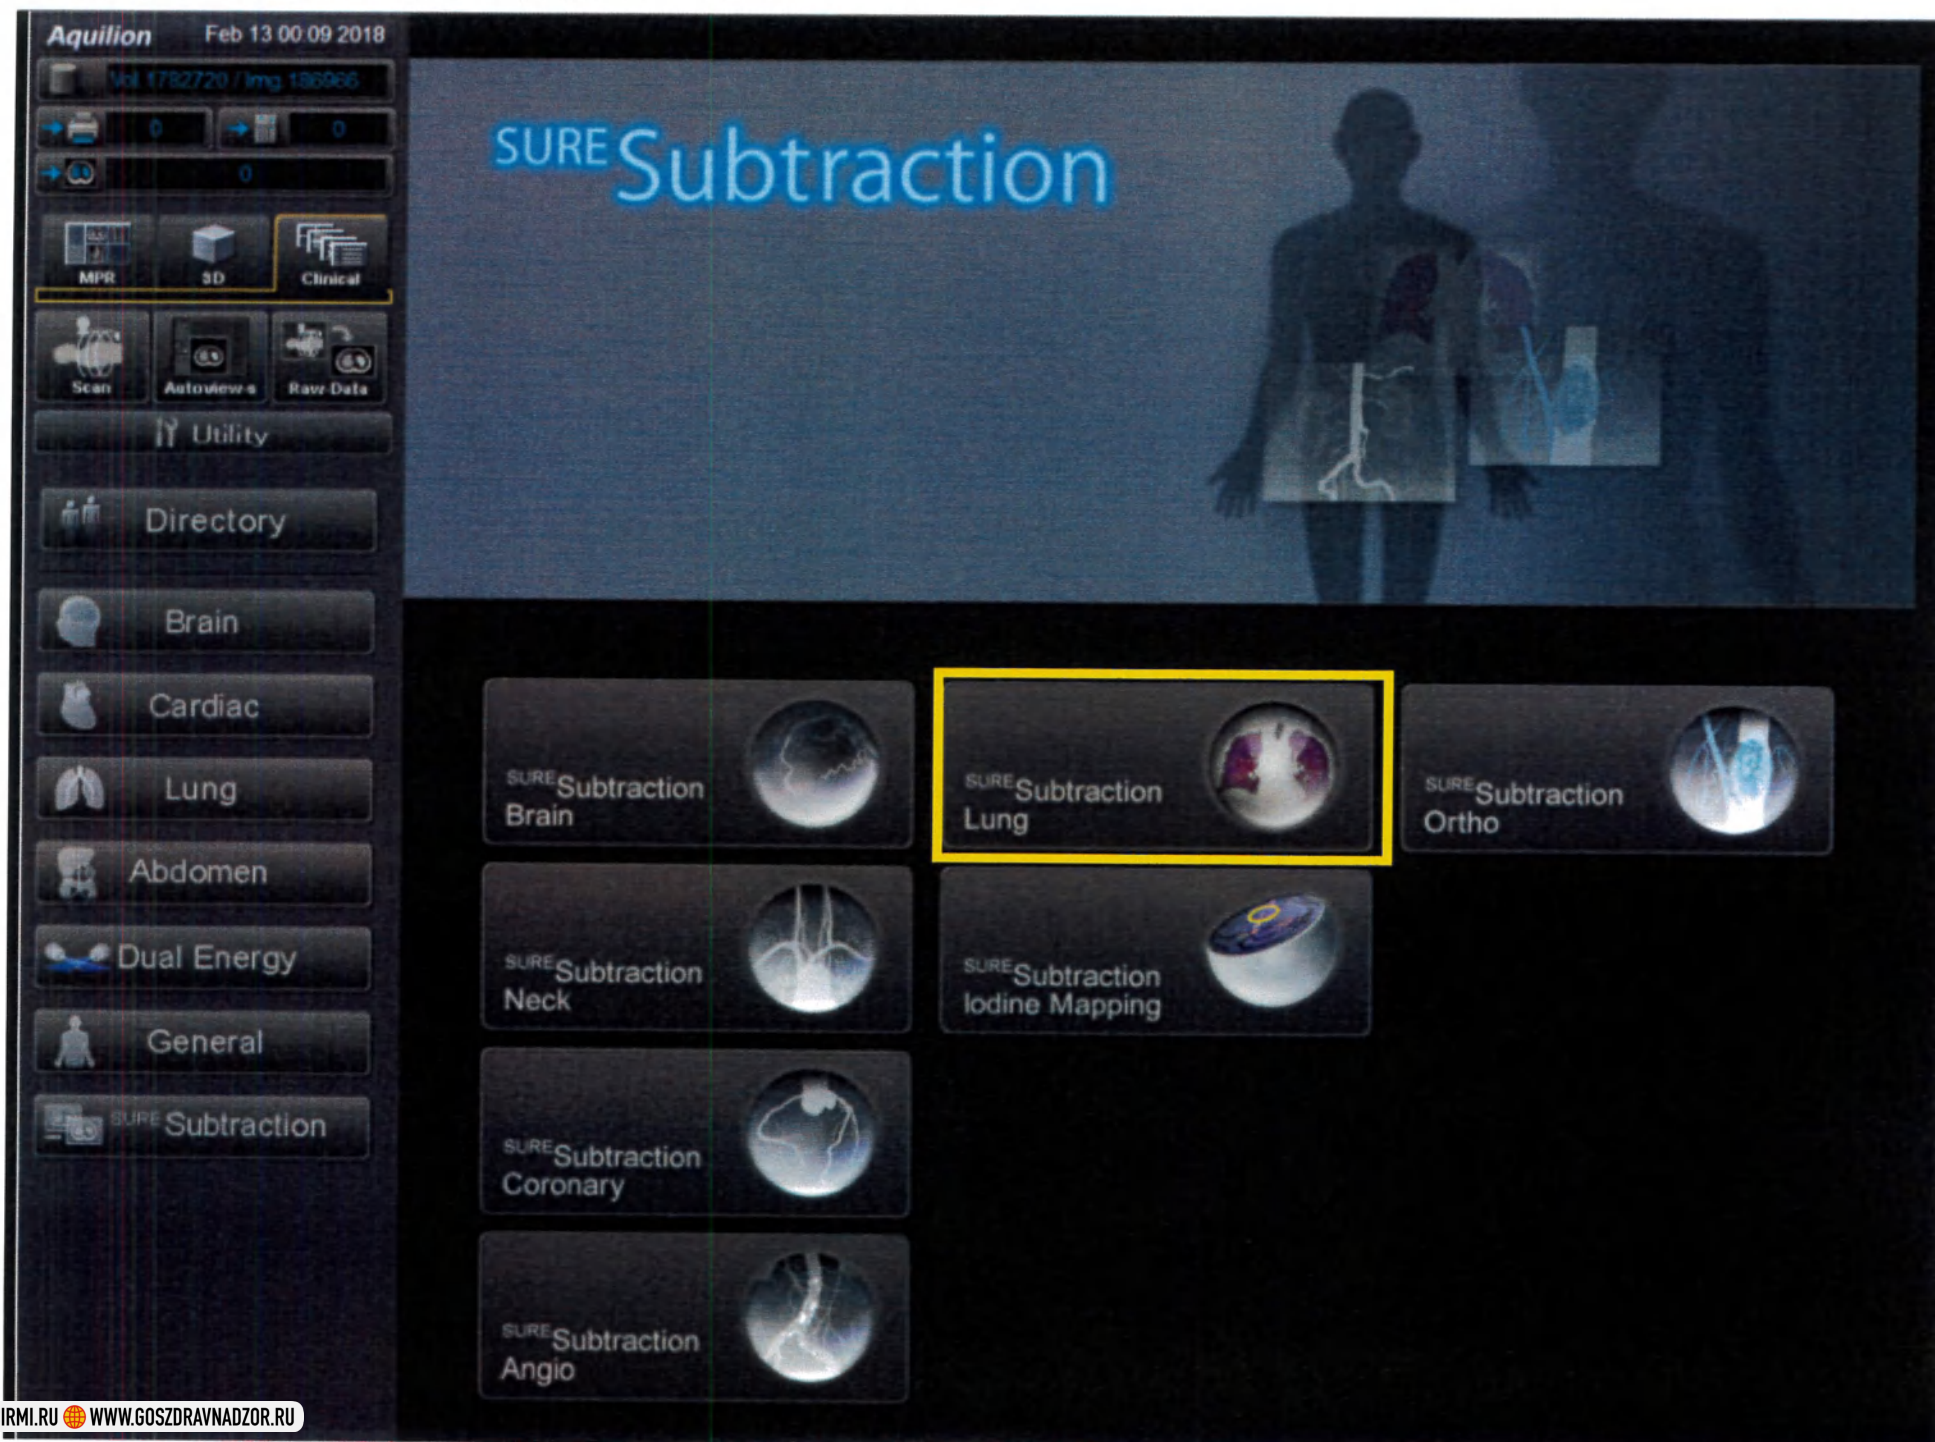


11. Программное обеспечение для субтракции легких.

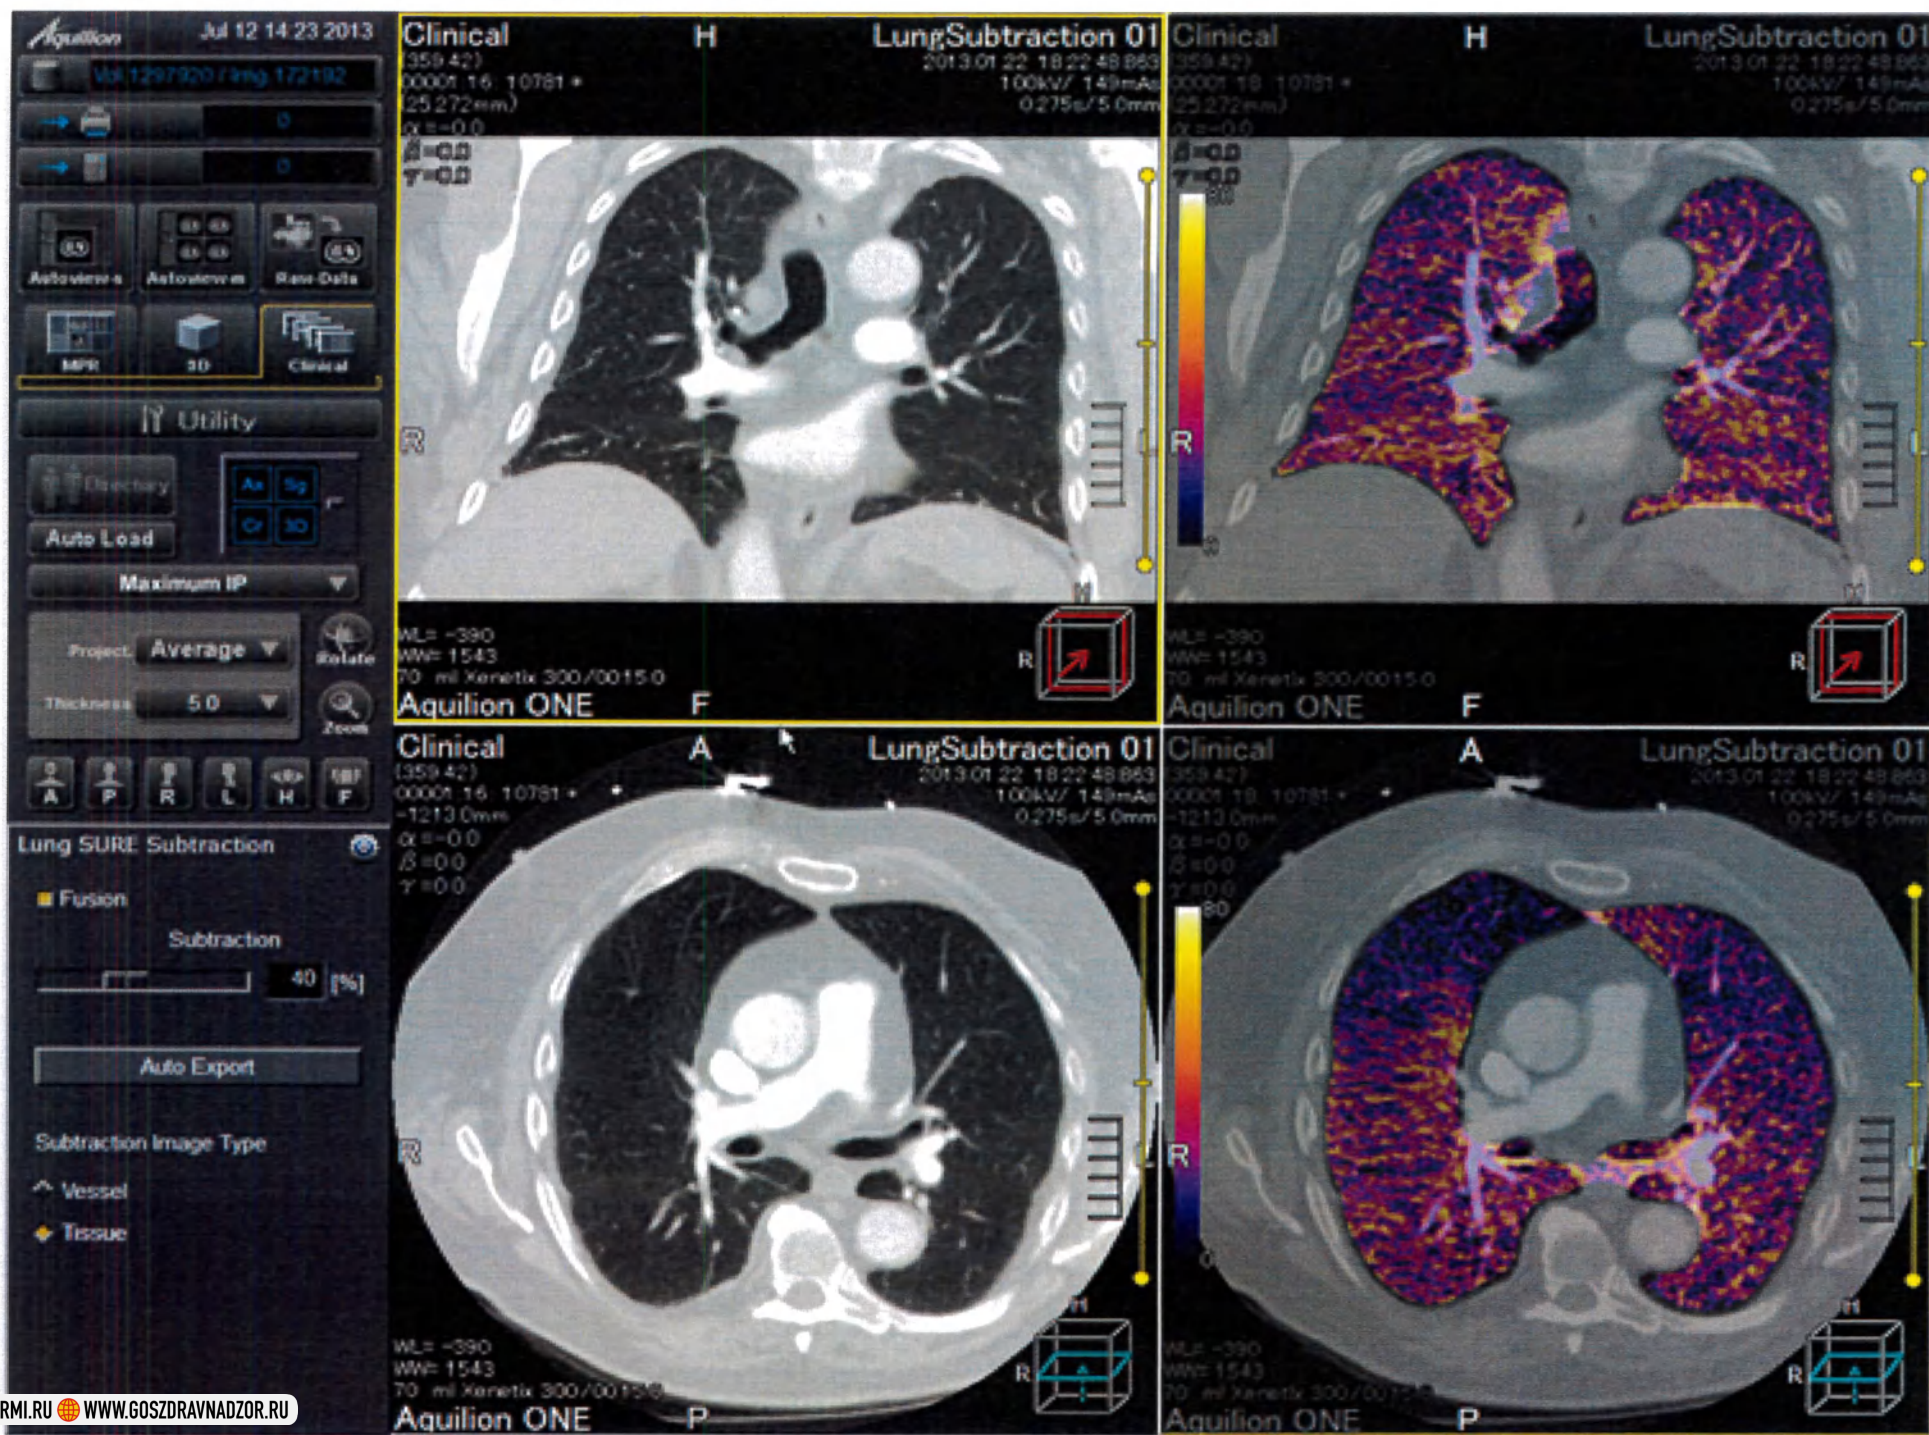

12. Программное обеспечение для анализа сосудов.

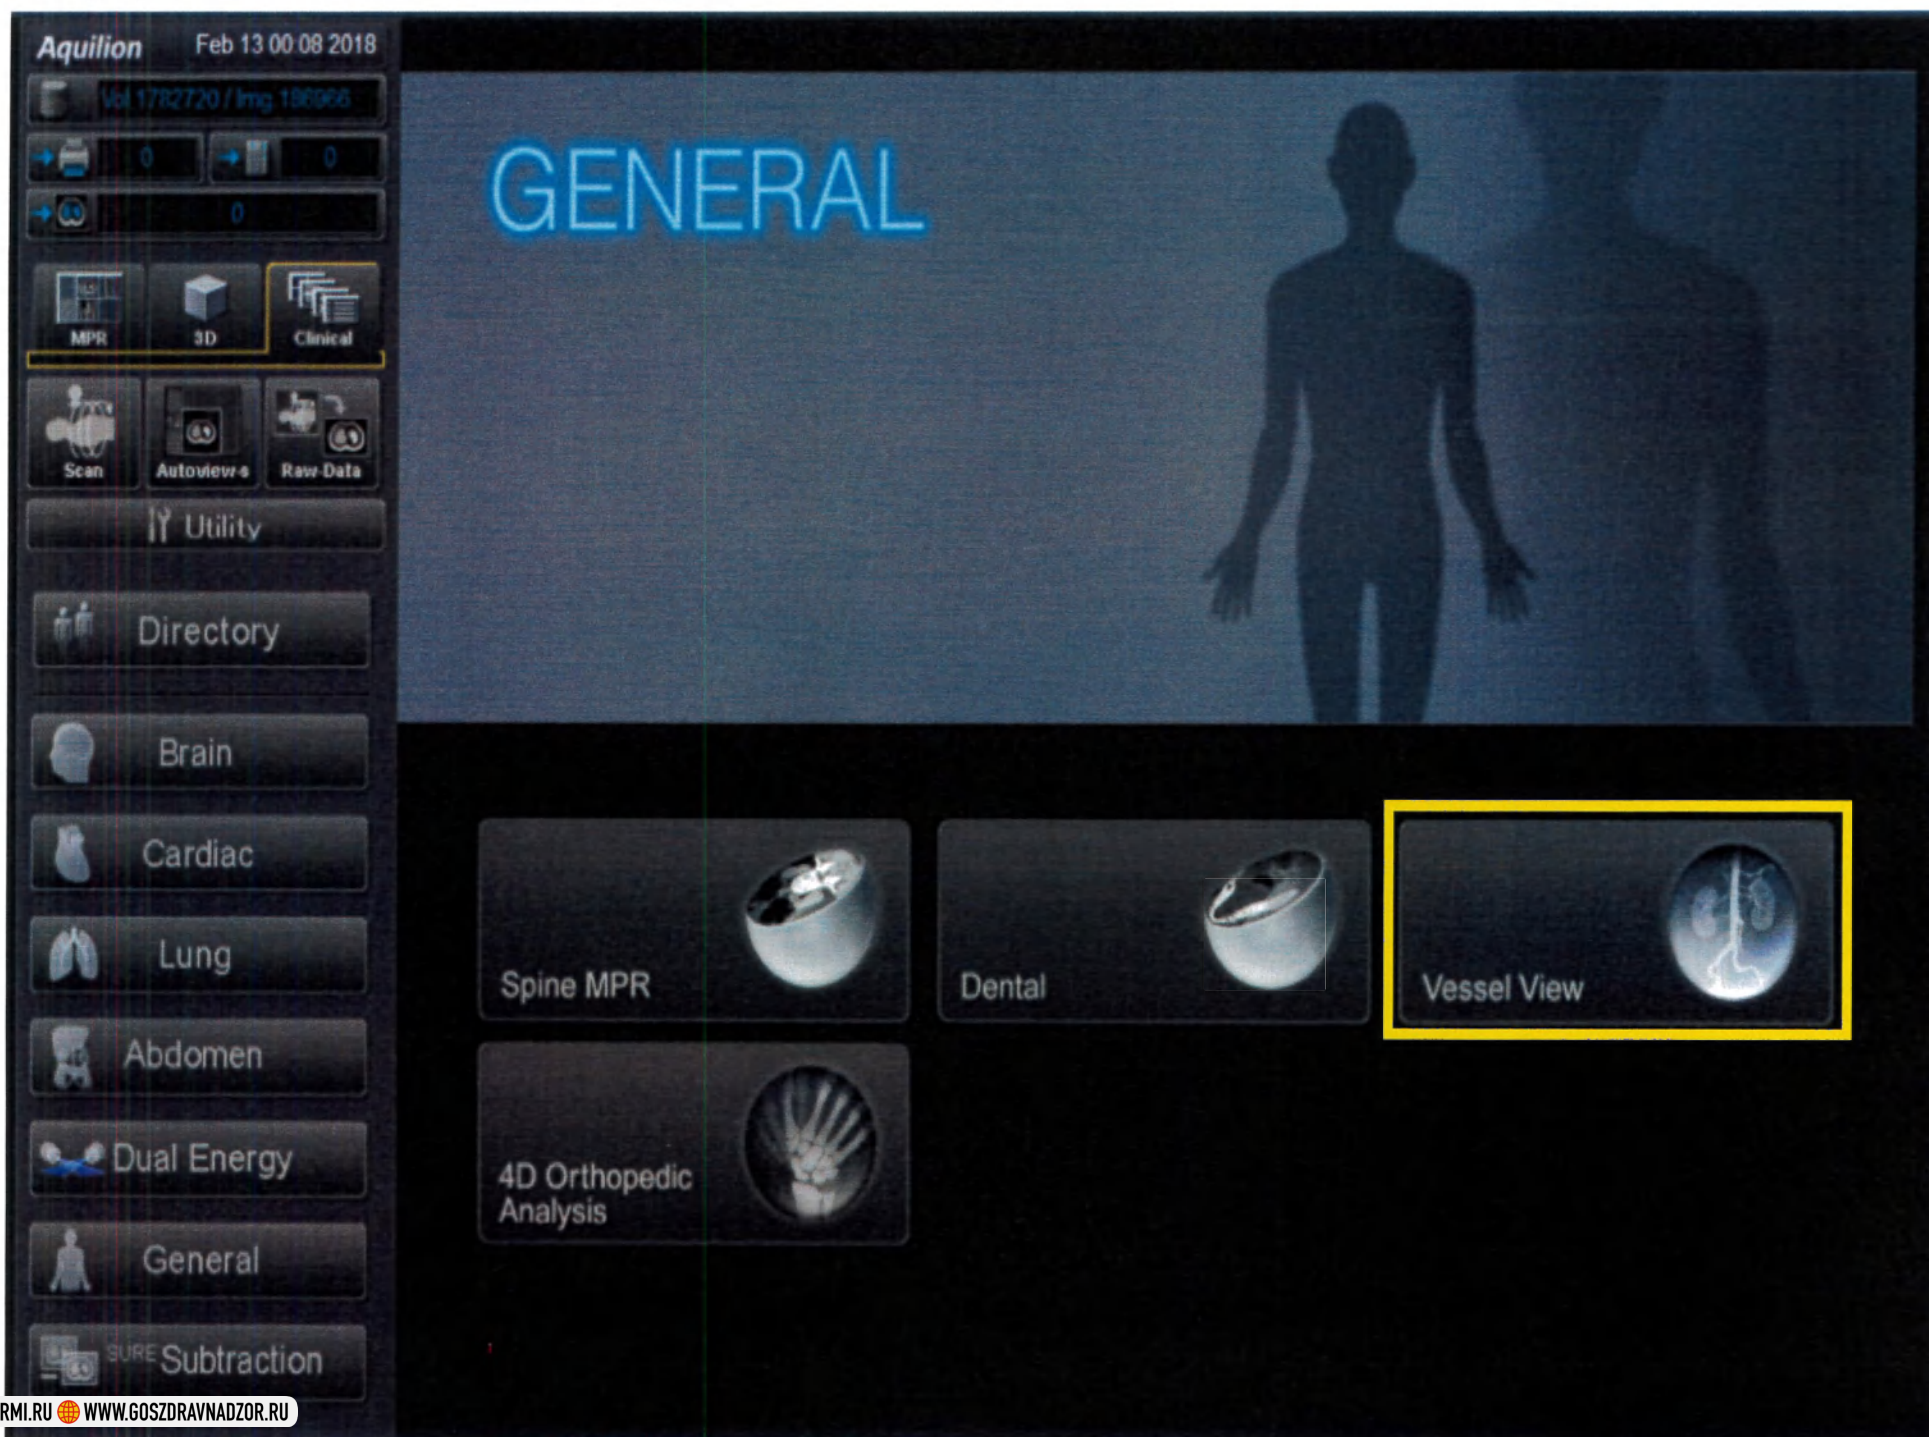

12. Программное обеспечение для анализа сосудов.

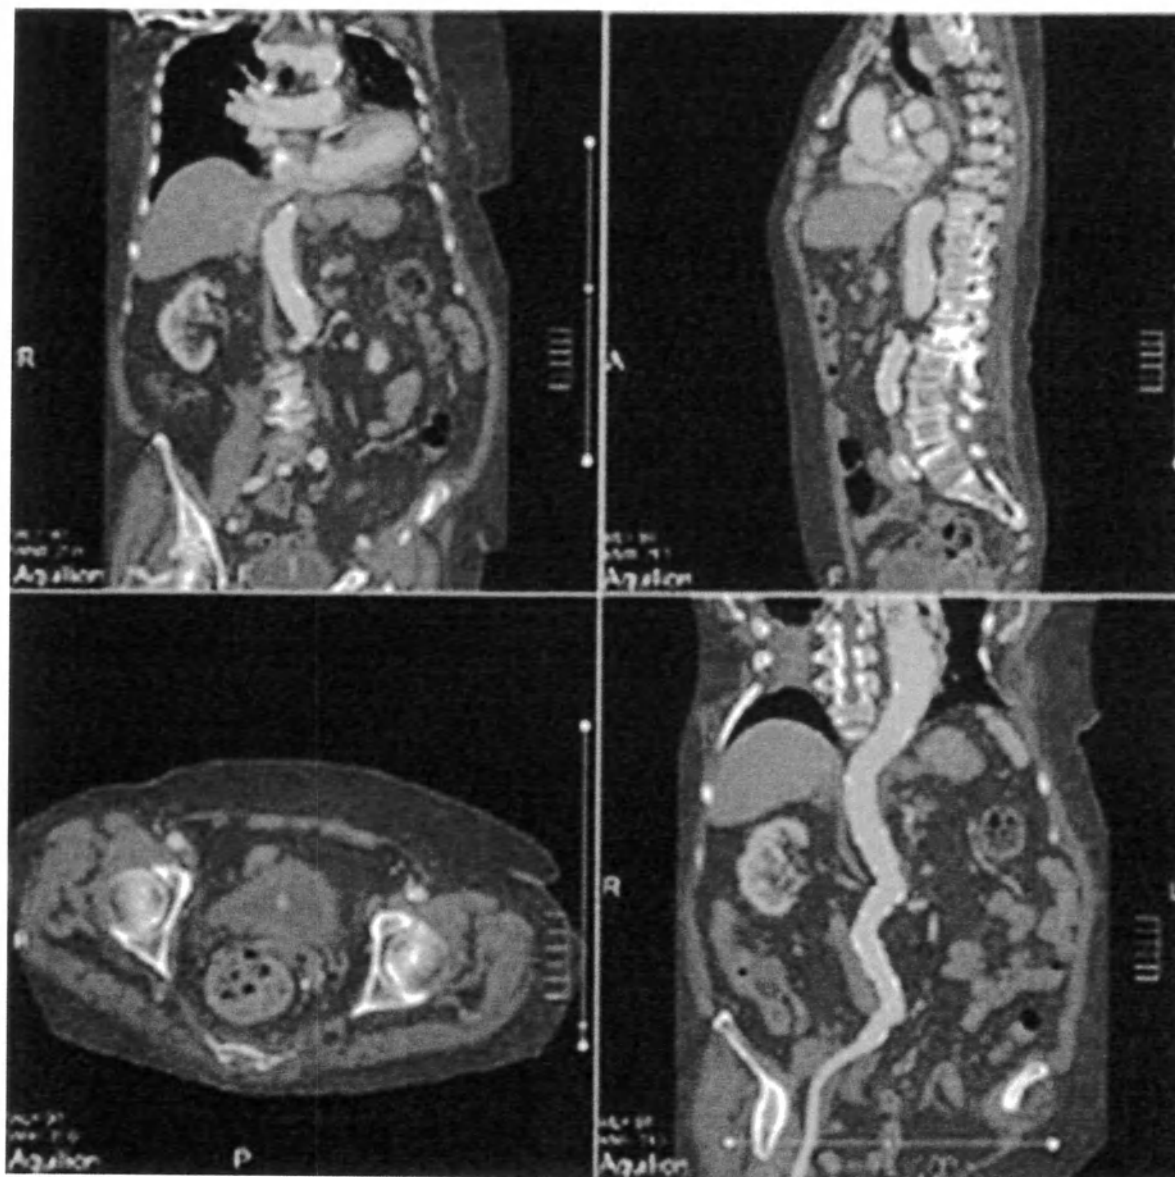


13. Модуль для удвоения количества срезов.




14. Программное обеспечение для реконструкции с ЭКГ синхронизацией.




14. Программное обеспечение для реконструкции с ЭКГ синхронизацией.

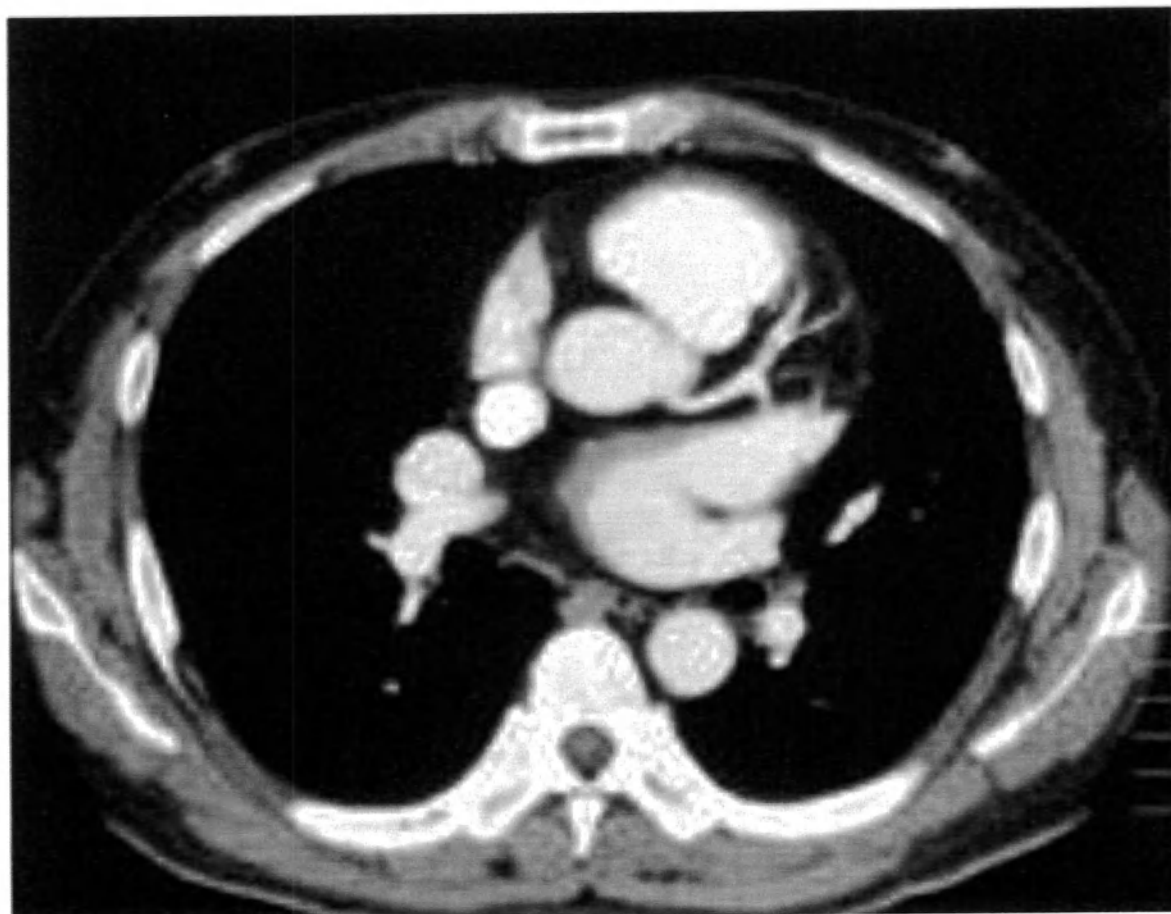

15. Программное обеспечение для сканирования с ЭКГ синхронизацией.

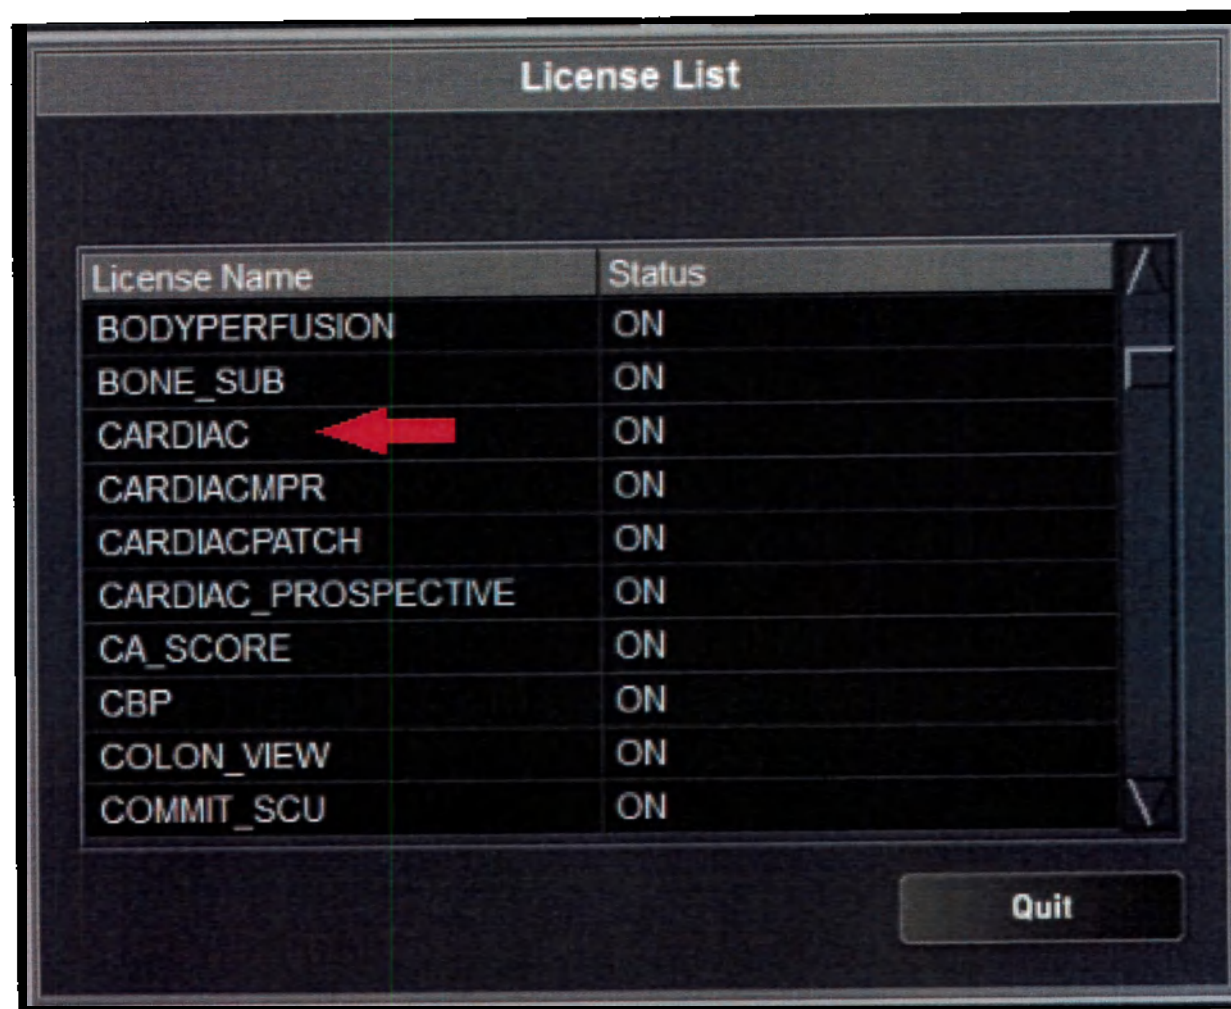


15. Программное обеспечение для сканирования с ЭКГ синхронизацией.

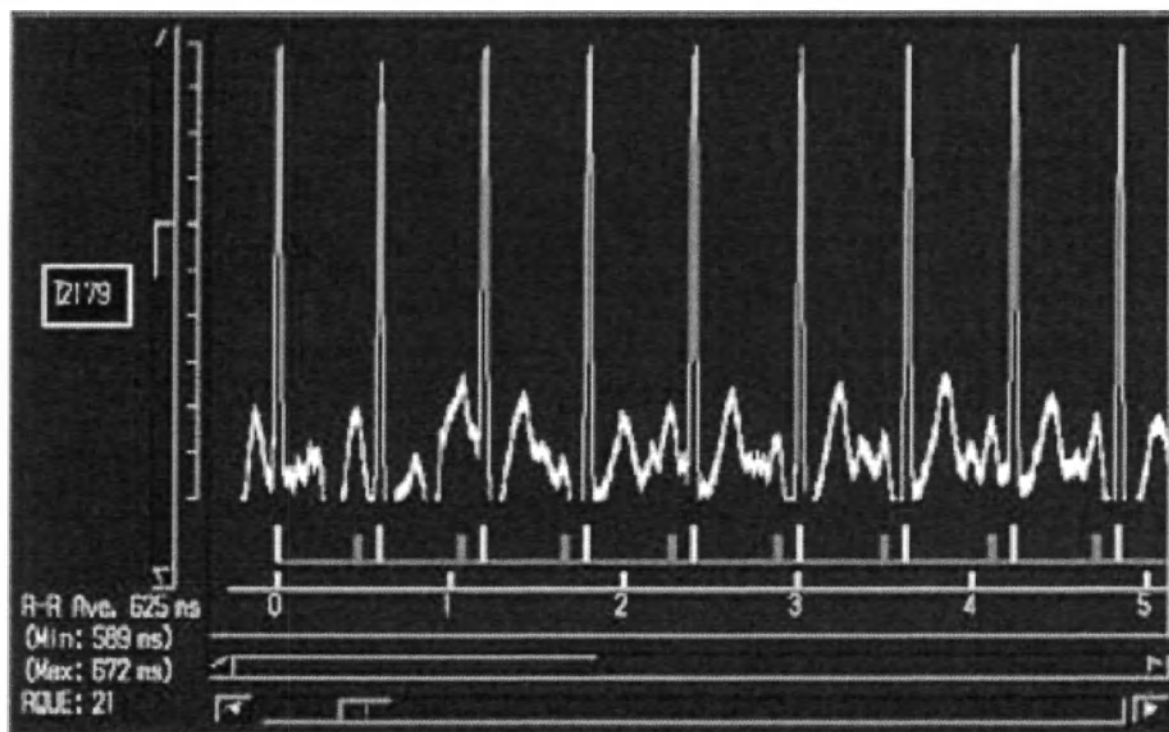


Scan				Edit				Scan Settings				Process Details			
Scan															
1	Heart rate box		Breath Det.		Breath hold time		Reference		vt	wt	ref. time	Range	Scan	Ref. Power	
2	63-64		159.52 ms		7.4		11.544		120	M300	0.4	90.0	ON	1053.0	
3	Heart rate		Time resolution		Detail		R		2.10v	EM. wt	Total Scan time	Direction	Image Thickness	Max. Scan time	
63-64		159.52 ms		Detail		16.4		100.0(1.2)	834	6.511	0/2	0.5	60.111		
Correction mode: Drive To Stop															
Best Phase + Window AutoPhase															
R-R Power		Scan Mode		ImageFact		CCT		ON	Comment	CAPSAR CTA		Recon. Frame		Frame	
0		2000		Secret		OFF		ON				0.3		Still	
Copy New Scan Delete															
Breath Control Confirm															


16. Программное обеспечение для сканирования с переменным питчем.

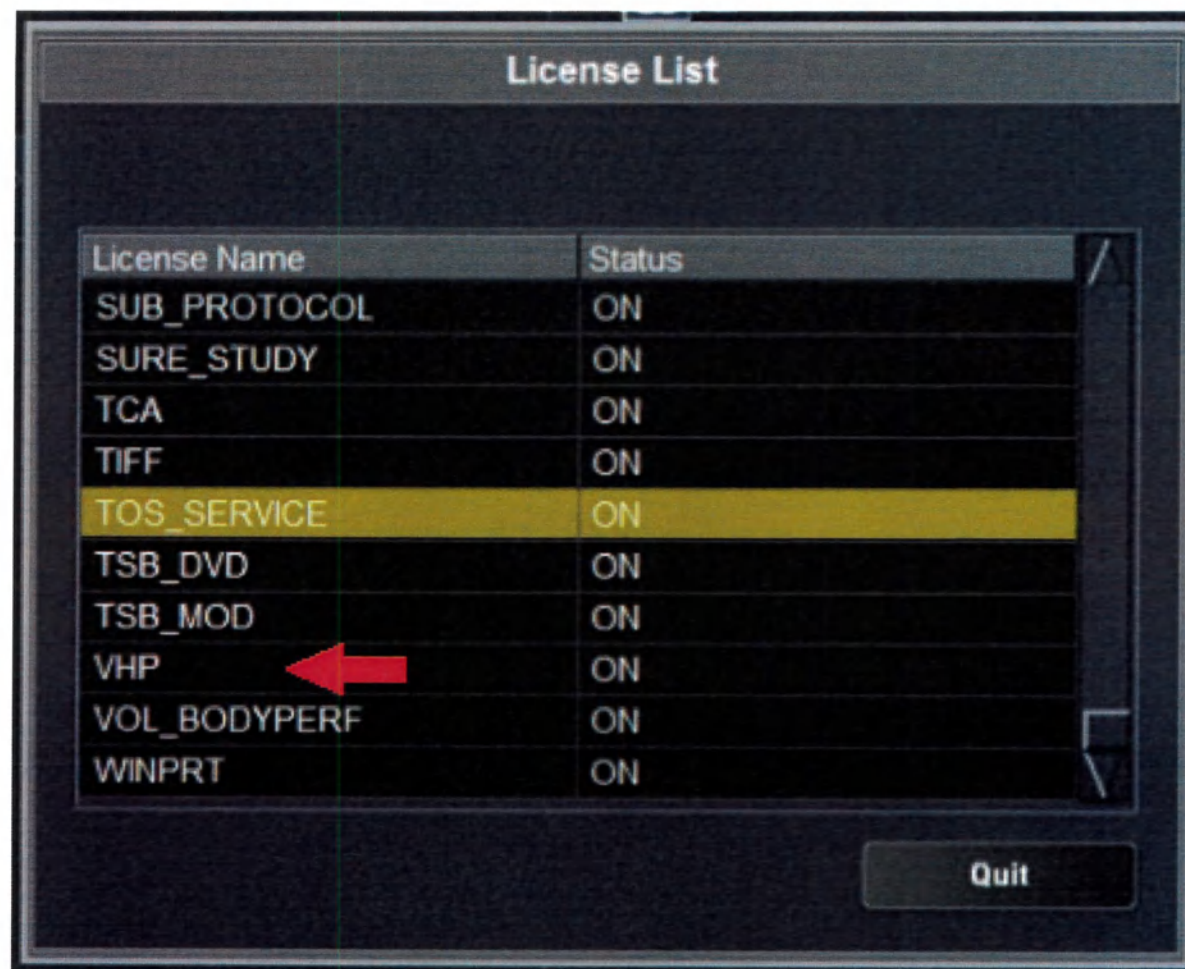

16. Программное обеспечение для сканирования с переменным питчем.

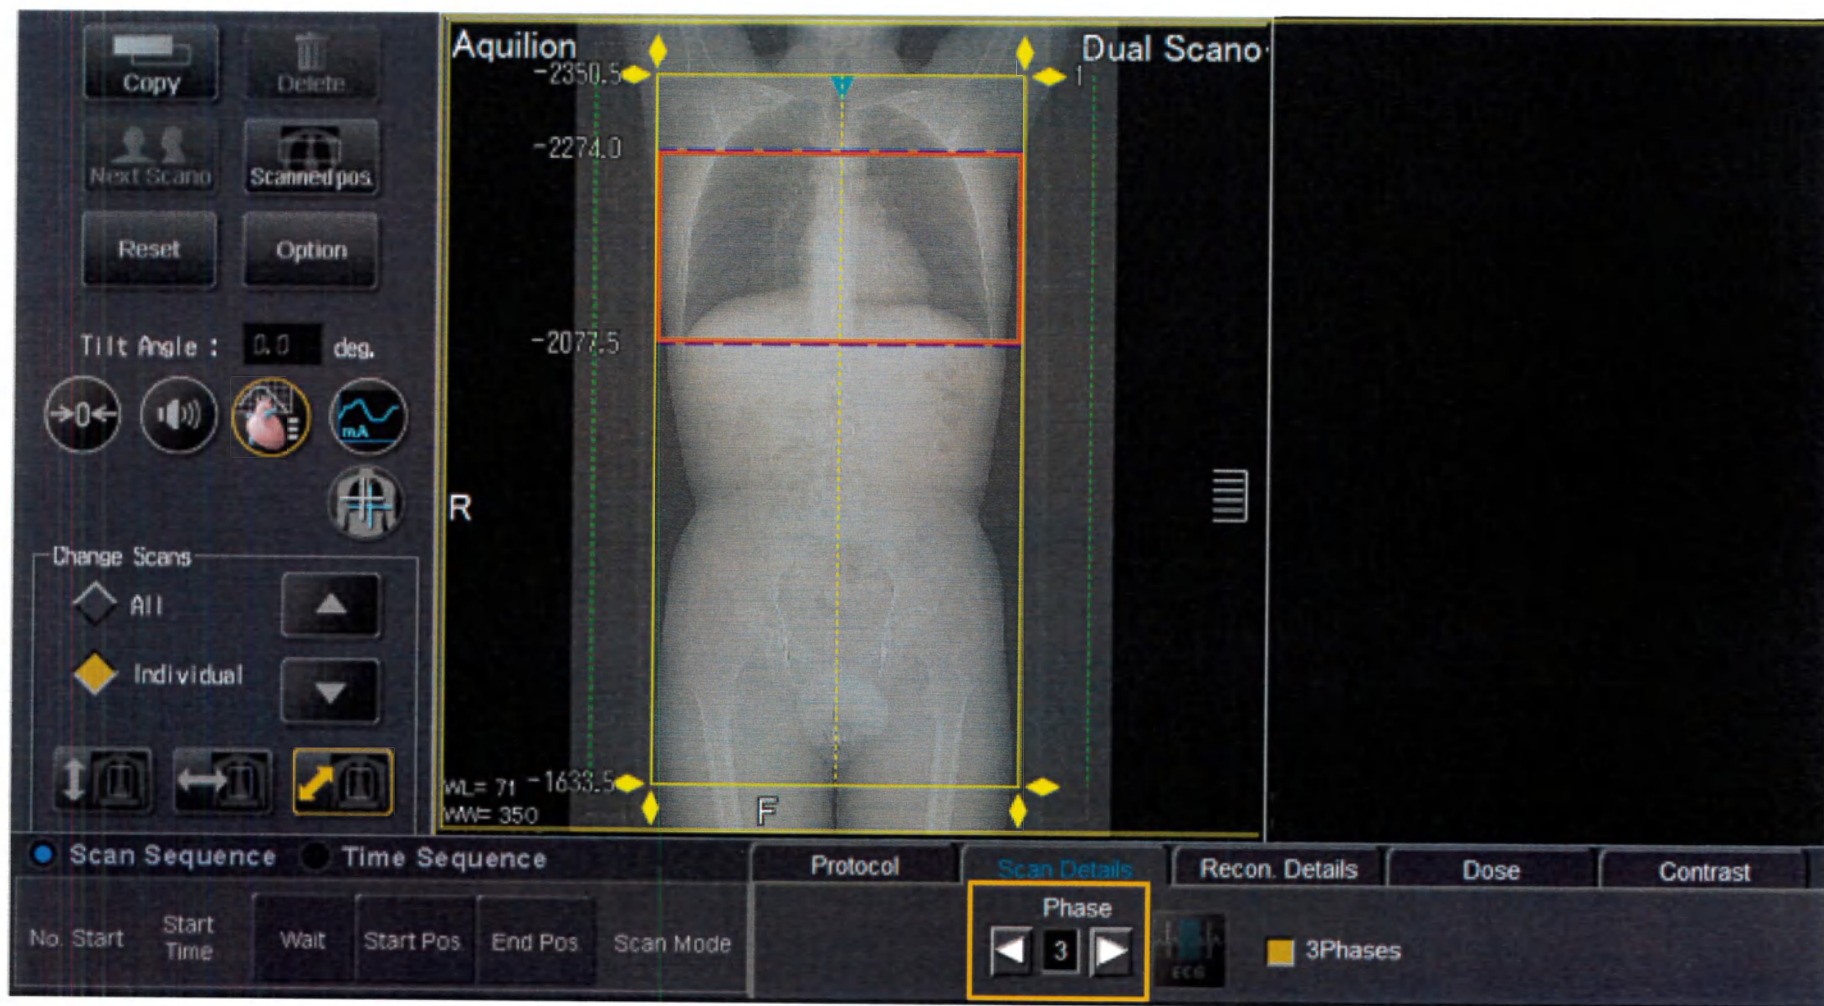


17. Программное обеспечение для сканирования с синхронизацией инжектора.

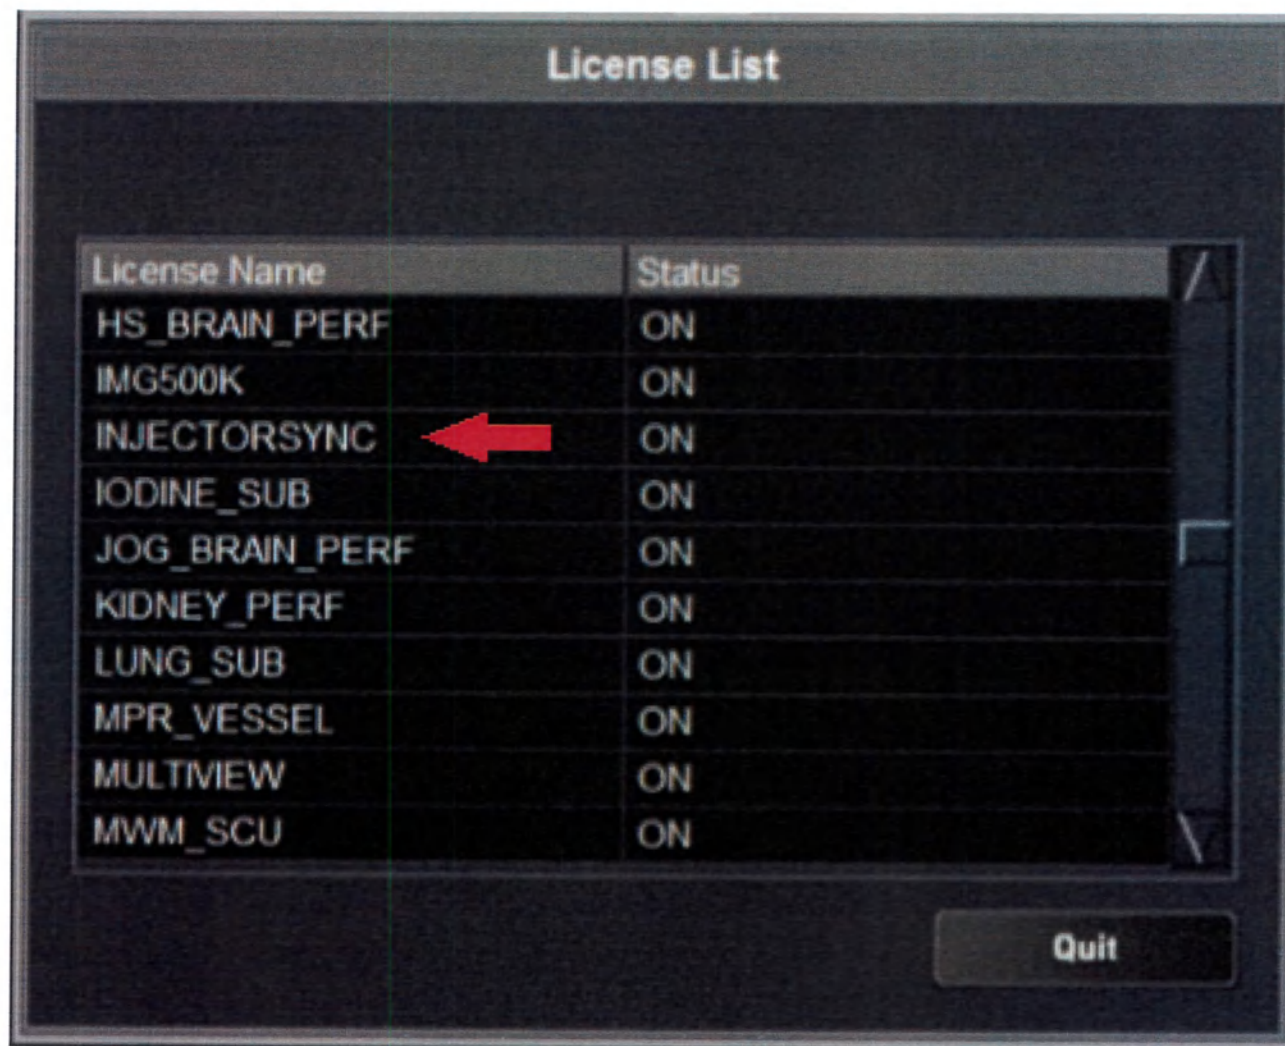

18. Интерфейс инжектора для введения контрастного вещества.




19. Программное обеспечение для сканирования с согласованием траекторий.

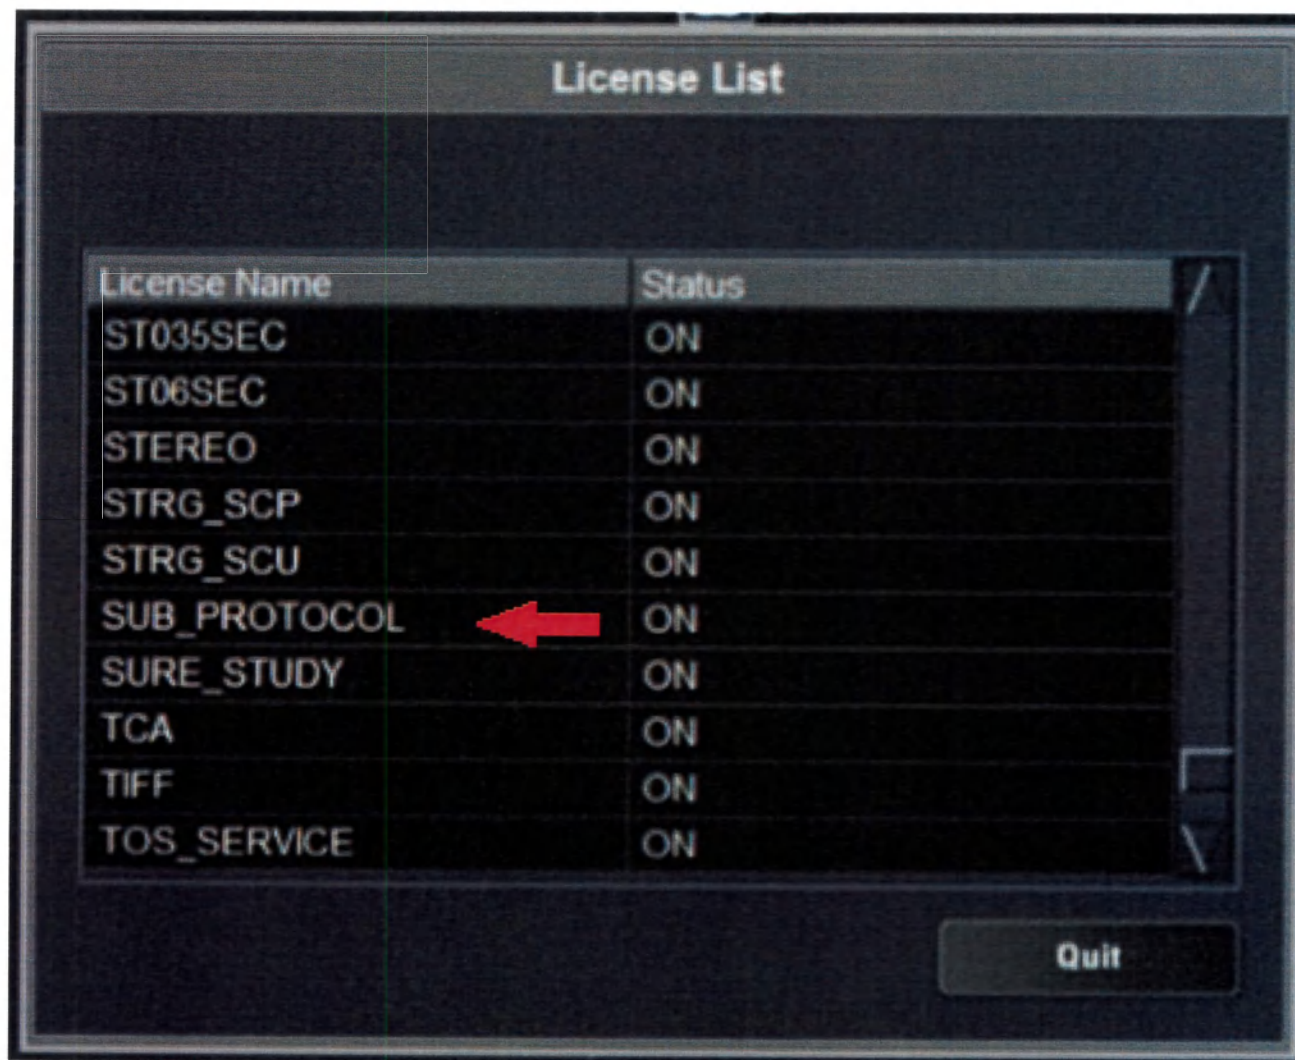




21. Программное обеспечение для картирования распределения йода.

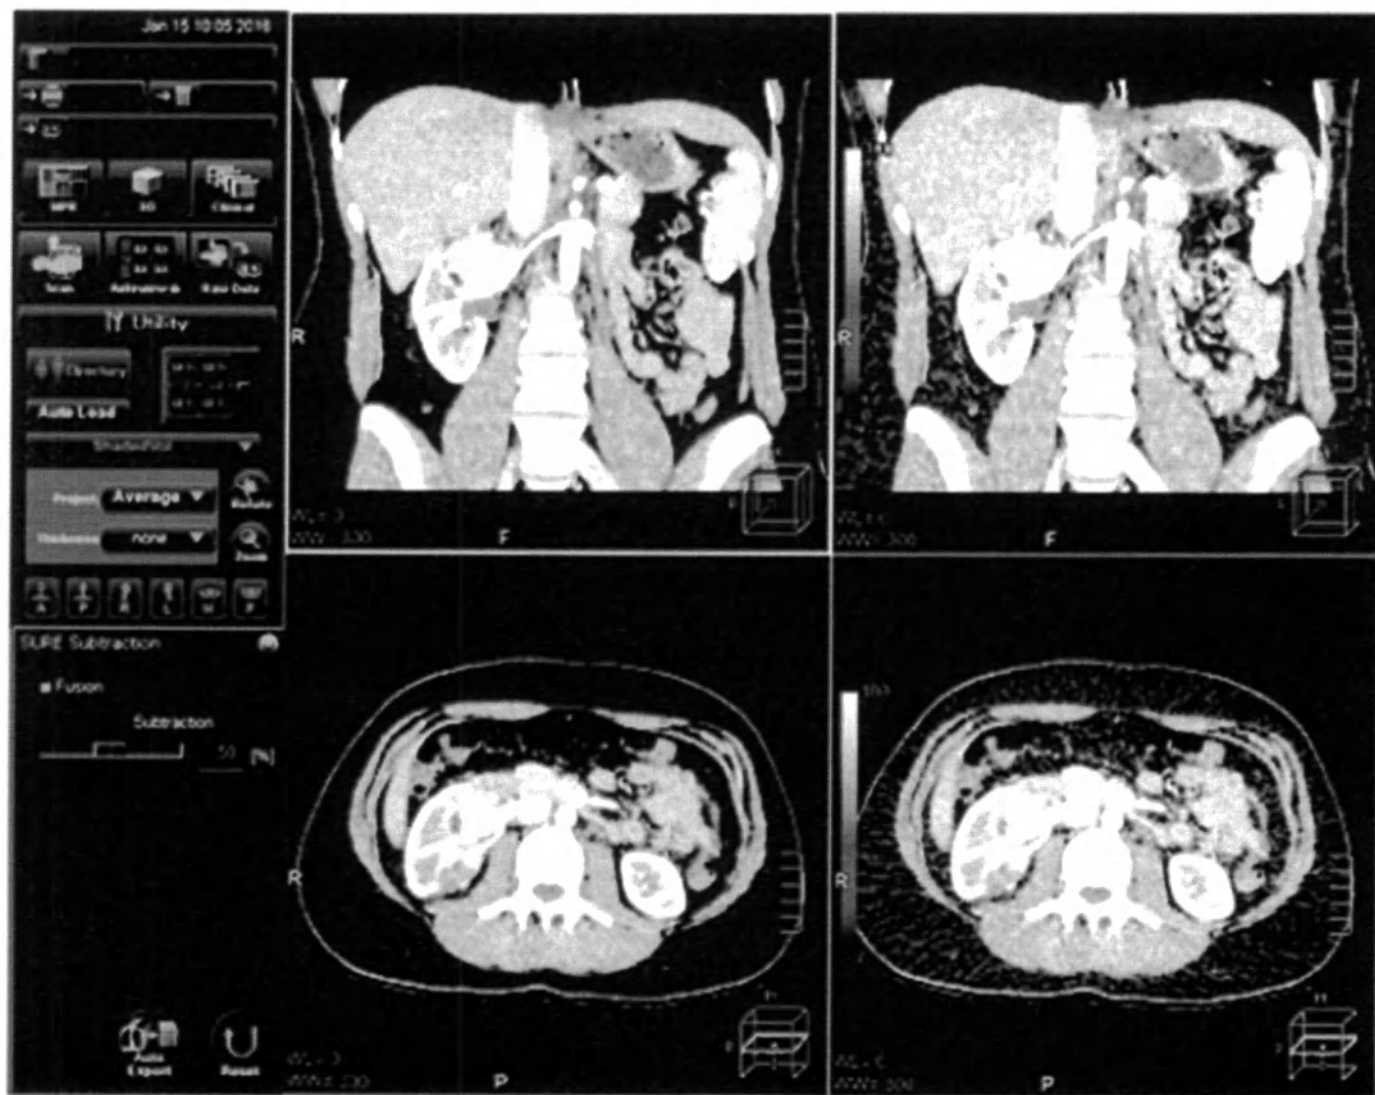



22. Модуль для сканирования в режиме субтракции.

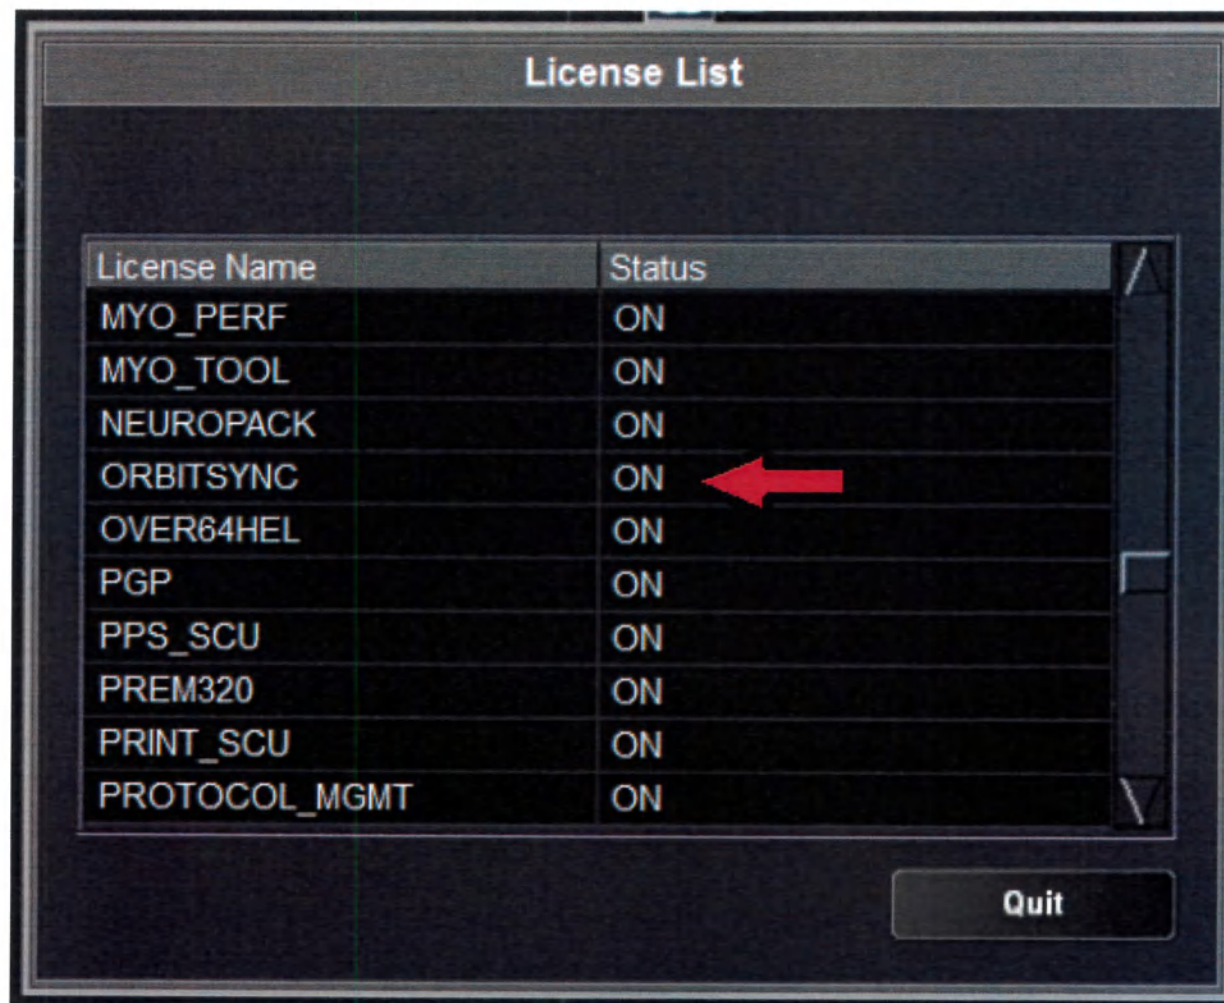


23. Интерфейс цветного принтера.



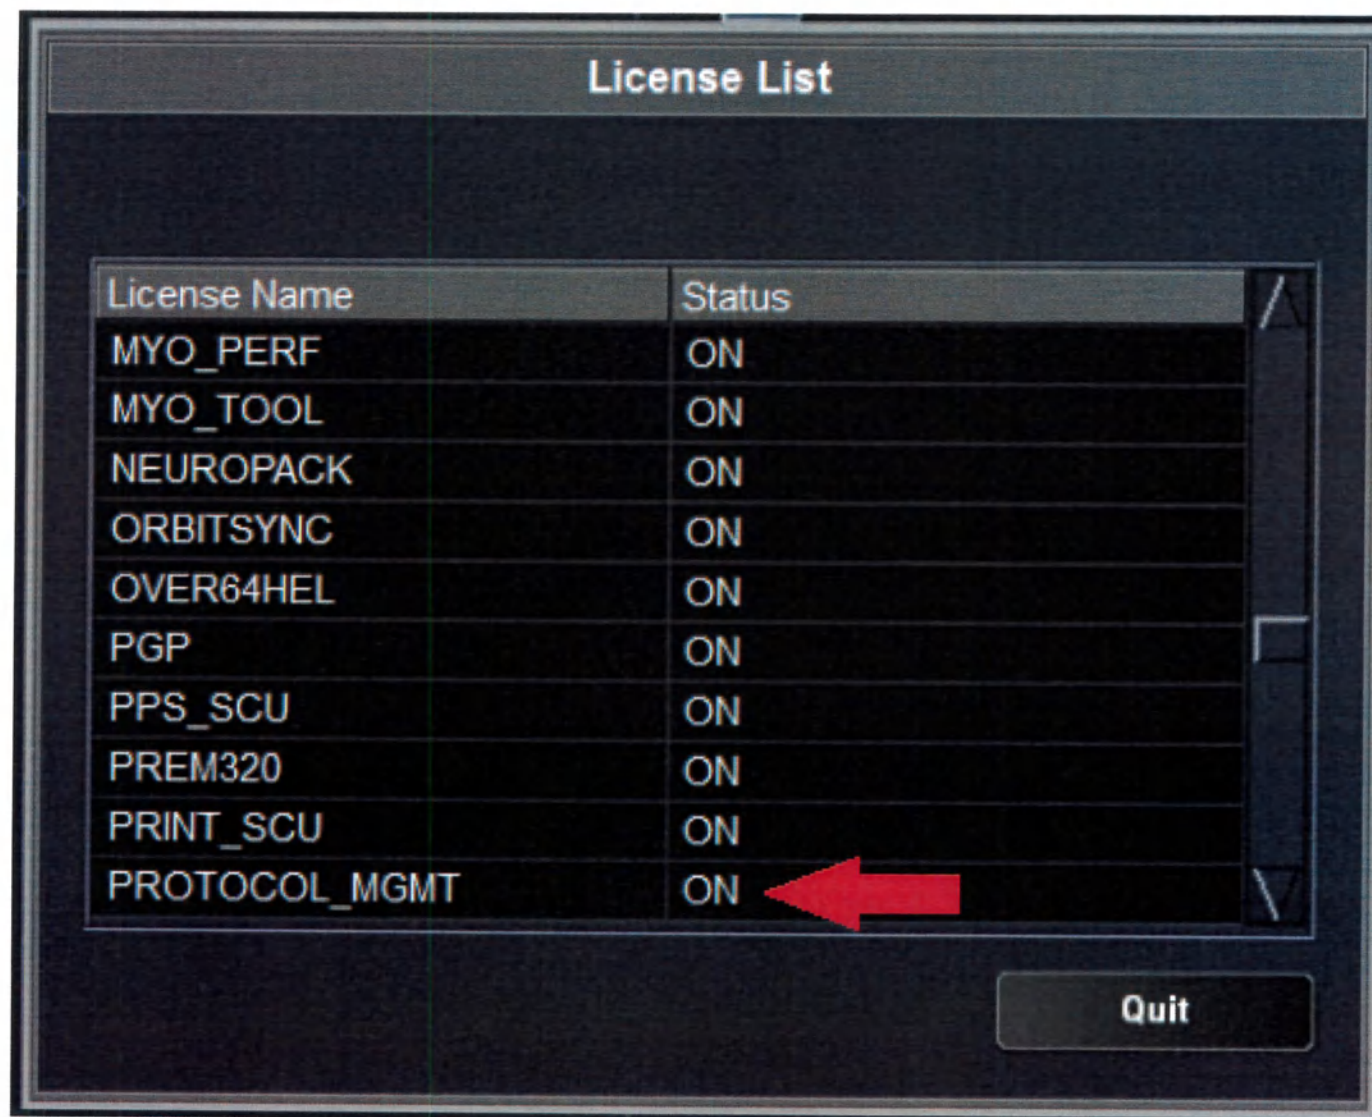


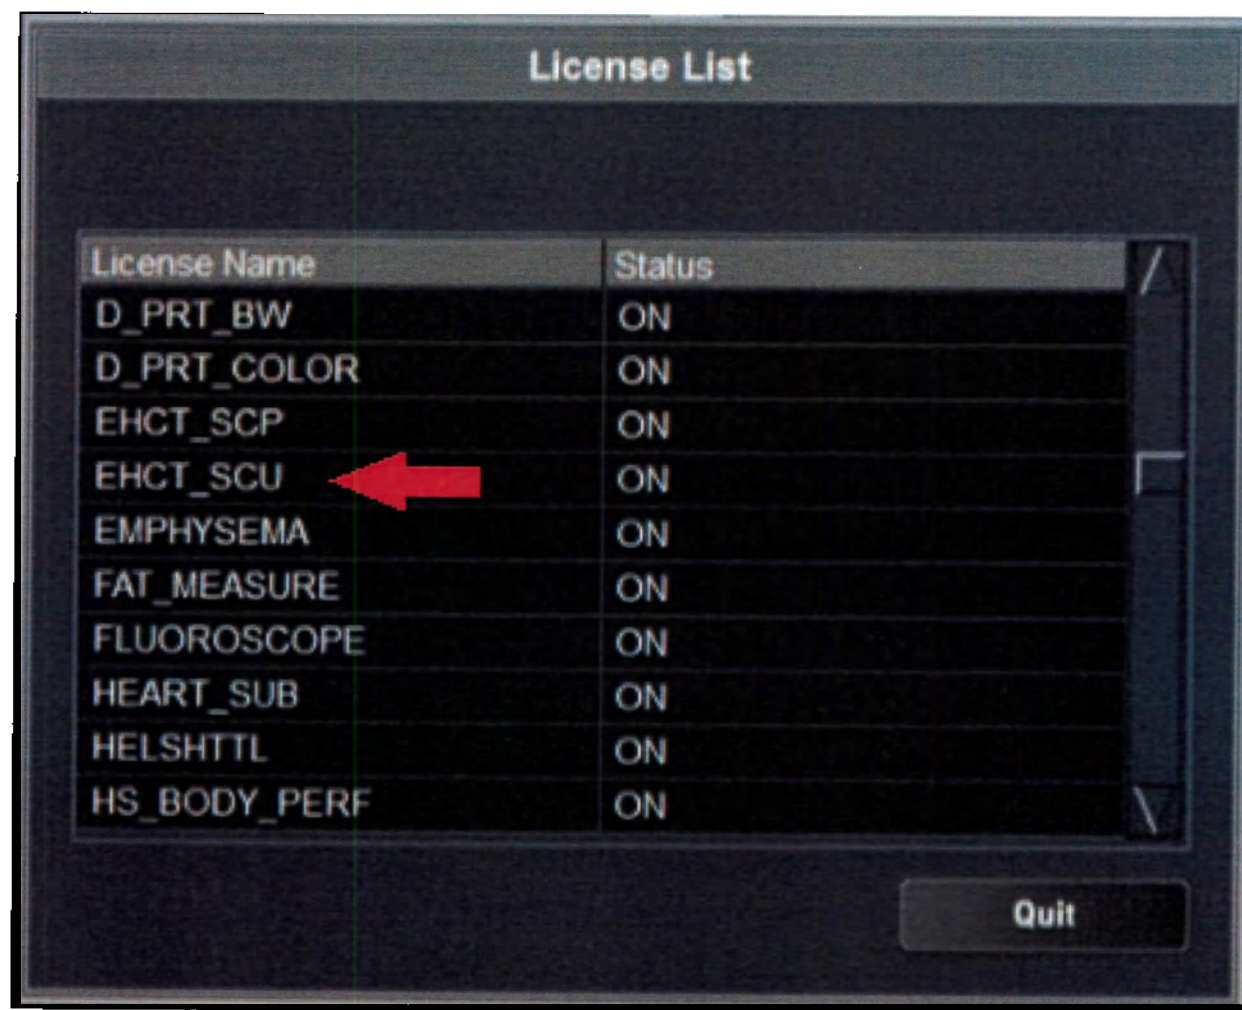


26. Интерфейс DICOM выполненный этап процедуры модальности MPPS.

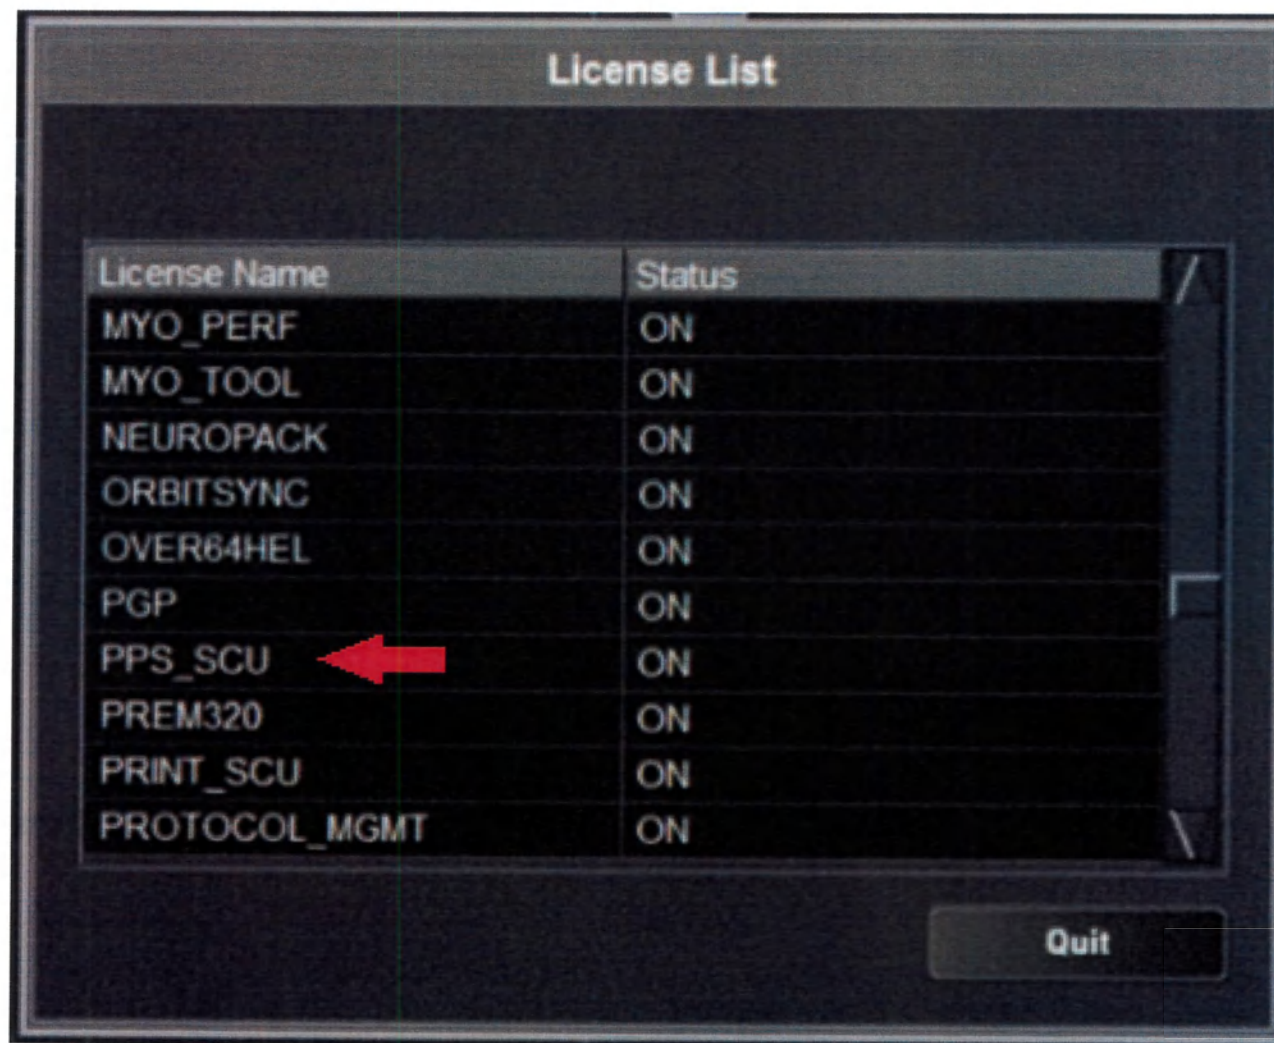


27. Интерфейс DICOM управление списком модальностей MWM.

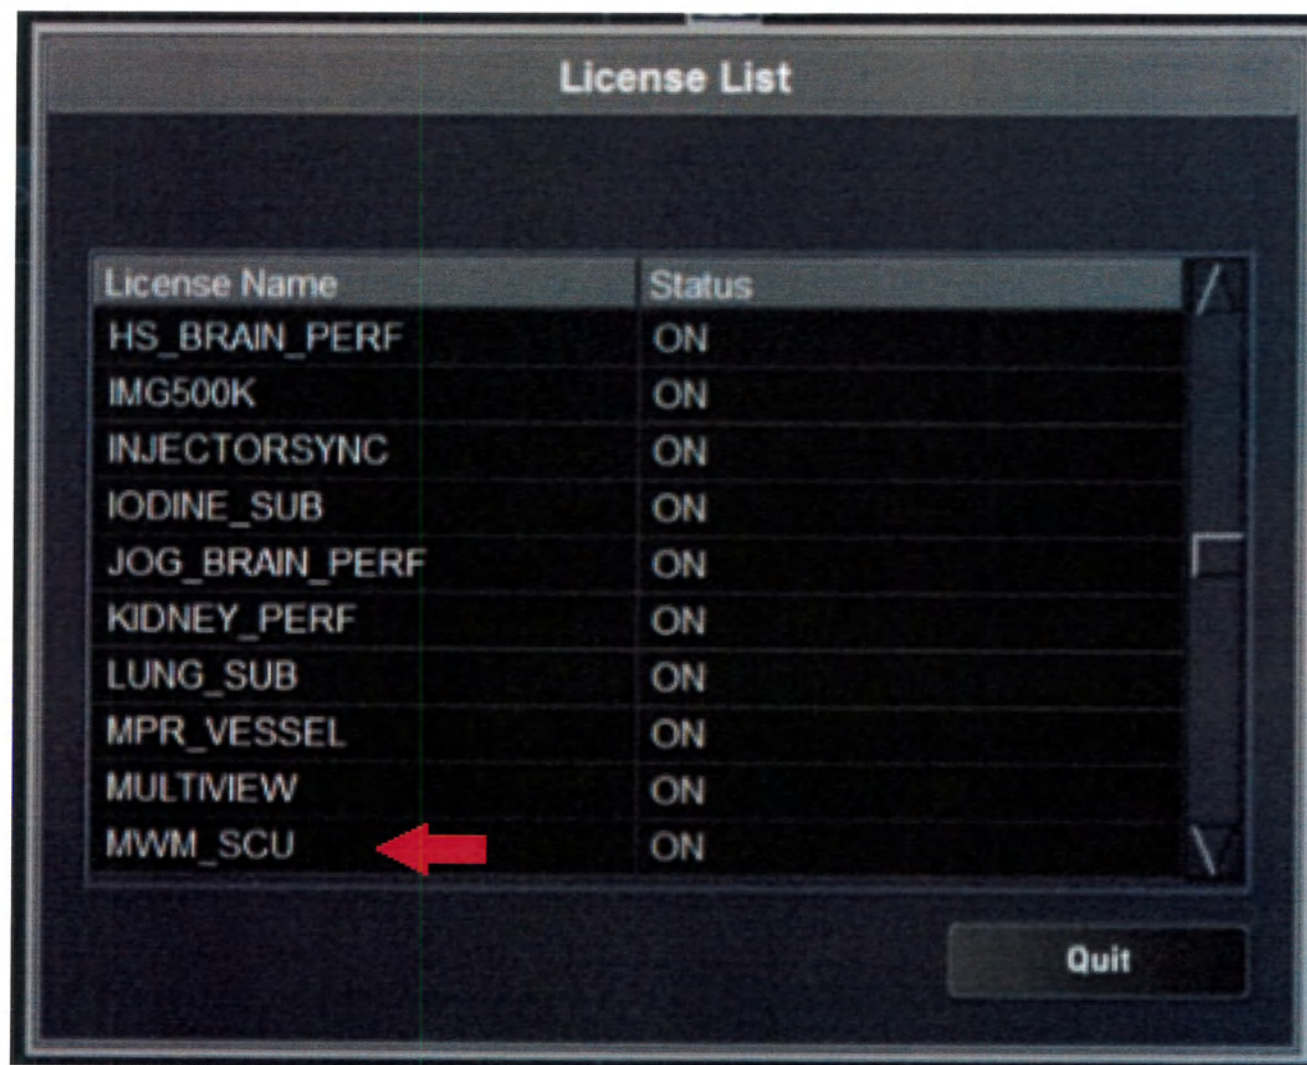

28. Интерфейс DICOM профиль PGP.

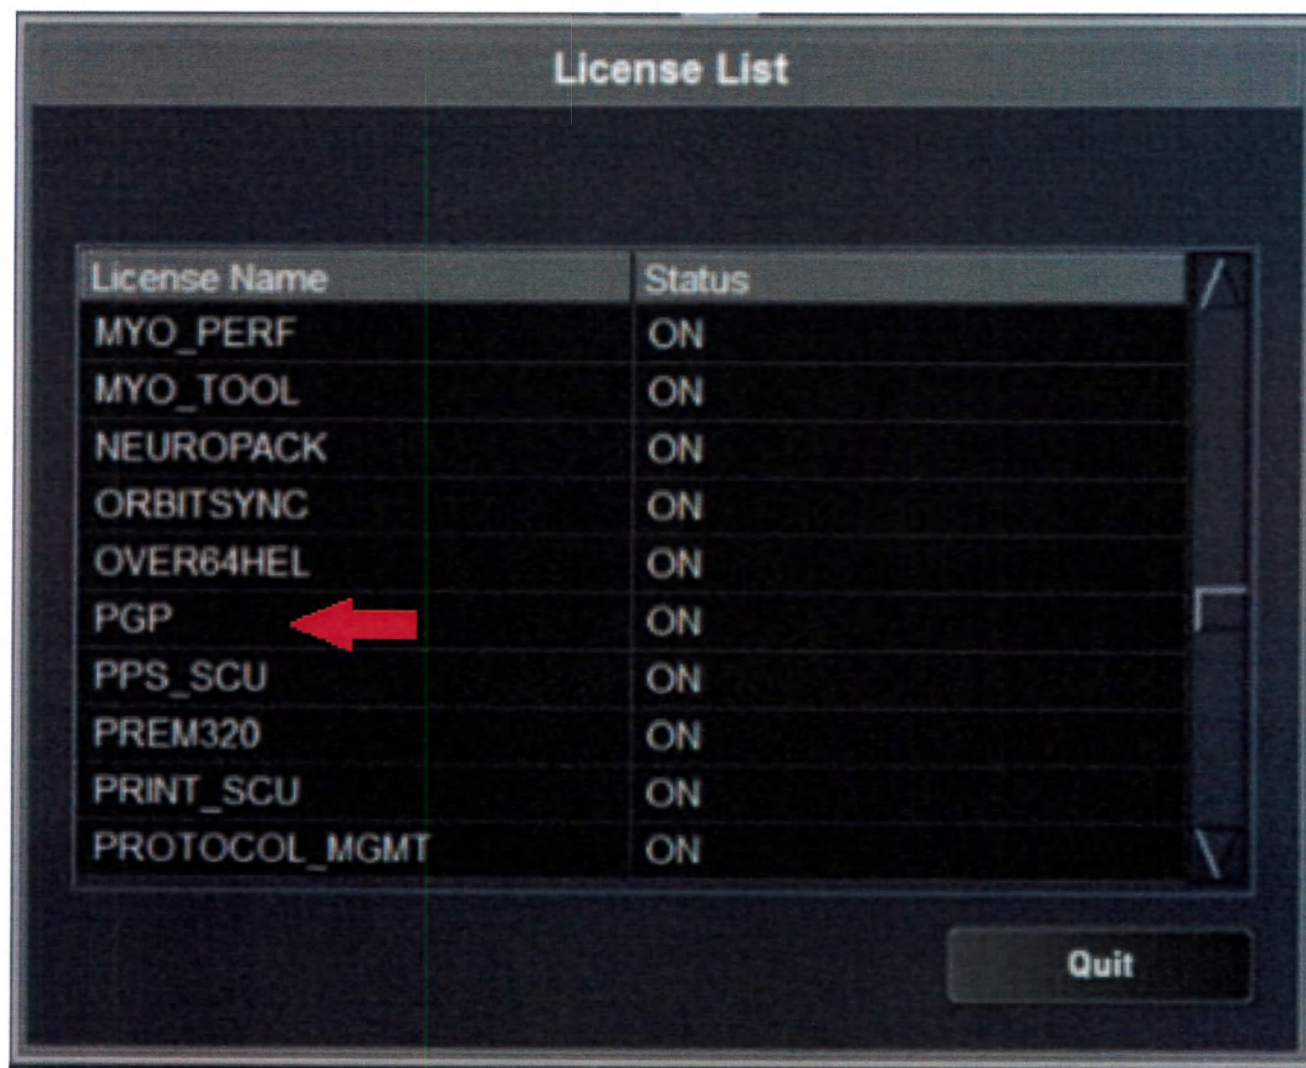

29. Интерфейс DICOM очередность и вызов Q/R SCP.

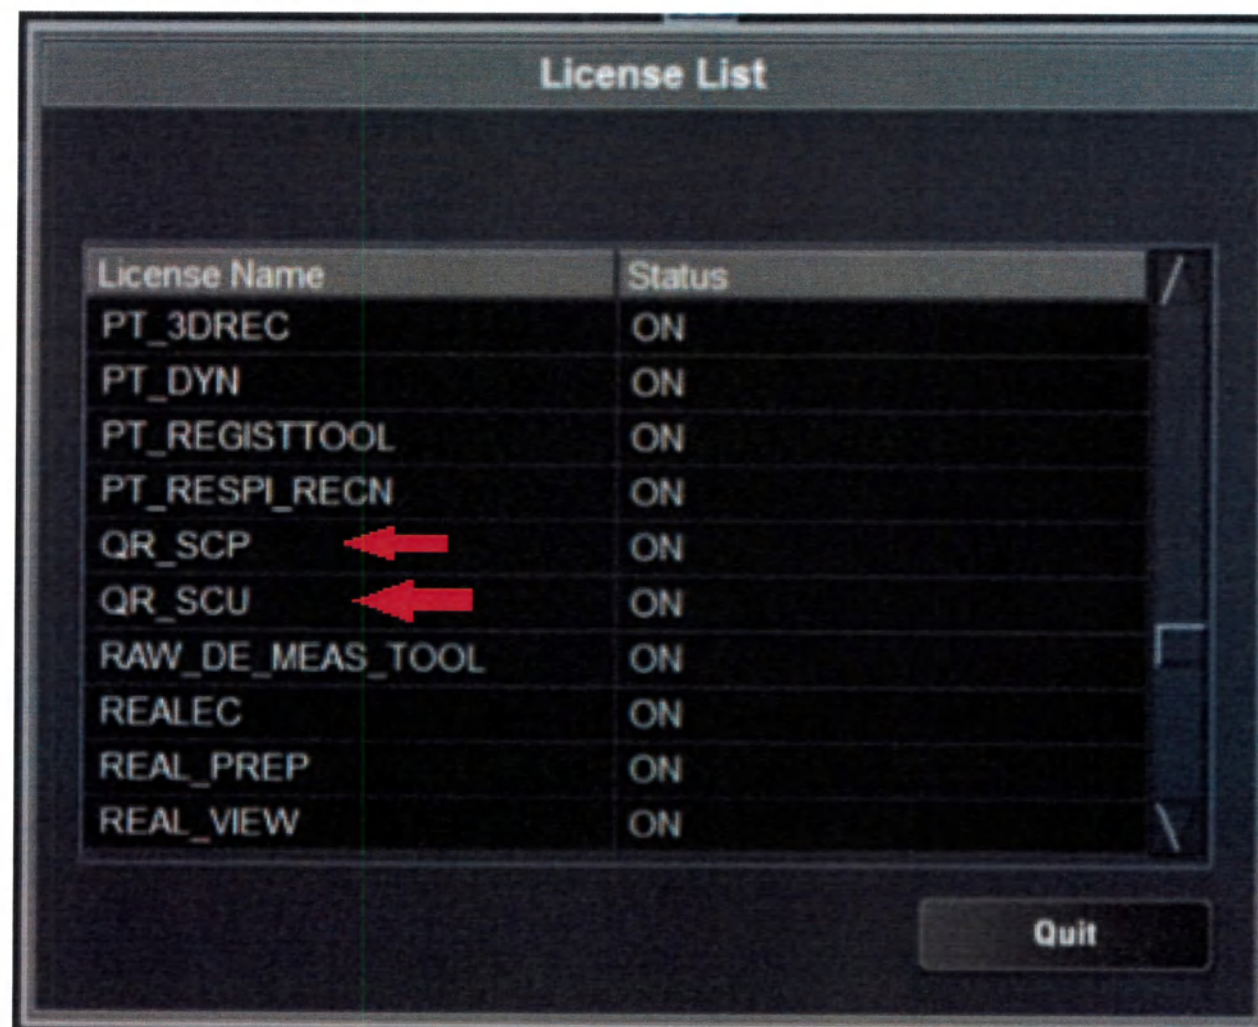


The screenshot shows a window titled "License List" with a table of licenses. The table has two columns: "License Name" and "Status". The licenses listed are PT_3DREC, PT_DYN, PT_REGISTTOOL, PT_RESPI_RECIN, QR_SCP, QR_SCU, RAW_DE_MEAS_TOOL, REALEC, REAL_PREP, and REAL_VIEW. All licenses are marked as "ON". Two red arrows point to the "QR_SCP" and "QR_SCU" rows. A "Quit" button is located at the bottom right of the window.

License Name	Status
PT_3DREC	ON
PT_DYN	ON
PT_REGISTTOOL	ON
PT_RESPI_RECIN	ON
QR_SCP	ON
QR_SCU	ON
RAW_DE_MEAS_TOOL	ON
REALEC	ON
REAL_PREP	ON
REAL_VIEW	ON

Quit

30. Интерфейс DICOM очередность и вызов Q/R SCU.

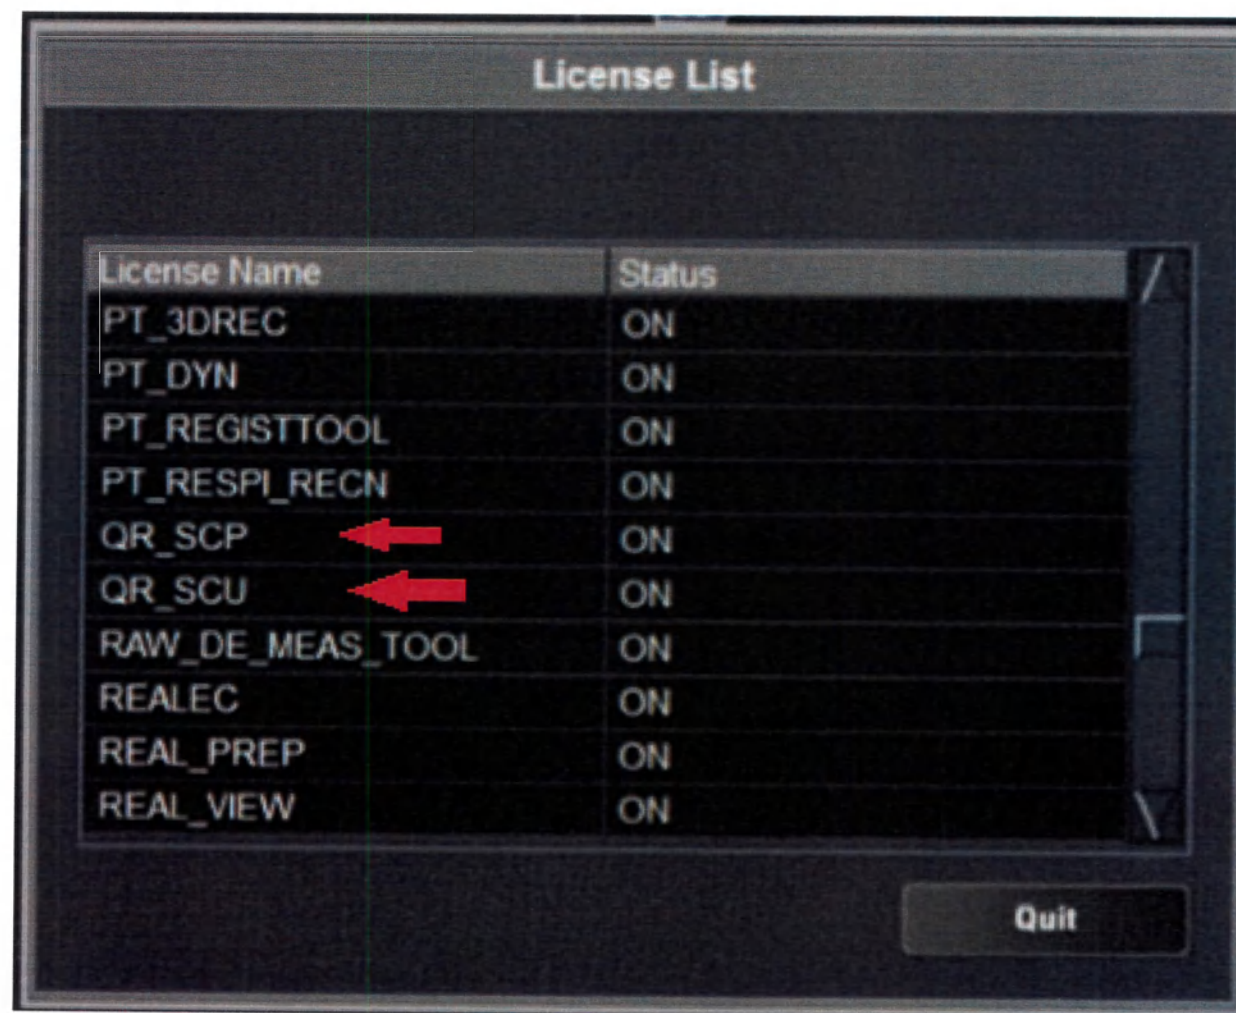



32. Интерфейс DICOM сохранение.




33. Педальный блок для передней части стола пациента.




34. Педальный блок для задней части стола пациента.



35. Модуль установки плоской деки стола для планирования лучевой терапии.

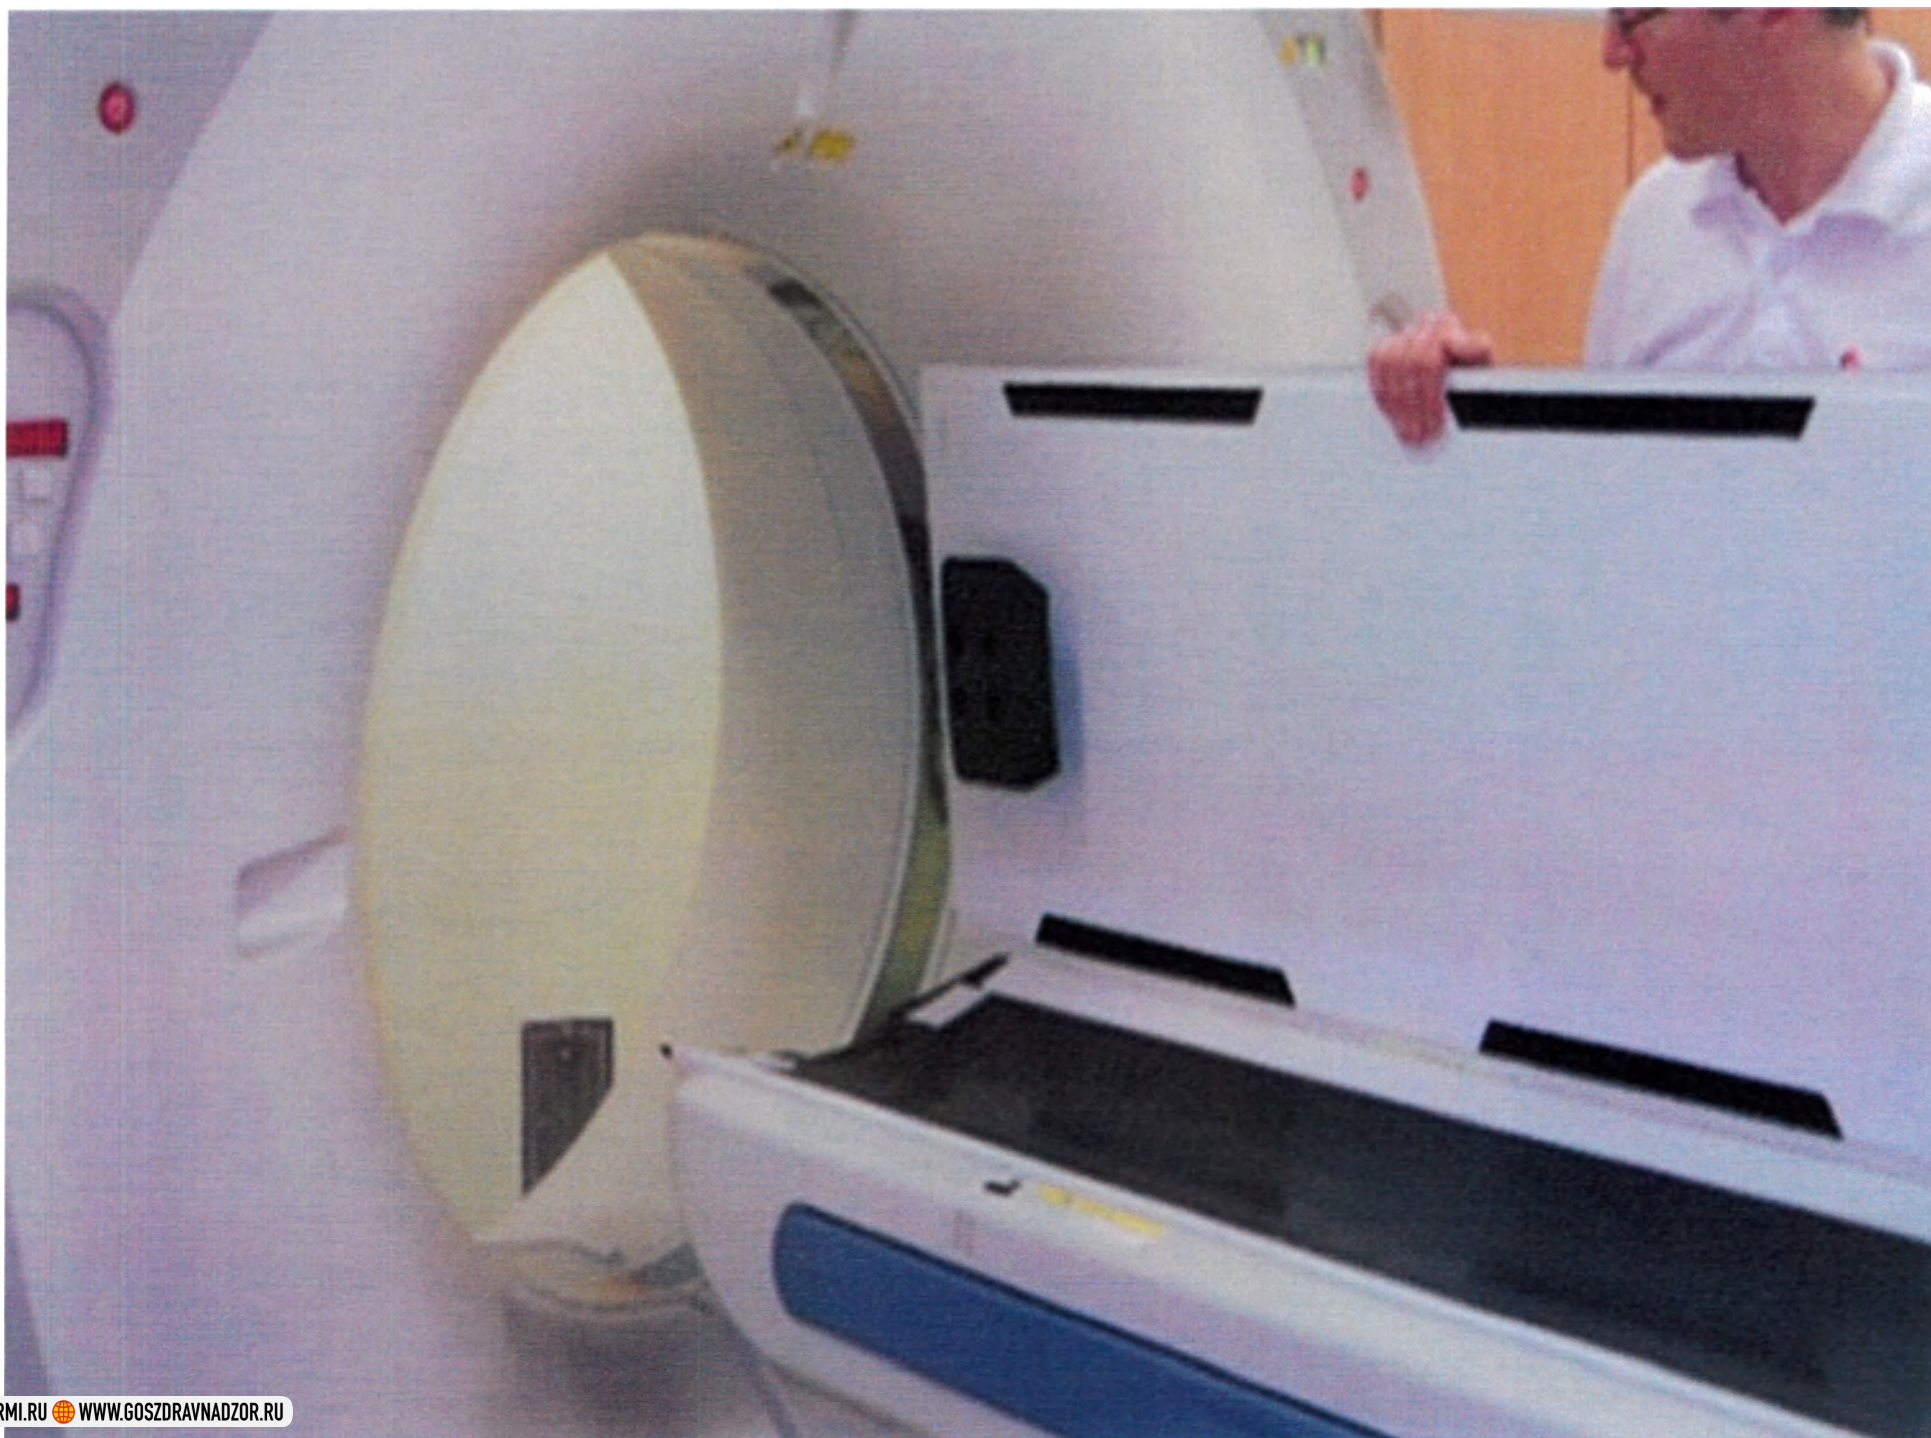


36. Плоская дека стола для планирования лучевой терапии.

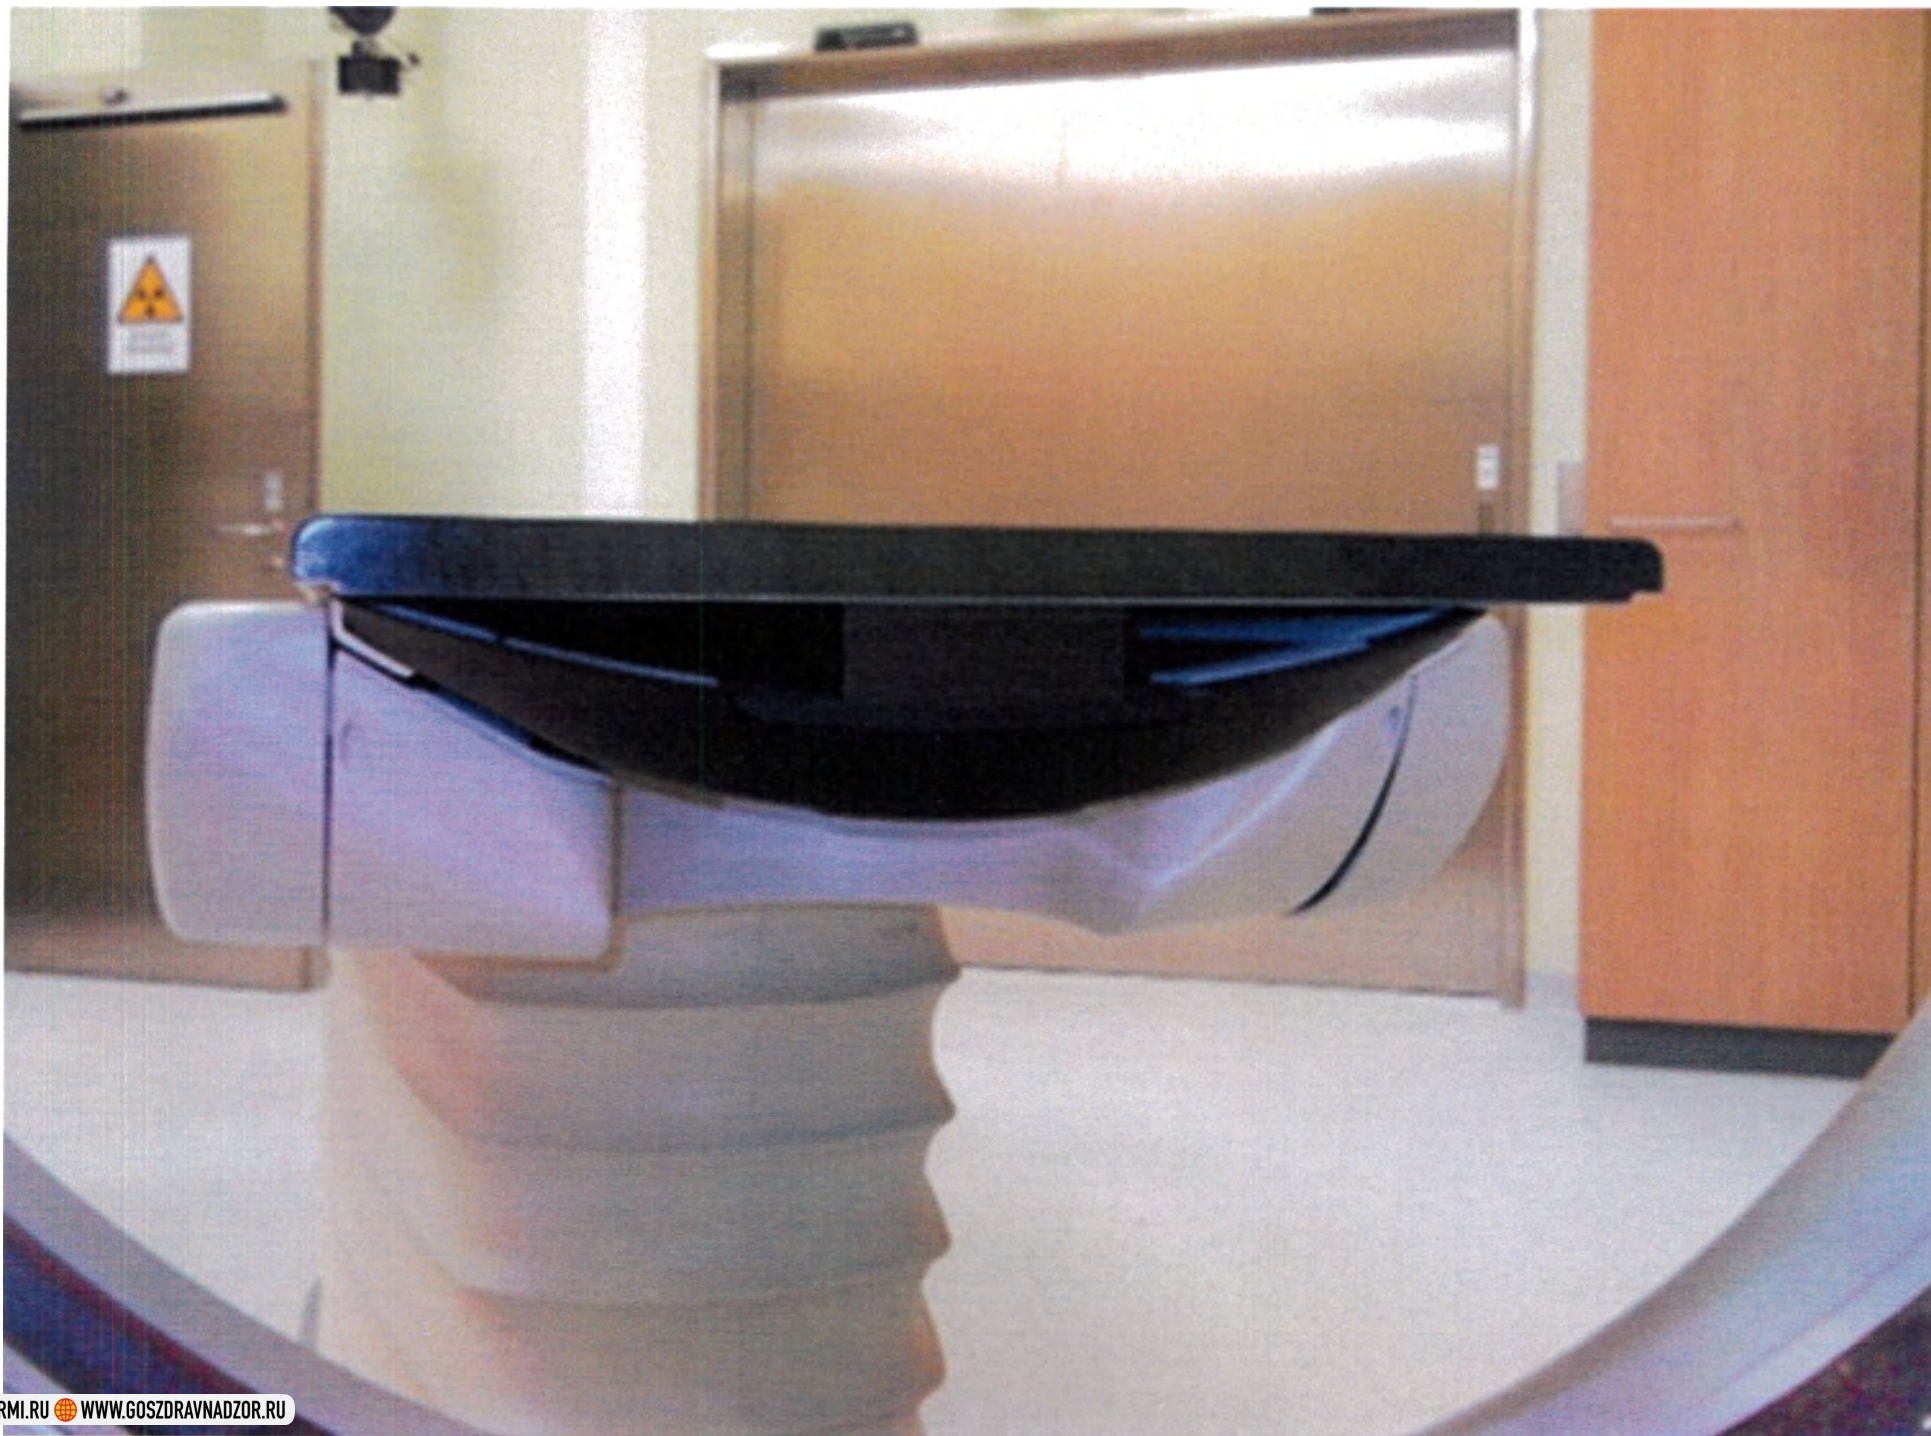

36. Плоская дека стола для планирования лучевой терапии.



37. Комплект короткого хода деки стола.

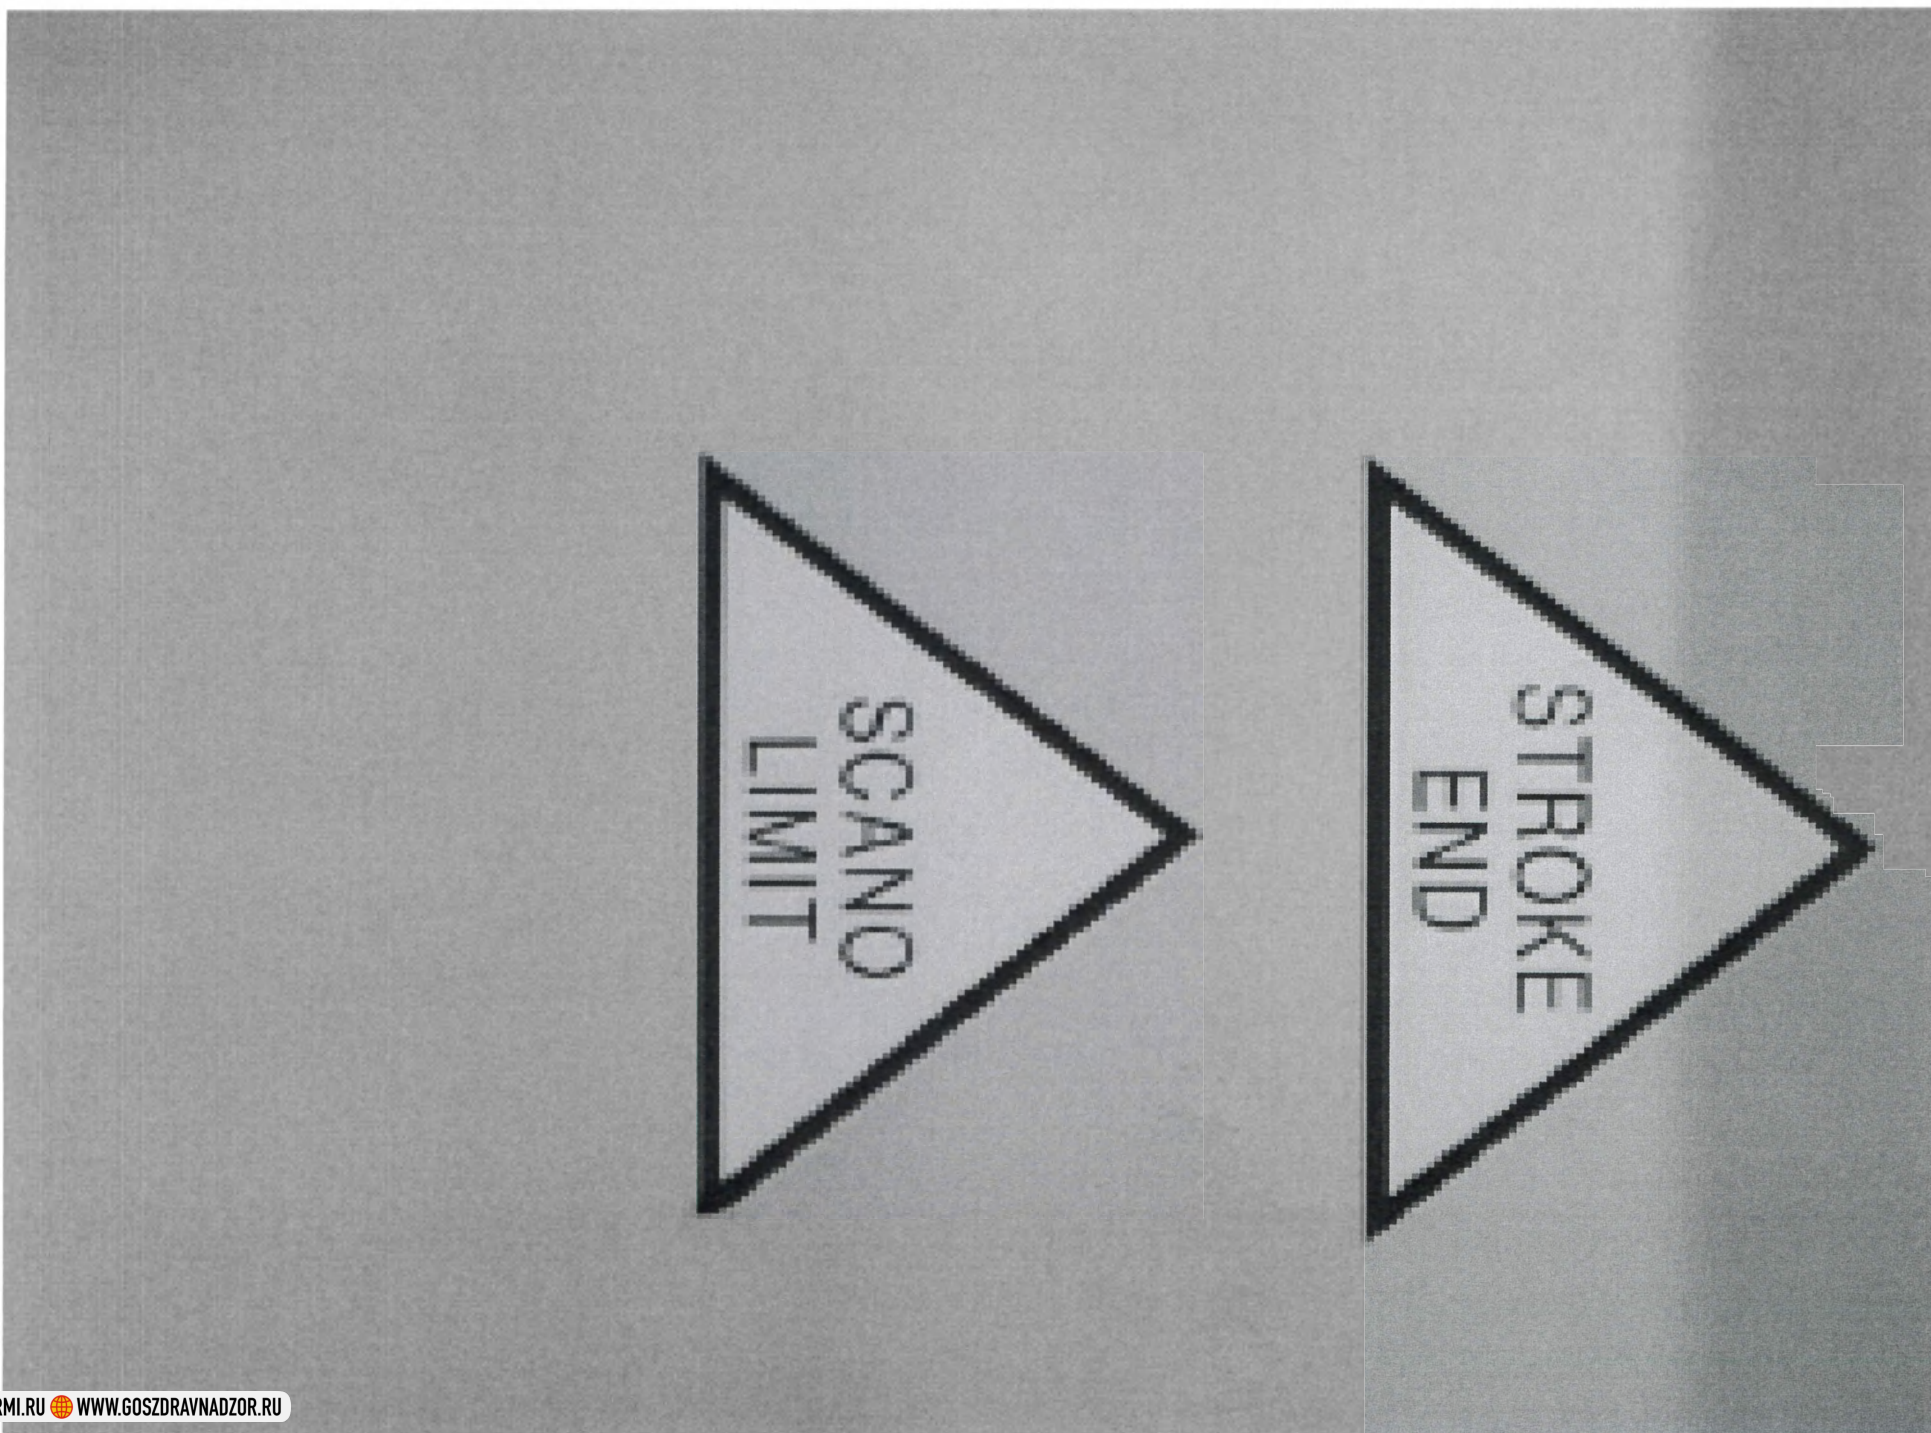


30. Комплект для проведения интервенционных вмешательств под КТ-контролем в реальном времени. - модуль управления в помещении для исследований.




- жидкокристаллический монитор в комнате для исследований.




- программное обеспечение для отображения диагностических изображений.

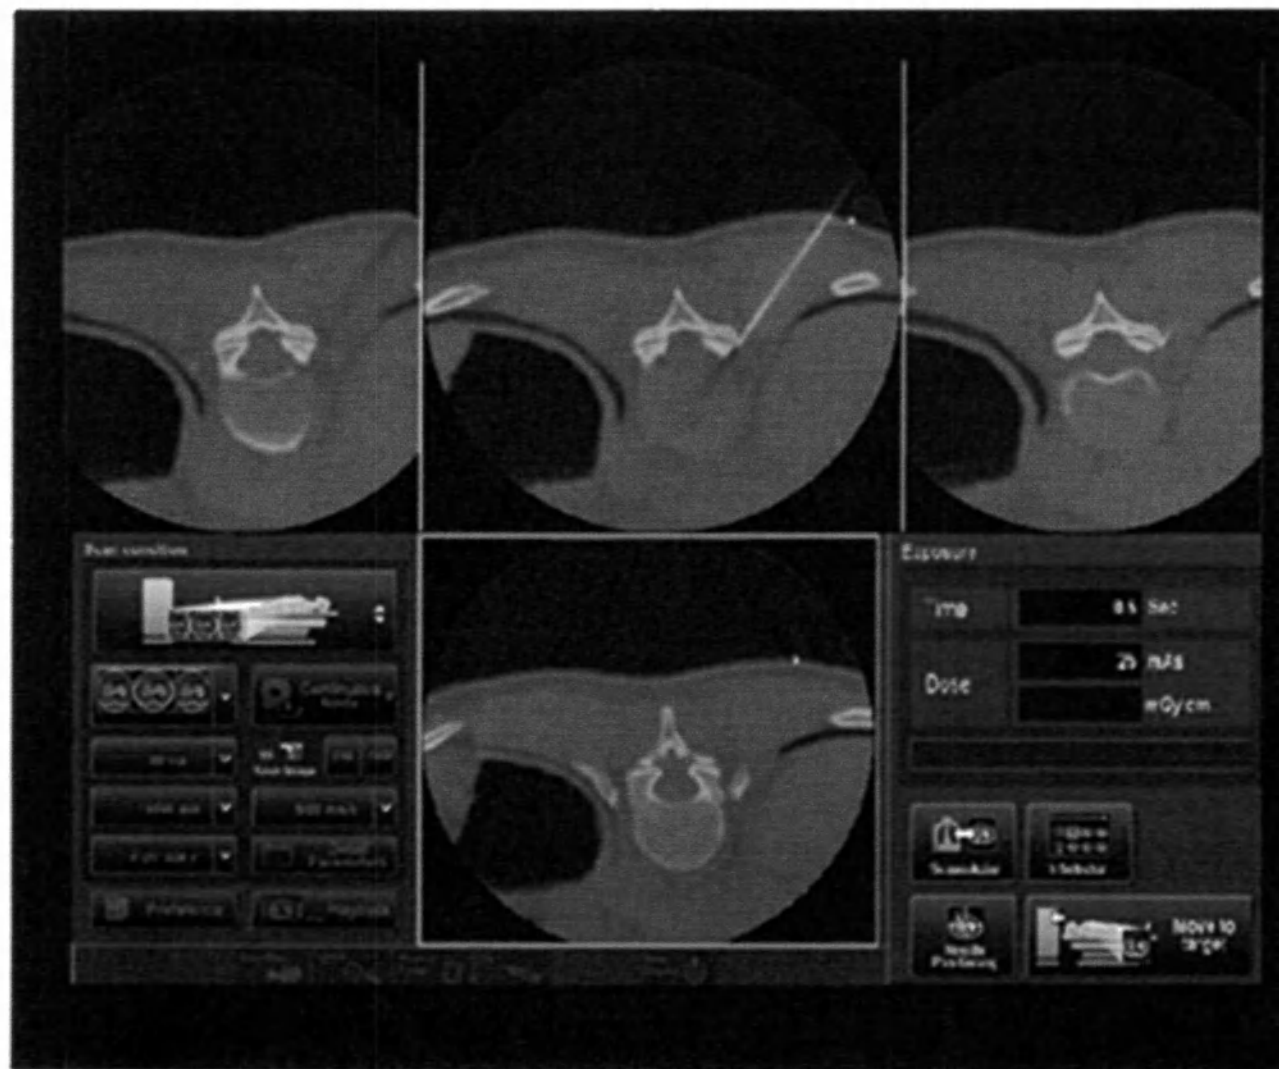


39. Модуль модернизации скорости вращения гентри.

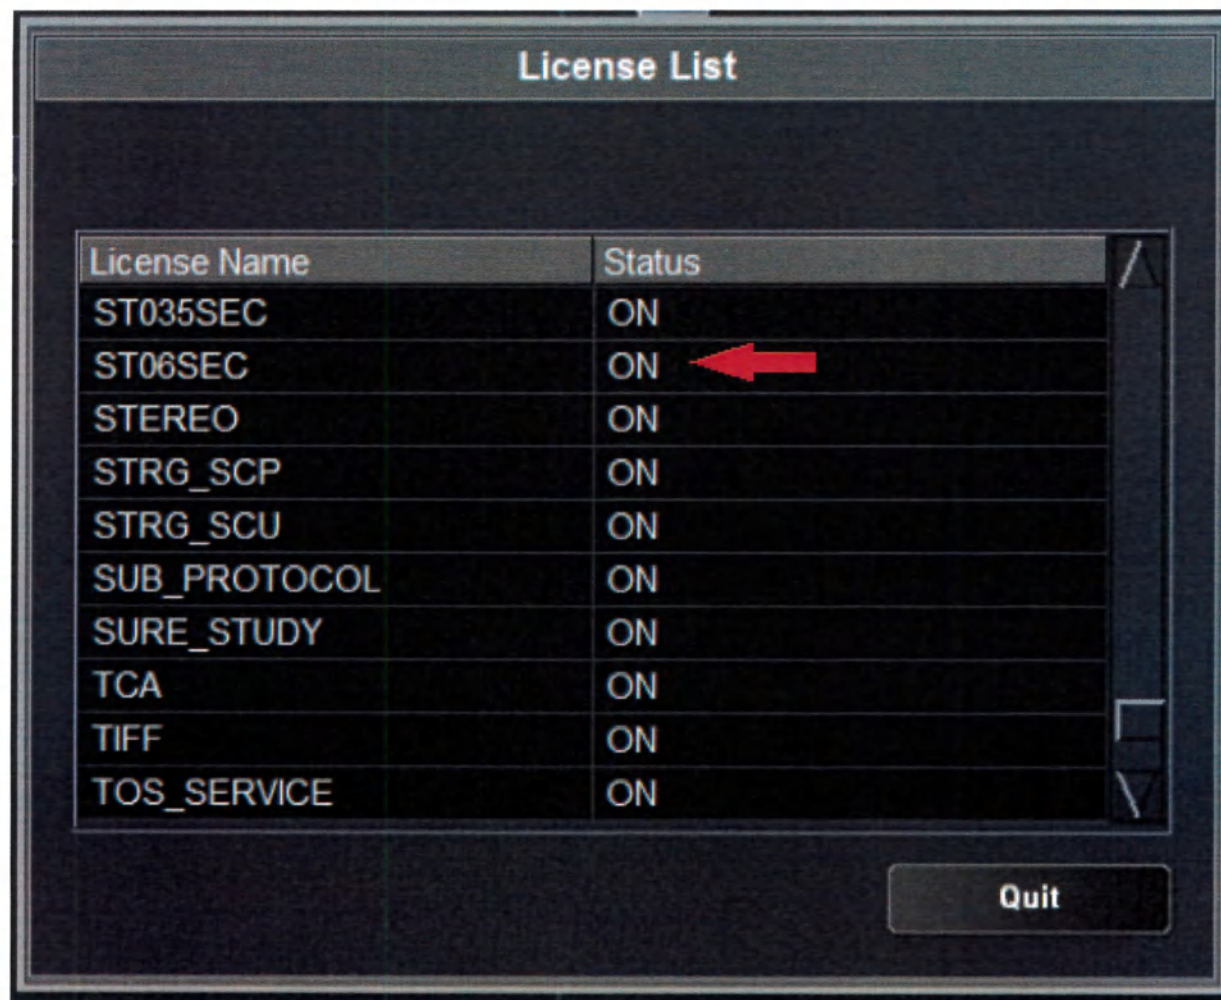


40. Модуль модернизации мощности генератора.

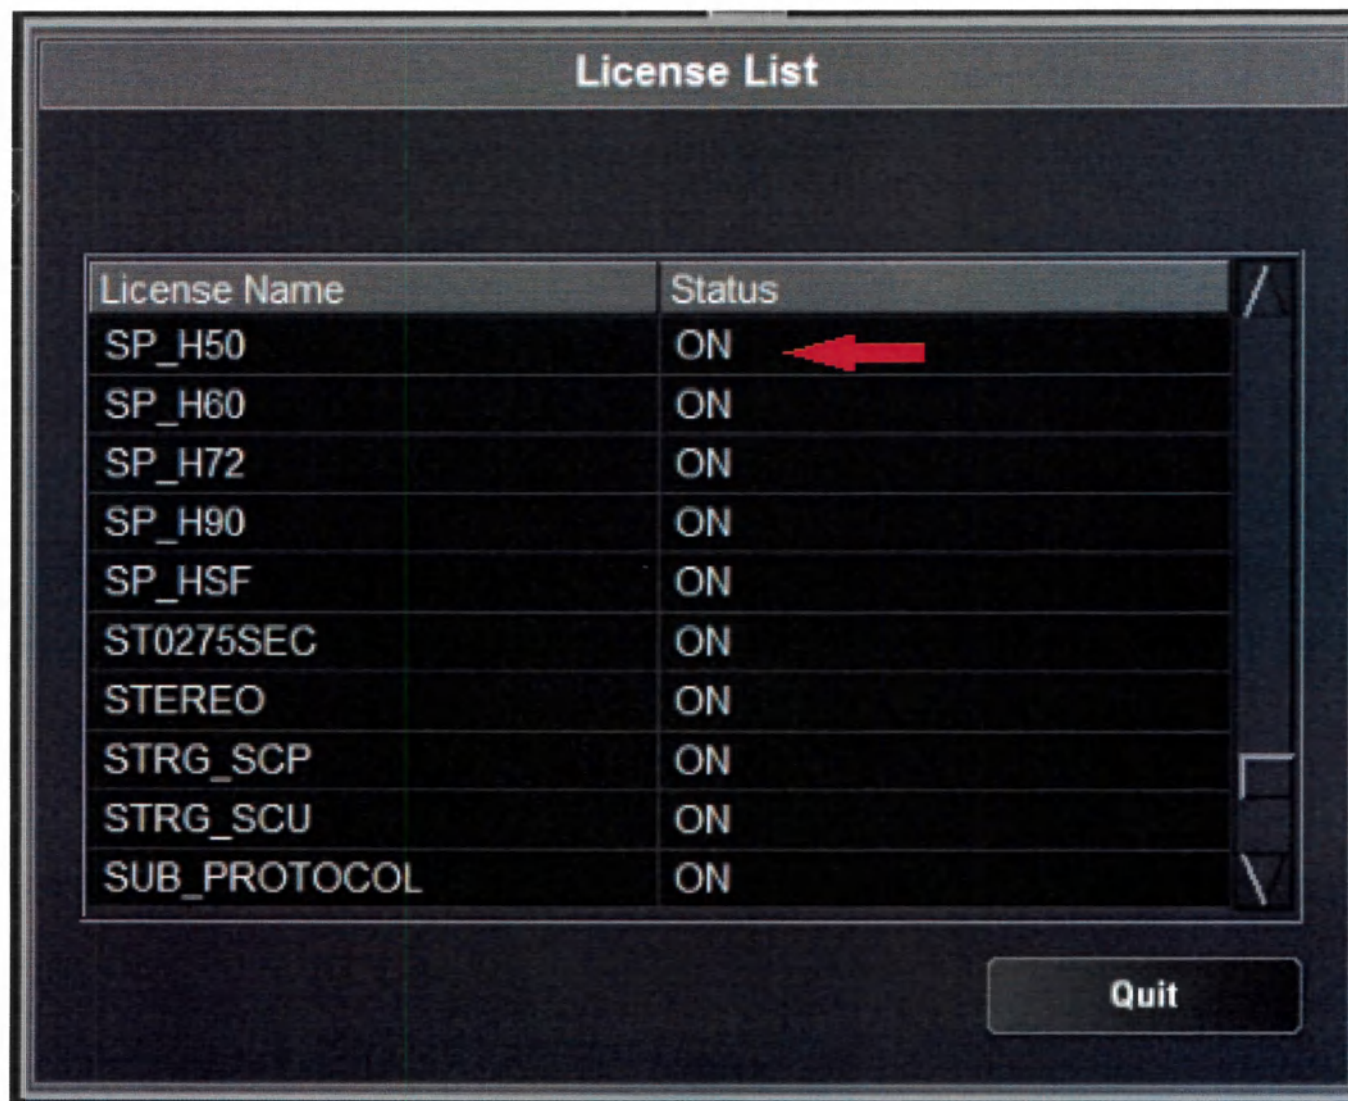

41. Подставка для рук в положении за головой.

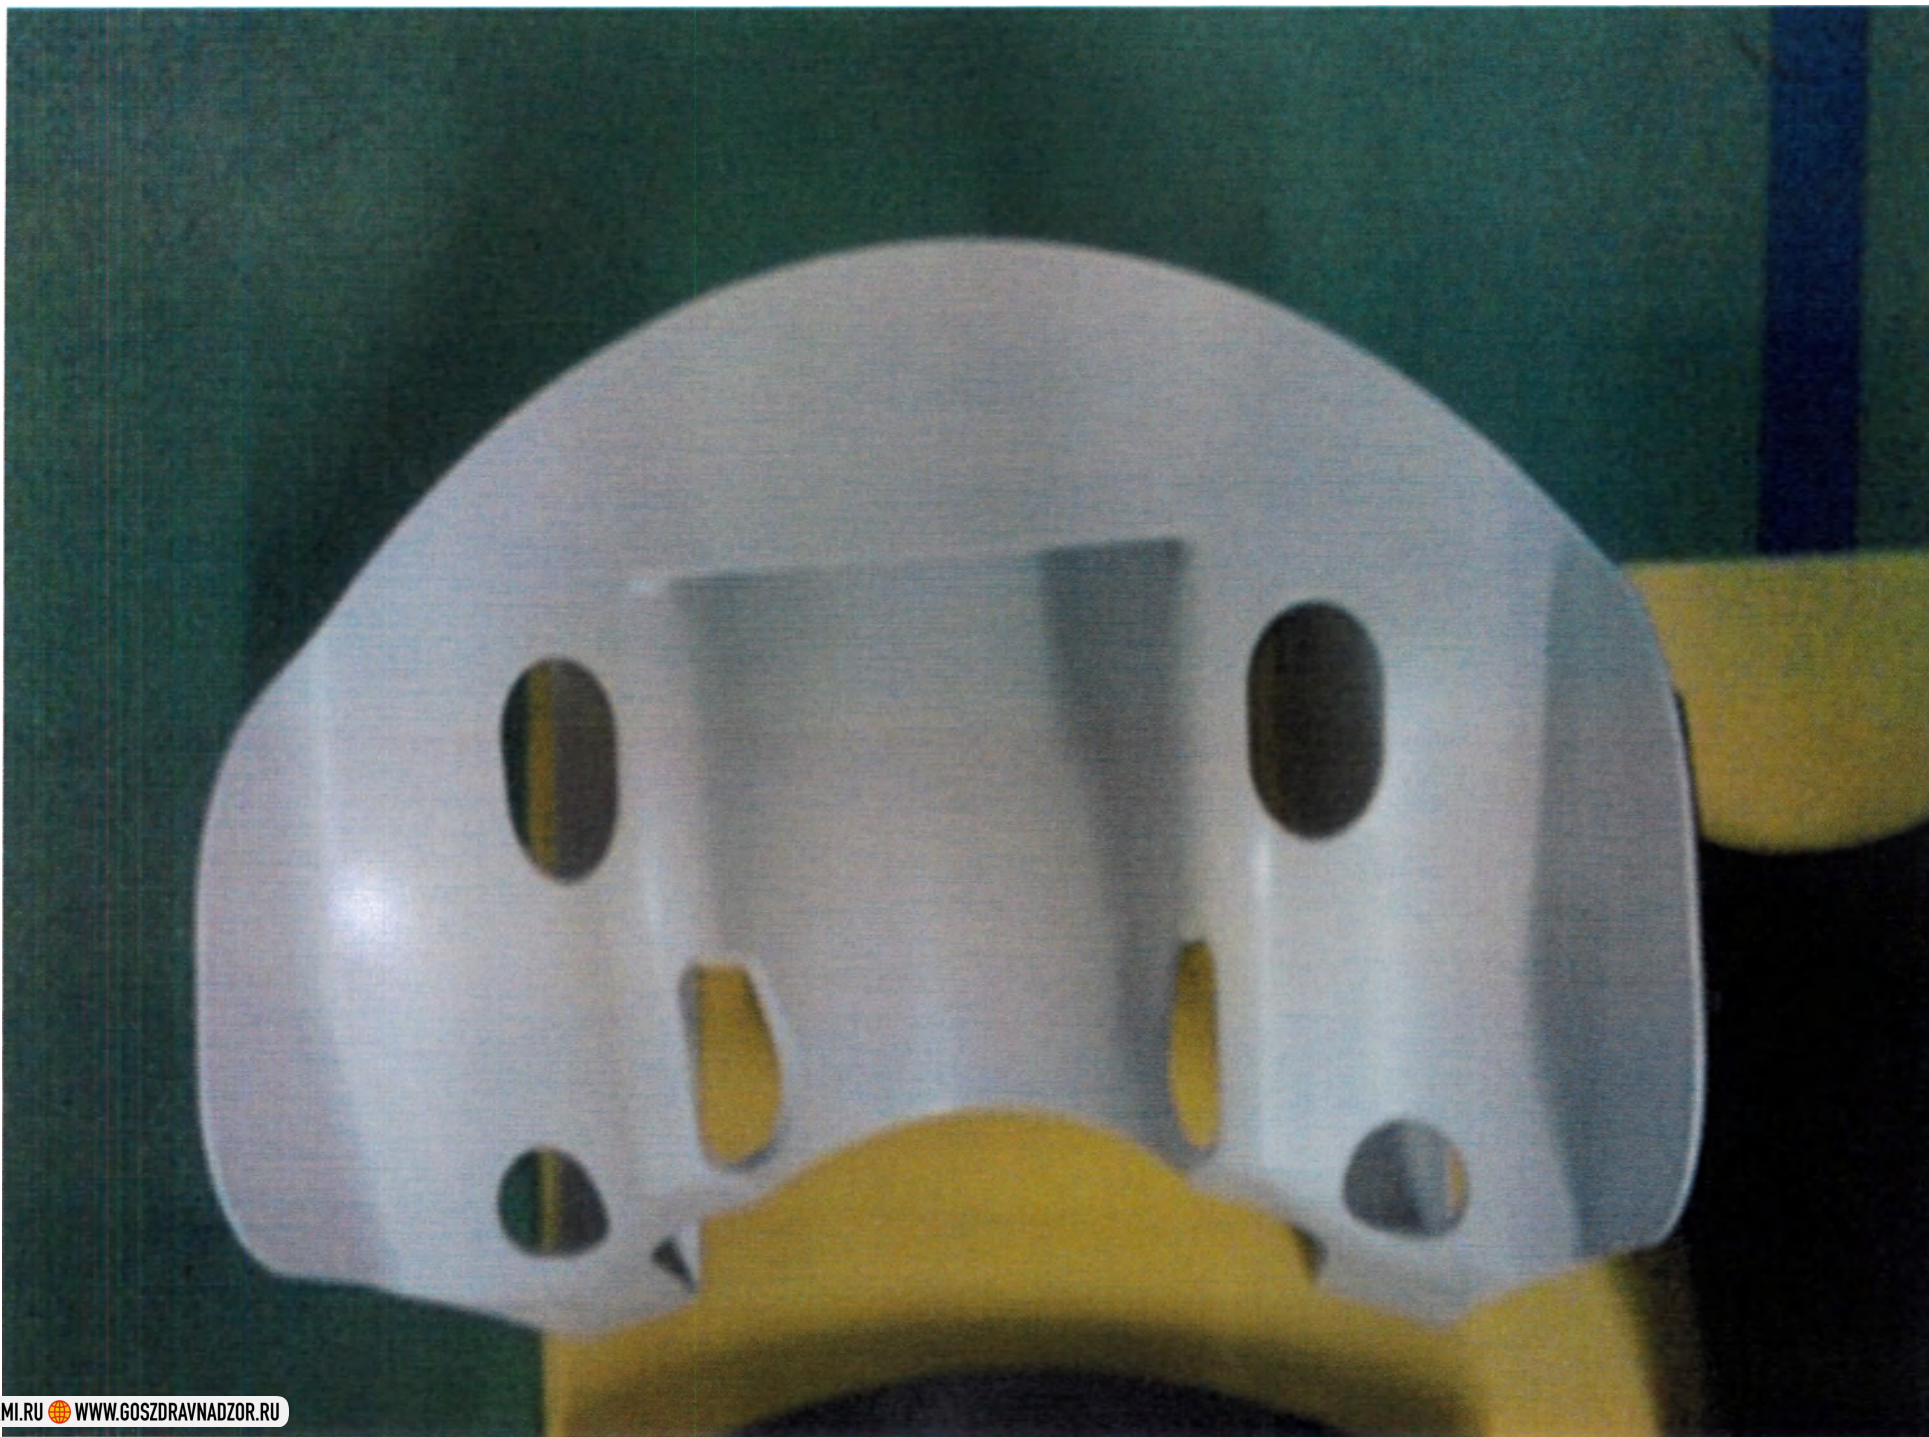

42. Пирамидальный матрац.

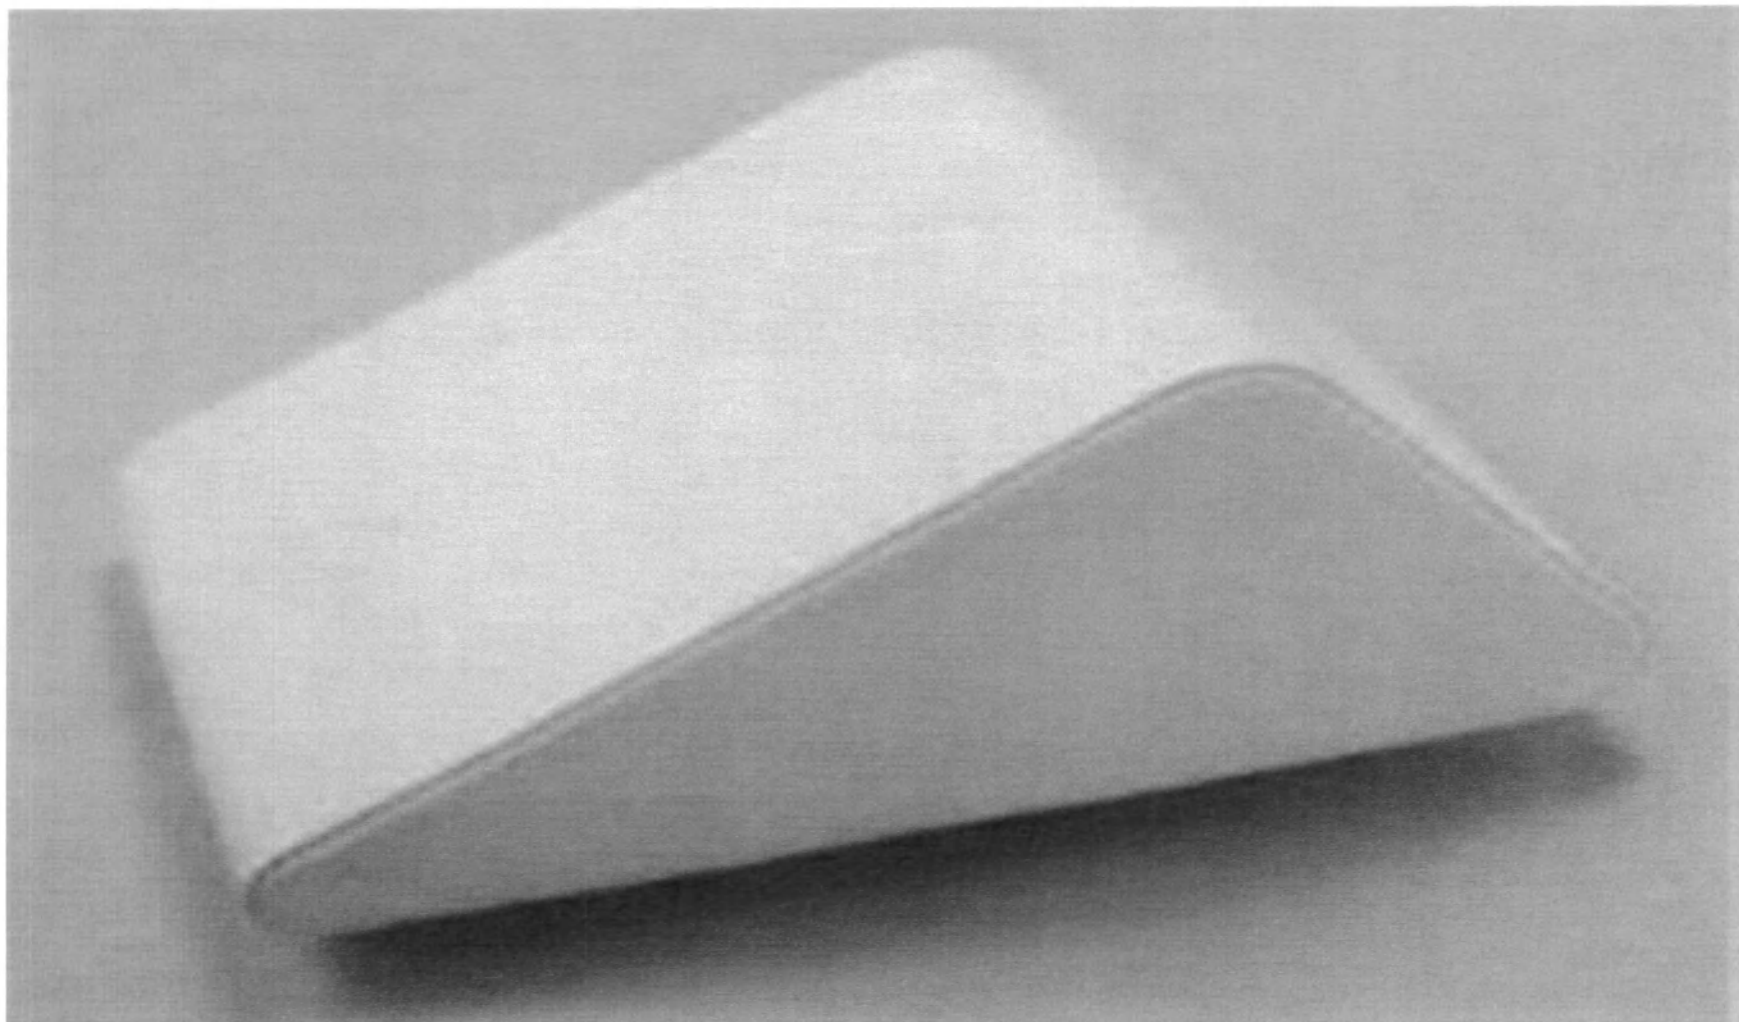

43. Подушка под голову.




44. Подставка для ног.




45. Матрац подставки для ног.




46. Монитор для сканирования с ЭКГ синхронизацией: - Модель LP110, производства фирмы Huntleigh Healthcare Ltd., Великобритания.

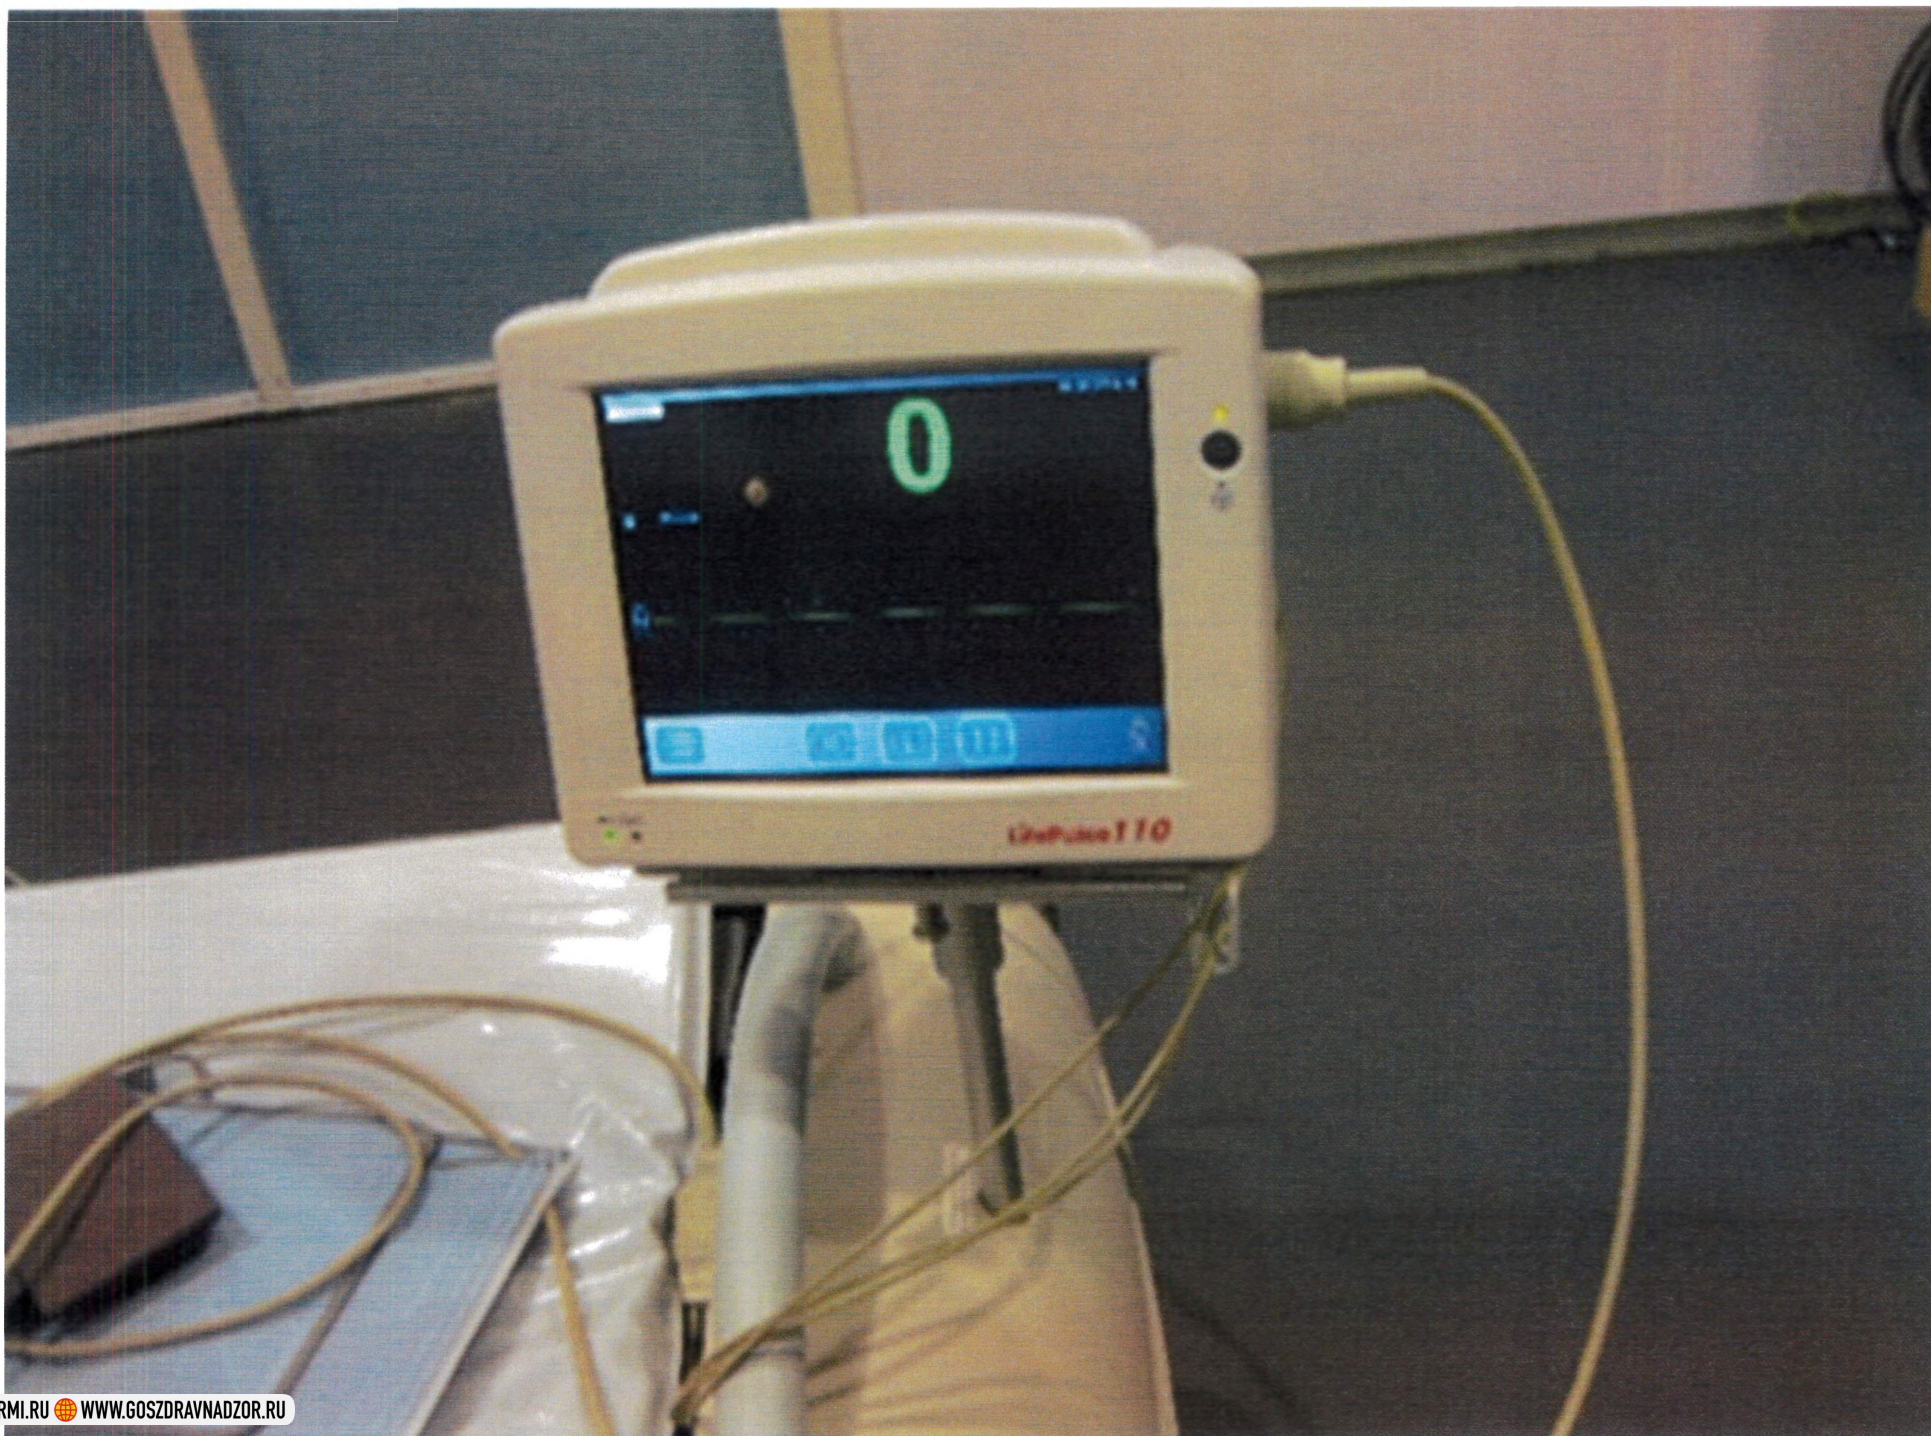

46. Монитор для сканирования с ЭКГ синхронизацией: - Модель 7800, производства фирмы IVY Biomedical Systems Inc., США.

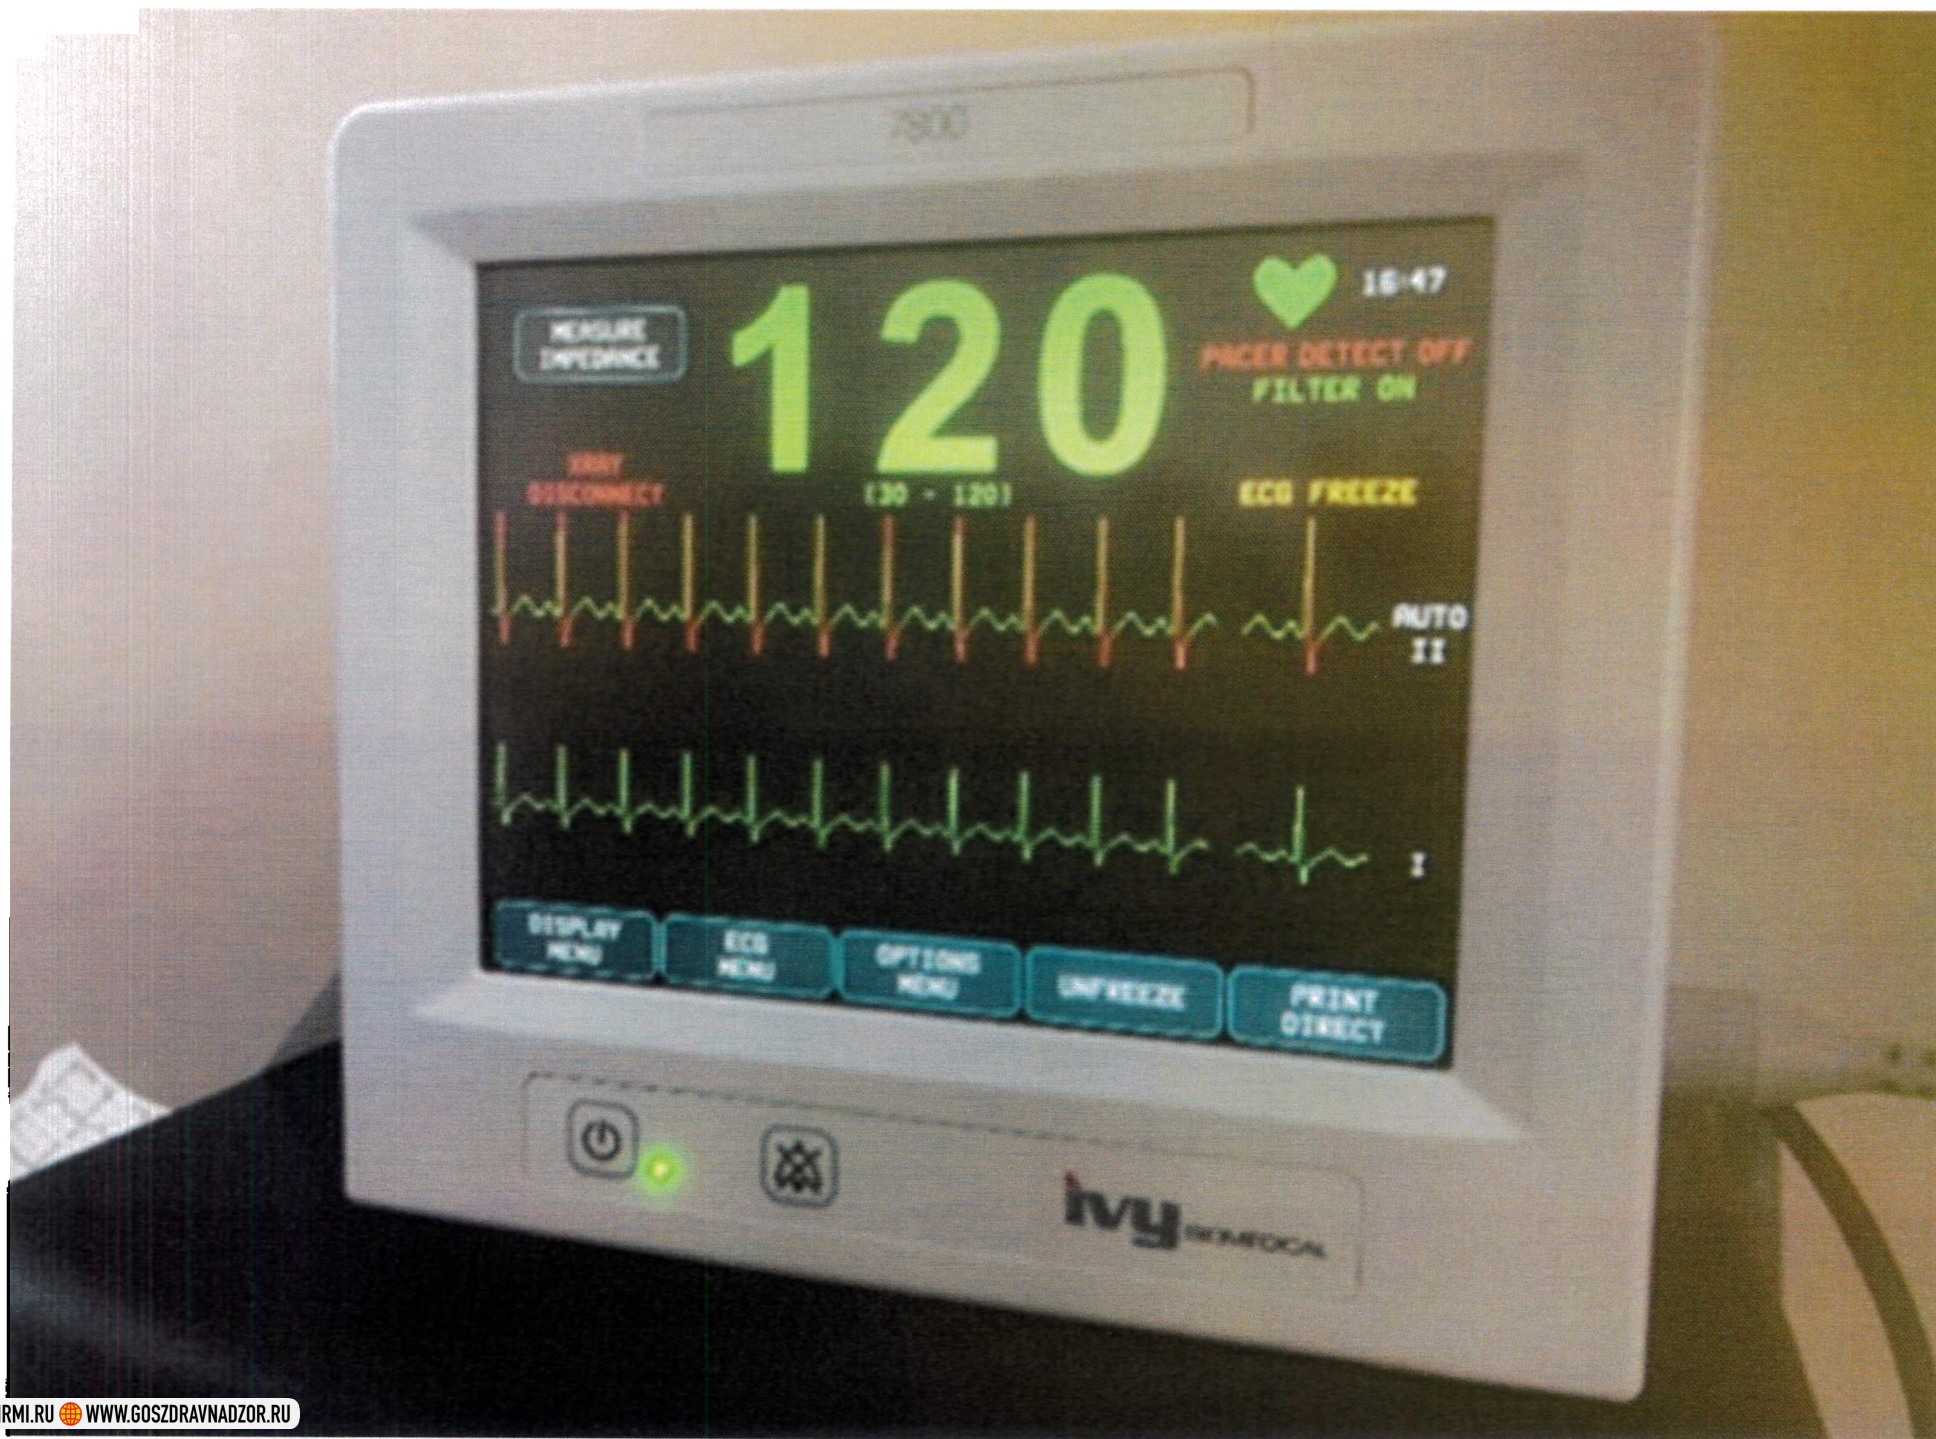

47. Подставка для ЭКГ монитора.

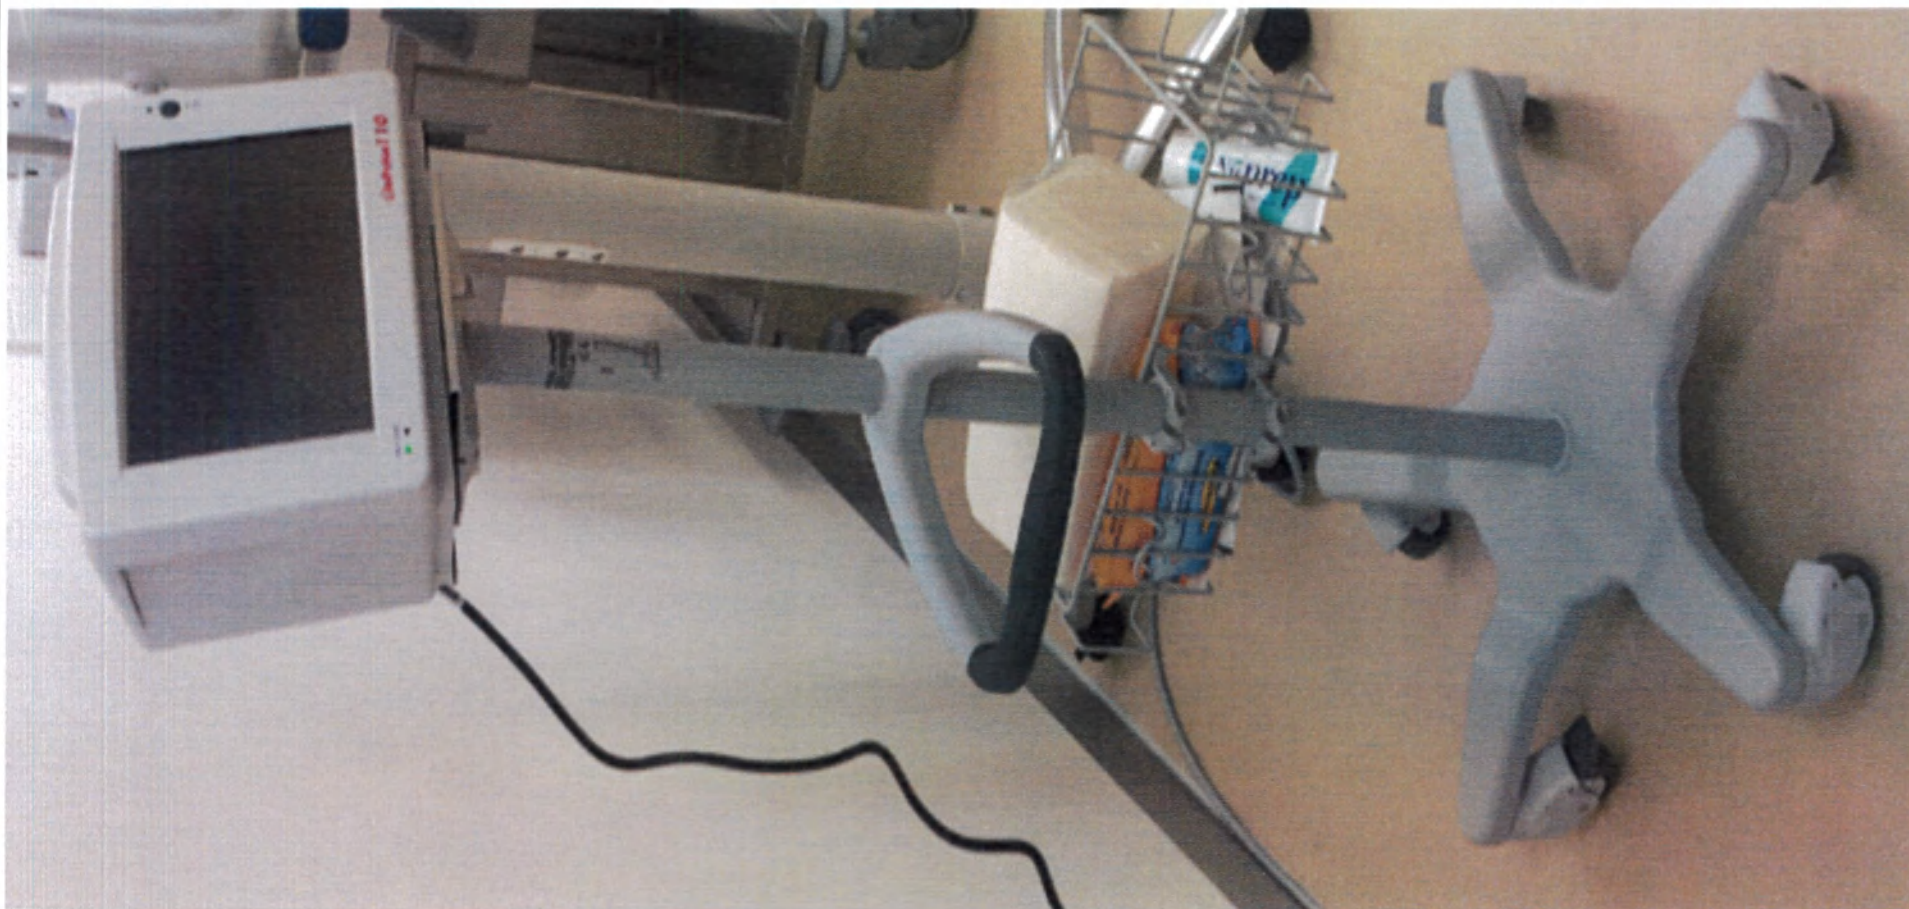


48. Плоский матрац для деки стола.



49. Подушки боковые, не более 4 штук




50. Подставка для руки в опущенном положении (односторонняя).

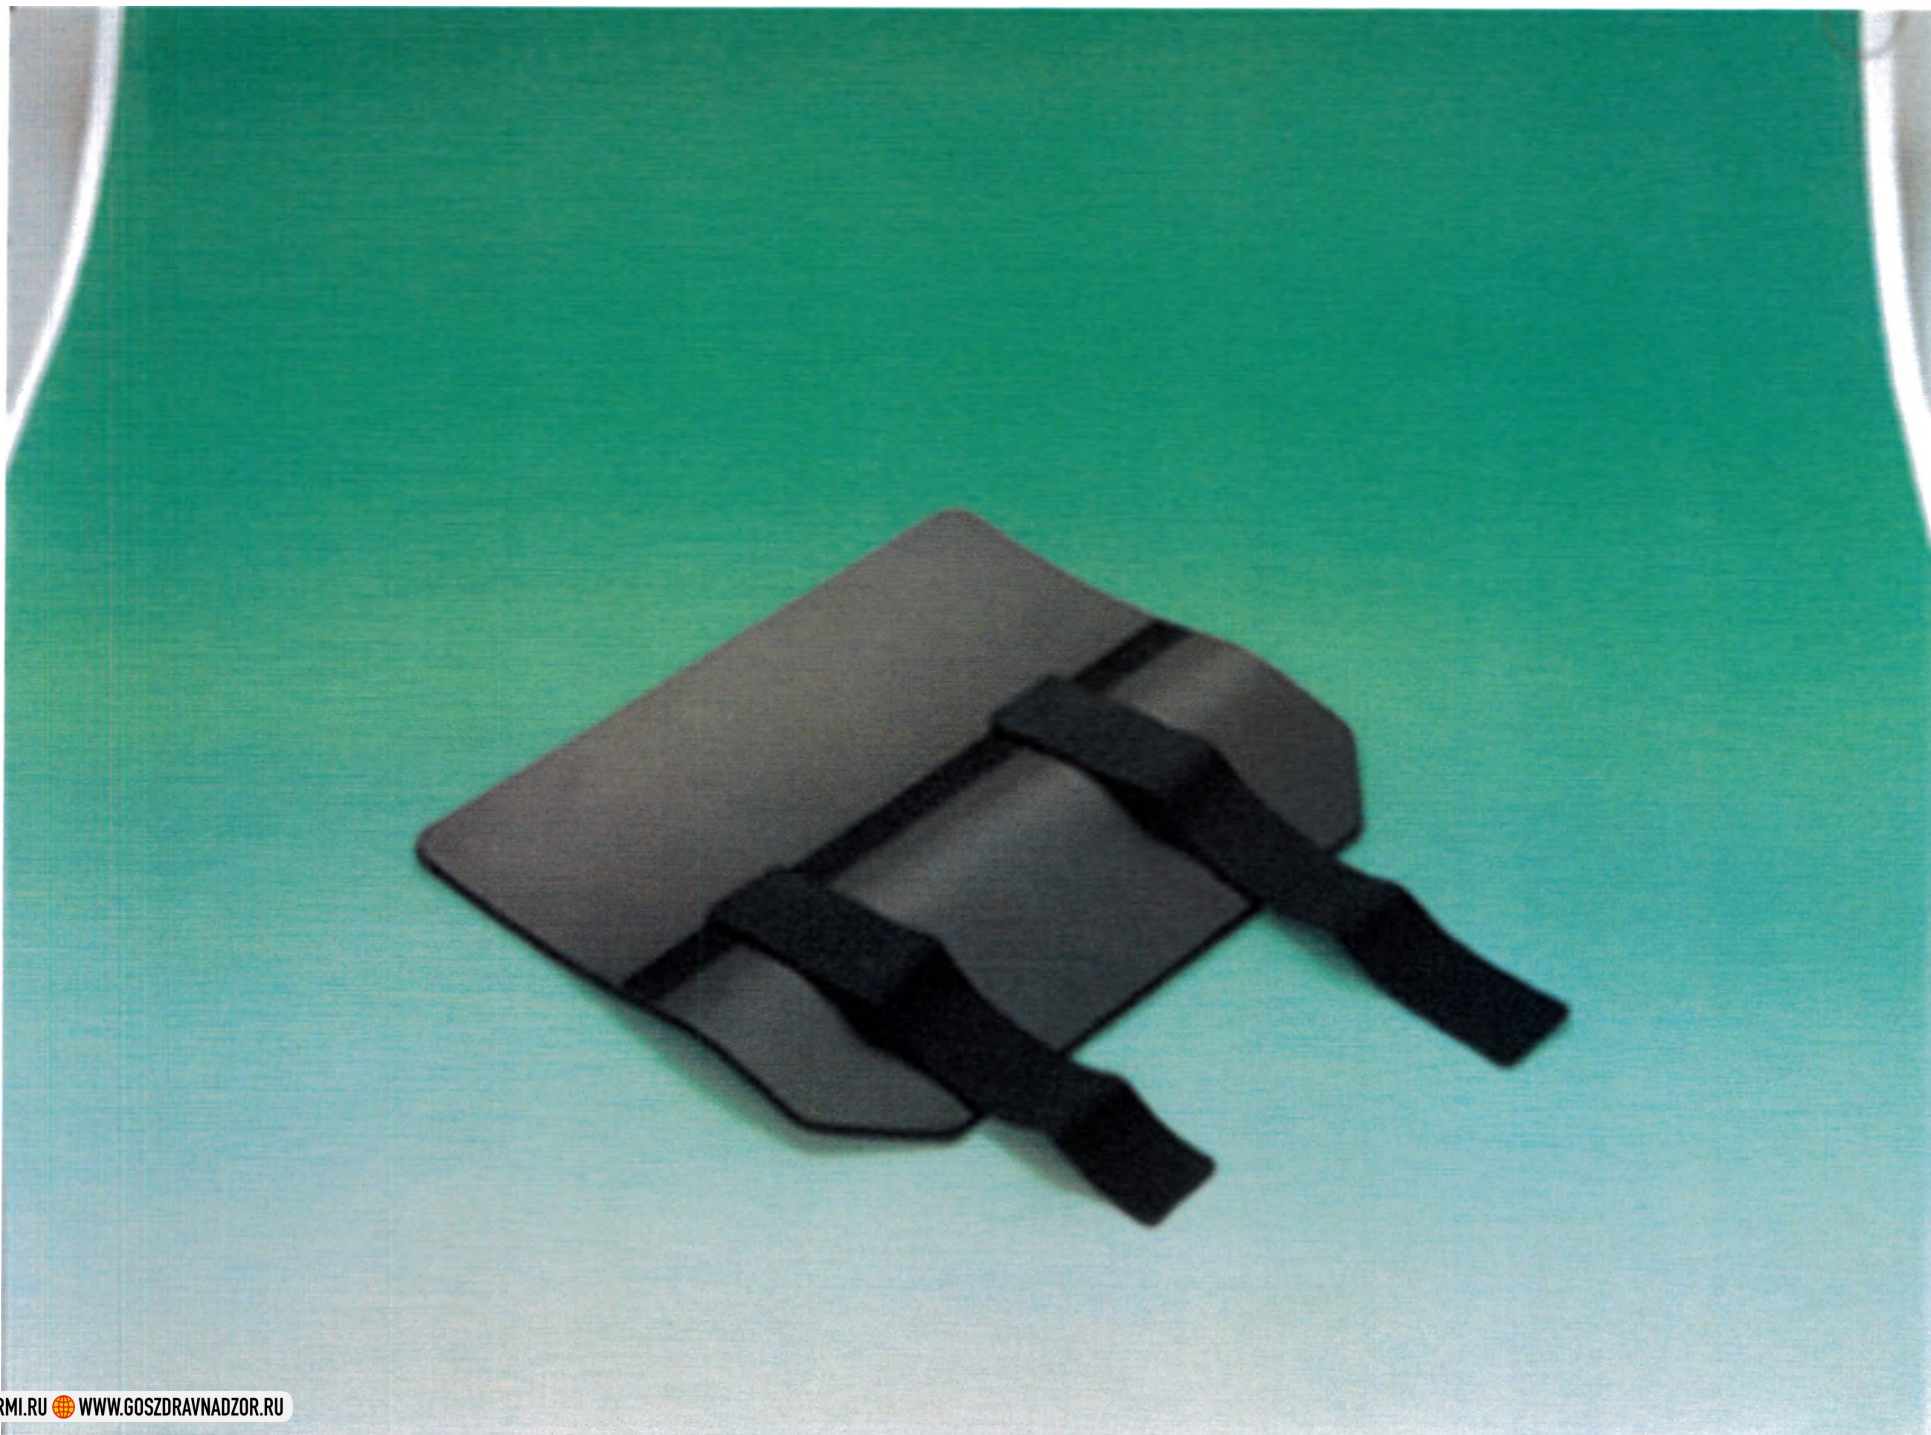

51. Подставка для рук в опущенном положении (двусторонняя).




52. Подголовник для укладки пациента в положении лежа на животе.

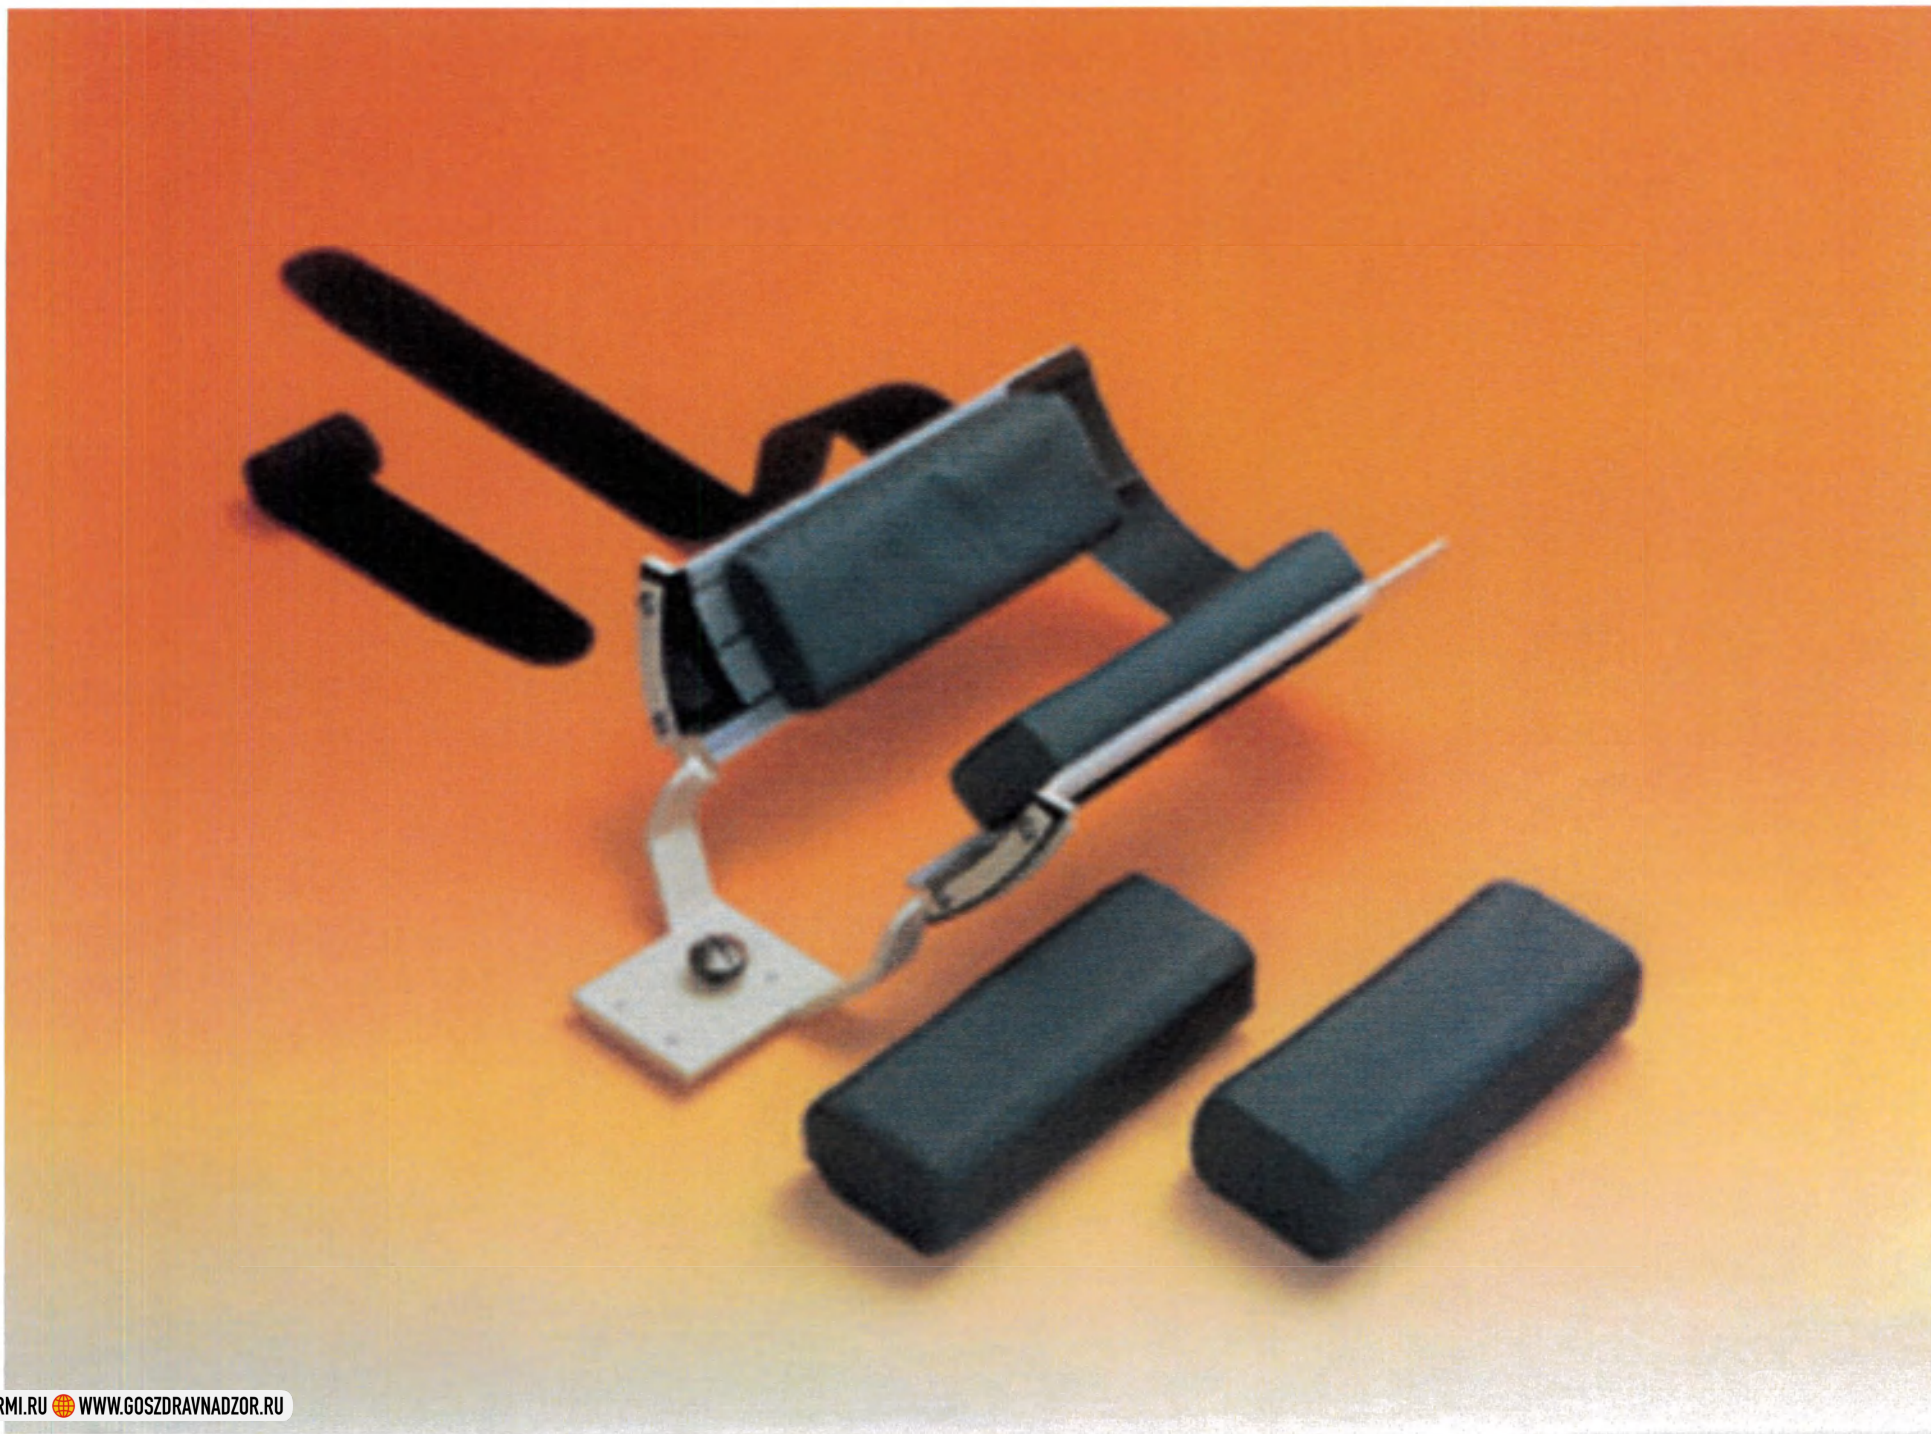


53. Подголовник педиатрический.



54. Подголовник для Хе-исследования.

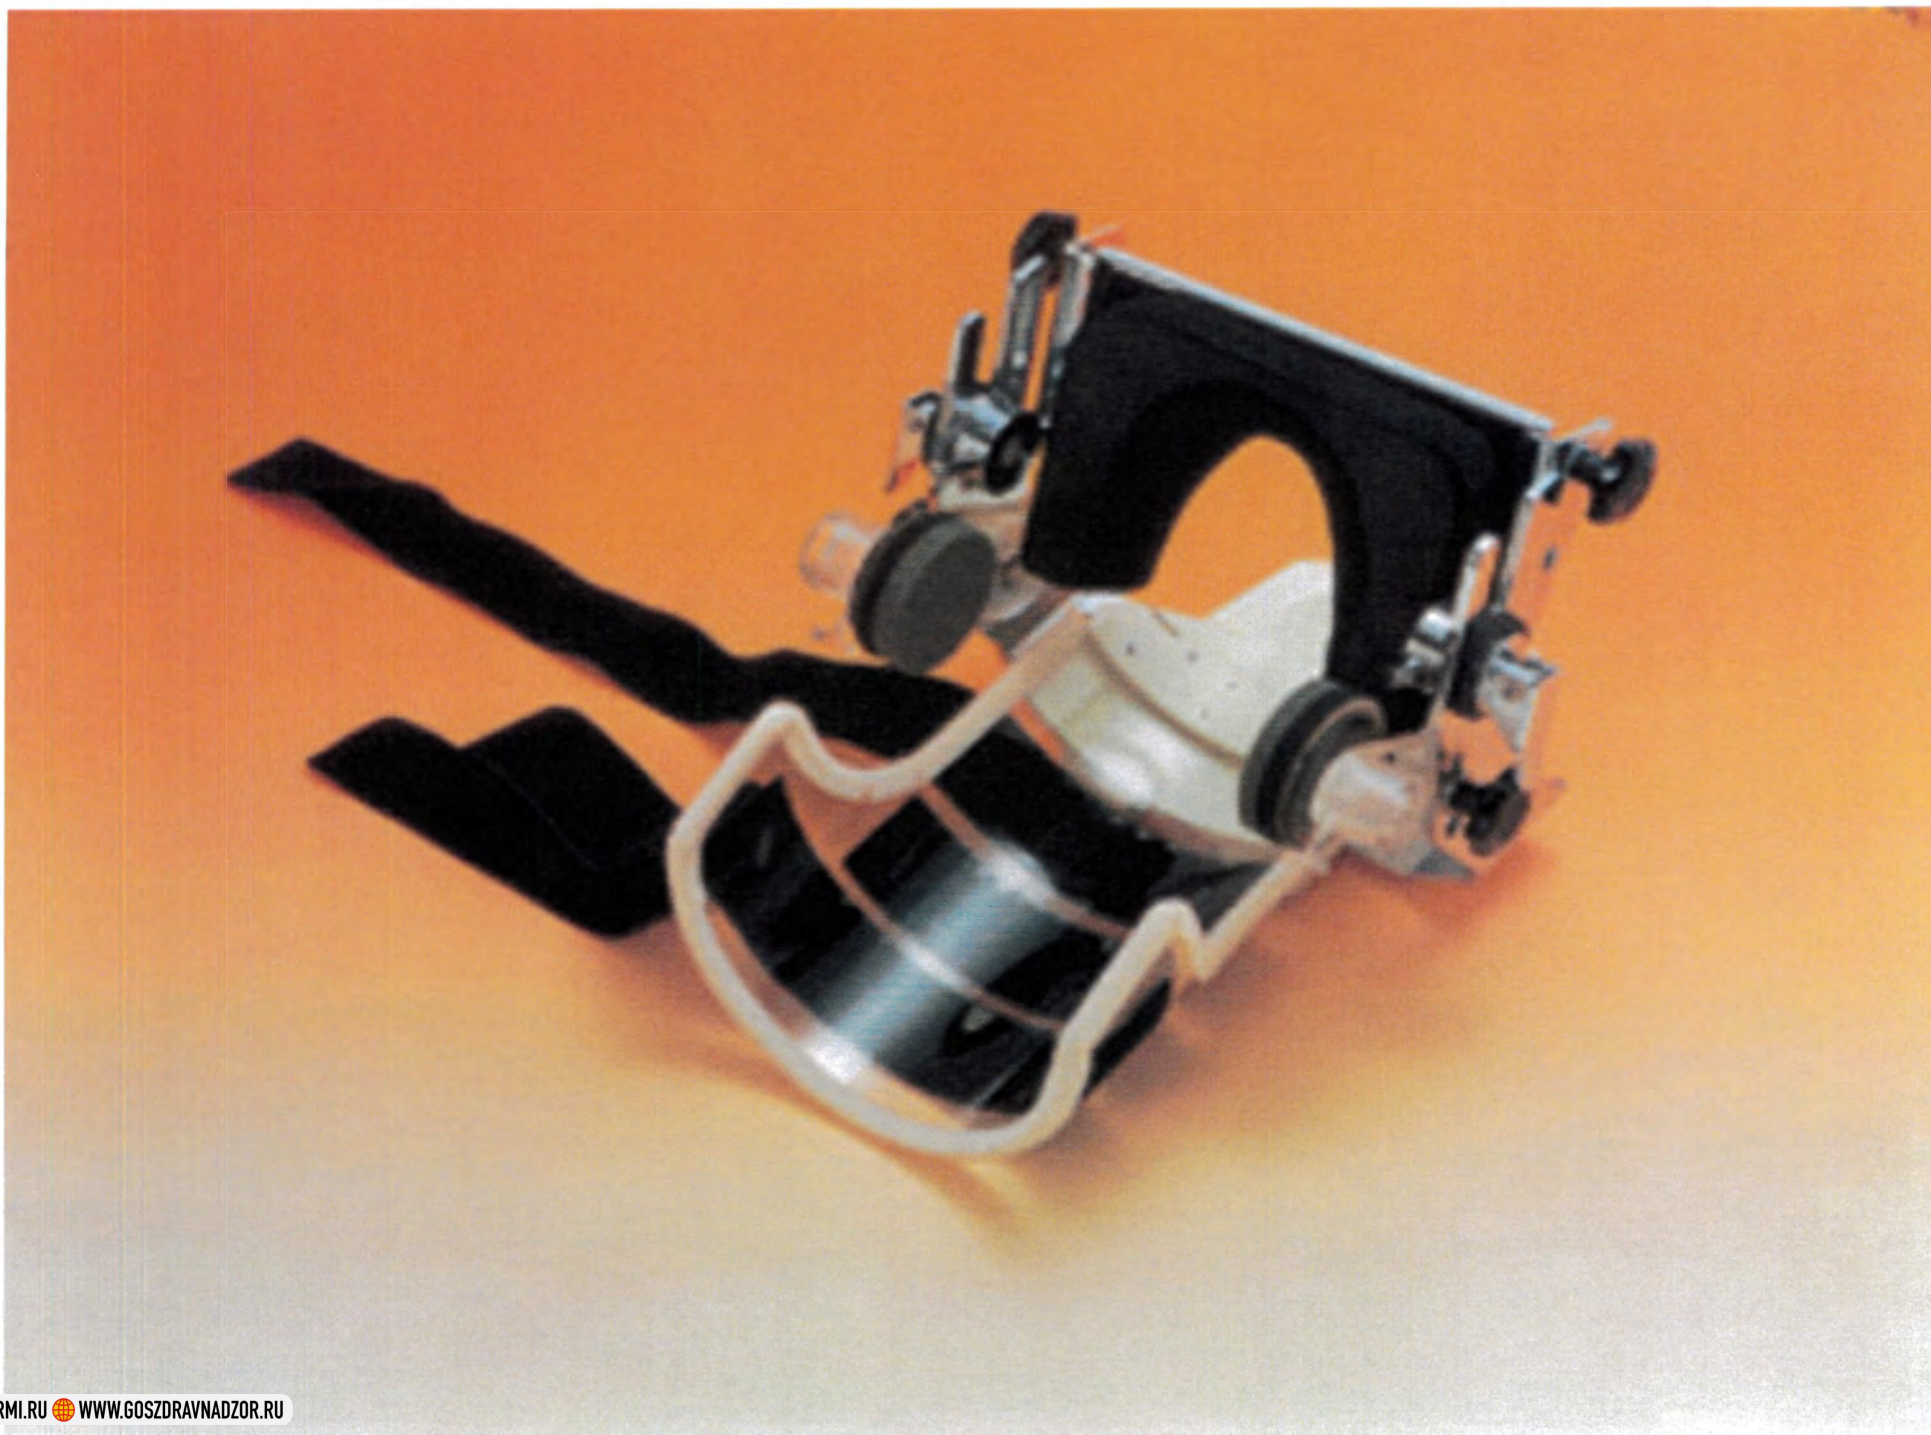

55. Люлька педиатрическая со средствами фиксации для младенцев.

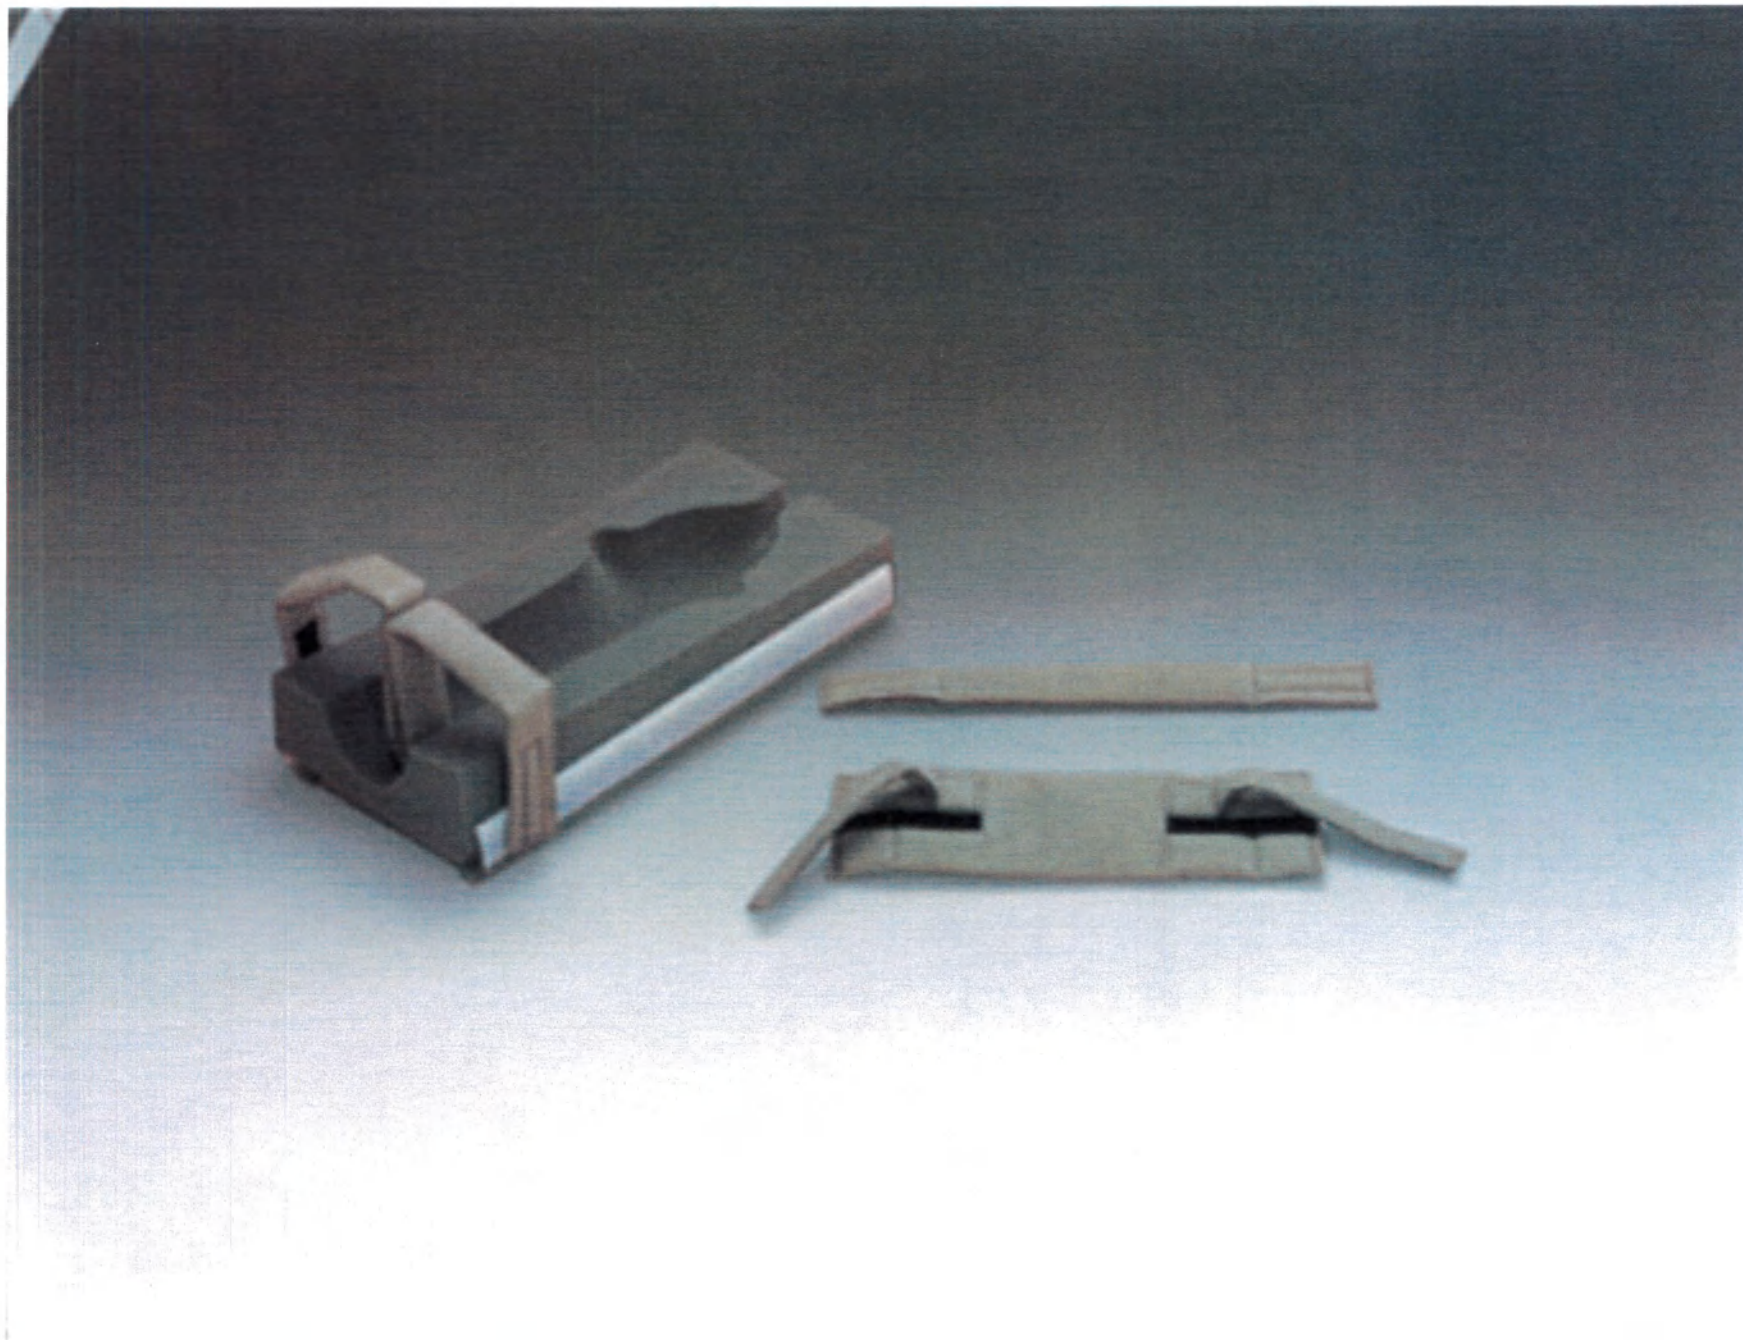


56. Рабочая станция мультимодальная



57. Рабочая станция мультимодальная: - системные блоки, не более 6 шт.




- мониторы, не более 12 шт.

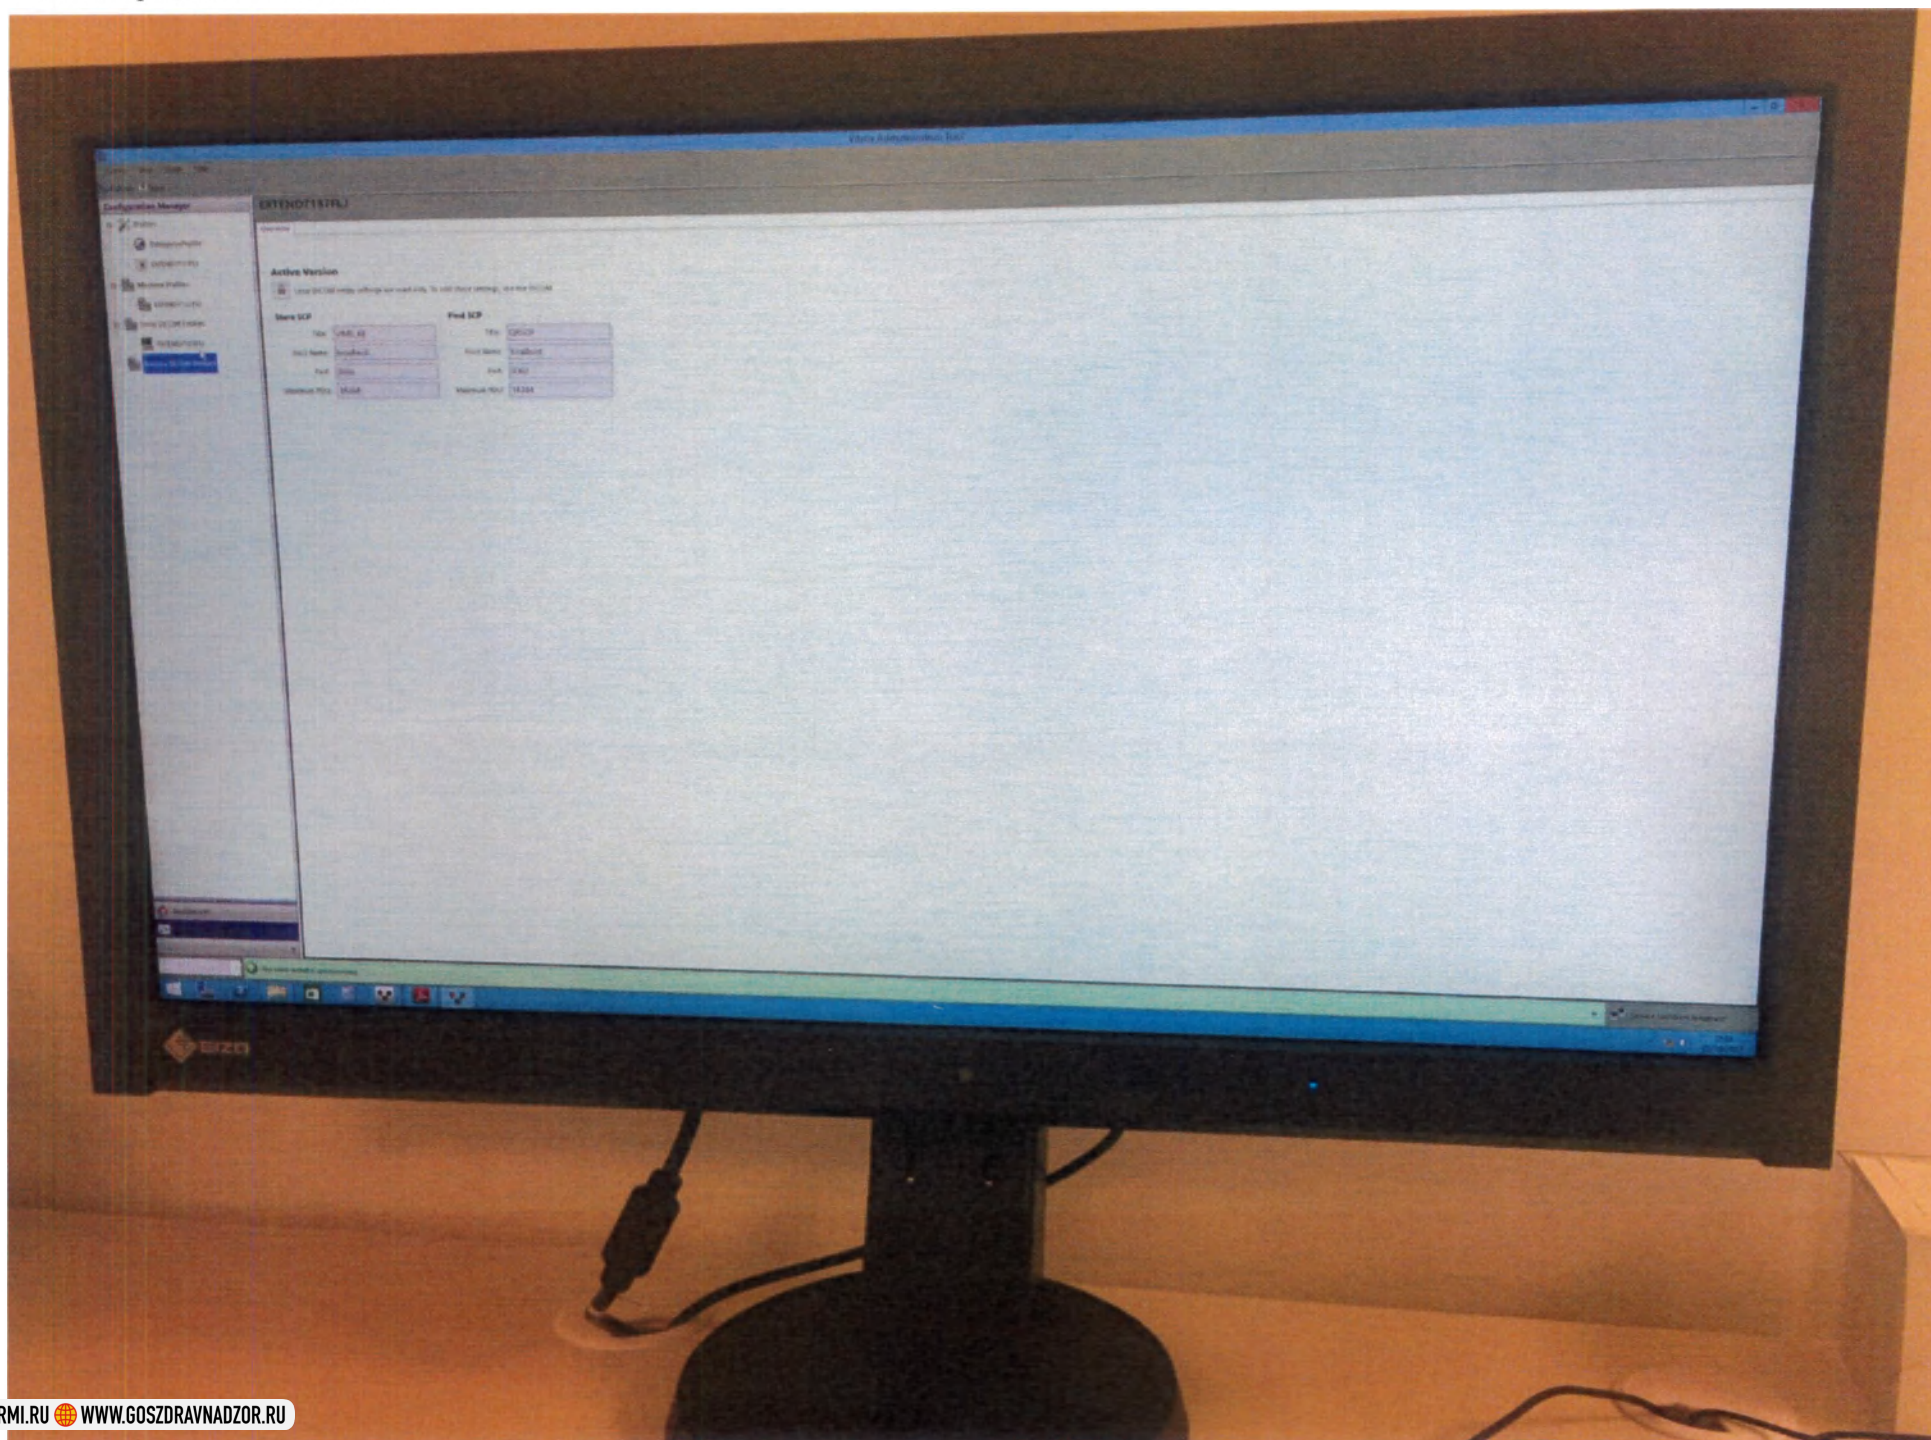

- клавиатуры, не более 6 шт.



- мыши компьютерные, не более 6 шт.

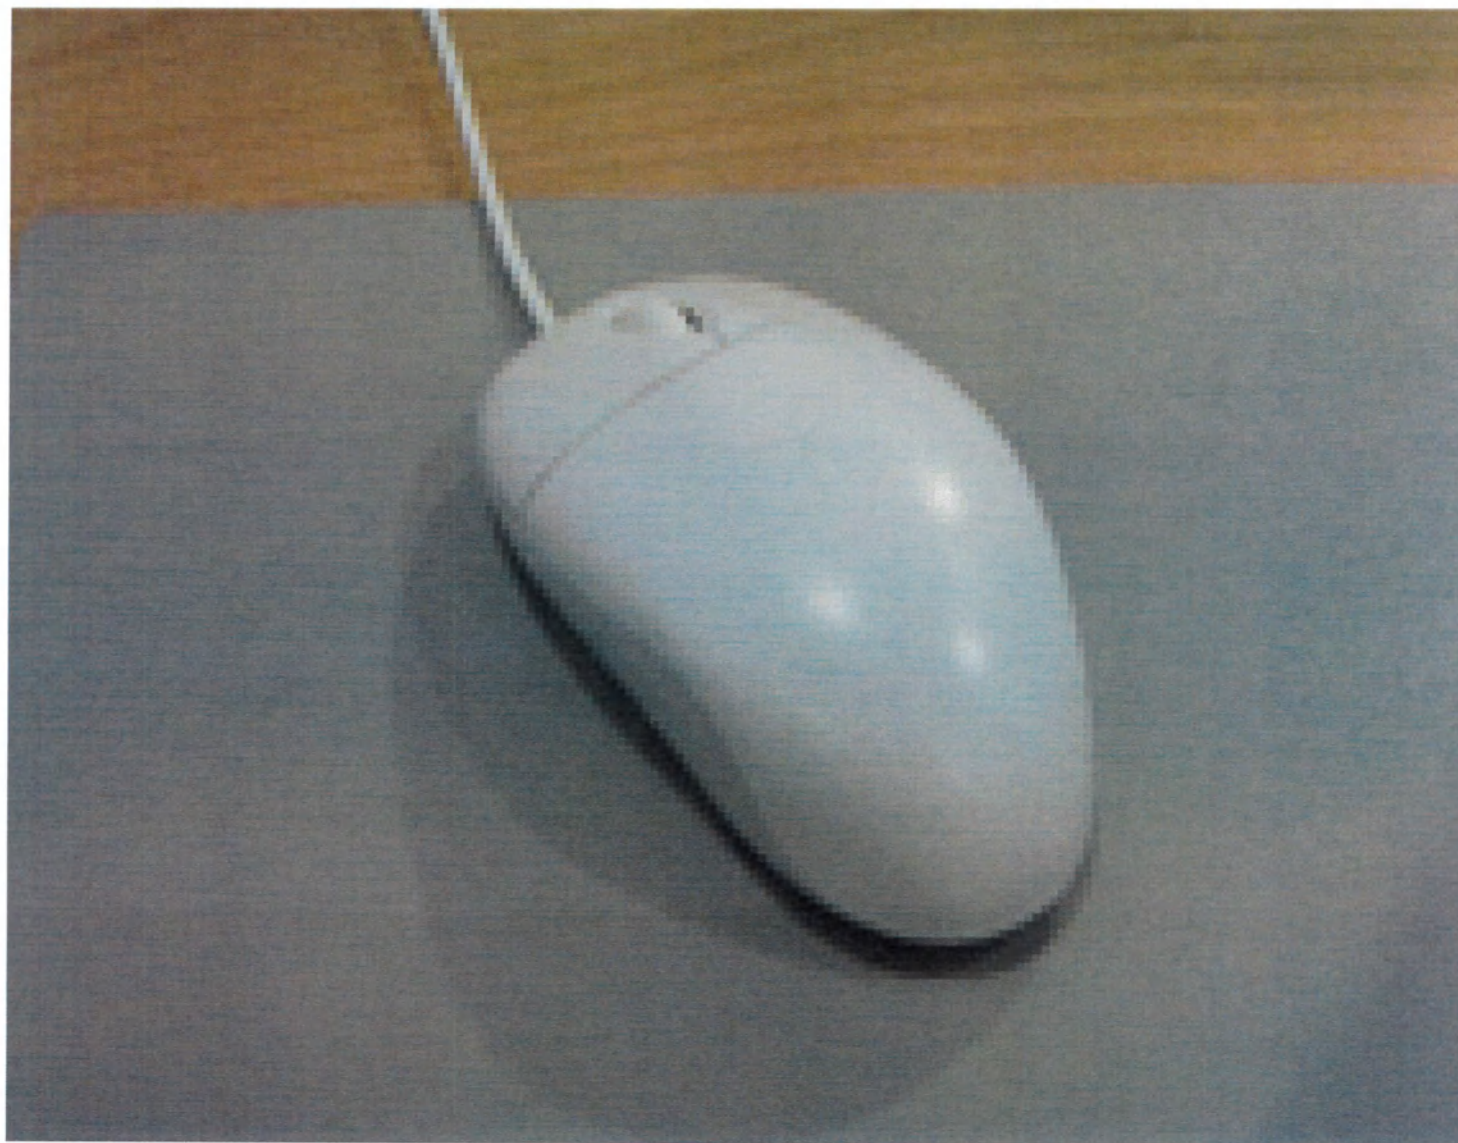

57. Программное обеспечение рабочей станции, не более 10 шт.

Filter By

Patient ID: [empty]

Patient Name: [empty]

Date of Birth: [mm/dd/yyyy]

Accession Number: [empty]

Study Description: [empty]

Modality: Any

Study Date: Any

Study	Series	Modality	Series Description	Acquisition Date/Time
AVERYUSHION V.N. [1440] - 15 May 2017 17:55	2	CT	Head 0.5 CE 4D-Vol. FCA1	04 Apr 2017 15:50
	2	CT	Head 0.5 CE 4D-Vol. FCA1	28 Nov 2016 13:37
	2	CT	Head 0.5 CE 4D-Vol. FCA1	17 Aug 2016 17:44
	2	CT	Head 0.5 CE 4D-Vol. FCA1	23 Mar 2015 02:24
	2	CT	Head 0.5 CE 4D-Vol. FCA1	20 Jan 2015 14:17
	2	CT	Head 0.5 CE 4D-Vol. FCA1	31 Oct 2014 13:45
	2	CT	Head 0.5 CE 4D-Vol. FCA1	30 Oct 2014 15:14
	2	CT	Head 0.5 CE 4D-Vol. FCA1	11 Sep 2014 11:39
	2	CT	Head 0.5 CE 4D-Vol. FCA1	20 Aug 2014 15:56
	2	CT	Head 0.5 CE 4D-Vol. FCA1	14 May 2014 16:00
	2	CT	Head 0.5 CE 4D-Vol. FCA1	14 Feb 2014 14:02
	2	CT	Head 0.5 CE 4D-Vol. FCA1	11 Feb 2014 14:41
	2	CT	Head 0.5 CE 4D-Vol. FCA1	16 Jan 2014 13:01
	2	CT	Head 0.5 CE 4D-Vol. FCA1	01 Mar 2013 16:09
	2	CT	Head 0.5 CE 4D-Vol. FCA1	

Applications

Gallery

Mirada XD

Mirada General Fusion

Mirada General Oncology

Multi Modality Viewer

Cardiol

Circle of Willis

Brain Shuttle Perfusion

Volume Synthesis

3D Viewer

Cerebral Artery

CT Dental

Body Perfusion 4D

4D Dual Input Liver

Study Description: [empty]

Modality: Any

Study Date: Any

Filter By

Patient ID: [empty]

Patient Name: [empty]

Date of Birth: [mm/dd/yyyy]

Accession Number: [empty]

Study Description: [empty]

Modality: Any

Study Date: Any

Study	Series	Modality	Series Description	Acquisition Date/Time
AVERYUSHION V.N. [1440] - 15 May 2017 17:55	2	CT	Head 0.5 CE 4D-Vol. FCA1	04 Apr 2017 15:50
	2	CT	Head 0.5 CE 4D-Vol. FCA1	28 Nov 2016 13:37
	2	CT	Head 0.5 CE 4D-Vol. FCA1	17 Aug 2016 17:44
	2	CT	Head 0.5 CE 4D-Vol. FCA1	23 Mar 2015 02:24
	2	CT	Head 0.5 CE 4D-Vol. FCA1	20 Jan 2015 14:17
	2	CT	Head 0.5 CE 4D-Vol. FCA1	31 Oct 2014 13:45
	2	CT	Head 0.5 CE 4D-Vol. FCA1	30 Oct 2014 15:14
	2	CT	Head 0.5 CE 4D-Vol. FCA1	11 Sep 2014 11:39
	2	CT	Head 0.5 CE 4D-Vol. FCA1	20 Aug 2014 15:56
	2	CT	Head 0.5 CE 4D-Vol. FCA1	14 May 2014 16:00
	2	CT	Head 0.5 CE 4D-Vol. FCA1	14 Feb 2014 14:02
	2	CT	Head 0.5 CE 4D-Vol. FCA1	11 Feb 2014 14:41
	2	CT	Head 0.5 CE 4D-Vol. FCA1	16 Jan 2014 13:01
	2	CT	Head 0.5 CE 4D-Vol. FCA1	01 Mar 2013 16:09
	2	CT	Head 0.5 CE 4D-Vol. FCA1	

Filter By

Patient ID: [empty]

Patient Name: [empty]

Date of Birth: [mm/dd/yyyy]

Accession Number: [empty]


Study Description: [empty]

Modality: Any


Study Date: Any

Study	Series	Modality	Series Description	Acquisition Date/Time
AVERYUSHION V.N. [1440] - 15 May 2017 17:55	2	CT	Head 0.5 CE 4D-Vol. FCA1	04 Apr 2017 15:50
	2	CT	Head 0.5 CE 4D-Vol. FCA1	28 Nov 2016 13:37
	2	CT	Head 0.5 CE 4D-Vol. FCA1	17 Aug 2016 17:44
	2	CT	Head 0.5 CE 4D-Vol. FCA1	23 Mar 2015 02:24
	2	CT	Head 0.5 CE 4D-Vol. FCA1	20 Jan 2015 14:17
	2	CT	Head 0.5 CE 4D-Vol. FCA1	31 Oct 2014 13:45
	2	CT	Head 0.5 CE 4D-Vol. FCA1	30 Oct 2014 15:14
	2	CT	Head 0.5 CE 4D-Vol. FCA1	11 Sep 2014 11:39
	2	CT	Head 0.5 CE 4D-Vol. FCA1	20 Aug 2014 15:56
	2	CT	Head 0.5 CE 4D-Vol. FCA1	14 May 2014 16:00
	2	CT	Head 0.5 CE 4D-Vol. FCA1	14 Feb 2014 14:02
	2	CT	Head 0.5 CE 4D-Vol. FCA1	11 Feb 2014 14:41
	2	CT	Head 0.5 CE 4D-Vol. FCA1	16 Jan 2014 13:01
	2	CT	Head 0.5 CE 4D-Vol. FCA1	01 Mar 2013 16:09
	2	CT	Head 0.5 CE 4D-Vol. FCA1	


58. Программное приложение для анализа перфузии головного мозга.

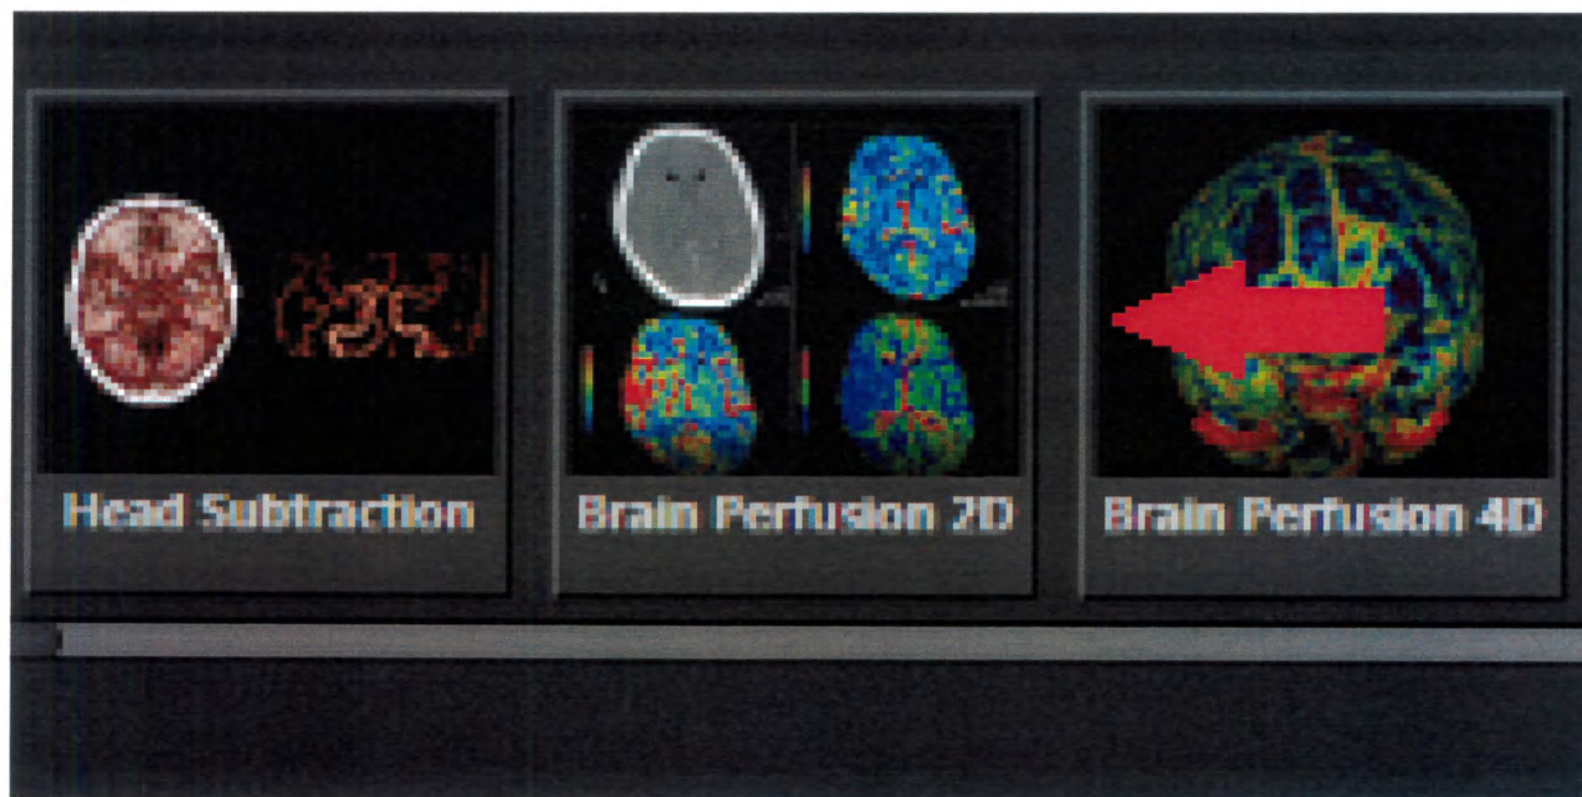


58. Программное приложение для анализа перфузии головного мозга.

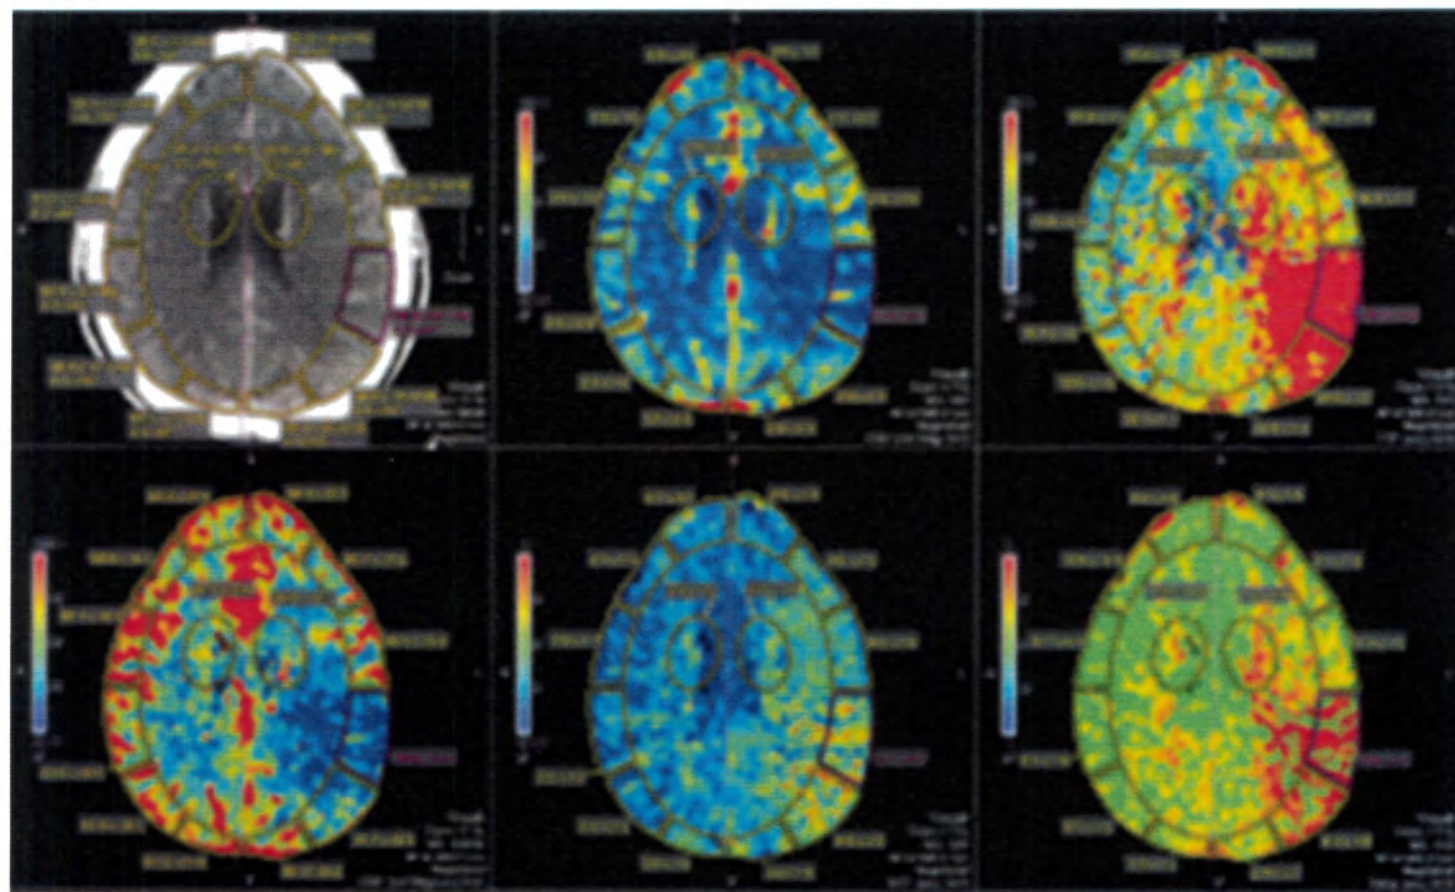

59. Программное приложение для планирования установки стента.

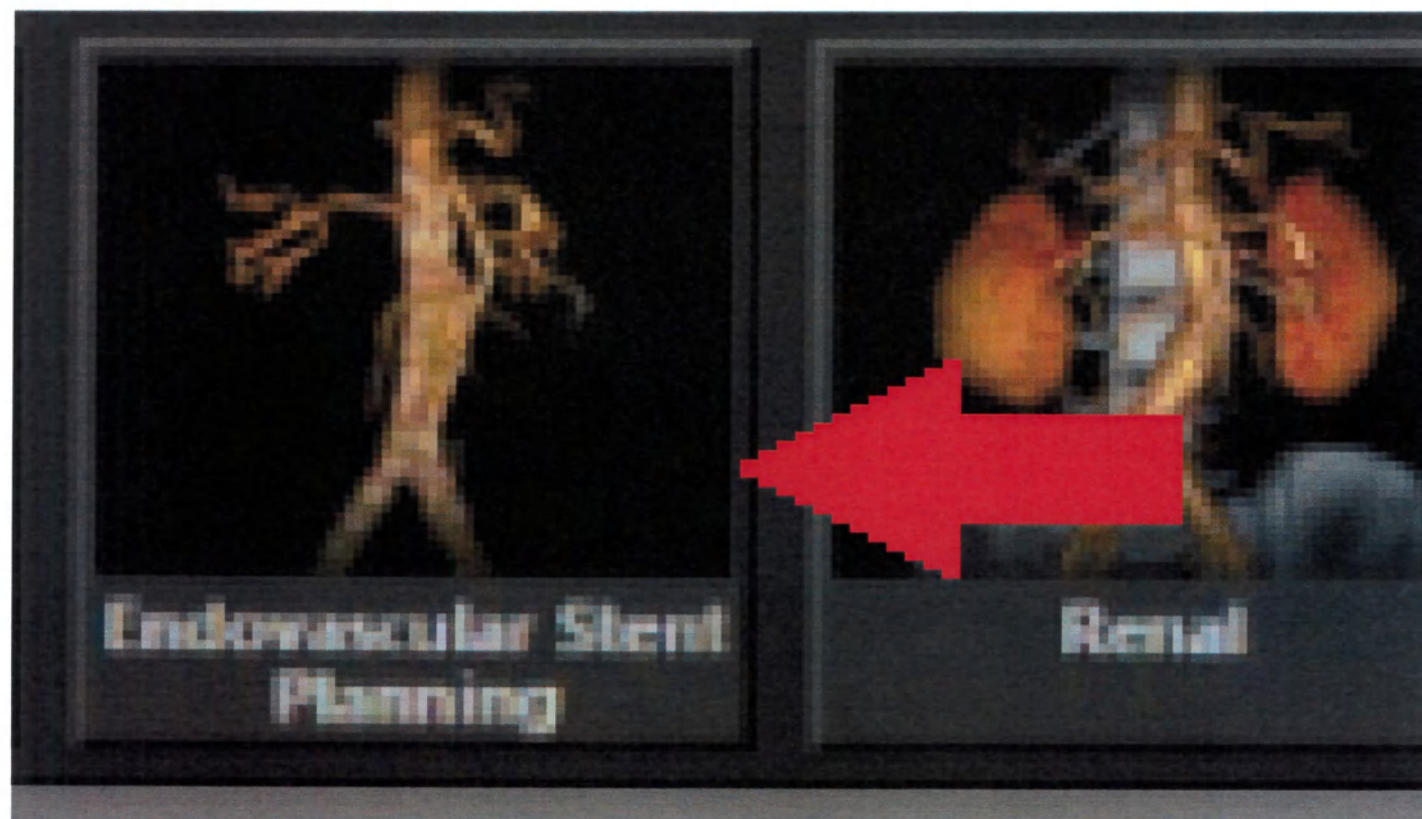

60. Программное приложение для оценки жирового индекса.

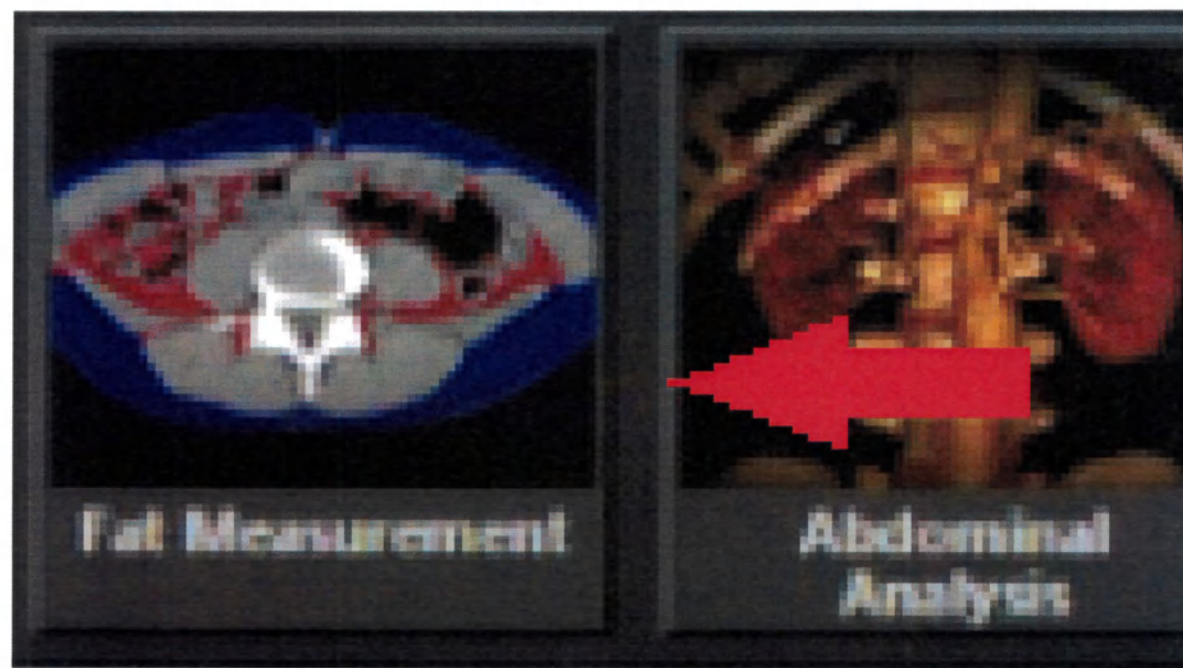




61. Программное приложение для виртуальной колоноскопии.




61. Программное приложение для виртуальной колоноскопии.





62. Программное приложение для виртуальной колоноскопии, включая функцию компьютеризированного поиска полипов.

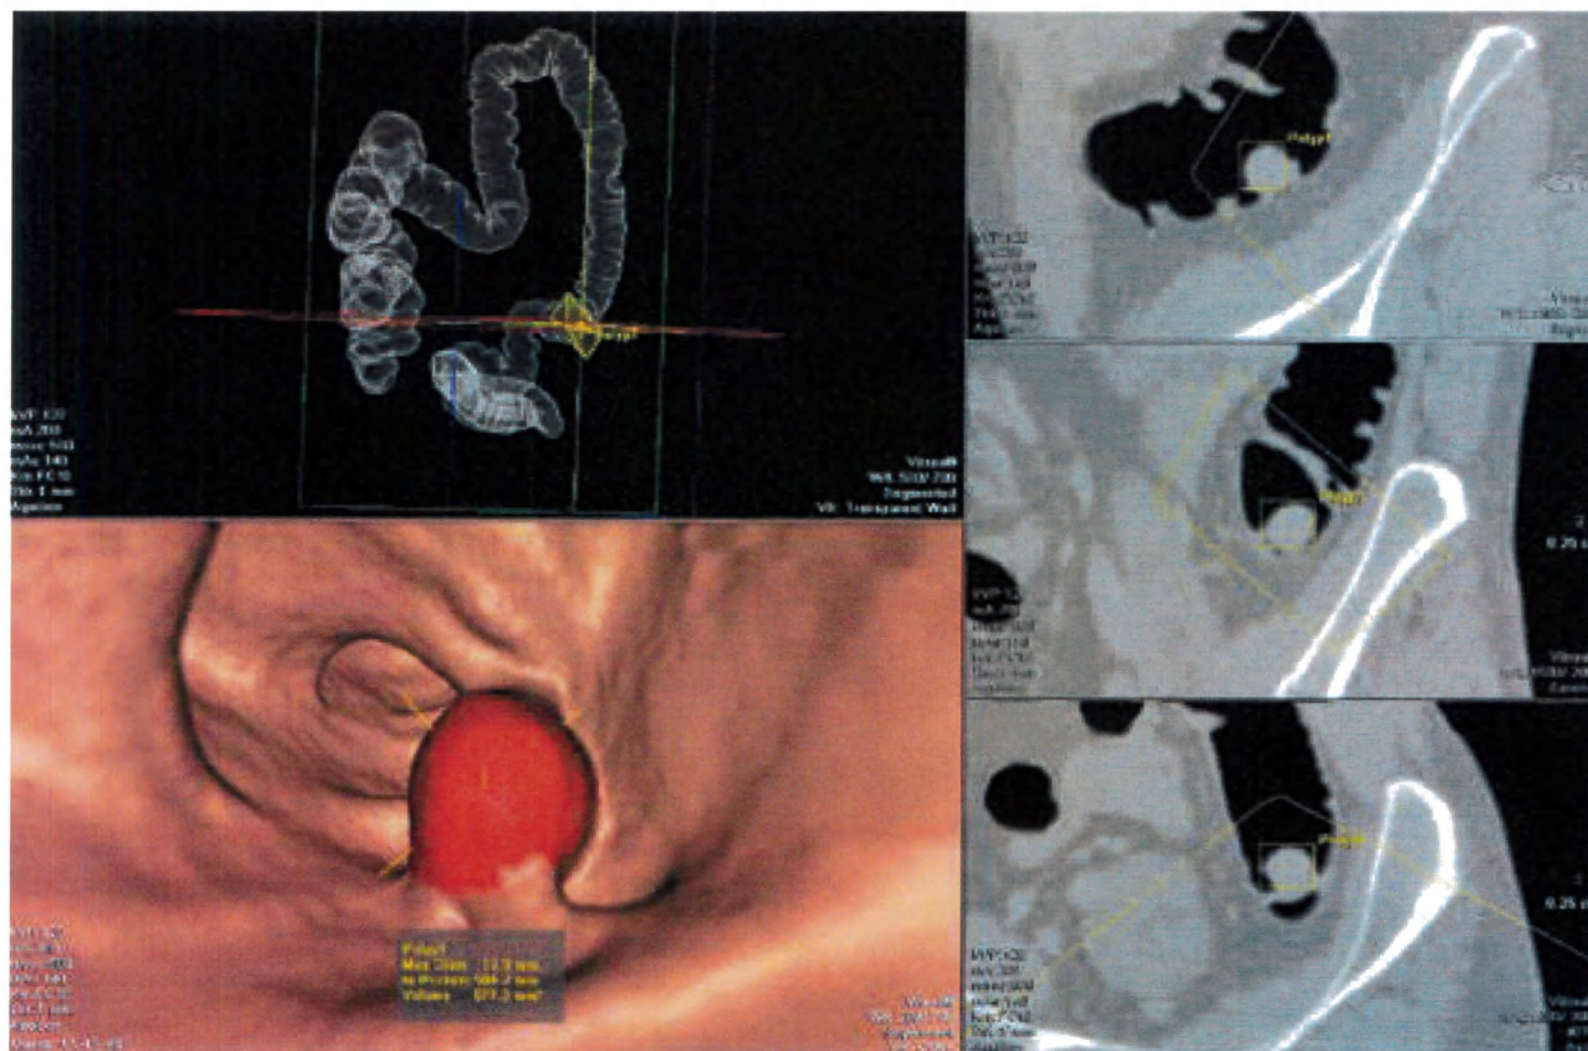


63. Программное приложение для анализа печени.

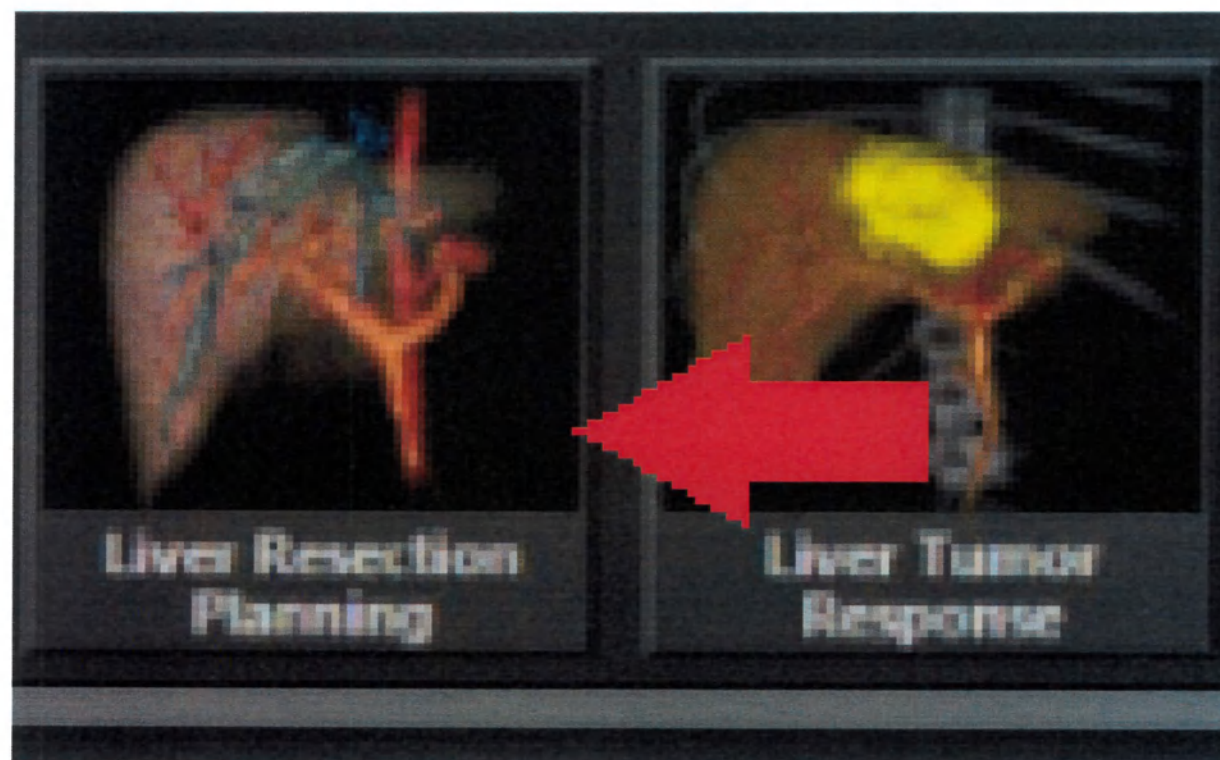


63. Программное приложение для анализа печени.

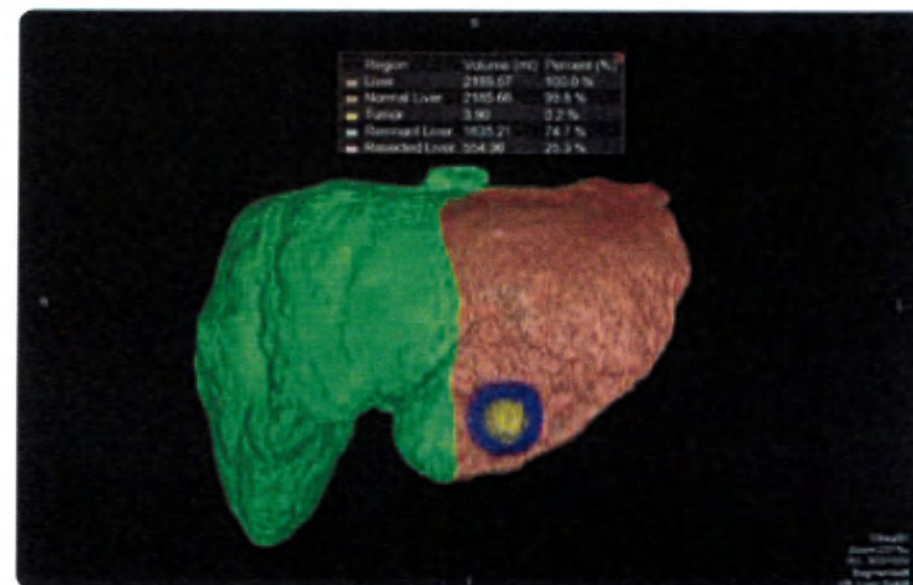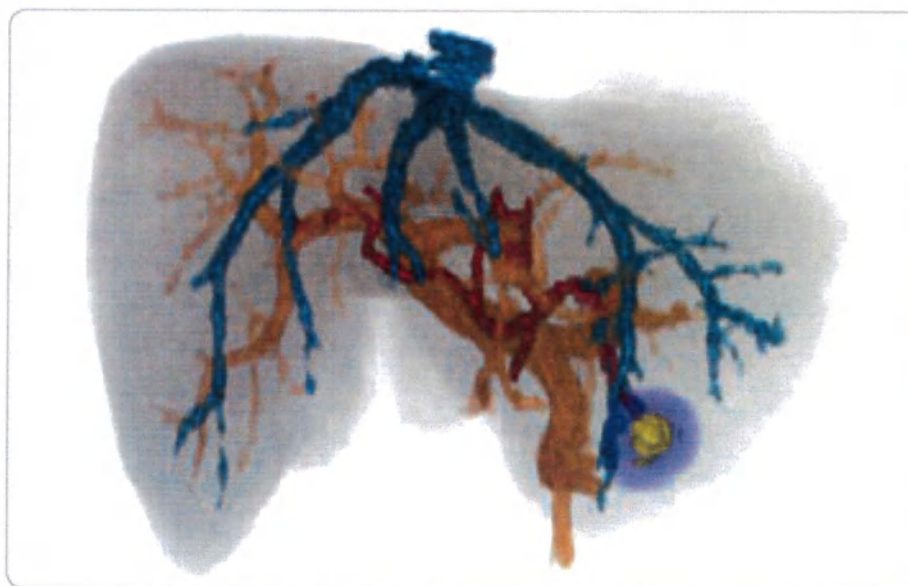


64. Программное приложение для анализа плотности легочной ткани.

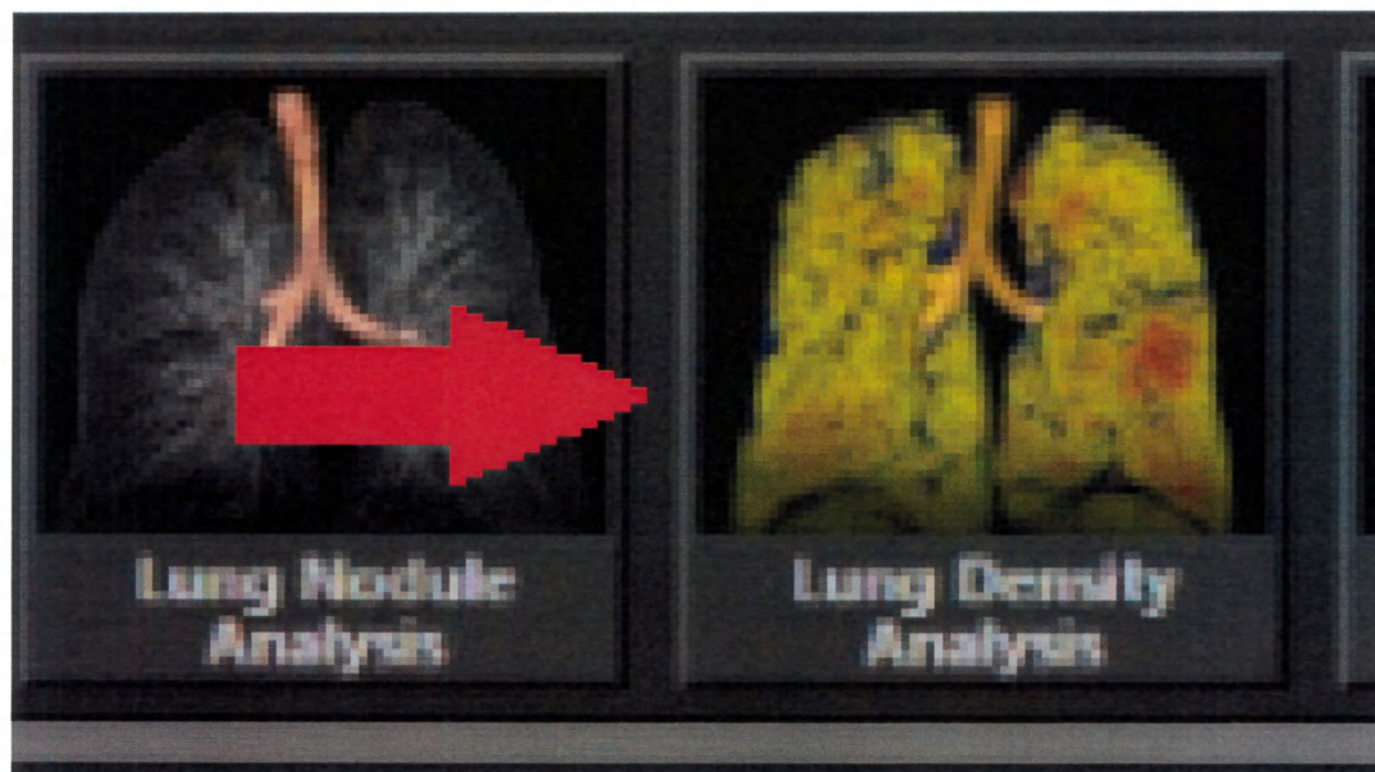


64. Программное приложение для анализа плотности легочной ткани.

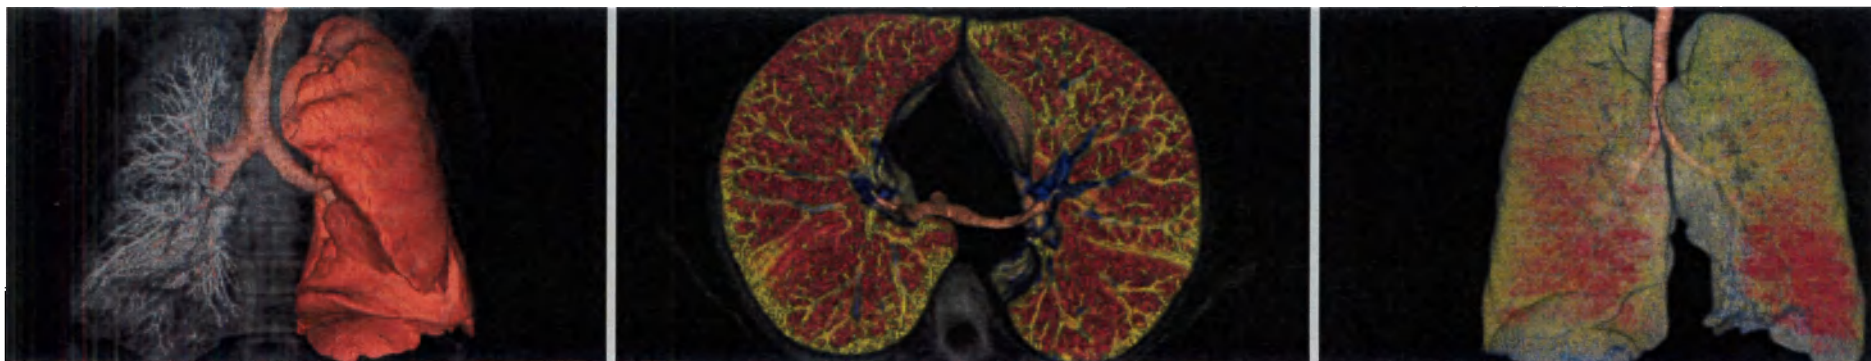


65. Программное приложение для анализа узелковых образований легких.

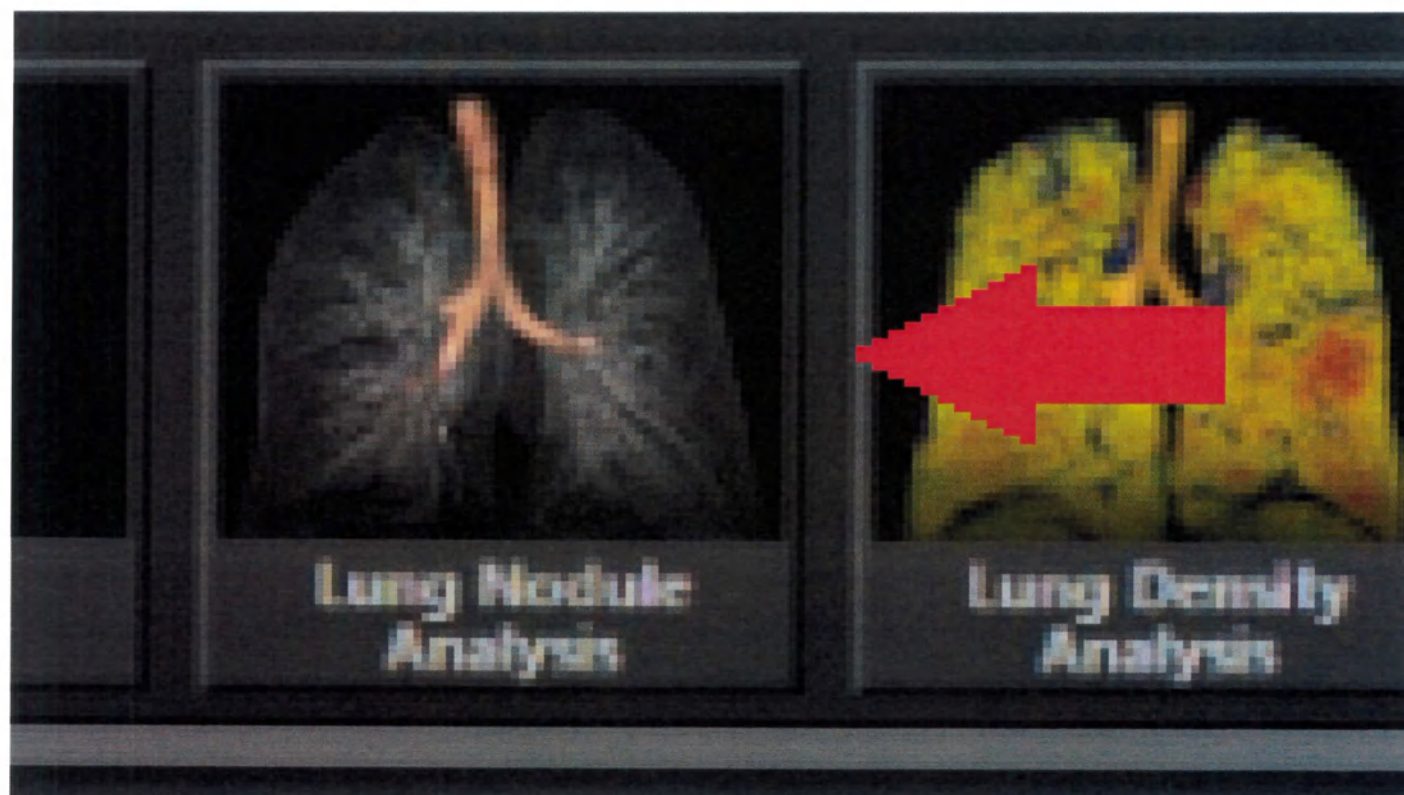


65. Программное приложение для анализа узелковых образований легких.

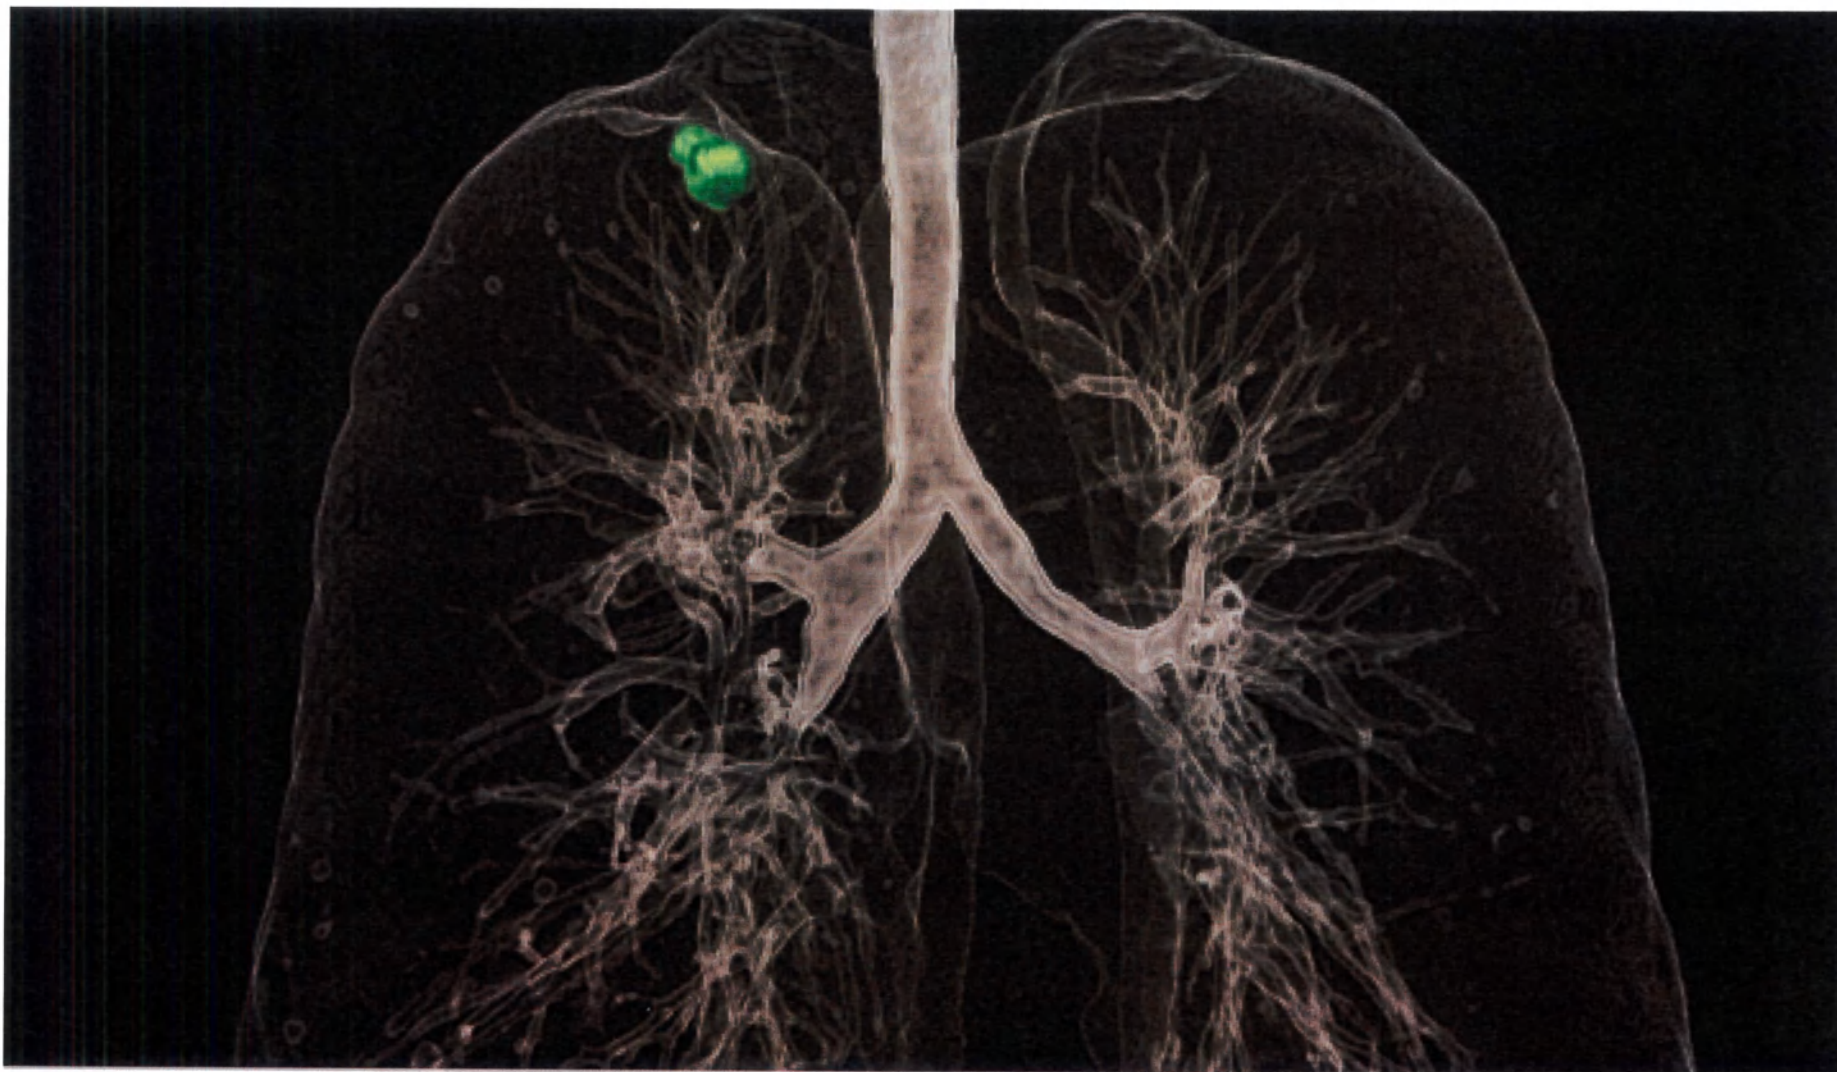


66. Программное приложение для анализа узелковых образований легких, включая функцию компьютеризированного поиска.

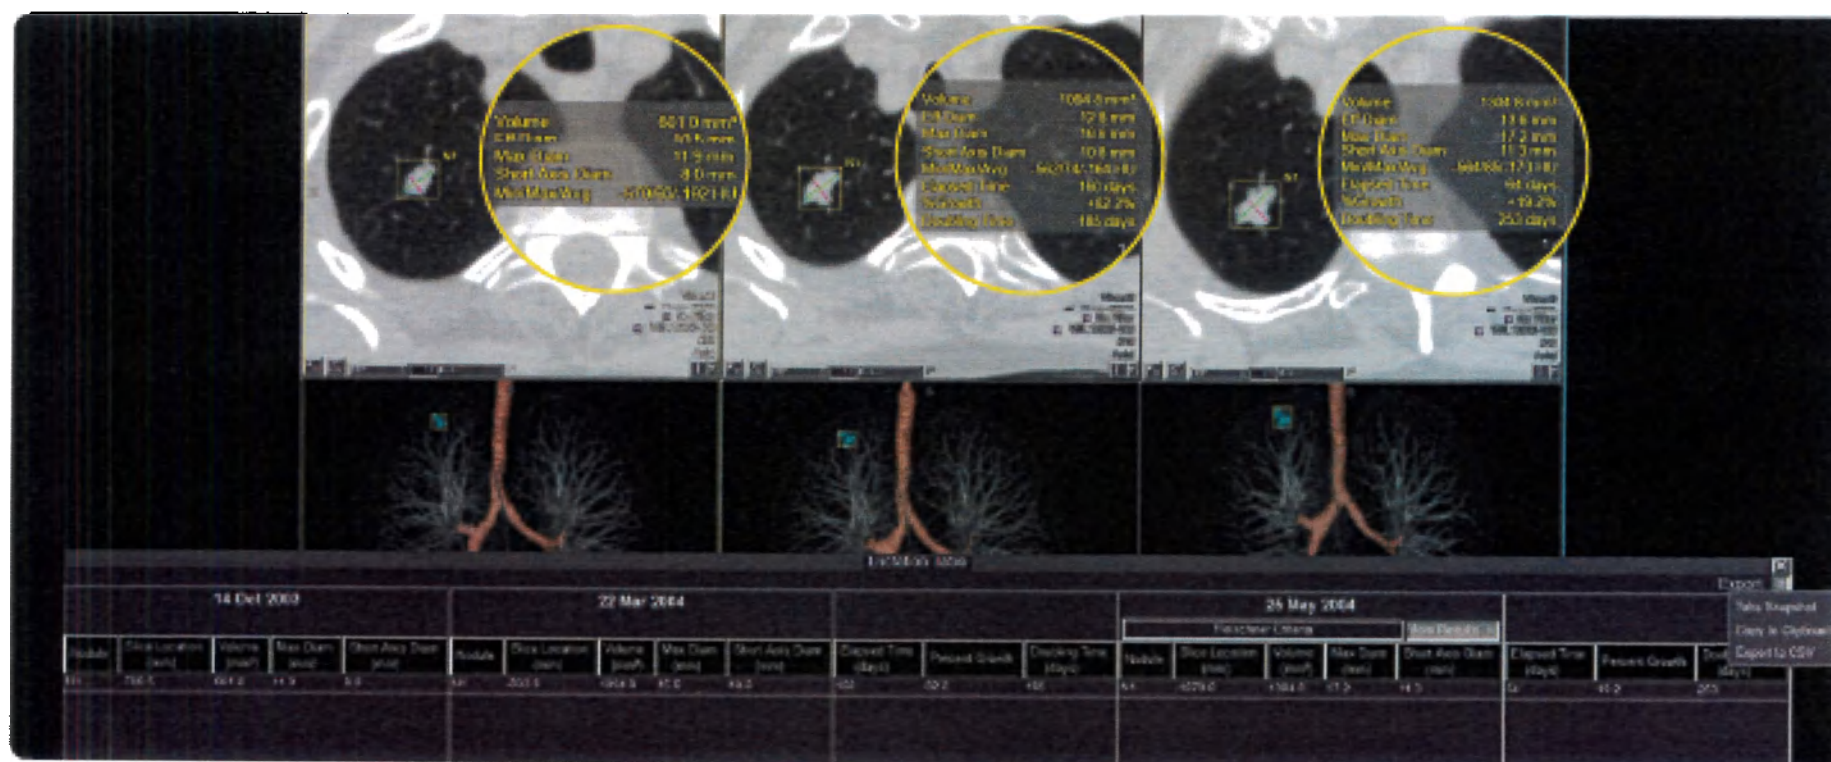


67. Программное приложение для анализа периферических сосудов.

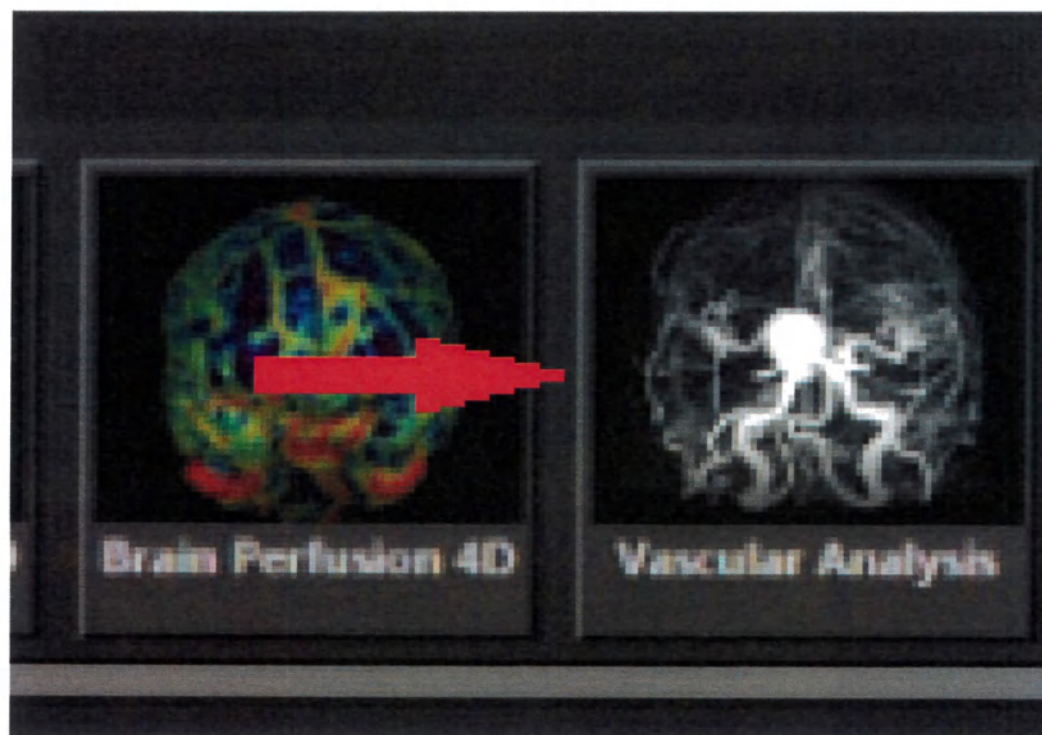

67. Программное приложение для анализа периферических сосудов.

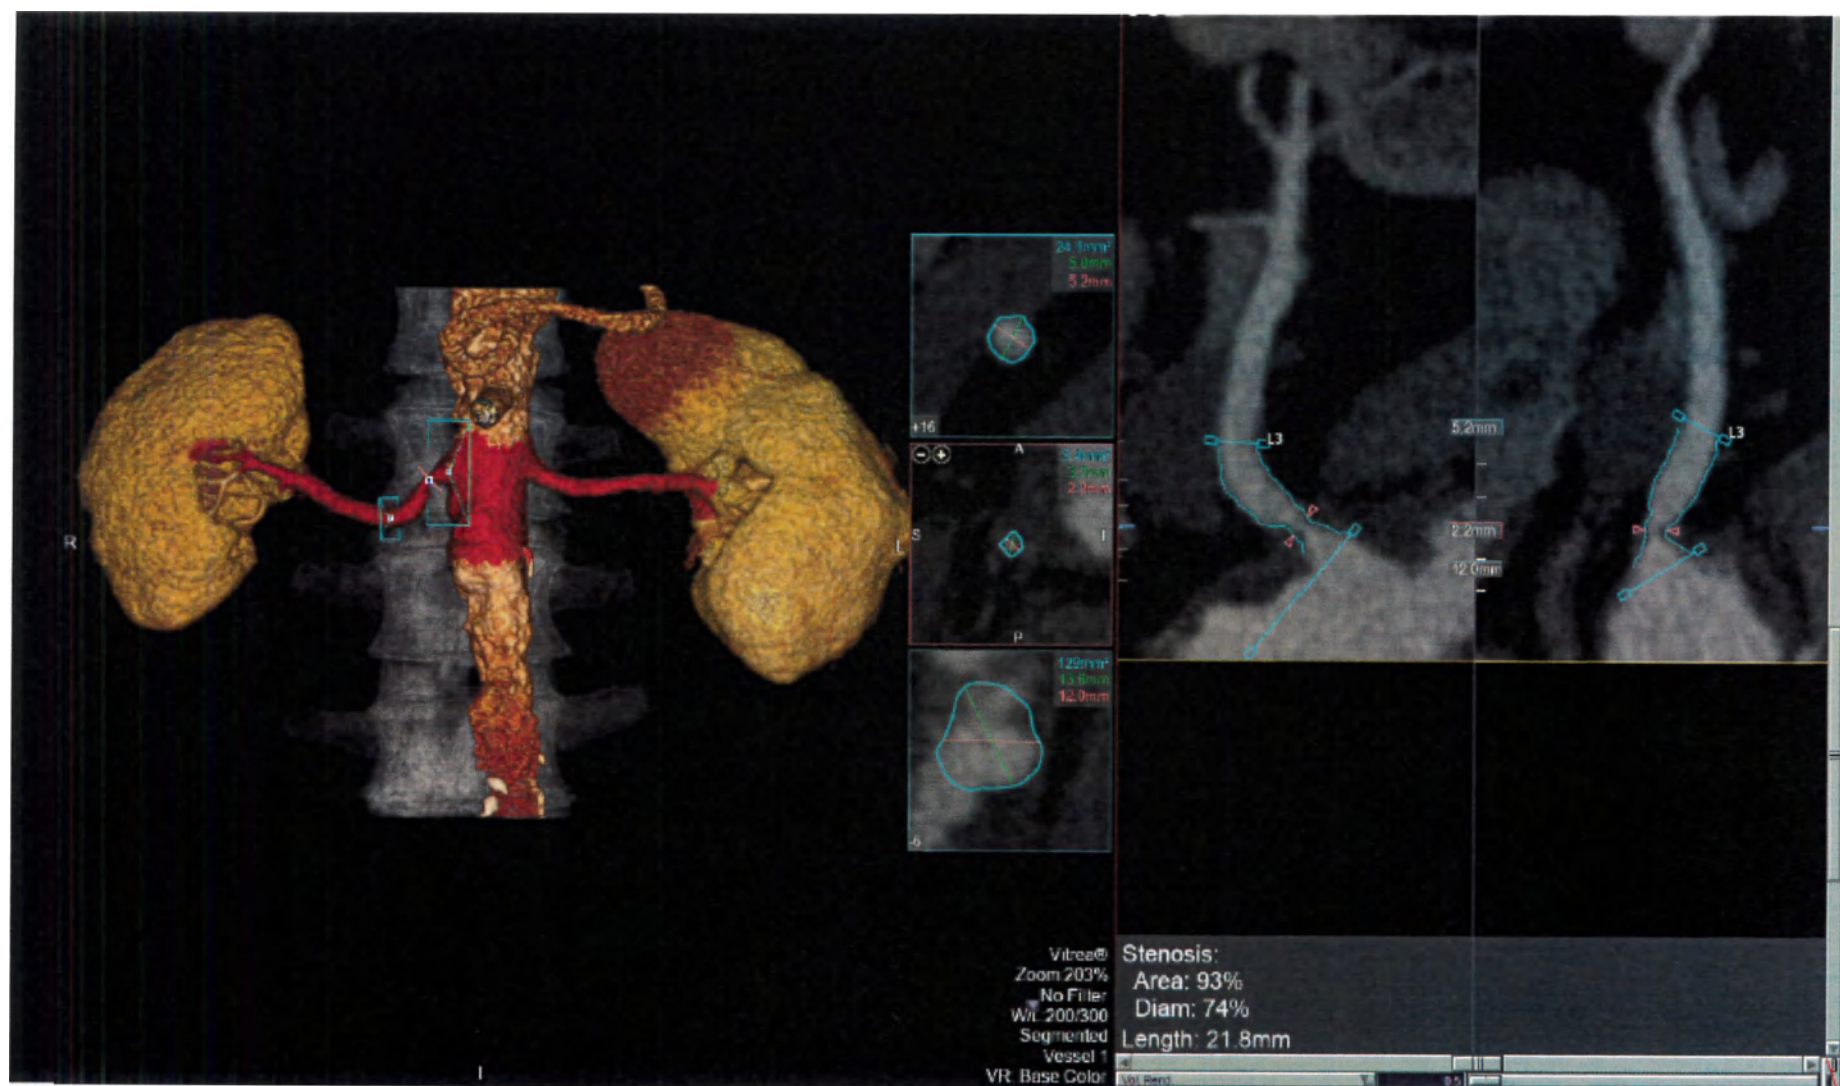


68. Программное приложение для анализа структуры атеросклеротических бляшек.

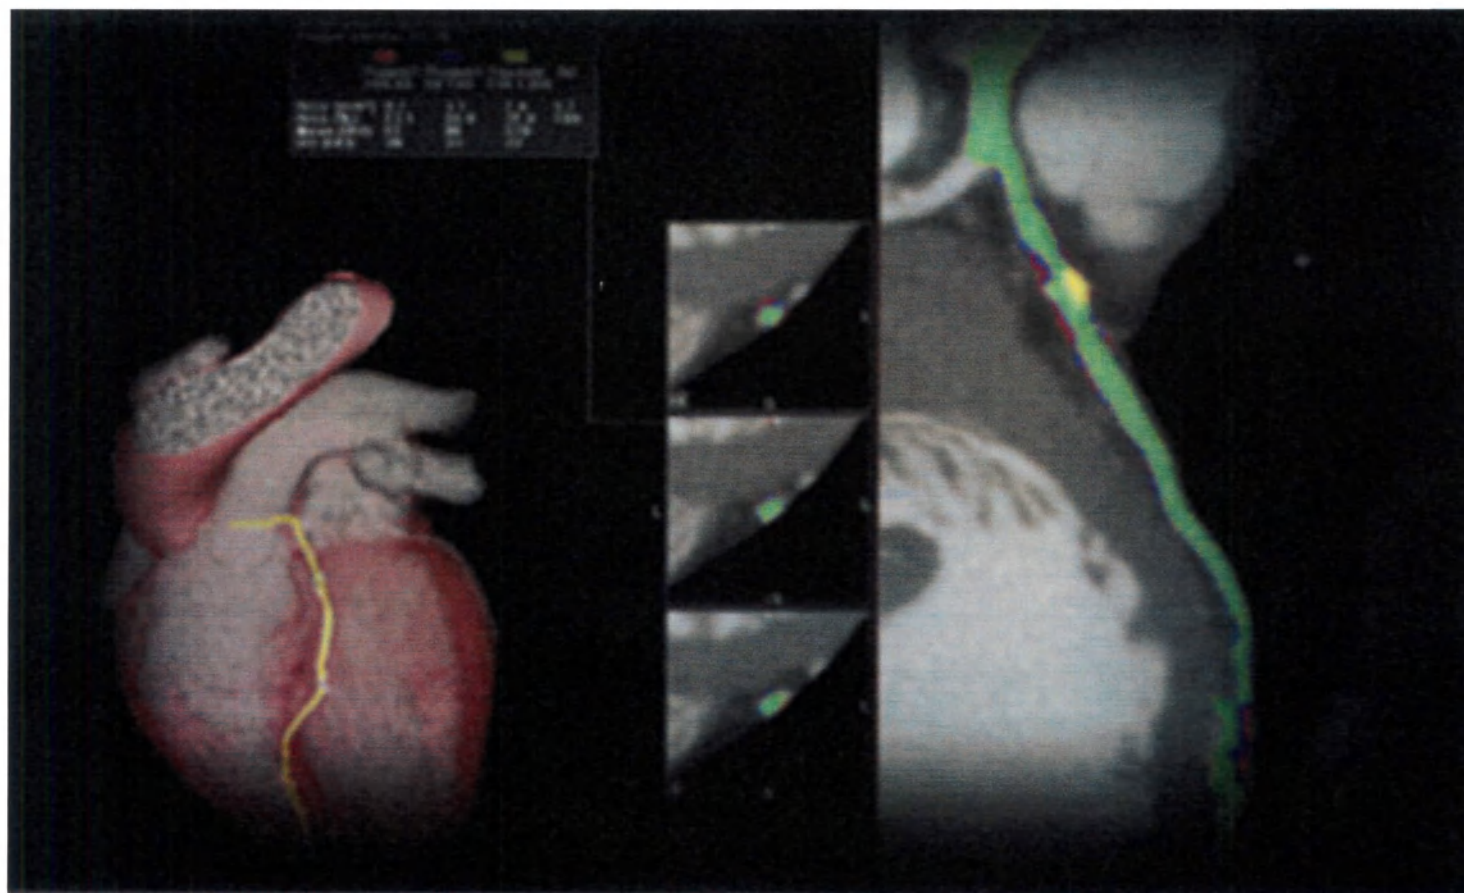

69. Программное приложение для оценки содержания кальция.





69. Программное приложение для оценки содержания кальция.

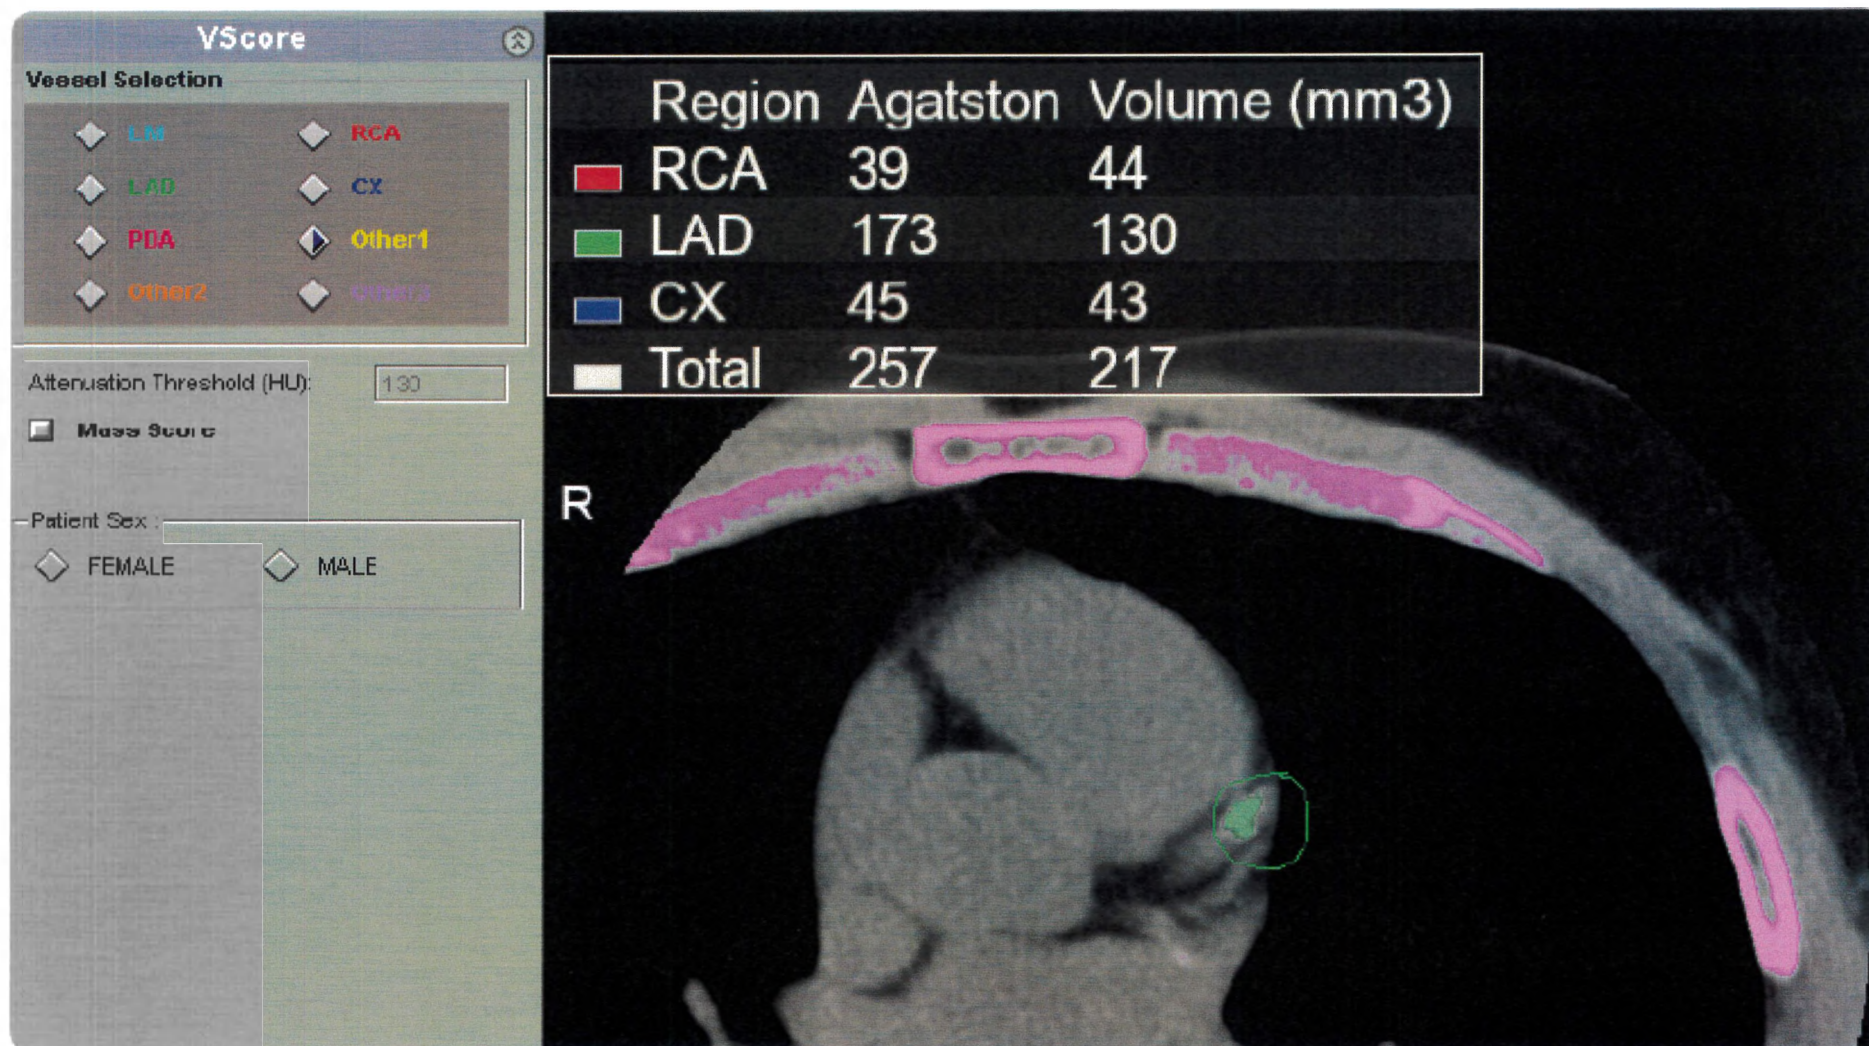

70. Программное приложение для совмещения и сопоставления изображений разных модальностей.




70. Программное приложение для совмещения и сопоставления изображений разных модальностей.

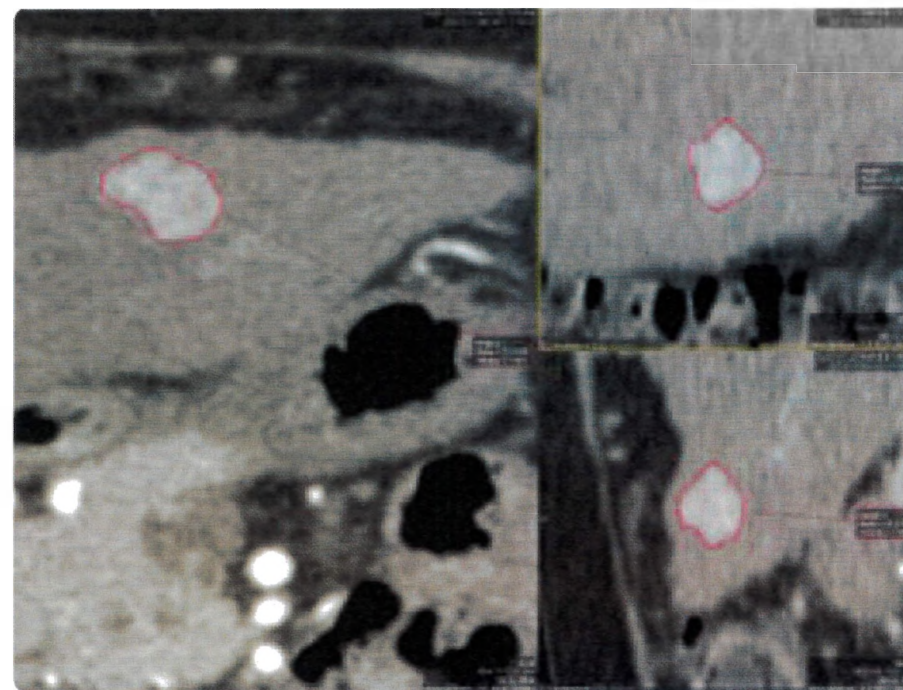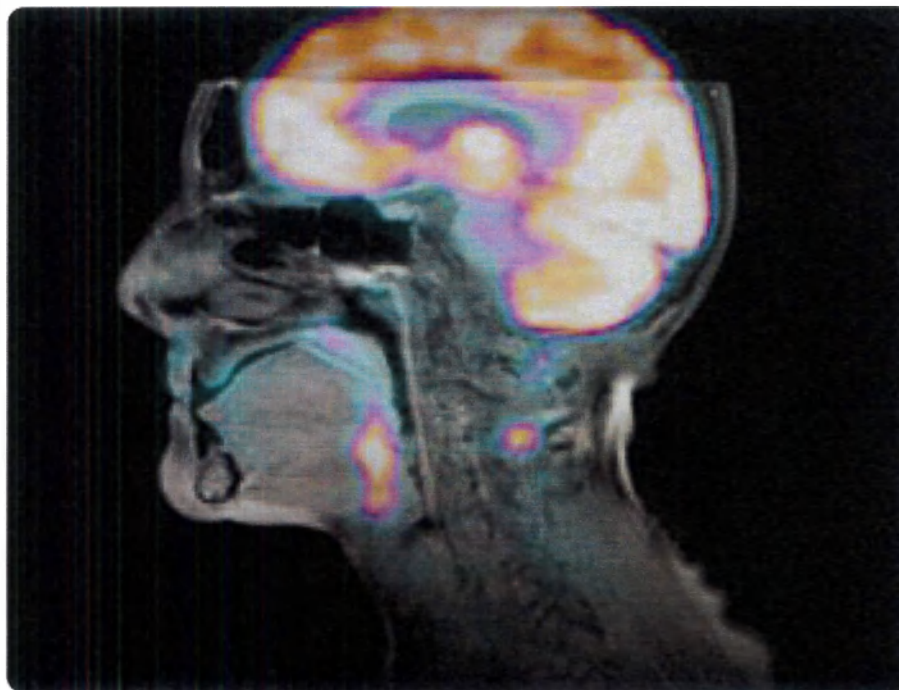


71. Программное приложение для стоматологического анализа.




71. Программное приложение для стоматологического анализа.

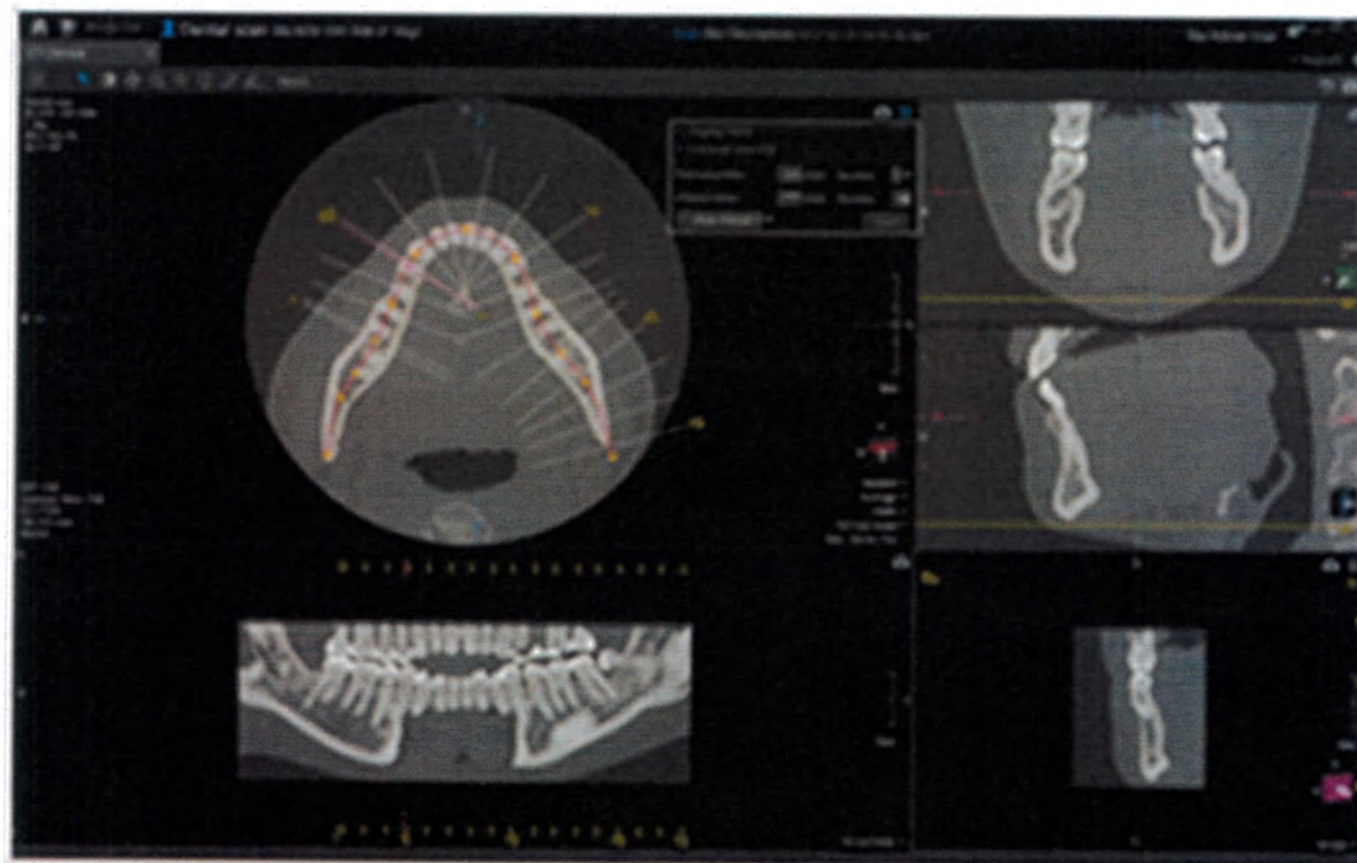


72. Программное приложение для анализа сердца и коронарных сосудов.

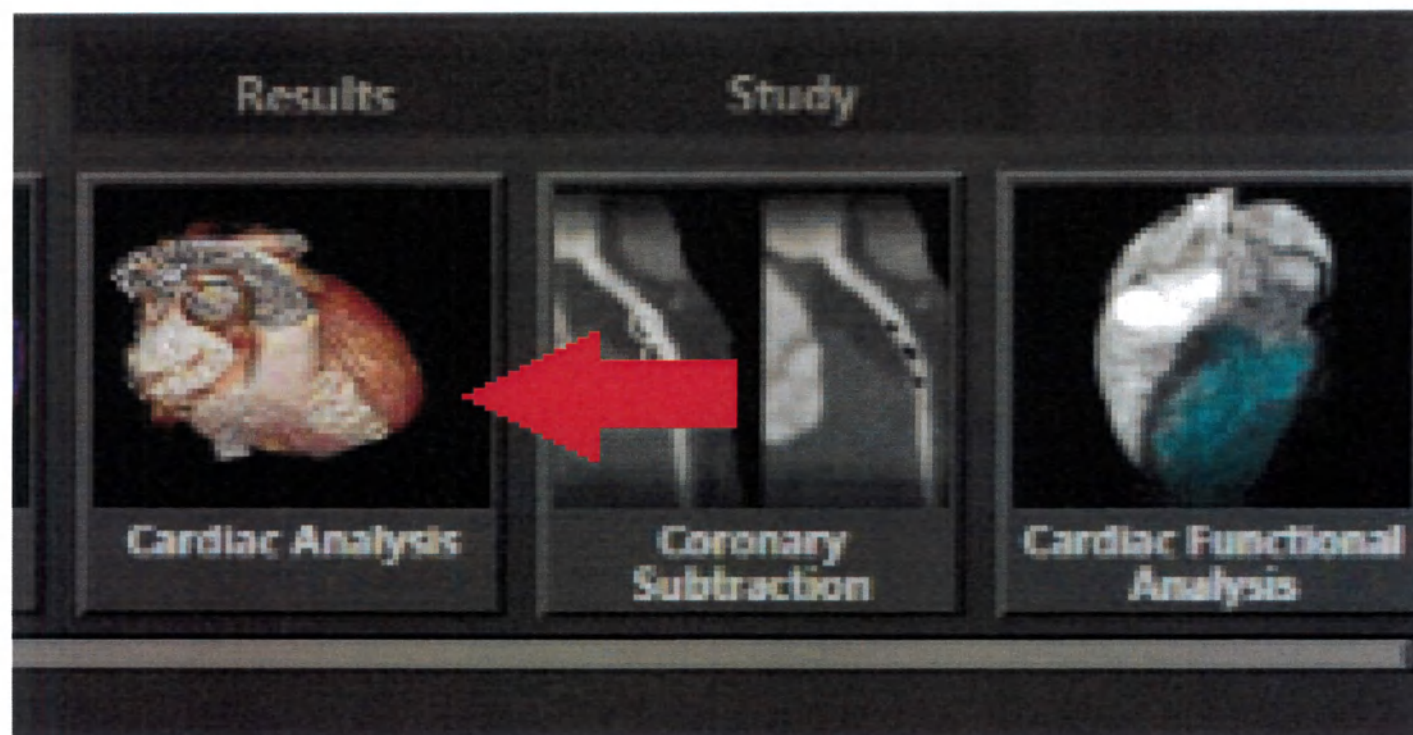


72. Программное приложение для анализа сердца и коронарных сосудов.

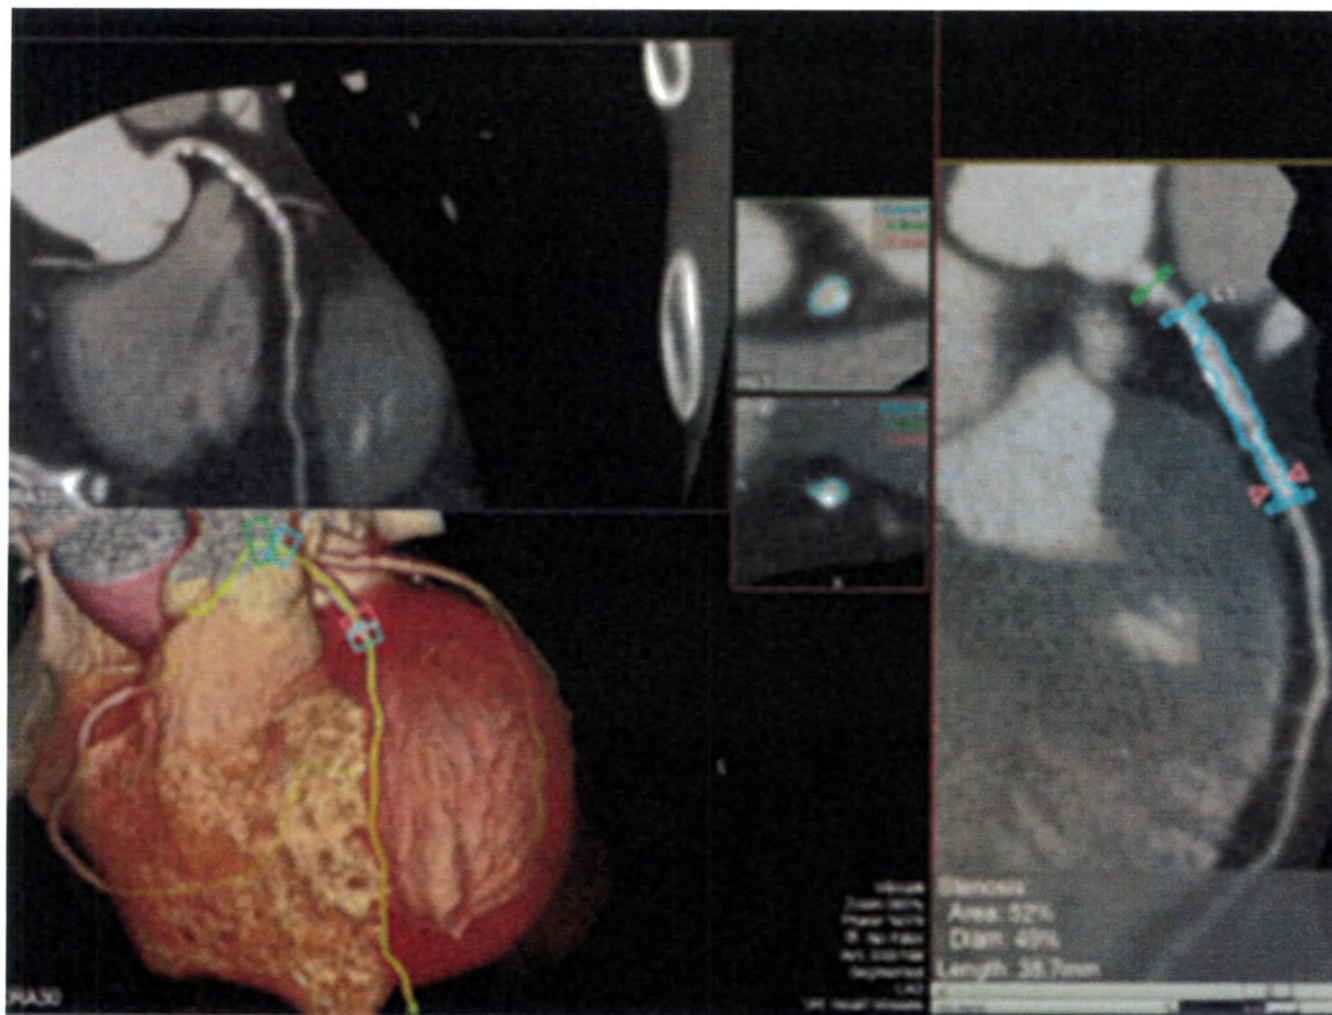


73. Программное приложение для функционального анализа сердца.

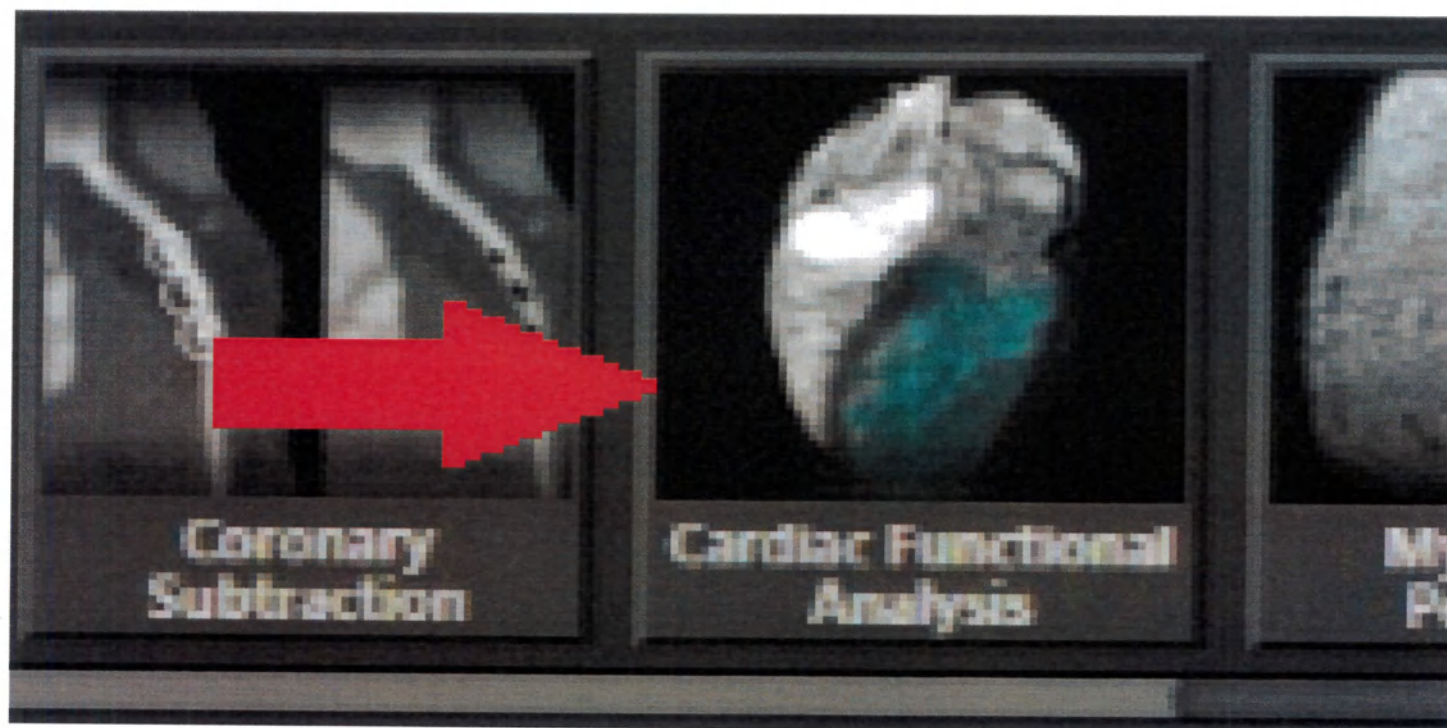

73. Программное приложение для функционального анализа сердца.

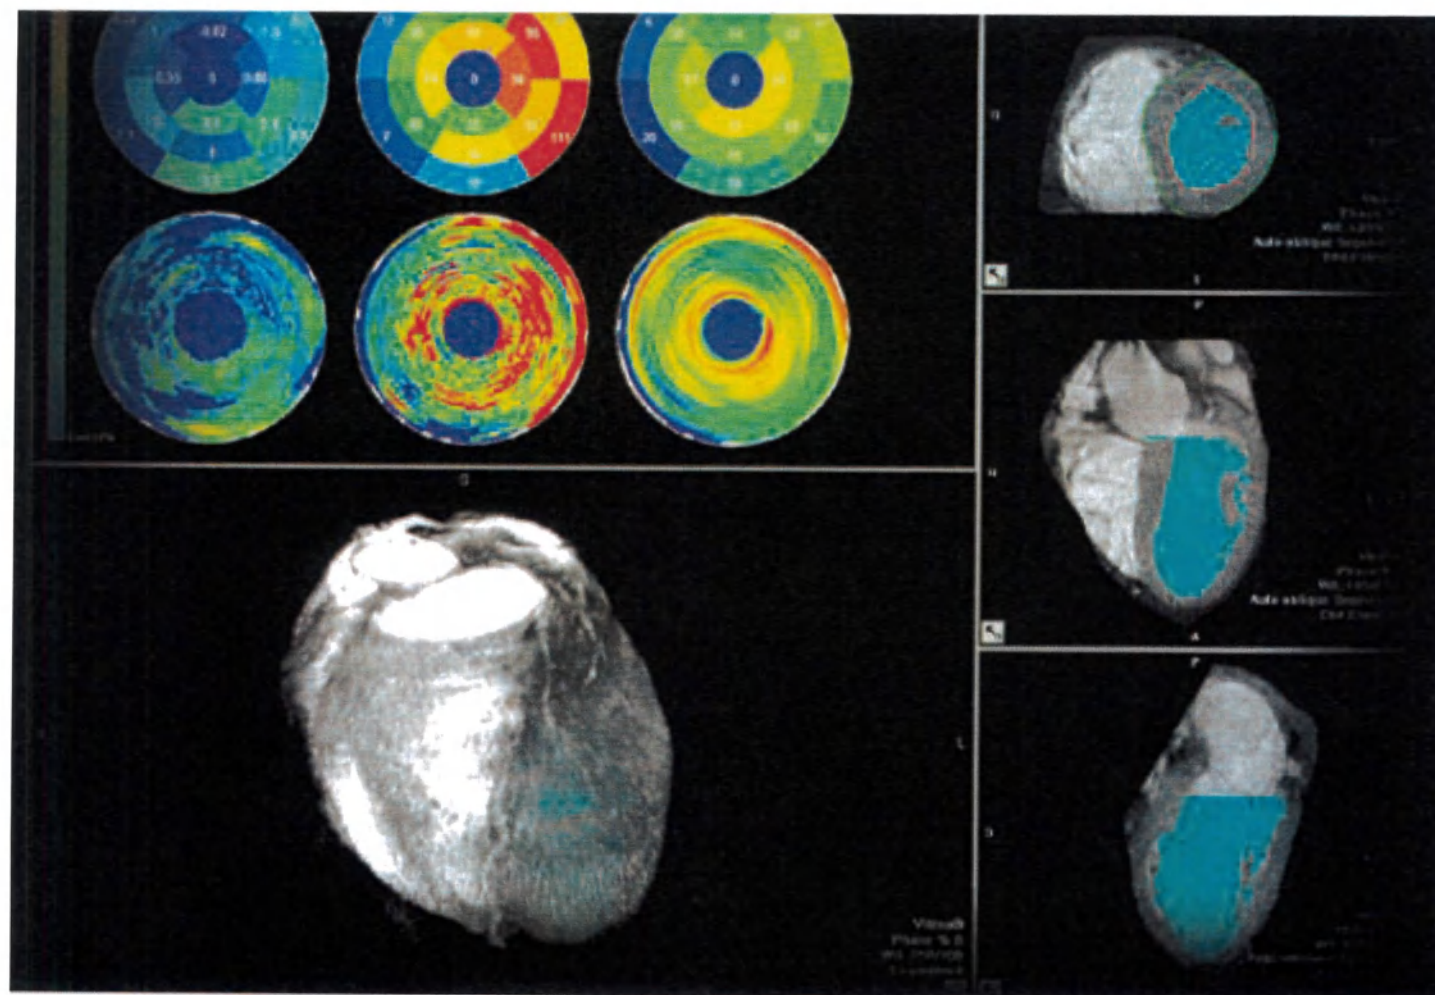

74. Программное приложение для многокамерного анализа функции сердца.

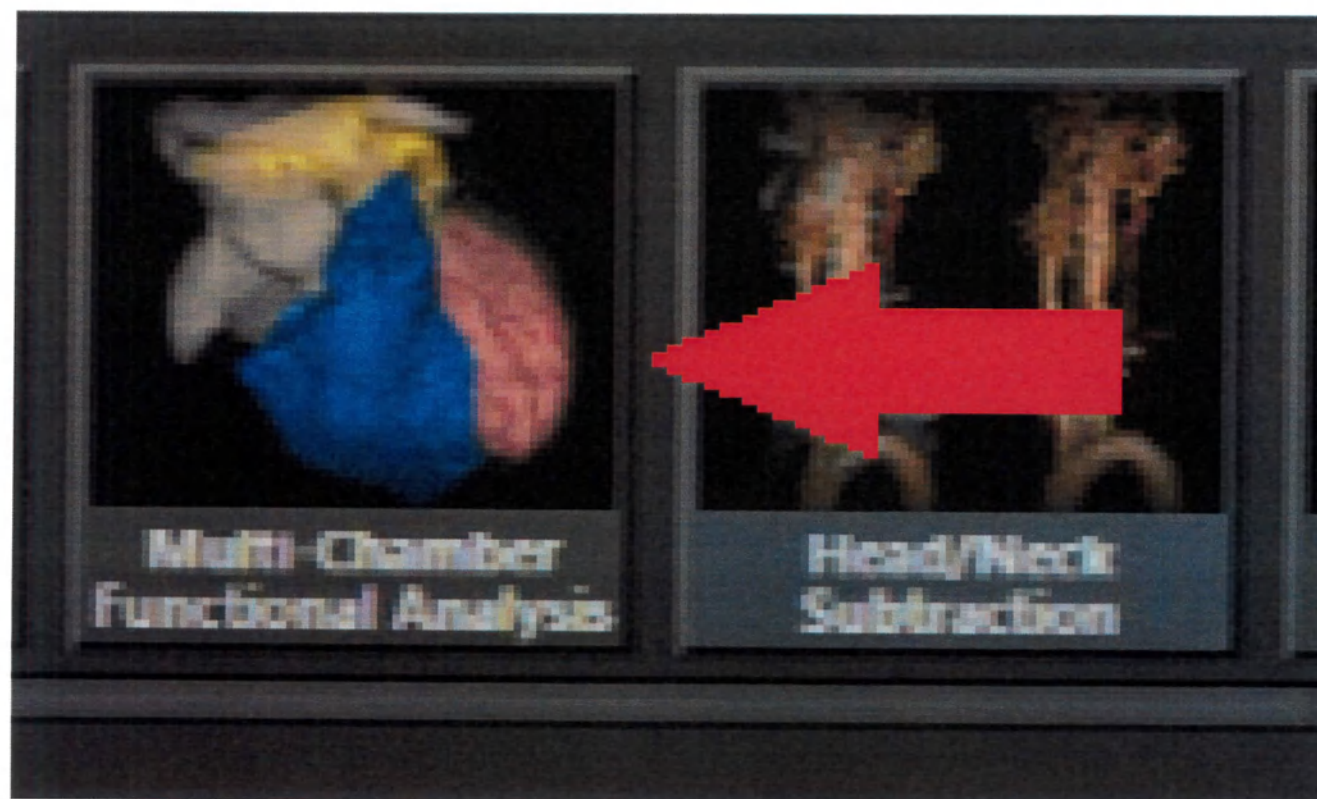

74. Программное приложение для многокамерного анализа функции сердца.

Chamber Results ✕

☒ Index	LV	RV	LA
EF (%)	64	50	8.7
EDVI (ml/m ²)	49	79	36
ESVI (ml/m ²)	17	39	33
SVI (ml/m ²)	31	40	3.1
CI (L/min/m ²)	2.0	2.6	

[Less Results](#) ⬆

Body

Heart Rate	65 bpm
Body Surface Area	1.9 m ²

LV


Myocardial Mass	93 g
Myocardial Index	1.2 g/kg
Myocardial Volume	88 ml

LV/RV


Regurgitation Fraction	21 %
------------------------	------

LA


Max. Vol. Index	50.6 ml/m ²
Cyc. Vol. Change Index	17.7 ml/m ²
Reservoir Vol. Index	

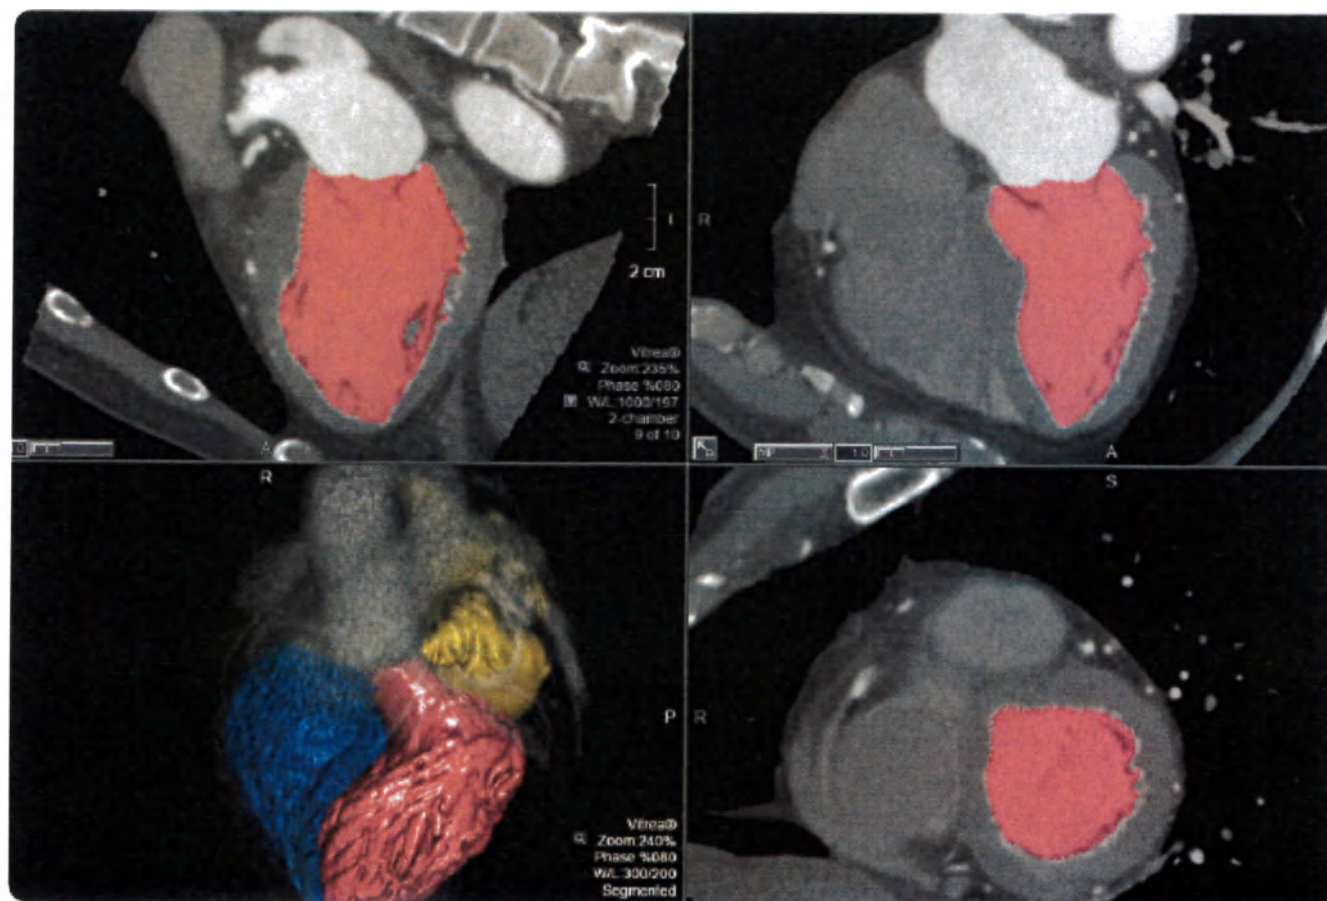


75. Программное приложение для электрофизиологического планирования.


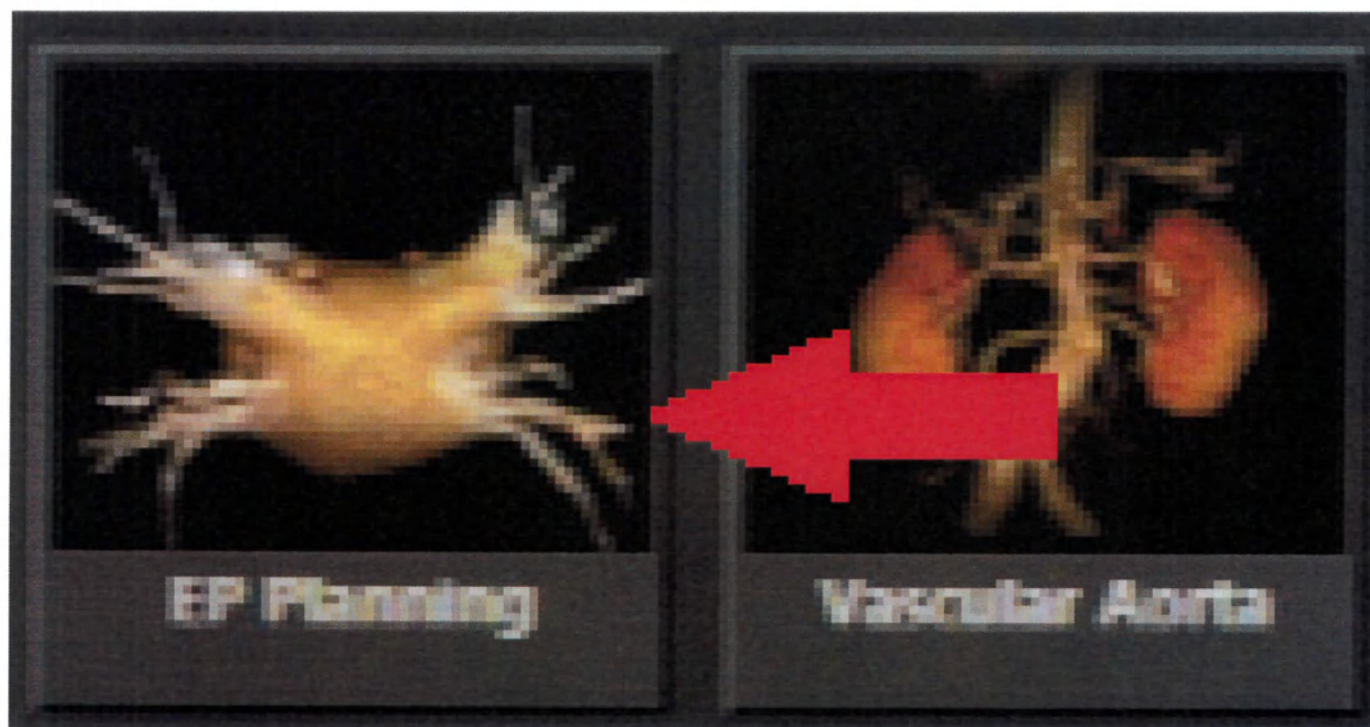




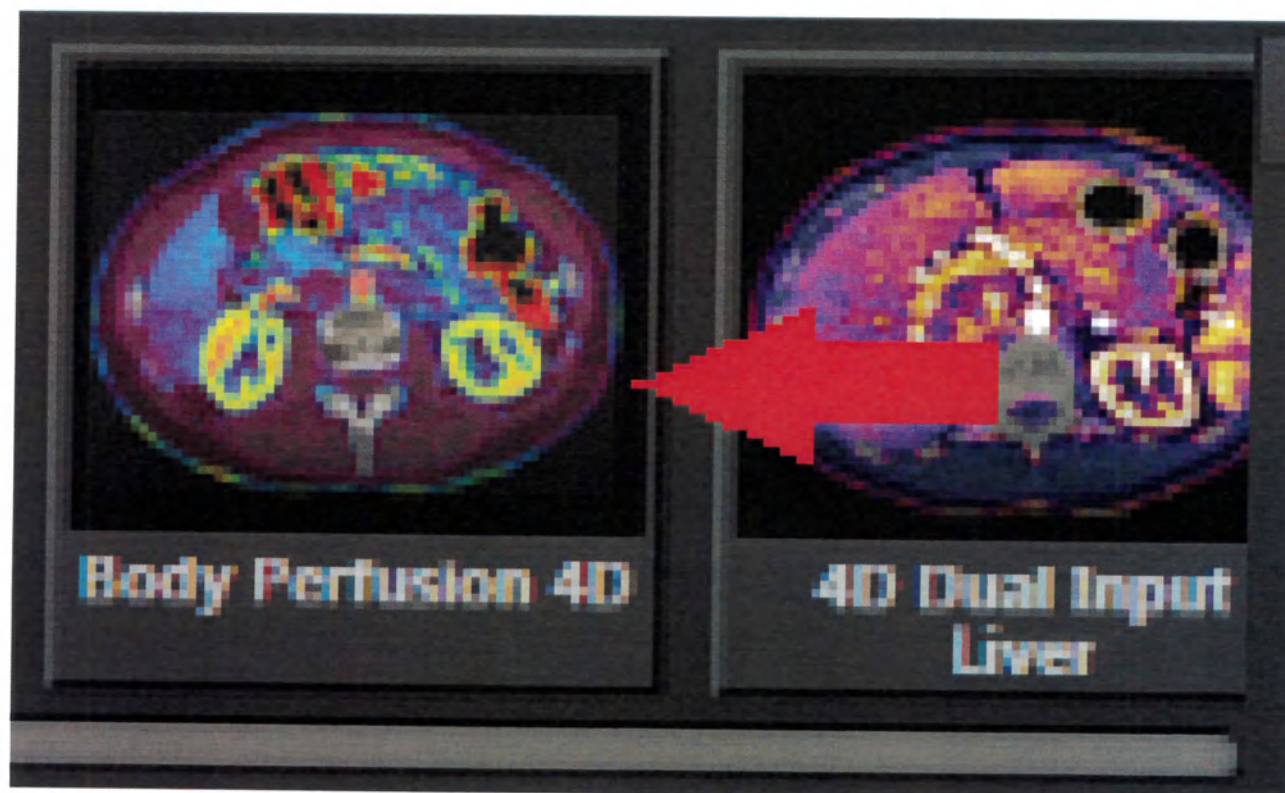


76. Программное приложение для оценки перфузии внутренних органов.

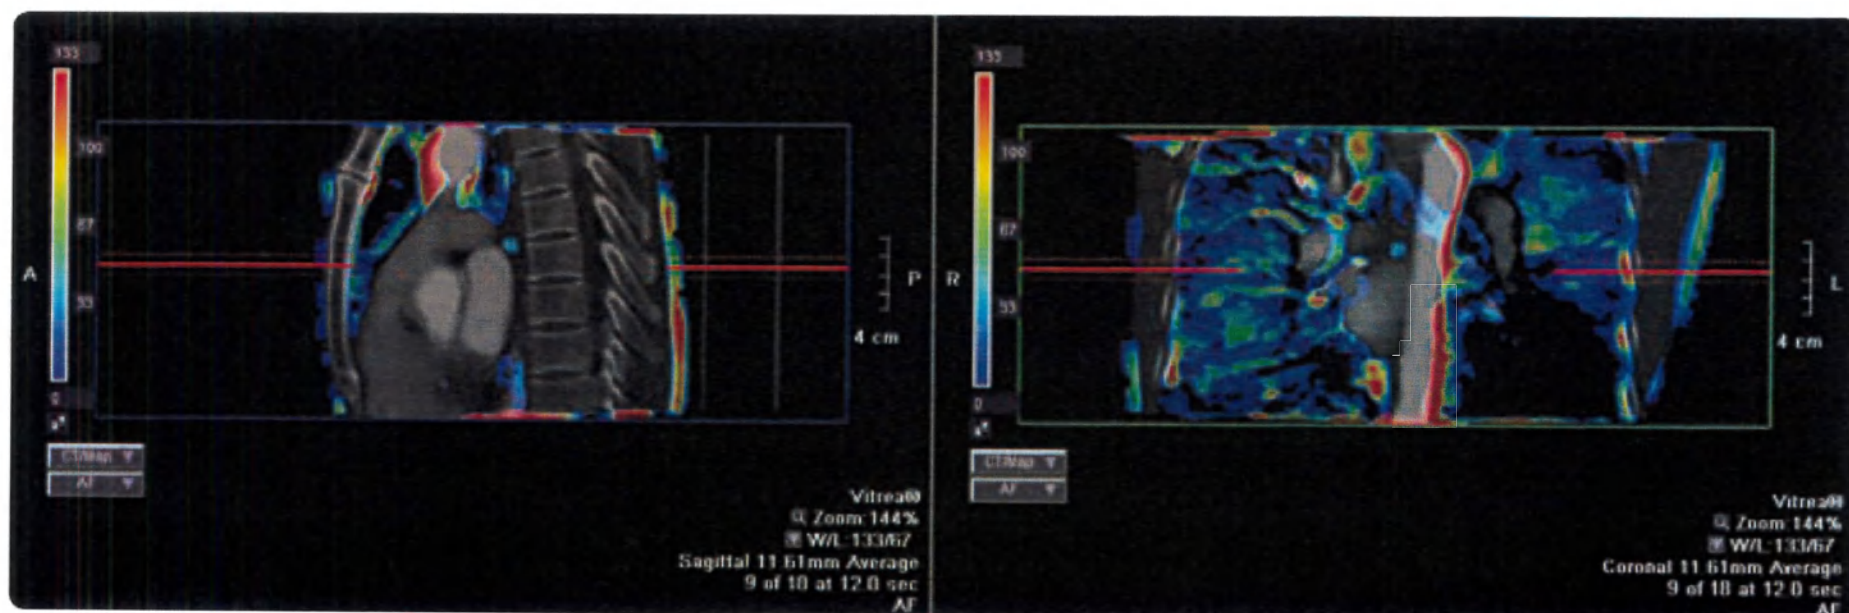

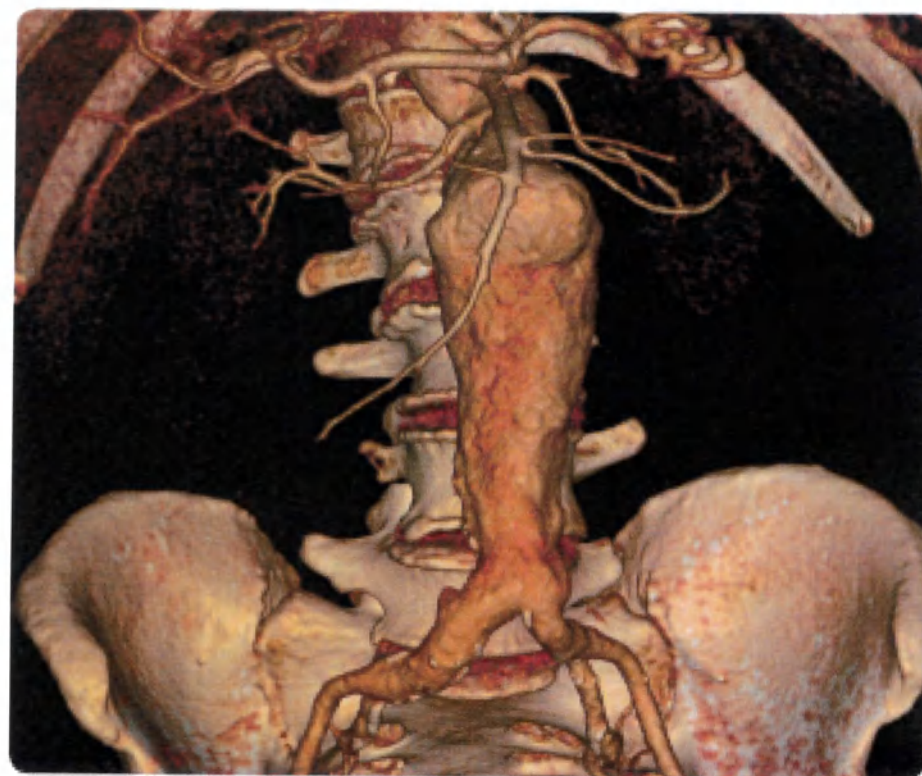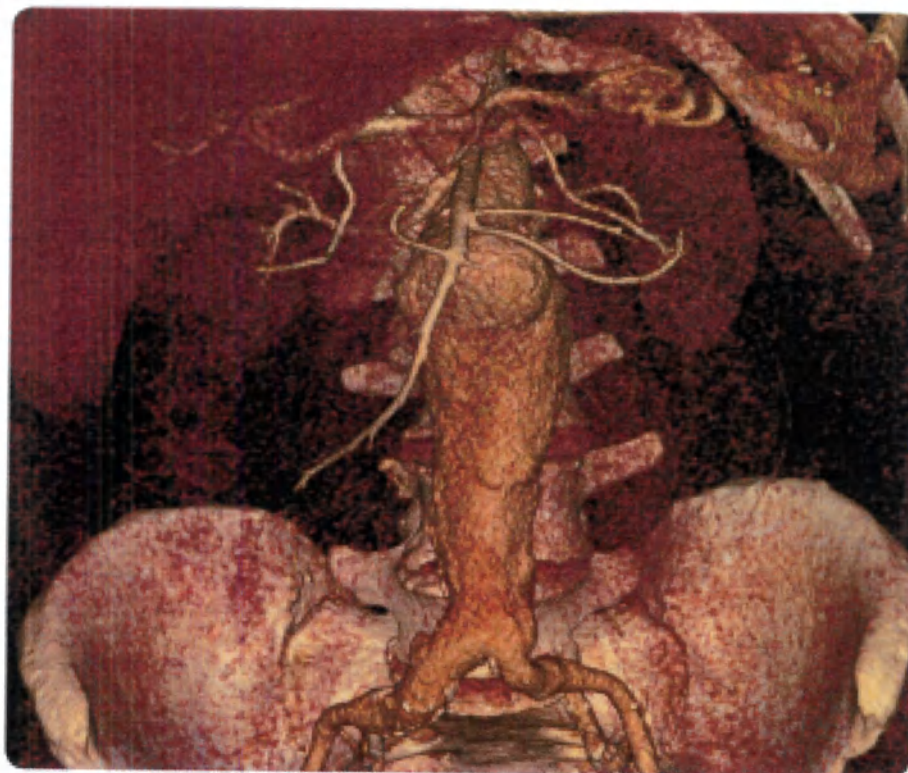


78. Программный пакет для анализа аневризм артерий головного мозга

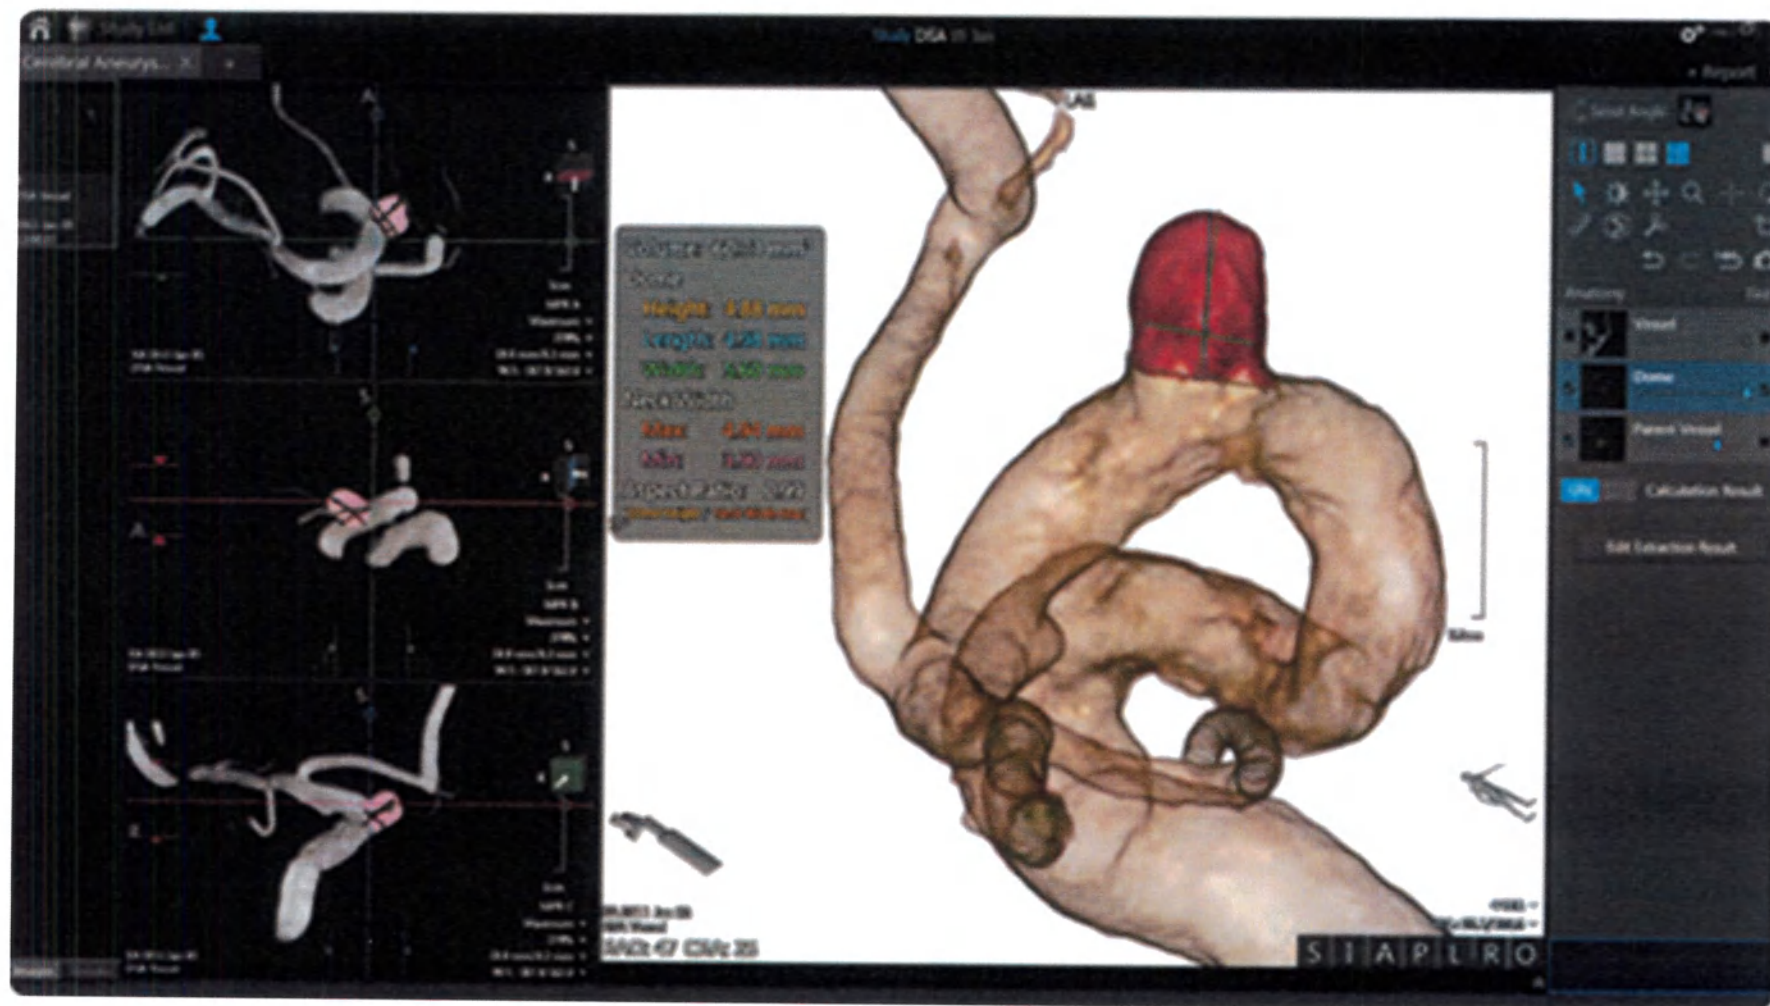


79. Программный пакет 3D-Angio.



80. Программный пакет для планирования эмболизации.

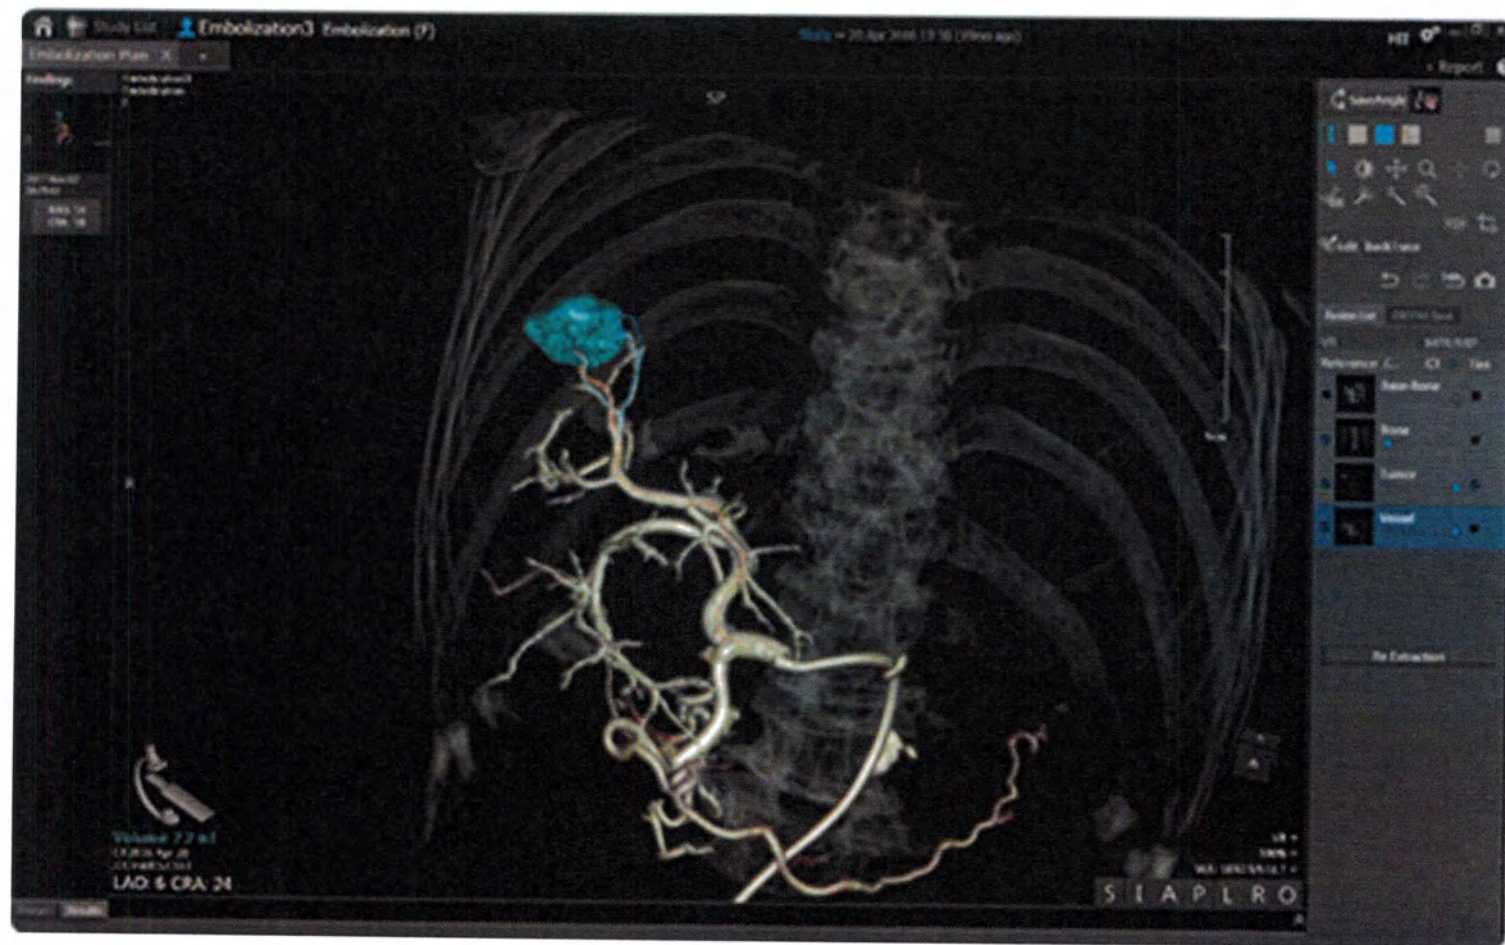


81. Программный пакет для анализа дыхательных путей.

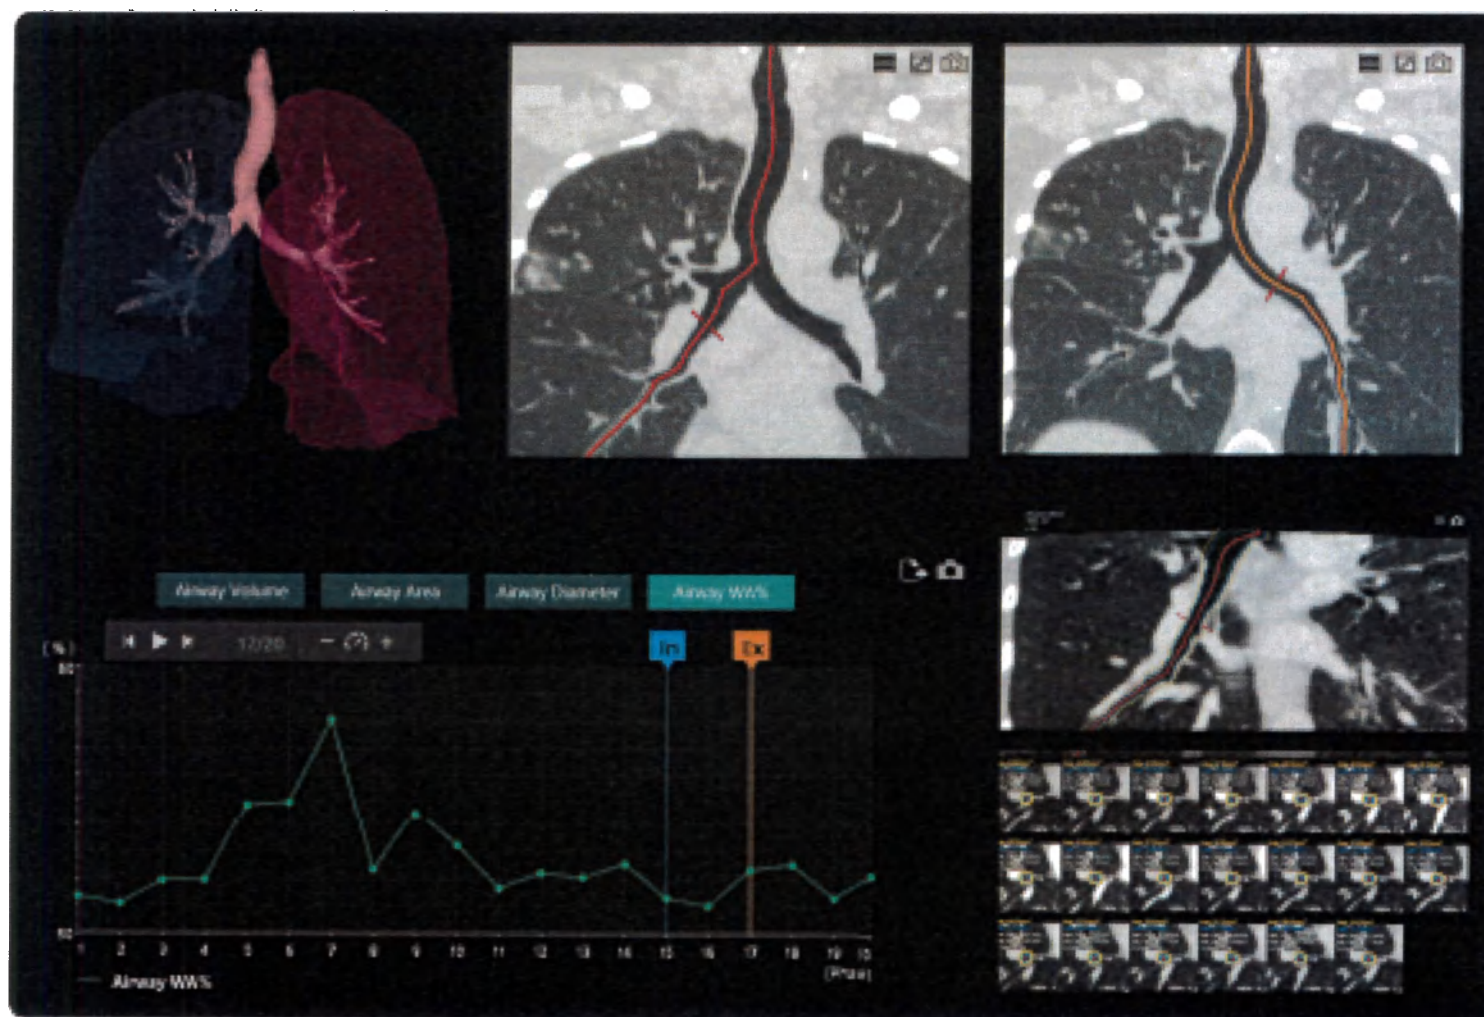




- программное обеспечение для двухмерного и трехмерного анализа плотности костной ткани.

103

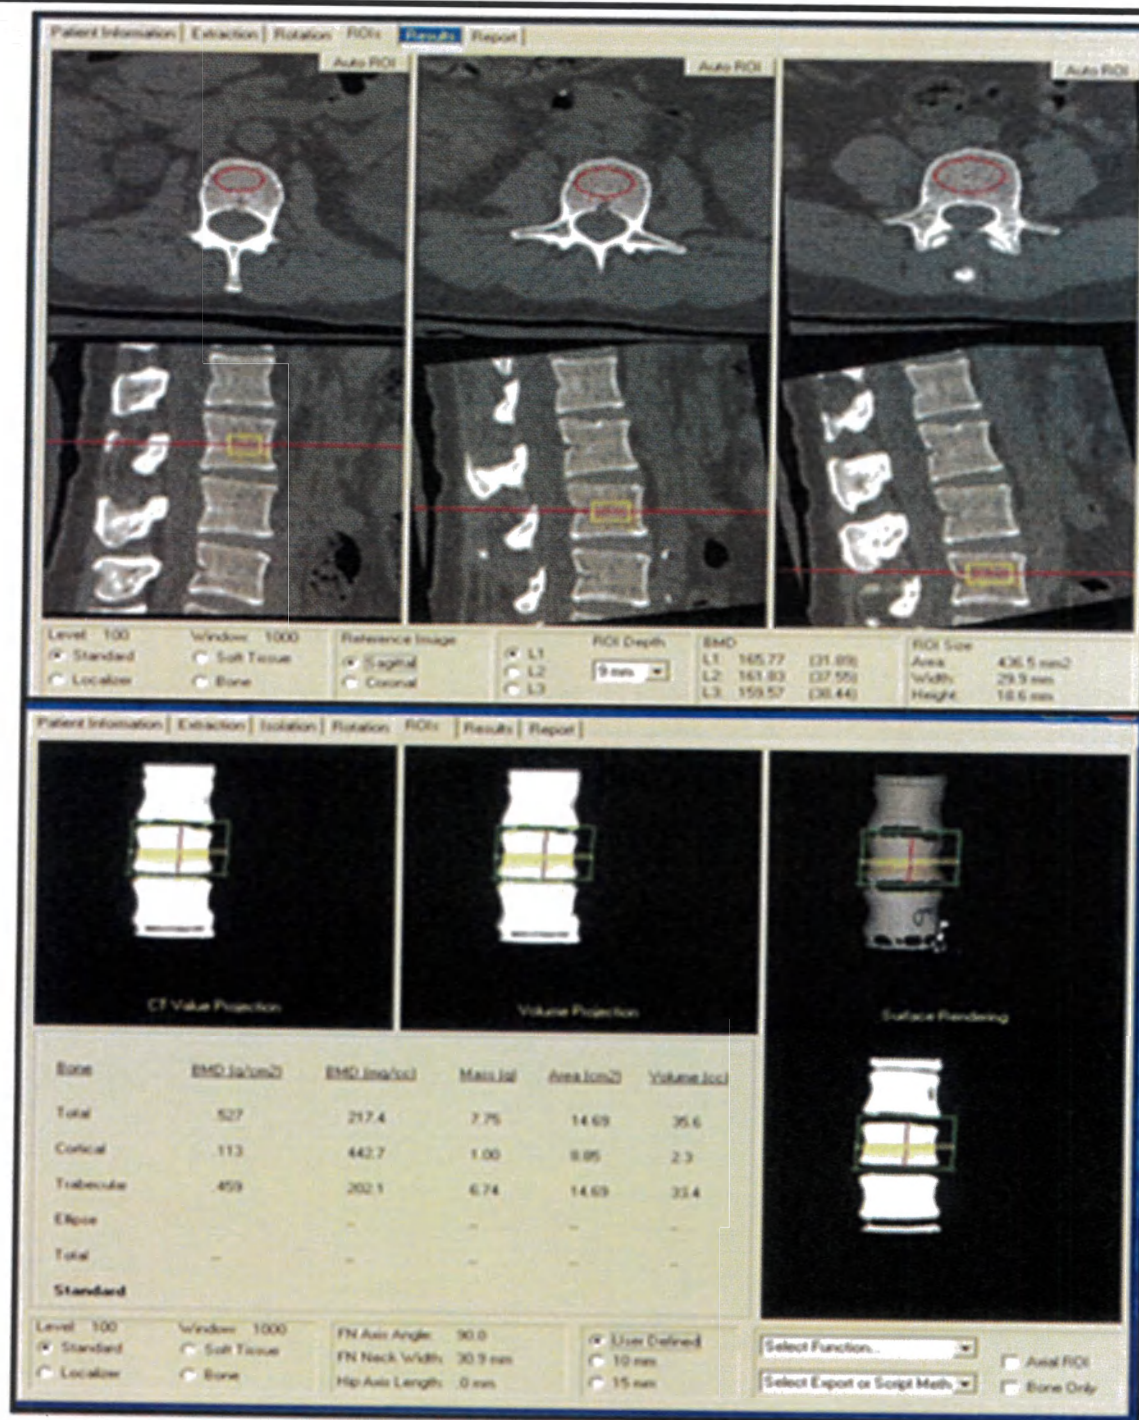

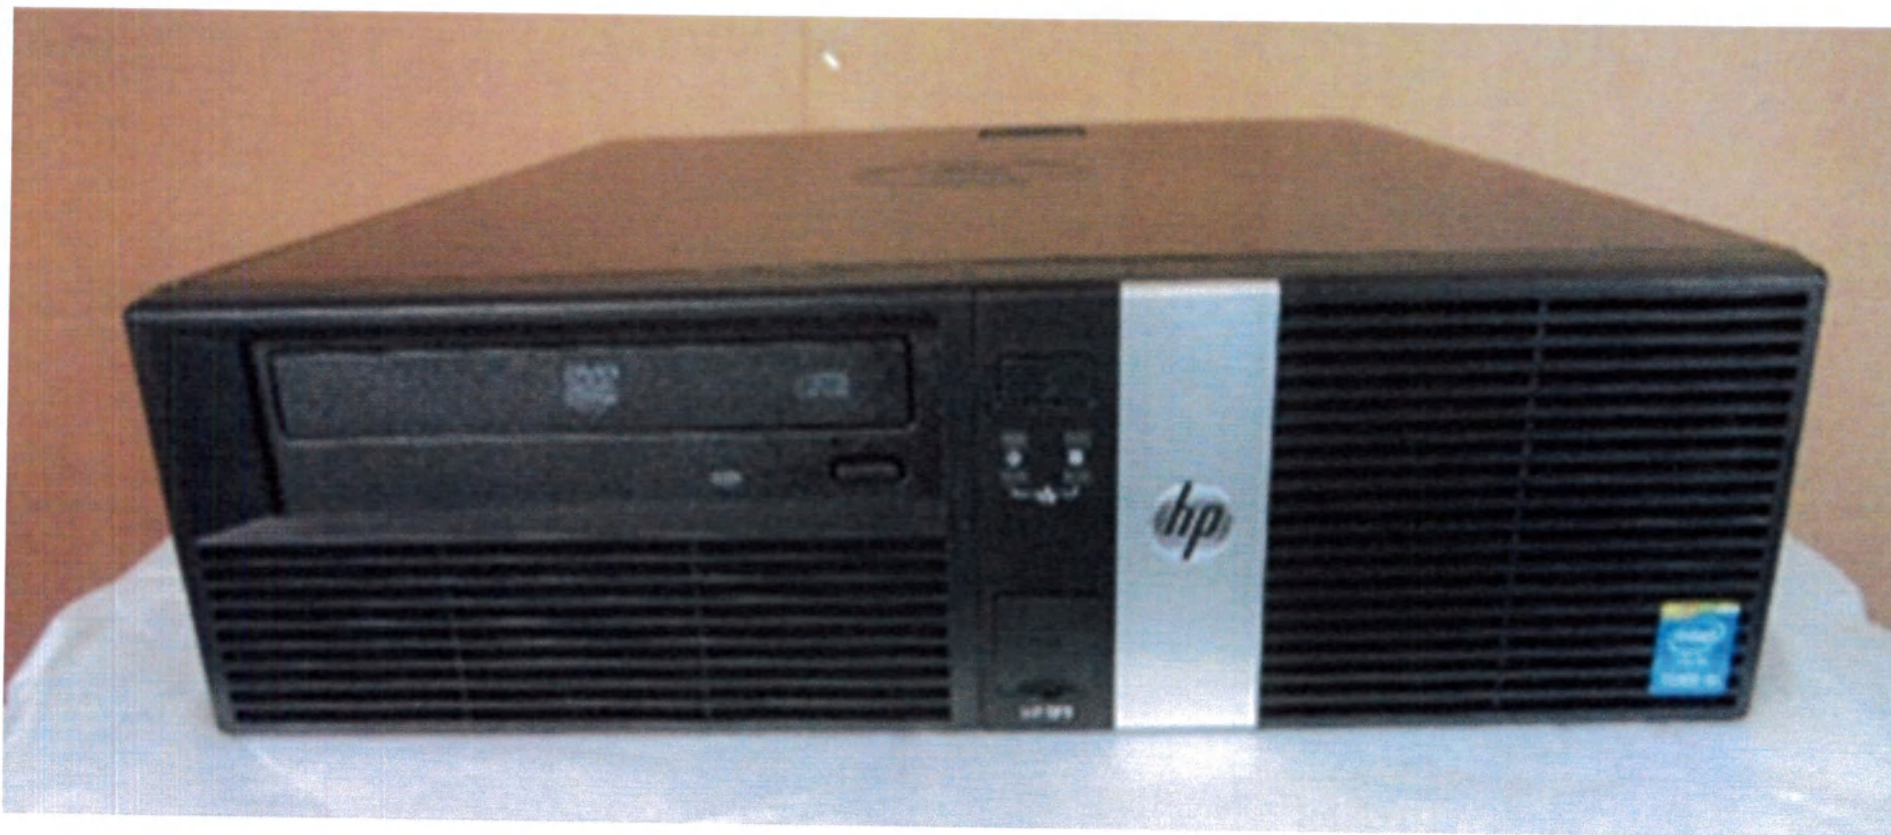

- жидкокристаллический монитор.





- мышь компьютерная.

101




- специализированный фантом для калибровки системы и укладки пациента, не более 2 шт.

100



- специализированный фантом для калибровки системы и укладки пациента, не более 2 шт.

109

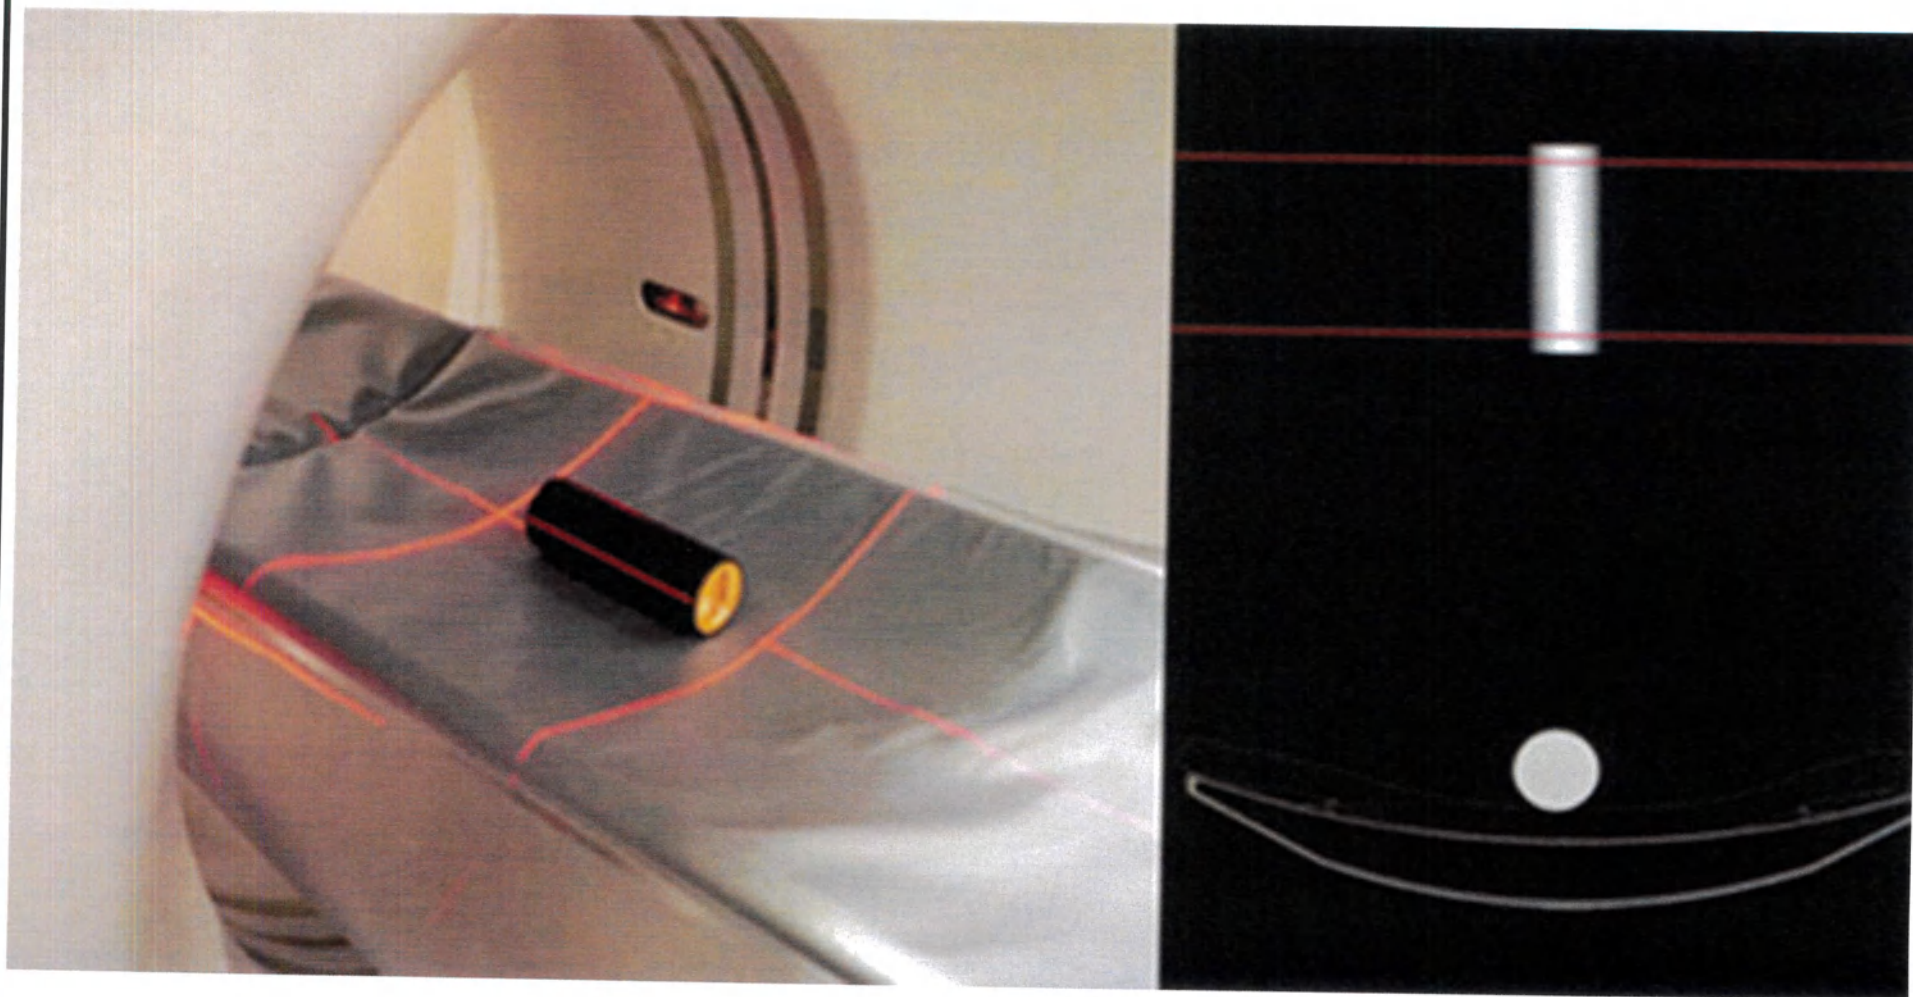

84. Модуль модернизации консоли



84. Модуль модернизации консоли



84. Модуль модернизации консоли





Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 163 листов
Подпись _____

Подпись

