


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
ООО «НПО «Диагностические системы»



«20» 01 2022 г. О.Н. Шлюндин

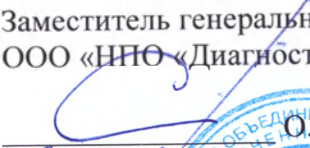


Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

**«Набор реагентов
для выявления спектра антител классов G, M, A
к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19)
методом иммуноферментного анализа»
(«ДС-ИФА-АНТИ-SARS-CoV-2-СПЕКТР»)**

Серия 243004 общий вид

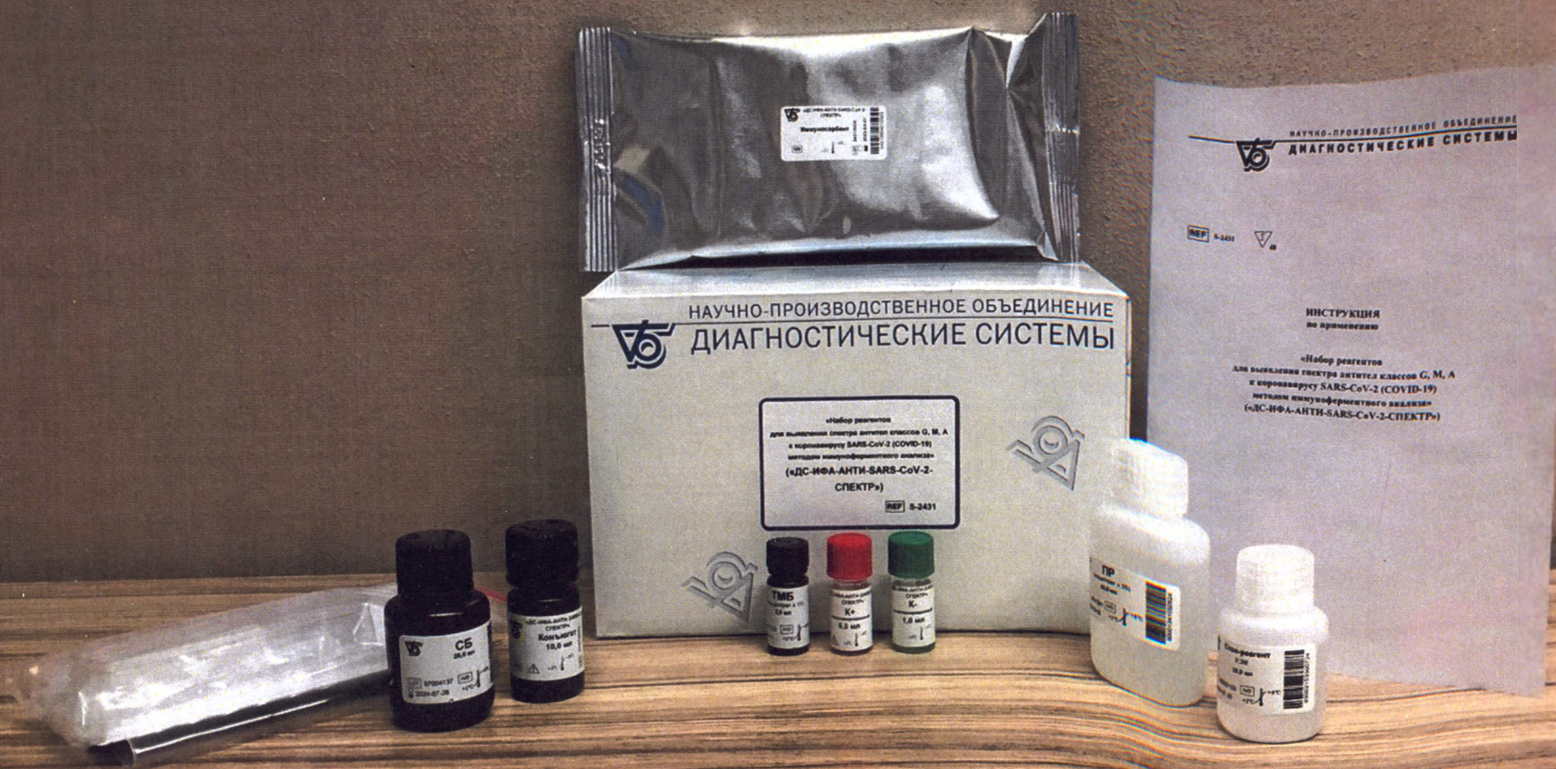

Серия 243004 общий вид

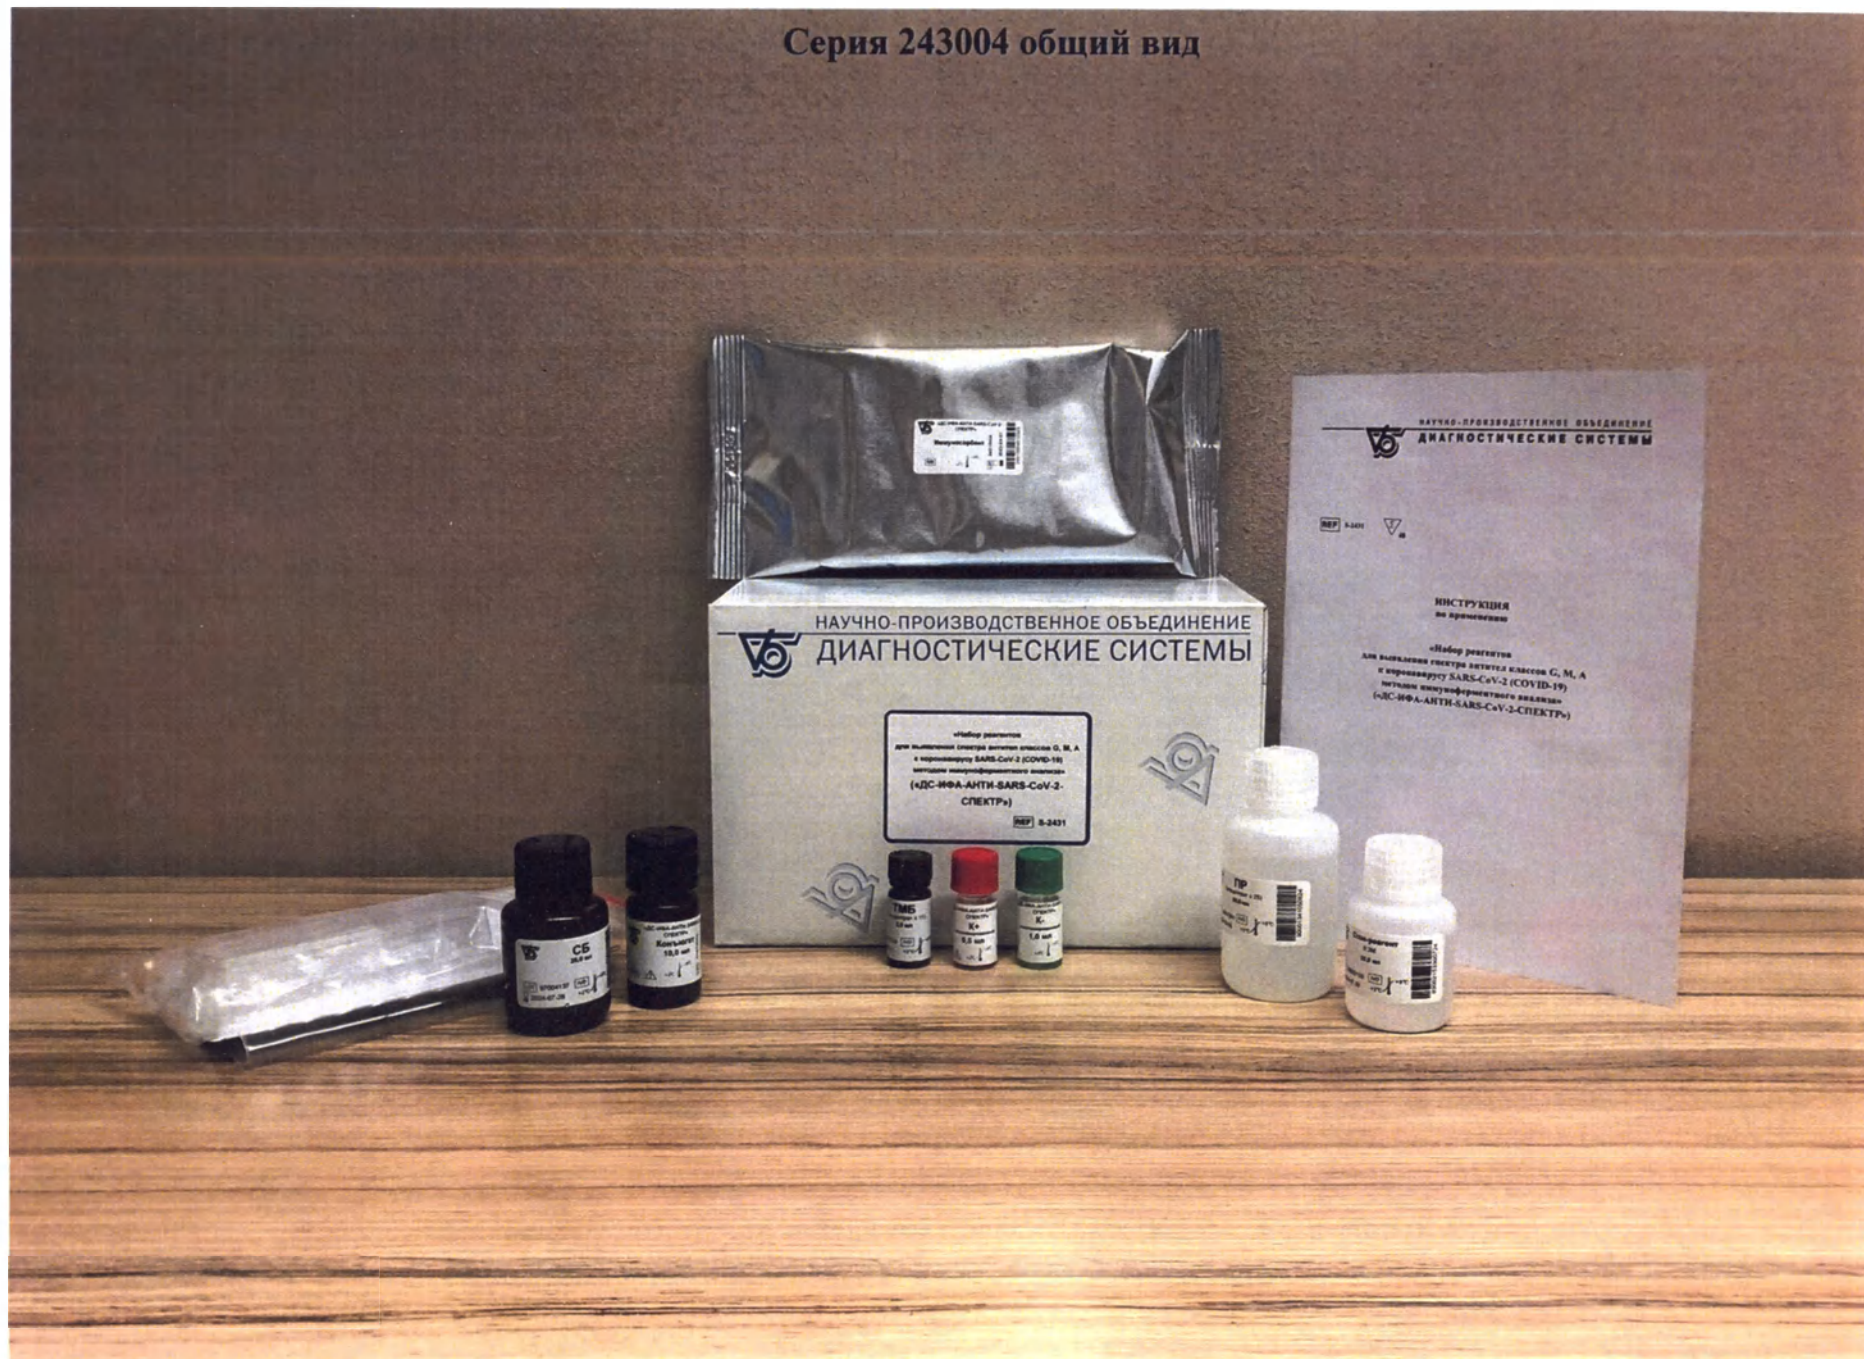

Серия 243004 вид сбоку
(состав набора)


«Для профессионального применения». «Не стерильно». «Реагенты изделия, содержащие в своем составе материалы человеческого происхождения, инактивированы. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют».

Состав набора			
1	Иммуносорбент	1 планшет	
2	Конъюгат	1 фл.	10,0 мл
3	K+, инактивированный	1 фл.	0,5 мл
4	K-, инактивированный	1 фл.	1,0 мл
5	ПР	1 фл.	60,0 мл
6	Стоп-реагент	1 фл.	25,0 мл
7	СБ	1 фл.	25,0 мл
8	ТМБ	1 фл.	2,5 мл
9	Плёнка защитная для ИФА-планшетов	2 шт.	
10	Наконечники одноразовые	16 шт.	
11	Ванночка пластиковая для жидких реагентов	2 шт.	
12	Пакет полиэтиленовый с замком Zip-Lock	1 шт.	
13	Инструкция по применению	1 шт.	


Серия 243004 вид сбоку
(информация о серии)



Серия 243004 вид сбоку

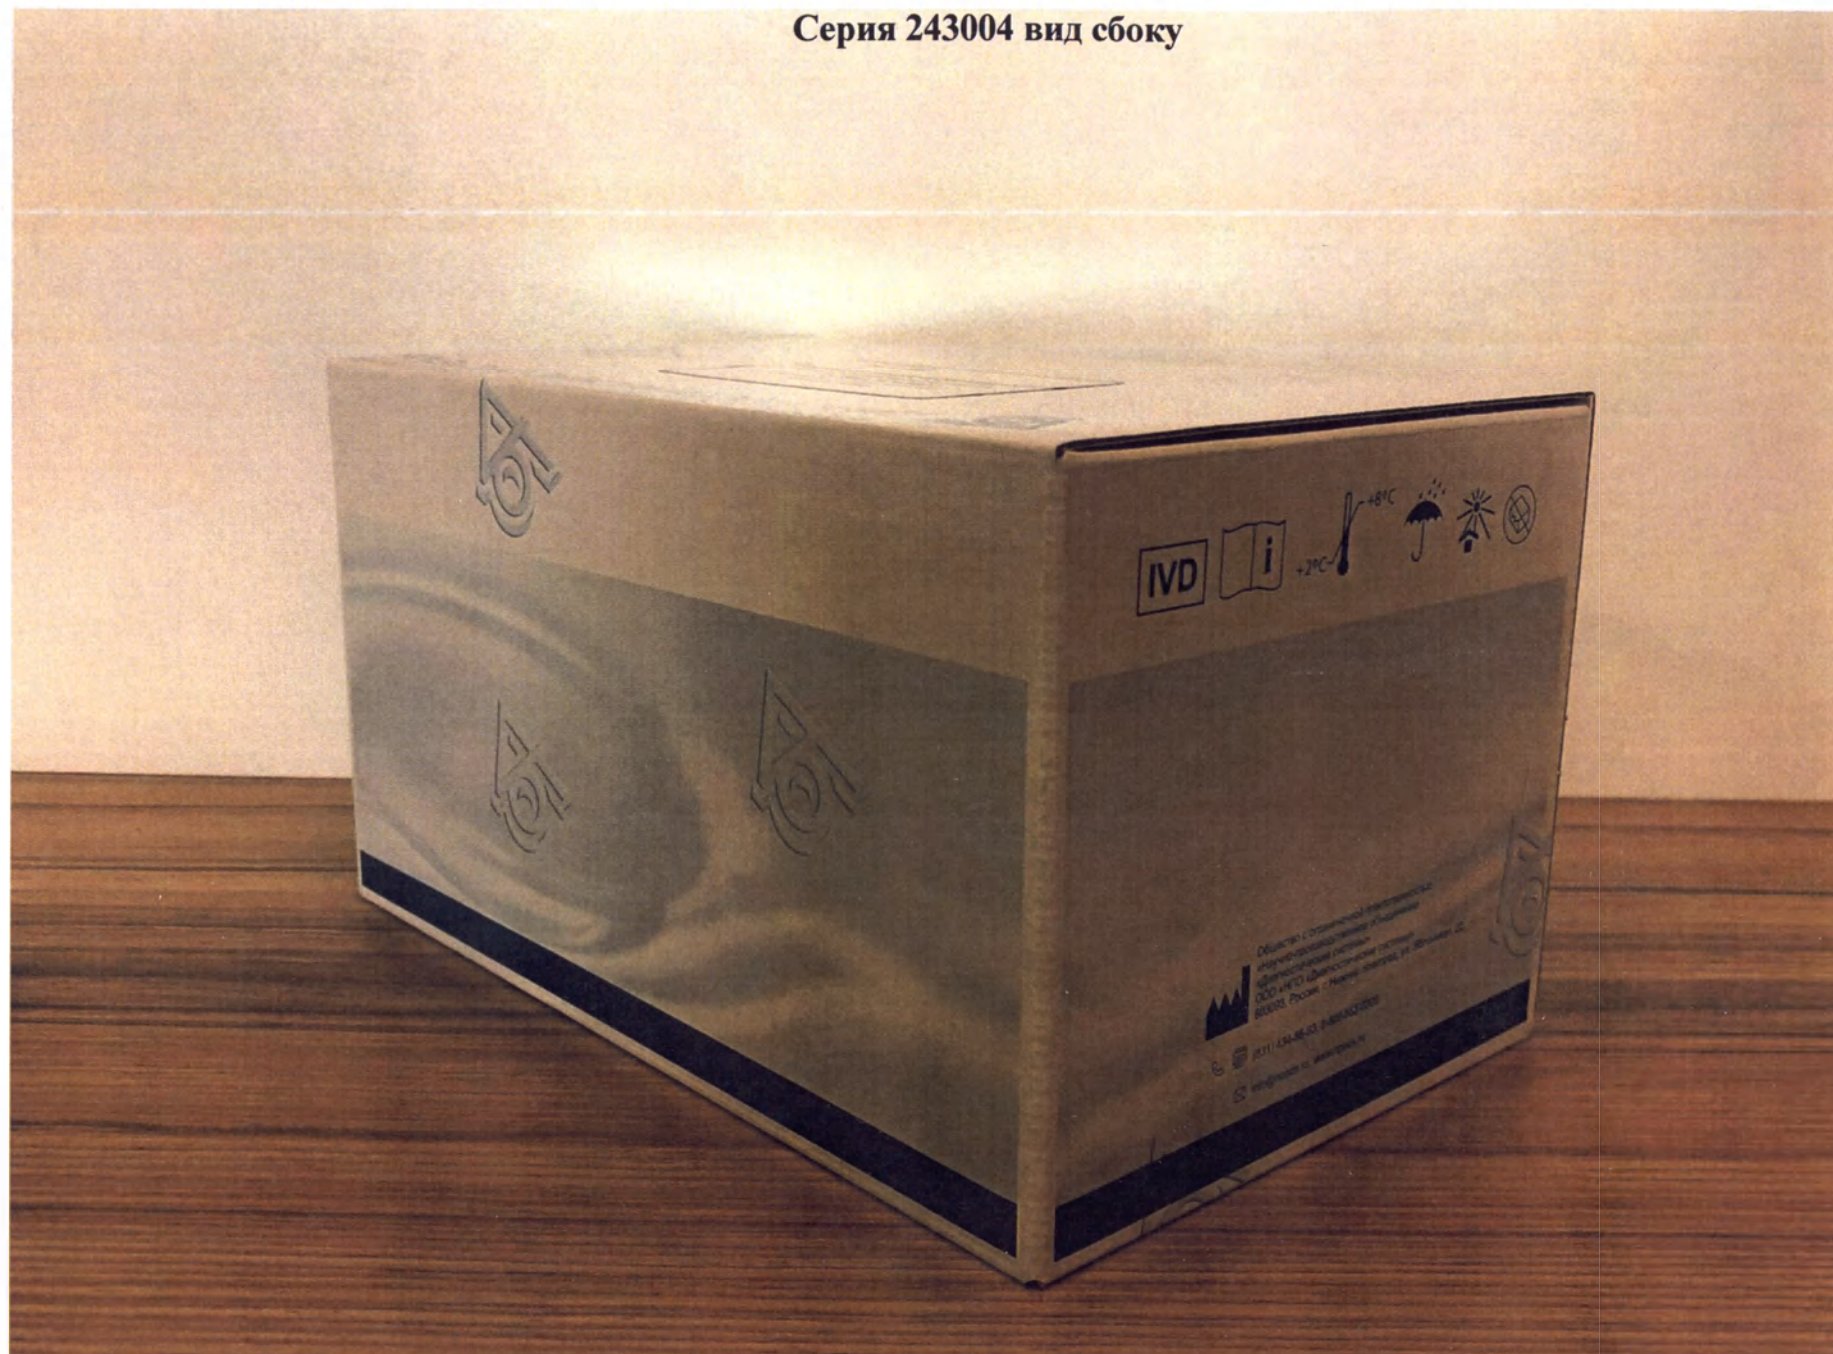

Серия 243005 общий вид

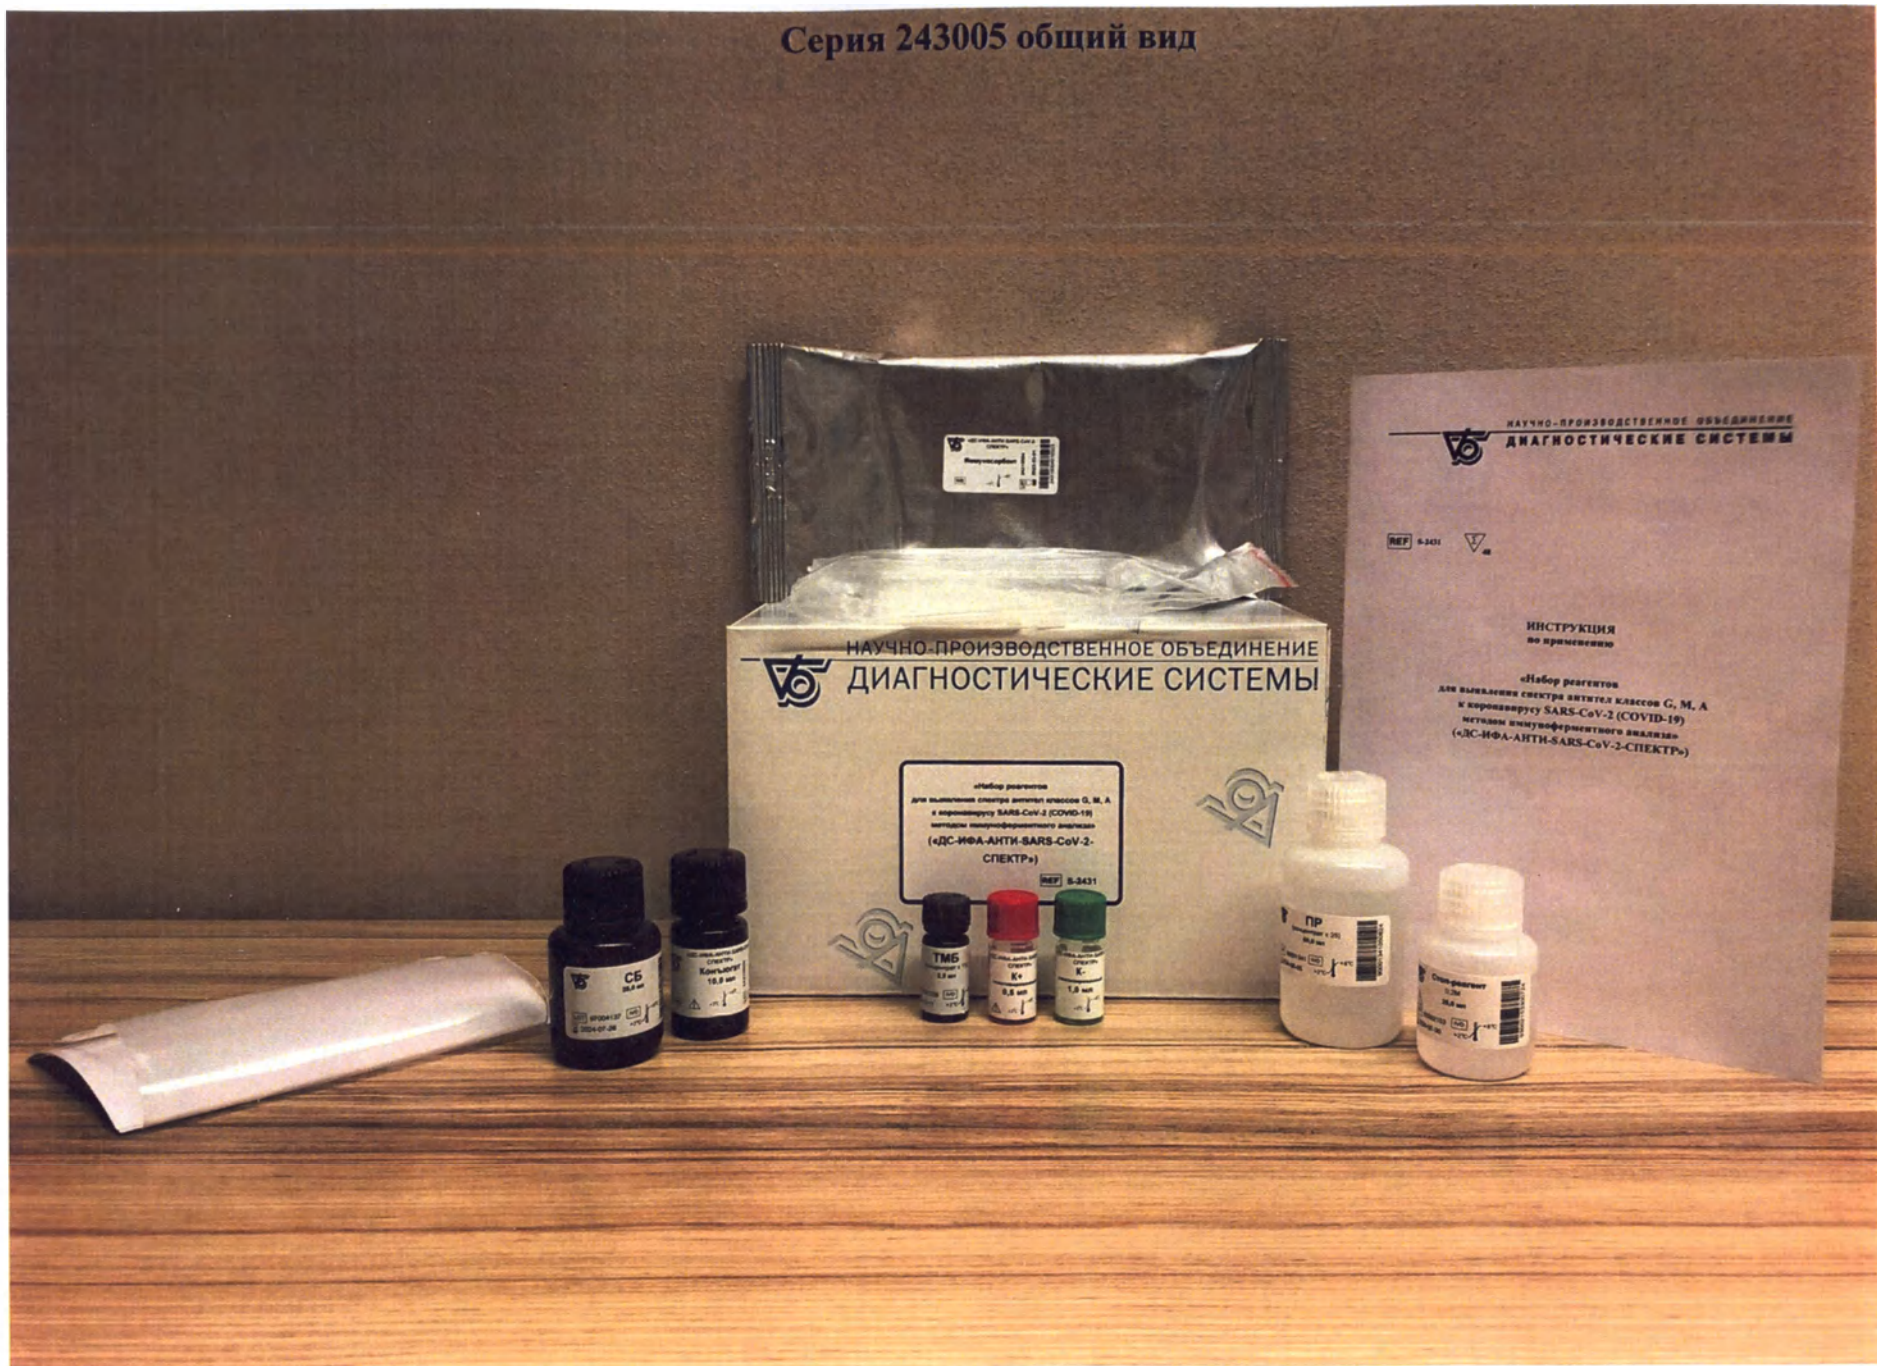

**Серия 243005 вид сбоку
(состав набора)**

«Для профессионального применения». «Не стерильно». «Реагенты изделия,
содержащие в своем составе материалы человеческого происхождения, инактивированы.
Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют».

Состав набора		Σ 48	
1	Иммуносорбент	1 планшет	
2	Конъюгат	1 фл.	10,0 мл
3	К+, инактивированный	1 фл.	0,5 мл
4	К-, инактивированный	1 фл.	1,0 мл
5	ПР	1 фл.	50,0 мл
6	Стоп-реагент	1 фл.	25,0 мл
7	СБ	1 фл.	25,0 мл
8	ТМБ	1 фл.	2,5 мл
9	Плѐнка защитная для ИФА-плашетов	2 шт.	
10	Наконечники одноразовые	16 шт.	
11	Ванночка пластиковая для жидких реагентов	2 шт.	
12	Пакет полиэтиленовый с замком Zip-Lock	1 шт.	
13	Инструкция по применению	1 шт.	

Серия 243005 вид сбоку
(информация о серии)



Серия 243005 вид сбоку





Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью

9 (девять) листов(а)
цифрами прописью

Заместитель генерального
директора

Шлюндин О.Н.
личная подпись