

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия вместе с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению

Анализатор автоматический глюкозы и лактата серии SUPER GL с принадлежностями:

Вариант исполнения:

Анализатор автоматический глюкозы и лактата SUPER GL

Принадлежности:

1. Сетевой кабель (Power connection cable) – 1 шт.
2. Адаптер электропитания анализатора и термопринтера (AC Adapter) – 1 шт.
3. Термопринтер (Thermal Printer) – 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации термопринтера на компакт-диске (Thermal Printer User's Guide) – при необходимости.
5. Дополнительный адаптер термопринтера (Power supply adapter for printer) – при необходимости.
6. Кабель термопринтера (Printer cable) – 1 шт.
7. Термобумага (Print-out paper) – не более 2 шт.
8. Руководство по эксплуатации анализатора (Operating Manual) – 1 шт.



Анализатор автоматический глюкозы и лактата SUPER GL



кабель (Power connection cable)

Анализатор автомобильных глюкоз и локатора серии SUPER GL
с принадлежностями:
ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ:
Анализатор автомобильных глюкоз и локатора
серии SUPER GL
ру № ФСЗ 2012/11951 от
Сертификат (Power connection cable)
Апр. 011168000100

История: АО
Серия
Хранить при температуре: -10°C до +50°C
Проектирование: "Др. Мастер Гроупс Радх", Германия
Dr. Müller GmbH, Burgstr. 13, D-01170, Freital, Germany
Место производства: АО "ИПАКОМ", 142200, Россия, Московская
область, с. Пущино, ул. Грозная, д. 18
Учредитель: АО "ИПАКОМ", 142200, Московская область, с. Пущино, ул.
Грозная, д. 18, тел. (485) 980-63-38, 980-63-39,
info@ipacom.ru



Анализатор автоматический глюкозы и лактата серии SUPER GL
с принадлежностями:
вариант исполнения:
Анализатор автоматический глюкозы и лактата
SUPER GL
РУ № ФСЗ 2012/11951 от _____
Адаптер электропитания анализатора и термопринтера
(AC Adapter)
Арт. 055200700400

Использовать до
Серия
Хранить при температуре: -10°C до +50°C
Производитель: "Др. Мюллер Герätebau ГмбХ", Германия,
Dr. Muller Geratebau GmbH, Burgker Str. 133, D-01705, Freital, Germany
Место производства: АО "ДИАКОН-ДС", 142290, Россия, Московская
область, г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а.
Уполномоченный представитель в РФ:
АО "ДИАКОН", Россия, 142290, Московская область, г. Пущино, ул.
Грузовая, д. 1а. тел. (495) 960-63-38, 980-63-39,
sales@diakonlab.ru



adapter for printer)



Анализатор автоматический глюкозы и лактата серии SUPER GL
с принадлежностями:
вариант исполнения:
Анализатор автоматический глюкозы и лактата
SUPER GL
ру № ФСЗ 2012/11951 от _____
Дополнительный адаптер термопринтера (Power supply
adapter for printer)
Art. 054070200000

Использовать до _____
Серия _____
Хранить при температуре: -10°C до +50°C
Производитель: "Др. Мюллер Gerätebau ГмбХ", Германия,
Dr. Müller Gerätebau GmbH, Bunker Str. 133, D-01705, Freital, Germany
Место производства: АО "ДИАКОН-ДС", 142290, Россия, Московская
область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.1а.
Уполномоченный представитель в РФ:
АО "ДИАКОН", Россия, 142290, Московская область, г. Пушкино, ул.
Грузовая, д. 1а, тел. (495) 980-63-38, 980-63-39,
sales@diakonlab.ru

Анализатор автоматический глюкозы и лактата серии SUPER GL
с принадлежностями:
вариант исполнения:
Анализатор автоматический глюкозы и лактата
SUPER GL
ру № ФСЗ 2012/11951 от _____
Кабель термопринтера (Printer cable)
Арт. 0240 905 000 00E

Использовать до _____
Серия _____
Хранить при температуре: -10°C до +50°C
Производитель: "Др. Мюллер Gerätebau GmbH", Германия,
Dr. Müller Gerätebau GmbH, Burgker Str. 133, D-01705, Freital, Germany
Место производства: АО "ДИАКОН-ДС", 142290, Россия, Московская
область, г. Пущино, ул. Грузовая, д.1а.
Уполномоченный представитель в РФ:
АО "ДИАКОН", Россия, 142290, Московская область, г. Пущино, ул.
Грузовая, д.1а: тел. (495)980-63-38, 980-63-39,
sale@diakontab.ru

а (Print-out paper)

Анализатор автоматический глюкозы и лактата серии SUPER GL
с принадлежностями:
вариант исполнения:
Анализатор автоматический глюкозы и лактата
SUPER GL
РУ № ФСЗ 2012/11951 от _____
Термобумага (Print-out paper)
Арт. 0240 980 001 00

Использовать до _____
Серия _____
Хранить при температуре: -10°C до +50°C
Производитель: "Др. Мюллер Gerätebau GmbH", Германия,
Dr. Müller Gerätebau GmbH, Burgker Str. 133, D-01705, Freital, Germany
Место производства: АО "ДИАКОН-ДС", 142290, Россия, Московская
область, г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а.
Уполномоченный представитель в РФ:
АО "ДИАКОН", Россия, 142290, Московская область, г. Пущино, ул.
Грузовая, д. 1а; тел. (495) 980-63-38, 980-63-39,
sale@diakonlab.ru



Анализатор автоматический глюкозы и лактата серии **SUPER GL** с принадлежностями, вариант исполнения:

**Анализатор автоматический глюкозы и лактата
SUPER GL**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




РУ № ФСЗ 2012/11951 от _____

Версия 2.0

Дата утверждения _____

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 11

Генеральный директор
АО «ДИАКОН»

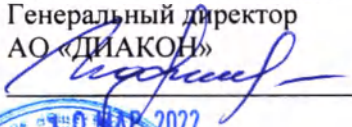
И.Е. Карпова



КОПИЯ
ВЕРНА


«УТВЕРЖДАЮ»

ДИАКОН

10 МАР 2022

Генеральный директор
«Dr. Muller Geratebau GmbH»,
Германия

ГЕН. ДИРЕКТОР
АО «ДИАКОН»
КАРЛОВА Н.Е.



Burgker Str. 133
01705 Freital
Tel.: 0351 / 645042
Fax: 0351/6491504

Маттиас Хартвиг

МП

Geratebau GmbH Internet: www.dr-mueller-geratebau.de

«28» 02 2022 г.

МАРКИРОВКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Анализатор автоматический глюкозы и лактата серии SUPER GL
с принадлежностями:**

Вариант исполнения:

Анализатор автоматический глюкозы и лактата SUPER GL

2022

1. Маркировка анализатора

Анализатор автоматический глюкозы и лактата серии SUPER GL с принадлежностями:

Вариант исполнения:

Анализатор автоматический глюкозы и лактата SUPER GL

Образец маркировки, расположенной на корпусе анализатора

Анализатор автоматический глюкозы и лактата серии SUPER GL с принадлежностями: вариант исполнения: Анализатор автоматический глюкозы и лактата SUPER GL РУ № ФСЗ 2012/11951 от 20 года		IVD
CE	SN 1880	12 В 12 Вт
   550530000000	  2021 г	Производитель: "Др. Мюллер Герätebau GmbH", Германия Dr.Muller Geratebau GmbH, Burgker Str. 133, D-01705, Freital, Germany Место производства: АО "ДИАКОН-ДС", 142290, Россия, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д.1а. Уполномоченный представитель в РФ: АО "ДИАКОН", Россия, 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д.1а. тел.(495)980-63-38, 980-63-39, sale@diakonlab.ru
Хранить при температуре: -10°C до +50°C		

Список символов на приборе и используемых материалах

Символ	Значение
	Биологическая опасность
IVD	Медицинское изделие для диагностики <i>in vitro</i>
CE	Наличие сертификата CE
	Обратите внимание!
	Следуйте указаниям руководства по эксплуатации
	Изготовлено из материала, который может быть подвергнут вторичной переработке
	Уничтожать в соответствии с установленными правилами
	Температура хранения
REF	Каталожный номер
LOT	Номер лота (серии)
	Срок годности
	Производитель
SN	Серийный номер прибора

2. Маркировка транспортной тары

В качестве упаковки анализатора используется коробка из жесткого картона с уплотнителем по форме корпуса прибора. Сам анализатор зафиксирован в форме из ударопрочного пористого пенополистирола (EPS).

Принадлежности, находящиеся в составе анализатора, упакованы в полиэтиленовые пакеты с zip-замком, которые помещены в специальные секции в уплотнителе анализатора. В коробку, вместе с анализатором, укладывается эксплуатационная документация: Руководство по эксплуатации, паспорт ОТК, гарантийный талон (упакованы в полиэтиленовые пакеты).

На коробке типографским способом или на наклейках (этикетках) нанесена следующая информация: графические символы «Беречь от влаги», «Хрупкое, обращаться осторожно», «Ограничение температуры», «Верх», согласно ГОСТ 14192.

Упаковка анализатора является противоударной, обеспечивающей его надёжную транспортировку по воздуху, железной дороге и морским транспортом, однако необходимо беречь её от дождя и снега, переворачивания и падения.

Надписи на транспортной упаковке

			
Хрупкое. Осторожно	Верх	Беречь от влаги	Ограничение температуры

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 3
Генеральный директор
АО «ДИАКОН»

И.Е. Карпова

10 MAR 2022





кабель (Power connection cable)



Анализатор автоматический глюкозы и лактата серии SUPER GL
с принадлежностями:
вариант исполнения:
Анализатор автоматический глюкозы и лактата
SUPER GL compact
ПУ № ФСЗ 2012/11951 от _____
Адаптер электропитания анализатора и термопринтера
(AC Adapter)
Арт. 055200700400

Использовать до
Серия

Хранить при температуре: -10°C до +50°C

Производитель: "Др. Мюллер Герätebau ГмбХ", Германия,
Dr. Muller Geratebau GmbH, Burgker Str. 133, D-01705, Freital, Germany

Место производства: АО "ДИАКОН-ДС", 142290, Россия, Московская
область, г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а.

Уполномоченный представитель в РФ:
АО "ДИАКОН", Россия, 142290, Московская область, г. Пущино, ул.
Грузовая, д. 1а, тел. (495) 980-63-38, 980-63-39,
sales@diakonlab.ru



Анализатор автоматический глюкозы и лактата серии SUPER GL
с принадлежностями:
вариант исполнения:
Анализатор автоматический глюкозы, лактата и гемоглобина
SUPER GL compact
ПУ № ФСЗ 2012/11951 от _____
Арматура блока контейнерное (Set Container Adapter)
Арт. 055097400000

Использовать до _____
Серия _____
Хранить при температуре: -10°C до +50°C
Производитель: "Др. Мюллер Гертебау ГмбХ", Германия
Dr. Muller Geratebau GmbH, Burgker Str. 133, D-01705, Freital, Germany
Место производства: АО "ДИАКОН-ДС", 142290, Россия, Московская
область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1а.
Уполномоченный представитель в РФ:
АО "ДИАКОН", Россия, 142290, Московская область, г. Пушкино, ул.
Грузовая, д. 1а, тел. (495) 980-63-38, 980-63-39,
sale@diakontab.ru

globin)

REF 0550 962 000

Sensor Hemoglobin

LOT 210323-1

2031-03-31



Анализатор автоматический глюкозы и лактата серии SUPER GL
с принадлежностями:
вариант исполнения:
Анализатор автоматический глюкозы, лактата и гемоглобина
SUPER GL compact
РУ № ФСЗ 2012/11951 от _____
Сенсор для определения гемоглобина (Sensor Hemoglobin)
Art. 550550962000

Использовать до
Серия

Хранить при температуре: +2°C до +8°C

Производитель: "Др. Мюллер Gerätebau GmbH", Германия,
Dr. Muller Gerätebau GmbH, Burgker Str. 133, D-01705, Freital, Germany

Место производства: АО "ДИАКОН-ДС", 142290, Россия, Московская
область, с. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а.

Уполномоченный представитель в РФ:
АО "ДИАКОН", Россия, 142290, Московская область, с. Пущино, ул.
Грузовая, д. 1а, тел. (495) 960-63-38, 960-63-39,
sale@diakonlab.ru

Анализатор автоматический глюкозы и лактата серии SUPER GL
с принадлежностями:
вариант исполнения:
Анализатор автоматический глюкозы, лактата и гемоглобина
SUPER GL compact
РУ № ФСЗ 2012/11951 от _____
Каретка (Slider)
Арт. 054000000900

Использовать до _____
Серия _____
Хранить при температуре: -10°C до +50°C
Производитель: "Др. Мюллер Gerätebau ГмбХ", Германия,
Dr. Müller Gerätebau GmbH, Burgker Str. 133, D-01705, Freital, Germany
Место производства: АО "ДИАКОН-ДС", 142290, Россия, Московская
область, с. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а.
Уполномоченный представитель в РФ:
АО "ДИАКОН", Россия, 142290, Московская область, с. Пущино, ул.
Грузовая, д. 1а, тел. (495) 980-63-38, 980-63-39,
sale@diakonlab.ru

FRONT

Only for prediluted cups
with 1000/500µl
Haemolysis-System-Solution
and 20/10µl-capillaries

Dilution: 50 + 1

Анализатор автоматический глюкозы и лактата серии SUPER GL
с принадлежностями:
вариант исполнения:

Анализатор автоматический глюкозы, лактата и гемоглобина
SUPER GL compact
РУ № ФСЗ 2012/11951 от _____

Операционная карта (Operation Card)
Art. 550550970005

Использовать до
Серия


Хранить при температуре: -10°C до +50°C


Производитель: "Др. Мюллер Герztebau ГмбХ", Германия,
Dr. Müller Gerätebau GmbH, Burgker Str. 133, D-01705, Freital, Germany

Место производства: АО "ДИАКОН-ДС", 142290, Россия, Московская
область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.1а.

Уполномоченный представитель в РФ:

АО "ДИАКОН", Россия, 142290, Московская область, г. Пушкино, ул.
Грузовая, д.1а, тел (495)980-63-38, 980-63-39,
sale@diakonlab.ru

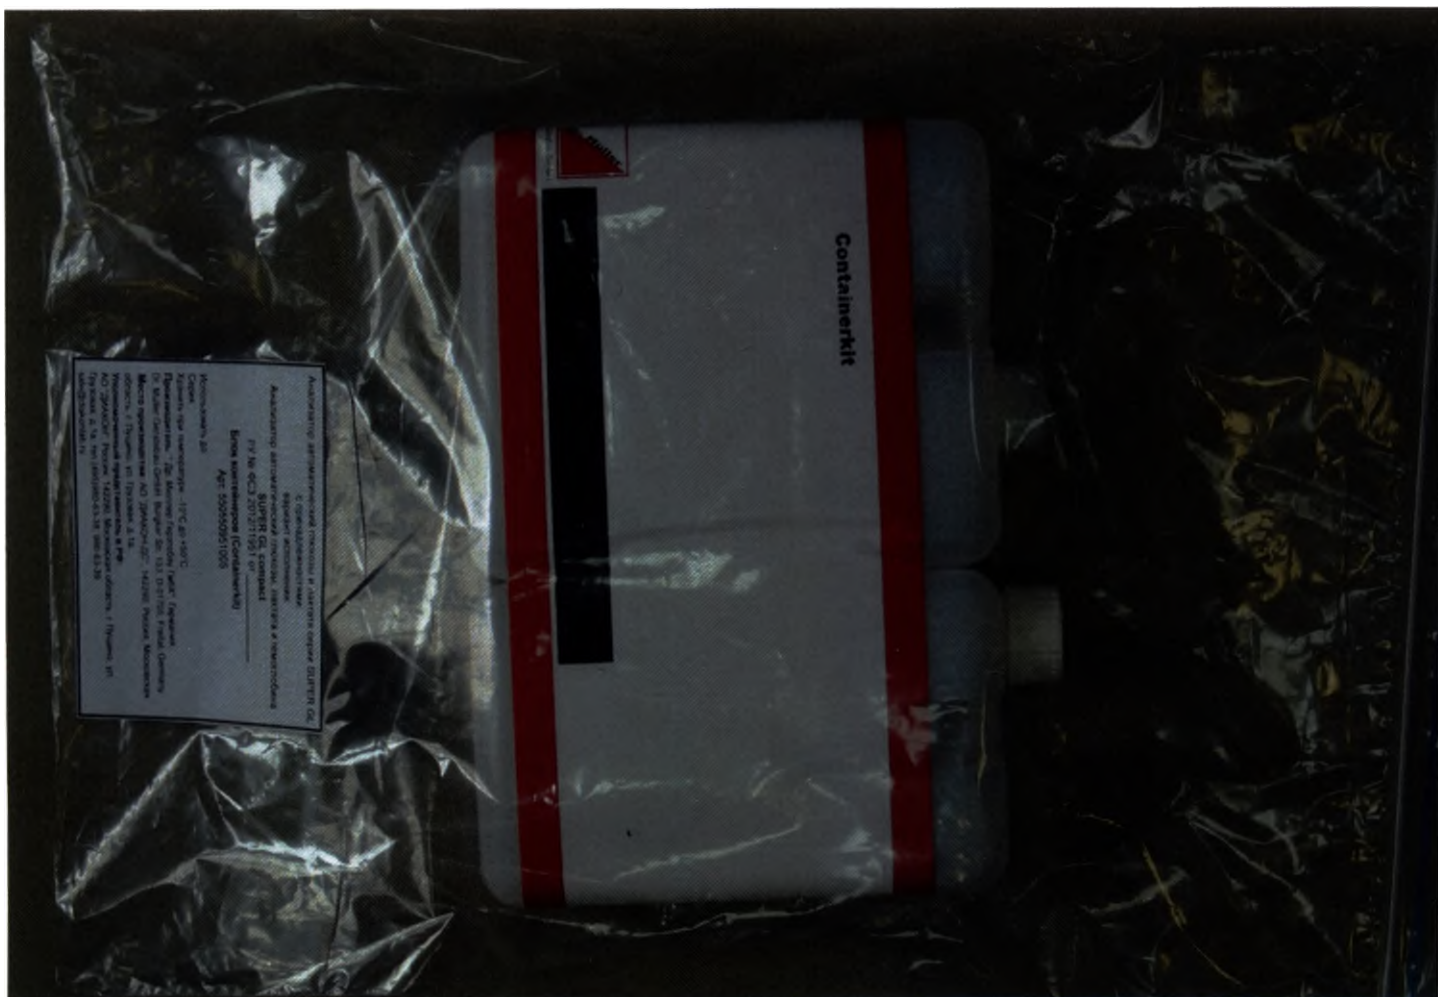

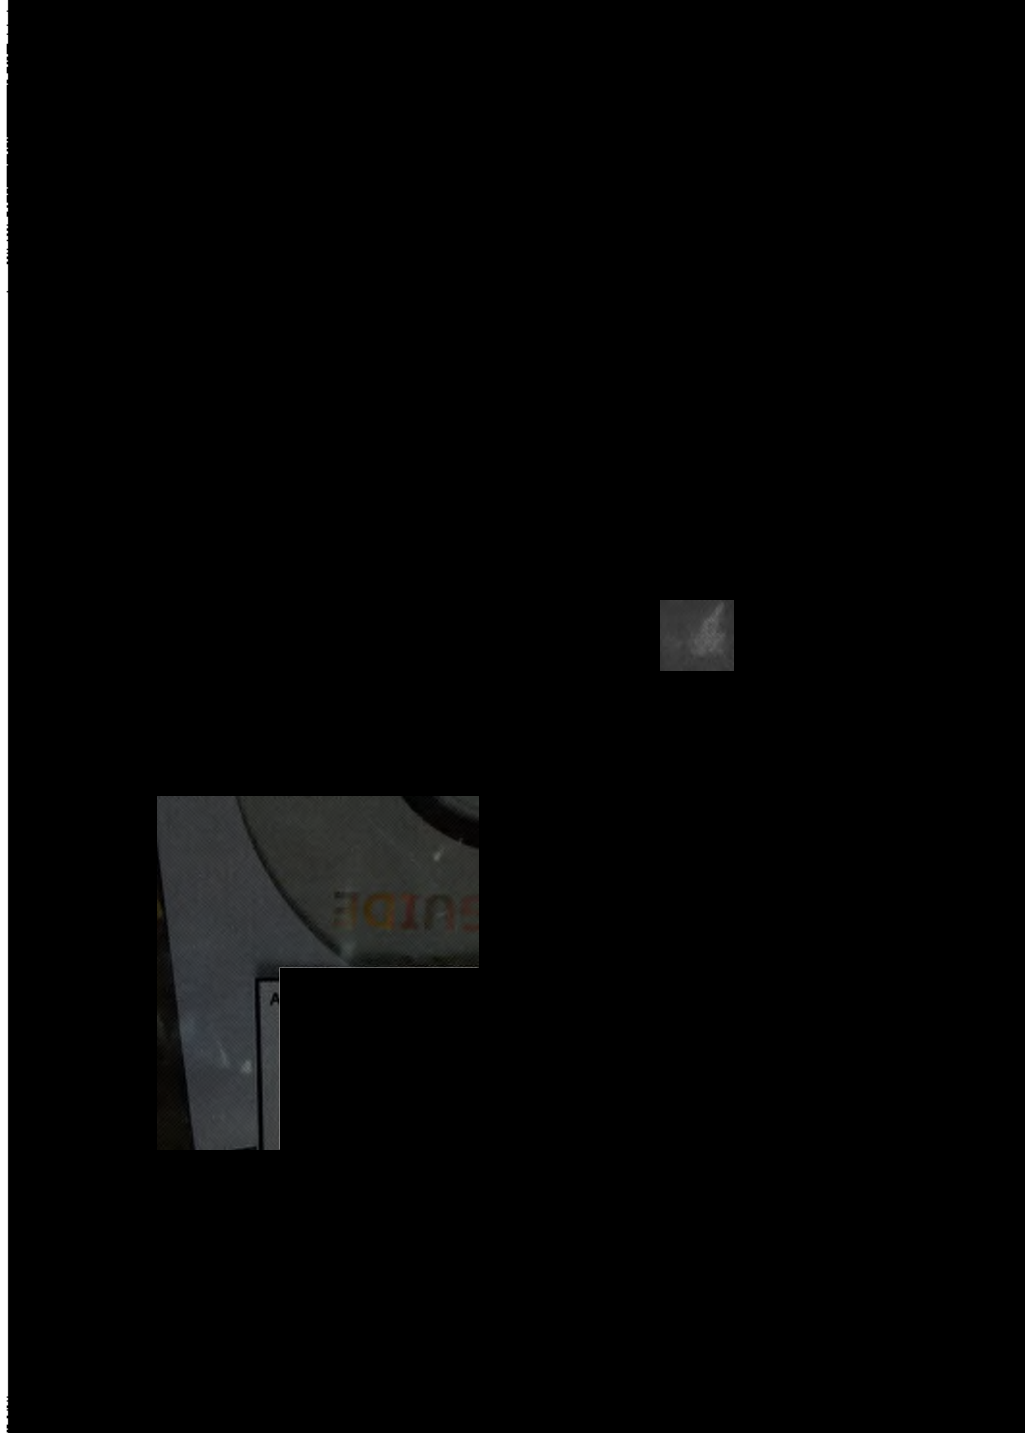

Анализатор автоматический глюкозы и лактата серии SUPER GL
с принадлежностями:
вариант исполнения:
Анализатор автоматический глюкозы, лактата и гемоглобина
SUPER GL compact
РУ № ФСЗ 2012/11951 от _____
Дополнительный адаптер термопритера (Power supply
adapter for printer)
Арт. 054070200000

Использовать до _____

Серия _____

Хранить при температуре: -10°C до +50°C

Производитель: "Др. Мюллер Gerätebau GmbH", Германия,
Dr. Müller Gerätebau GmbH, Burgker Str. 133, D-01705, Freital, Germany

Место производства: АО "ДИАКОН-ДС", 142290, Россия, Московская
область, г. Пущино, ул. Грузовая, д.1а.

Уполномоченный представитель в РФ:

АО "ДИАКОН", Россия, 142290, Московская область, г. Пущино, ул.
Грузовая, д.1а, тел.(495)980-63-38, 980-63-39,
sale@diakonlab.ru

Анализатор автоматический глюкозы и лактата серии SUPER GL
с принадлежностями:
вариант исполнения:

Анализатор автоматический глюкозы, лактата и гемоглобина
SUPER GL compact
РУ № ФСЗ 2012/11951 от _____

Кабель термопринтера (Printer cable)
Арт. 0240 905 000 00E

Использовать до _____

Серия _____

Хранить при температуре: -10°C до +50°C

Производитель: "Др. Мюллер Герателбау ГмбХ", Германия

Dr. Muller Geratebau GmbH, Burgker Str. 133, D-01705, Freital, Germany

Место производства: АО "ДИАКОН-ДС", 142290, Россия, Московская
область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1а

Уполномоченный представитель в РФ:

АО "ДИАКОН", Россия, 142290, Московская область, г. Пушкино, ул.

Грузовая, д. 1а, тел. (495) 990-63-38, 990-63-39,

sale@diakonlab.ru

Анализатор автоматический глюкозы и лактата серии SUPER GL
с принадлежностями:
вариант исполнения:

Анализатор автоматический глюкозы, лактата и гемоглобина
SUPER GL compact
РУ № ФСЗ 2012/11951 от _____

Термобумага (Print-out paper)
Арт. 0240 980 001 00

Использовать до
Серия

Хранить при температуре: -10°C до +50°C

Производитель: "Др. Мюллер Герätebau ГмбХ", Германия,
Dr. Muller Geratebau GmbH, Burgker Str. 133, D-01705, Freital, Germany

Место производства: АО "ДИАКОН-ДС", 142290, Россия, Московская
область, г. Пущино, ул. Грузовая, д.1а.

Уполномоченный представитель в РФ:
АО "ДИАКОН", Россия, 142290, Московская область, г. Пущино, ул.
Грузовая, д.1а. тел.(495)980-63-38, 980-63-39,
sale@diakonlab.ru

по эксплуатации анализатора
(ual)



Анализатор автоматический глюкозы и лактата серии SUPER GL с принадлежностями, вариант исполнения:

Анализатор автоматический глюкозы, лактата и гемоглобина

SUPER GL compact

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




РУ № ФСЗ 2012/11951 от _____

Версия 2.0

Дата утверждения _____

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 16
Генеральный директор
АО «ДИАКОН»



И.Е. Карпова



КОПИЯ
ВЕРНА

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
«Dr. Muller Gerätebau GmbH».

Германия

Burgker Str. 133

01705 Freital

Tel.: 0351 / 645042

Fax: 0351/6491504

Matthias Hartwig

МП

Gerätebau GmbH Internet: www.dr-mueller-geraetebau.de

ГЕН. ДИРЕКТОР
АО «ДИАКОН»
КАРЛОВА И Е

«28» 02 2022 г.

МАРКИРОВКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Анализатор автоматический глюкозы и лактата серии SUPER GL

с принадлежностями:

Вариант исполнения:

**Анализатор автоматический глюкозы, лактата и гемоглобина
SUPER GL compact**

2022

1. Маркировка анализатора

Анализатор автоматический глюкозы и лактата серии SUPER GL с принадлежностями:

Вариант исполнения:

Анализатор автоматический глюкозы, лактата и гемоглобина SUPER GL compact

Образец маркировки, расположенной на корпусе анализатора



Список символов на приборе и используемых материалах

Символ	Значение
	Биологическая опасность
IVD	Медицинское изделие для диагностики <i>in vitro</i>
CE	Наличие сертификата CE
	Обратите внимание!
	Следуйте указаниям руководства по эксплуатации
	Изготовлено из материала, который может быть подвергнут вторичной переработке
	Уничтожать в соответствии с установленными правилами
	Температура хранения
REF	Каталожный номер
LOT	Номер лота (серии)
	Срок годности
	Производитель
SN	Серийный номер прибора

2. Маркировка транспортной тары

В качестве упаковки анализатора используется коробка из жесткого картона с уплотнителем по форме корпуса прибора. Сам анализатор зафиксирован в форме из ударопрочного пористого пенополистирола (EPS).

Принадлежности, находящиеся в составе анализатора, упакованы в полиэтиленовые пакеты с зип-замком, которые помещены в специальные секции в уплотнителе анализатора. В коробку, вместе с анализатором, укладывается эксплуатационная документация: Руководство по эксплуатации, паспорт ОТК, гарантийный талон (упакованы в полиэтиленовые пакеты).

На коробке типографским способом или на наклейках (этикетках) нанесена следующая информация: графические символы «Беречь от влаги», «Хрупкое, обращаться осторожно», «Ограничение температуры», «Верх», согласно ГОСТ 14192.

Упаковка анализатора является противоударной, обеспечивающей его надёжную транспортировку по воздуху, железной дороге и морским транспортом, однако необходимо беречь её от дождя и снега, переворачивания и падения.

Надписи на транспортной упаковке

			
Хрупкое. Осторожно	Верх	Беречь от влаги	Ограничение температуры

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 4

Генеральный директор
АО «ДИАКОН»

И.Е. Карпова

10 MAR 2022

