


Фотография

состава набора реагентов «ДС-РПГА-АНТИ-ЛЮИС»

Иммунодиагностикум эритроцитарный для выявления специфических антител к *Treponema pallidum*» комплект 1 по ТУ 9398-085-05941003-2013 производства ООО «НПО «Диагностические системы»

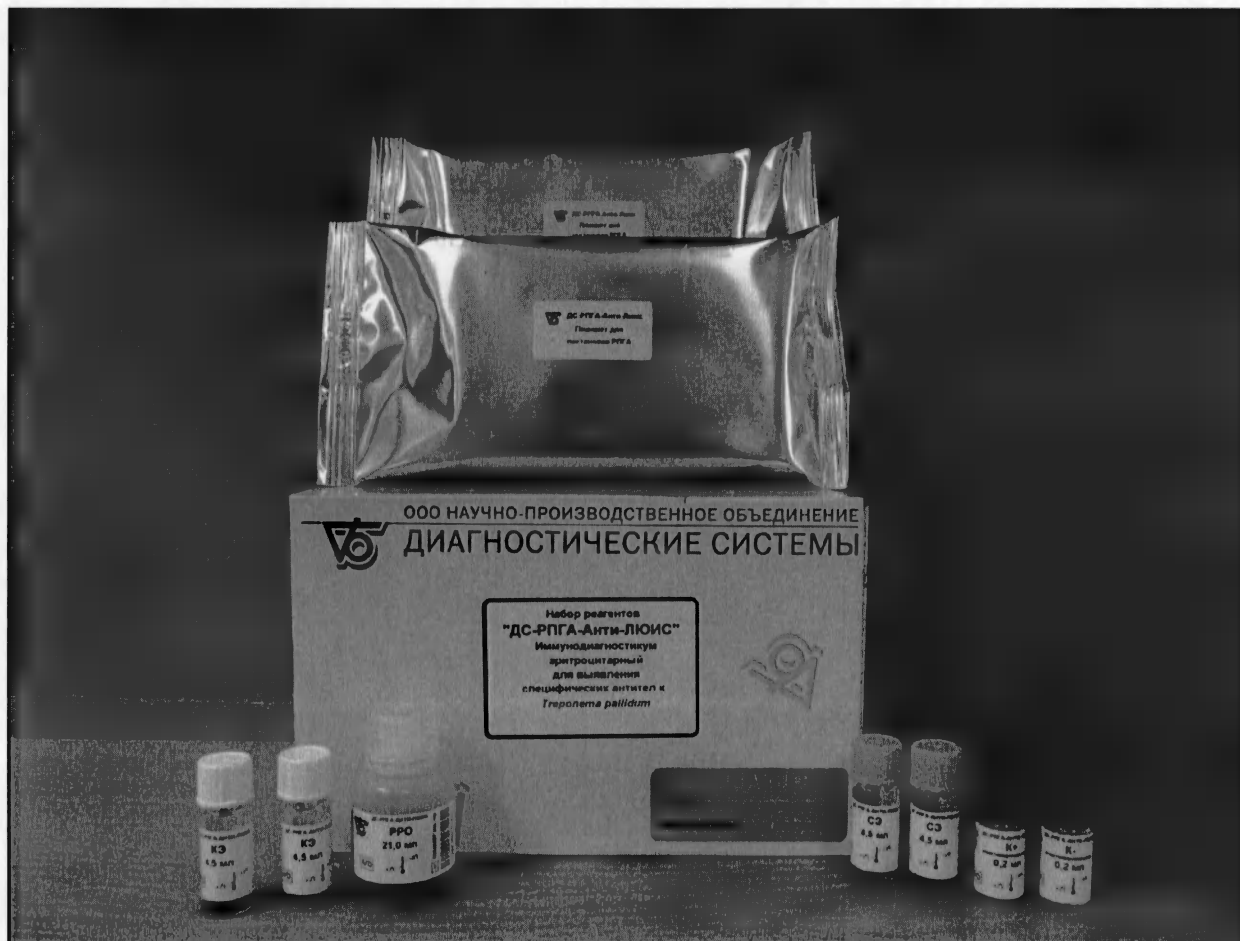

Ответственный по испытаниям,

врач клинической лабораторной диагностики

лабораторного центра

ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России,

д.м.н., доцент

С.В. Ротанов

03.09.2013 г.

Фотография

состава набора реагентов «ДС-РПГА-АНТИ-ЛЮИС»
Иммунодиагностикум эритроцитарный для выявления специфических антител
к *Treponema pallidum*» комплект 2 по ТУ 9398-085-05941003-2013
производства ООО «НПО «Диагностические системы»



Ответственный по испытаниям,
врач клинической лабораторной диагностики
лабораторного центра
ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России,
д.м.н., доцент

С.В. Ротанов

03.09.2013 г.

Фотография

состава набора реагентов «ДС-РПГА-АНТИ-ЛЮИС»

Иммунодиагностикум эритроцитарный для выявления специфических антител к *Treponema pallidum*» комплект 3 по ТУ 9398-085-05941003-2013 производства ООО «НПО «Диагностические системы»



Ответственный по испытаниям,
врач клинической лабораторной диагностики
лабораторного центра
ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России,
д.м.н., доцент

С.В. Ротанов

03.09.2013 г.