

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор





АО «Вектор-Бест»

М.Д. Хусаинов
2021 г.



**Образцы маркировки на Набор реагентов для дифференциального выявления ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК вирусов иммунодефицита человека 1 и 2 типов методом ПЦР/ОТ-ПЦР в режиме реального времени
“РеалБест ВГВ/ВГС/ВИЧ ПЦР”**

1. Образцы этикеток на компоненты набора “РеалБест ВГВ/ВГС/ВИЧ ПЦР”

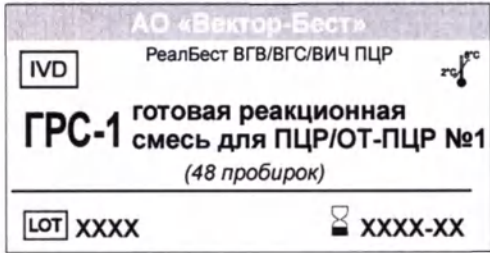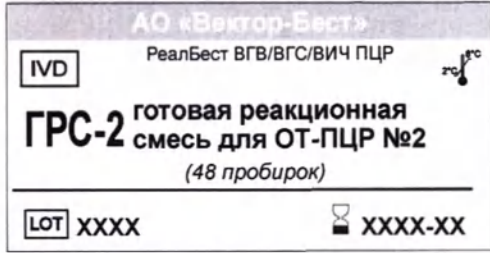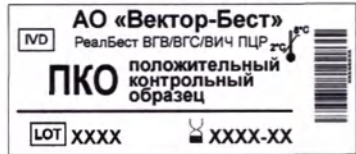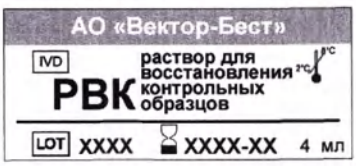Наименование компонента	Этикетка
Готовая реакционная смесь для ПЦР/ОТ-ПЦР №1 (ГРС-1)	
Готовая реакционная смесь для ОТ-ПЦР №2 (ГРС-2)	
Положительный контрольный образец (ПКО)	
Раствор для восстановления контрольных образцов (РВК)	

2. Образцы этикеток на коробку набора "РеалБест ВГВ/ВГС/ВИЧ ПЦР"

2.1. Верхняя этикетка.

REF	набор реагентов для дифференциального выявления ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК вирусов иммунодефицита человека 1 и 2 типов методом ПЦР/ОТ-ПЦР в режиме реального времени																						
X-XXXX																							
РеалБест ВГВ/ВГС/ВИЧ ПЦР																							
LOT XXXX	состав:	LOT																					
<table><tr><td>1. Положительный контрольный образец</td><td>1 фл.</td><td>XXXX</td></tr><tr><td>2. Готовая реакционная смесь для ПЦР/ОТ-ПЦР №1</td><td>48 пр.</td><td>XXXX</td></tr><tr><td>3. Готовая реакционная смесь для ОТ-ПЦР №2</td><td>48 пр.</td><td>XXXX</td></tr><tr><td>4. Раствор для восстановления контрольных образцов</td><td>1 фл., 4 мл</td><td>XXXX</td></tr><tr><td>5. Оптическая пленка</td><td>1,5 листа</td><td></td></tr><tr><td>6. Пластиковая крышка</td><td>1 шт.</td><td></td></tr><tr><td>7. Вкладыш со штрих-кодом</td><td>1 шт.</td><td></td></tr></table>			1. Положительный контрольный образец	1 фл.	XXXX	2. Готовая реакционная смесь для ПЦР/ОТ-ПЦР №1	48 пр.	XXXX	3. Готовая реакционная смесь для ОТ-ПЦР №2	48 пр.	XXXX	4. Раствор для восстановления контрольных образцов	1 фл., 4 мл	XXXX	5. Оптическая пленка	1,5 листа		6. Пластиковая крышка	1 шт.		7. Вкладыш со штрих-кодом	1 шт.	
1. Положительный контрольный образец	1 фл.	XXXX																					
2. Готовая реакционная смесь для ПЦР/ОТ-ПЦР №1	48 пр.	XXXX																					
3. Готовая реакционная смесь для ОТ-ПЦР №2	48 пр.	XXXX																					
4. Раствор для восстановления контрольных образцов	1 фл., 4 мл	XXXX																					
5. Оптическая пленка	1,5 листа																						
6. Пластиковая крышка	1 шт.																						
7. Вкладыш со штрих-кодом	1 шт.																						
ТУ 21.20.23-071-23548172-2021 ру																							

2.2. Боковая этикетка №1.

REF	X-XXXX	LOT	XXXX
2°C	8°C	IVD	Σ 48
РеалБест ВГВ/ВГС/ВИЧ ПЦР		XXXX-XX-XX XXXX-XX-XX	
		XXXXXXXXXXXXXXXXXX	

2.3. Боковая этикетка №2.

АО «Вектор-Бест»
Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211, тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52 E-mail: vbmarket@vector-best.ru www.vector-best.ru

Примечание. Текст боковой этикетки №2 может быть нанесен непосредственно на коробку типографским способом

«СОГЛАСОВАНО»

Директор по производству
АО «Вектор-Бест»

В.К. Ткачев

«01» 07

2021 г.

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 2 листов.

Директор по технологии и качеству
АО «Вектор-Бест»



Масяго А.В.
2021 г.




РеалБест ВГВ/ВГС/ВИЧ ПЦР X-XXXX

Состав набора:	1	Штрих-код набора	XXXXXXX
ГРС 1		Штрих-код ГРС	XXXXXXX
Инфекция:	ВГВ/ВГС		
Флуор. канал:	ROX/HEX		
Протокол:	ОТ-ПЦР		
Серия ГРС-1:	1		
ГРС 2		Штрих-код ГРС	XXXXXXXX
Инфекция:	ВИЧ-1/ВИЧ-2		
Флуор. канал:	ROX/HEX		
Протокол:	ОТ-ПЦР		
Серия ГРС-2:	1		

серия		Диапазон Ct ПК			
ПКО	1	ВГВ	ВГС	ВИЧ 1	ВИЧ 2
		≤ 32	≤ 32	≤ 35	≤ 35



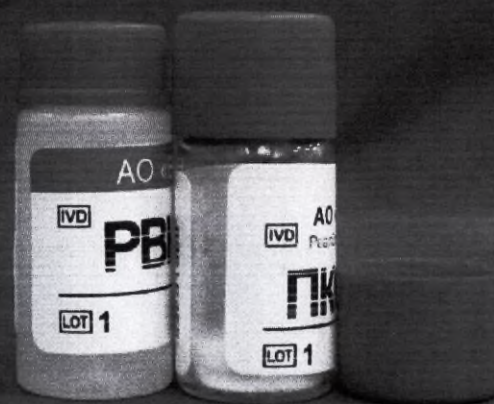





ВЕКТОР

БЕСТ

REF

X-XXXX

набор реагентов для дифференциального
выявления ДНК вируса гепатита В,
РНК вируса гепатита С и РНК вирусов
иммунодефицита человека 1 и 2 типов
методом ПЦР/ОТ-ПЦР
в режиме реального времени

РеалБест ВГВ/ВГС/ВИЧ ПЦР

LOT 1

СОСТАВ:

1. Положительный контрольный образец	1 фл.	1
2. Готовая реакционная смесь для ПЦР/ОТ-ПЦР №1	48 пр.	1
3. Готовая реакционная смесь для ОТ-ПЦР №2	48 пр.	1
4. Раствор для восстановления контрольных образцов	1 фл. 4 мл	1
5. Оптическая пленка	1,5 листа	1
6. Пластиковая крышка	1 шт.	1
7. Вкладыш со штрих-кодом	1 шт.	1

ТУ 21.20.23-071-23548172-2021
ру





АО «Вектор-Бест»


Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

E-mail: vbmarket@vector-best.ru

www.vector-best.ru


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“РеалБест ВГВ/ВГС/ВИЧ ПЦР”
 серия 2

АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
 “02” “04” 2021 г.

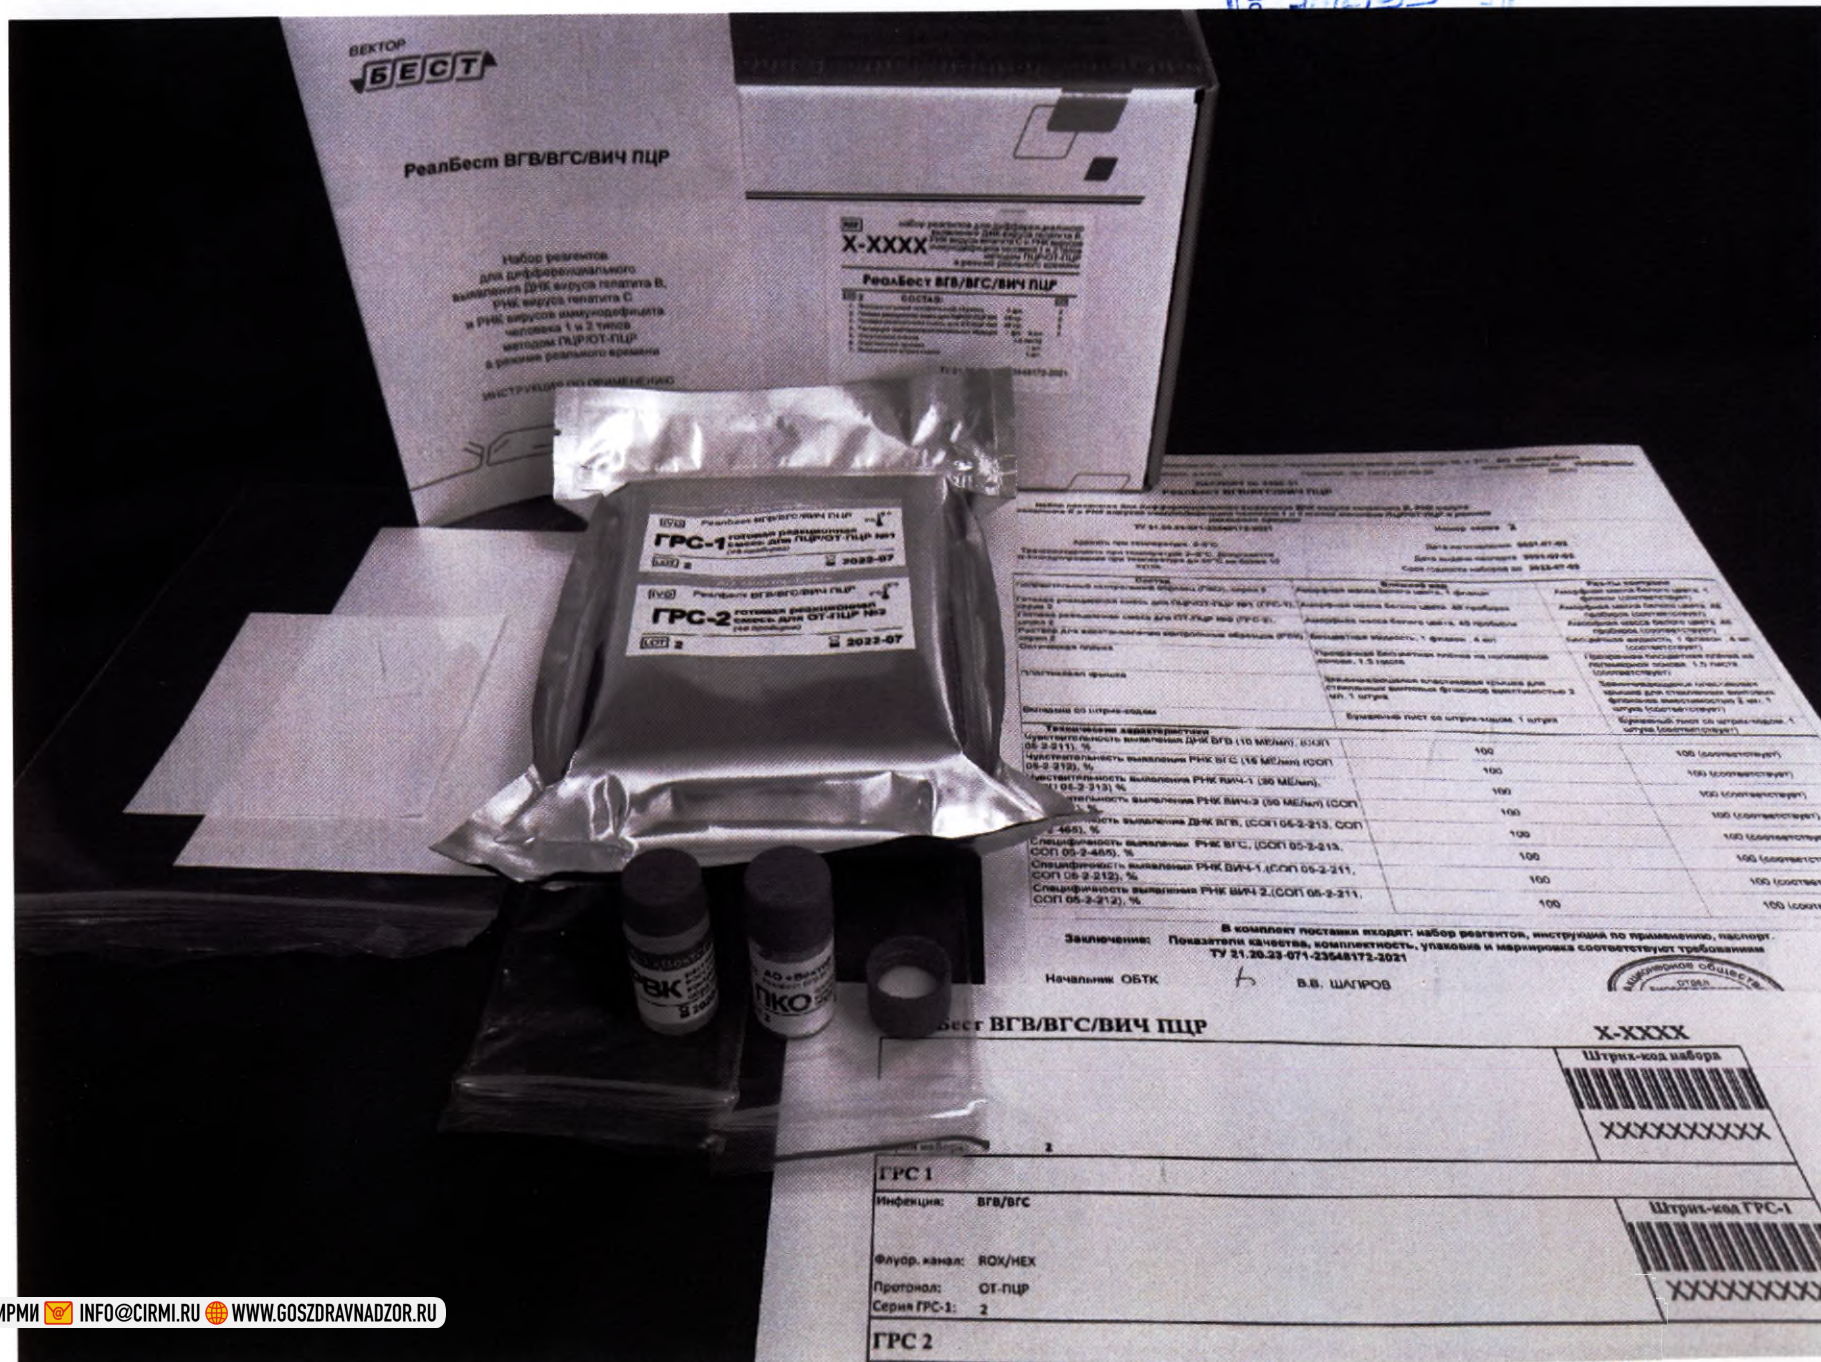


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“РеалБест ВГВ/ВГС/ВИЧ ПЦР” № 1
 серия 2

Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
 “се” 2021 г.
 М.П.

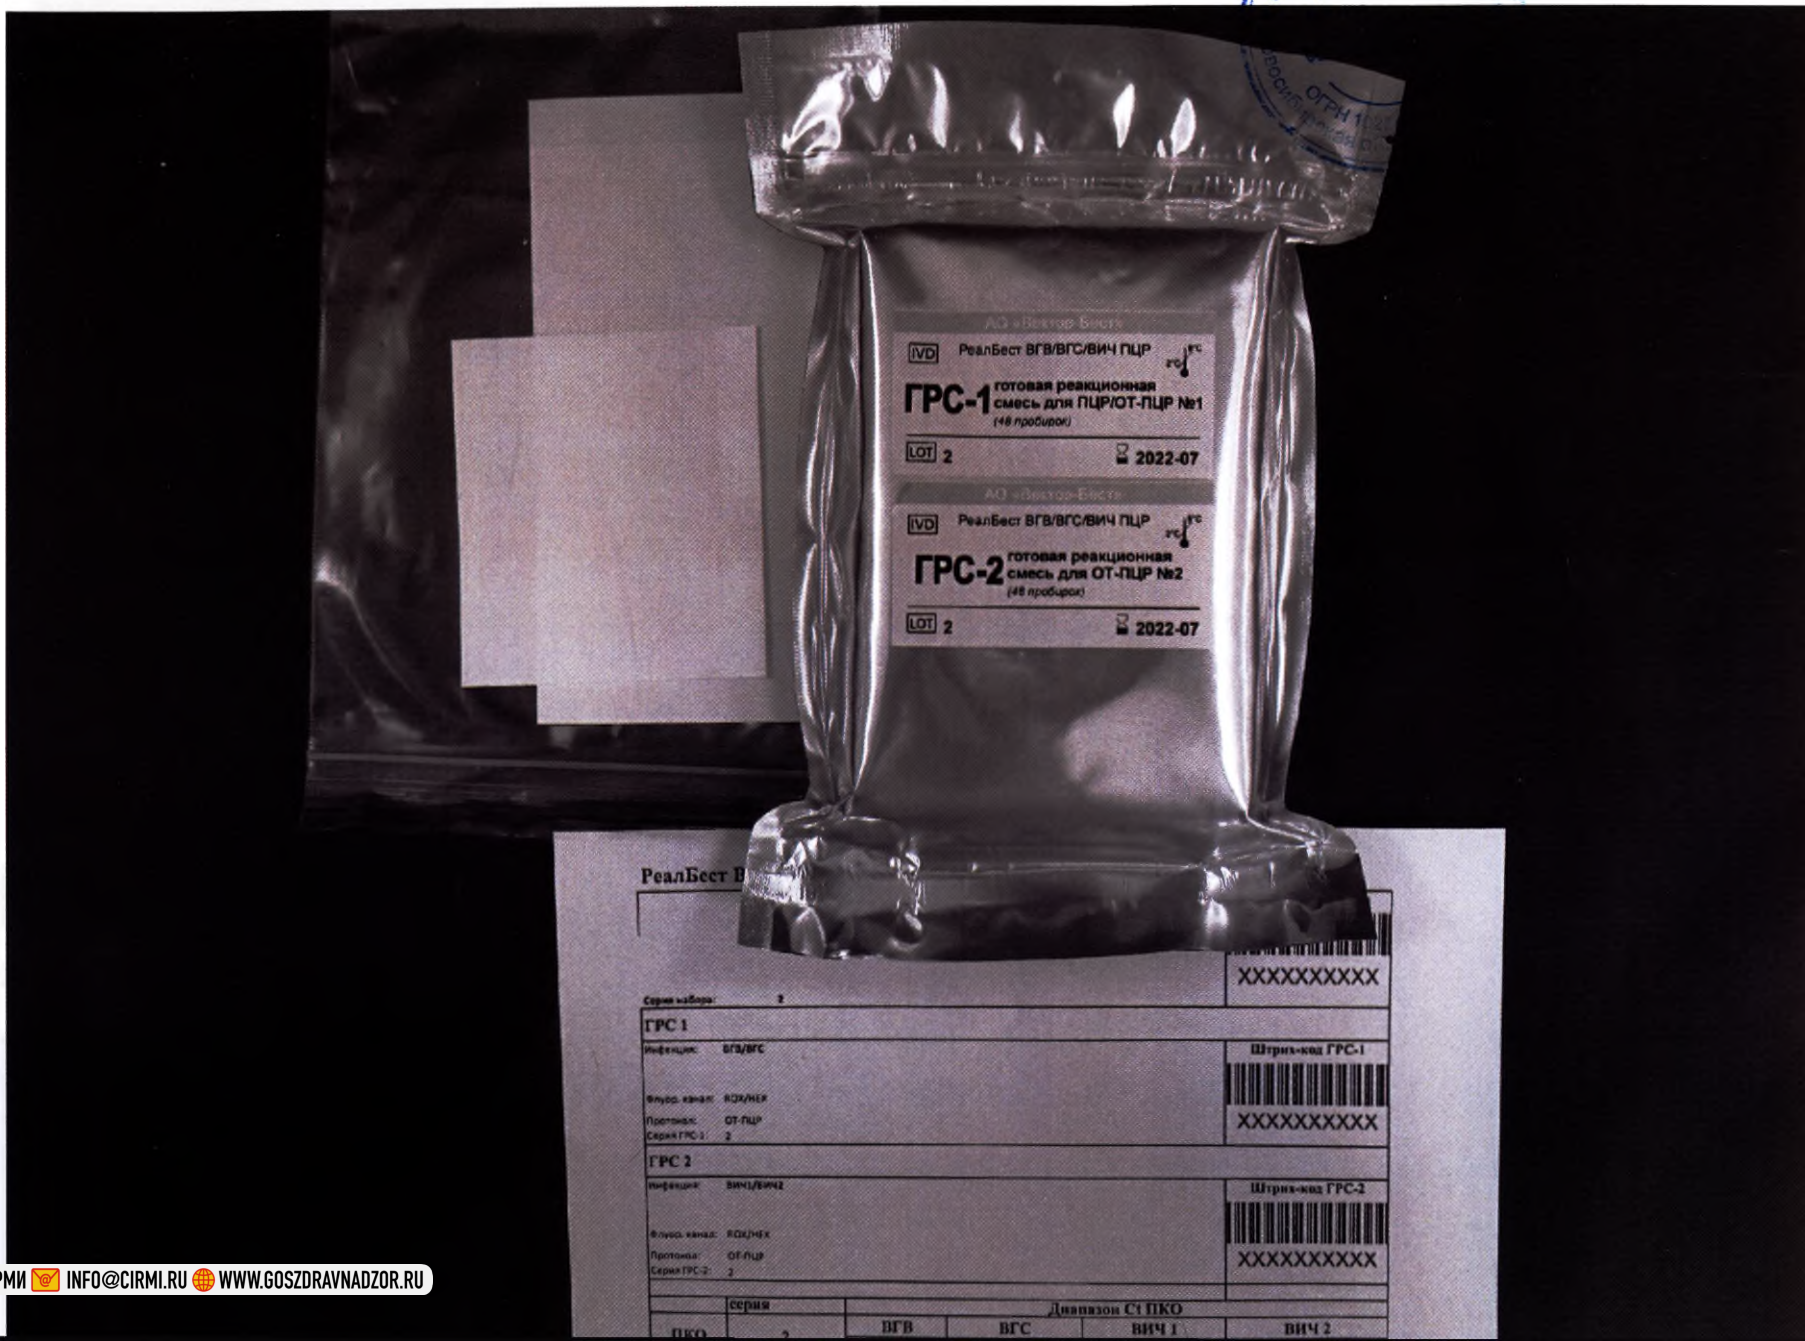

РеалБест В		XXXXXXXXXX
Серия набора: 2		
ГРС 1		
Идентификатор: ВГВ/ВГС	Штрих-код ГРС-1	
Вспомогательный канал: ЯСД/НЧ	XXXXXXXXXX	
Подтип: ОТ-ПЦР		
Сериал ГРС 1: 2		
ГРС 2		
Идентификатор: ВМЧ/ВМЧ2	Штрих-код ГРС-2	
Вспомогательный канал: ЯСД/НЧ	XXXXXXXXXX	
Подтип: ОТ-ПЦР		
Сериал ГРС 2: 2		
серия		
Диагностический С1 ПК		
ПК	ВГВ	ВГС
ВМЧ 1	ВМЧ 2	



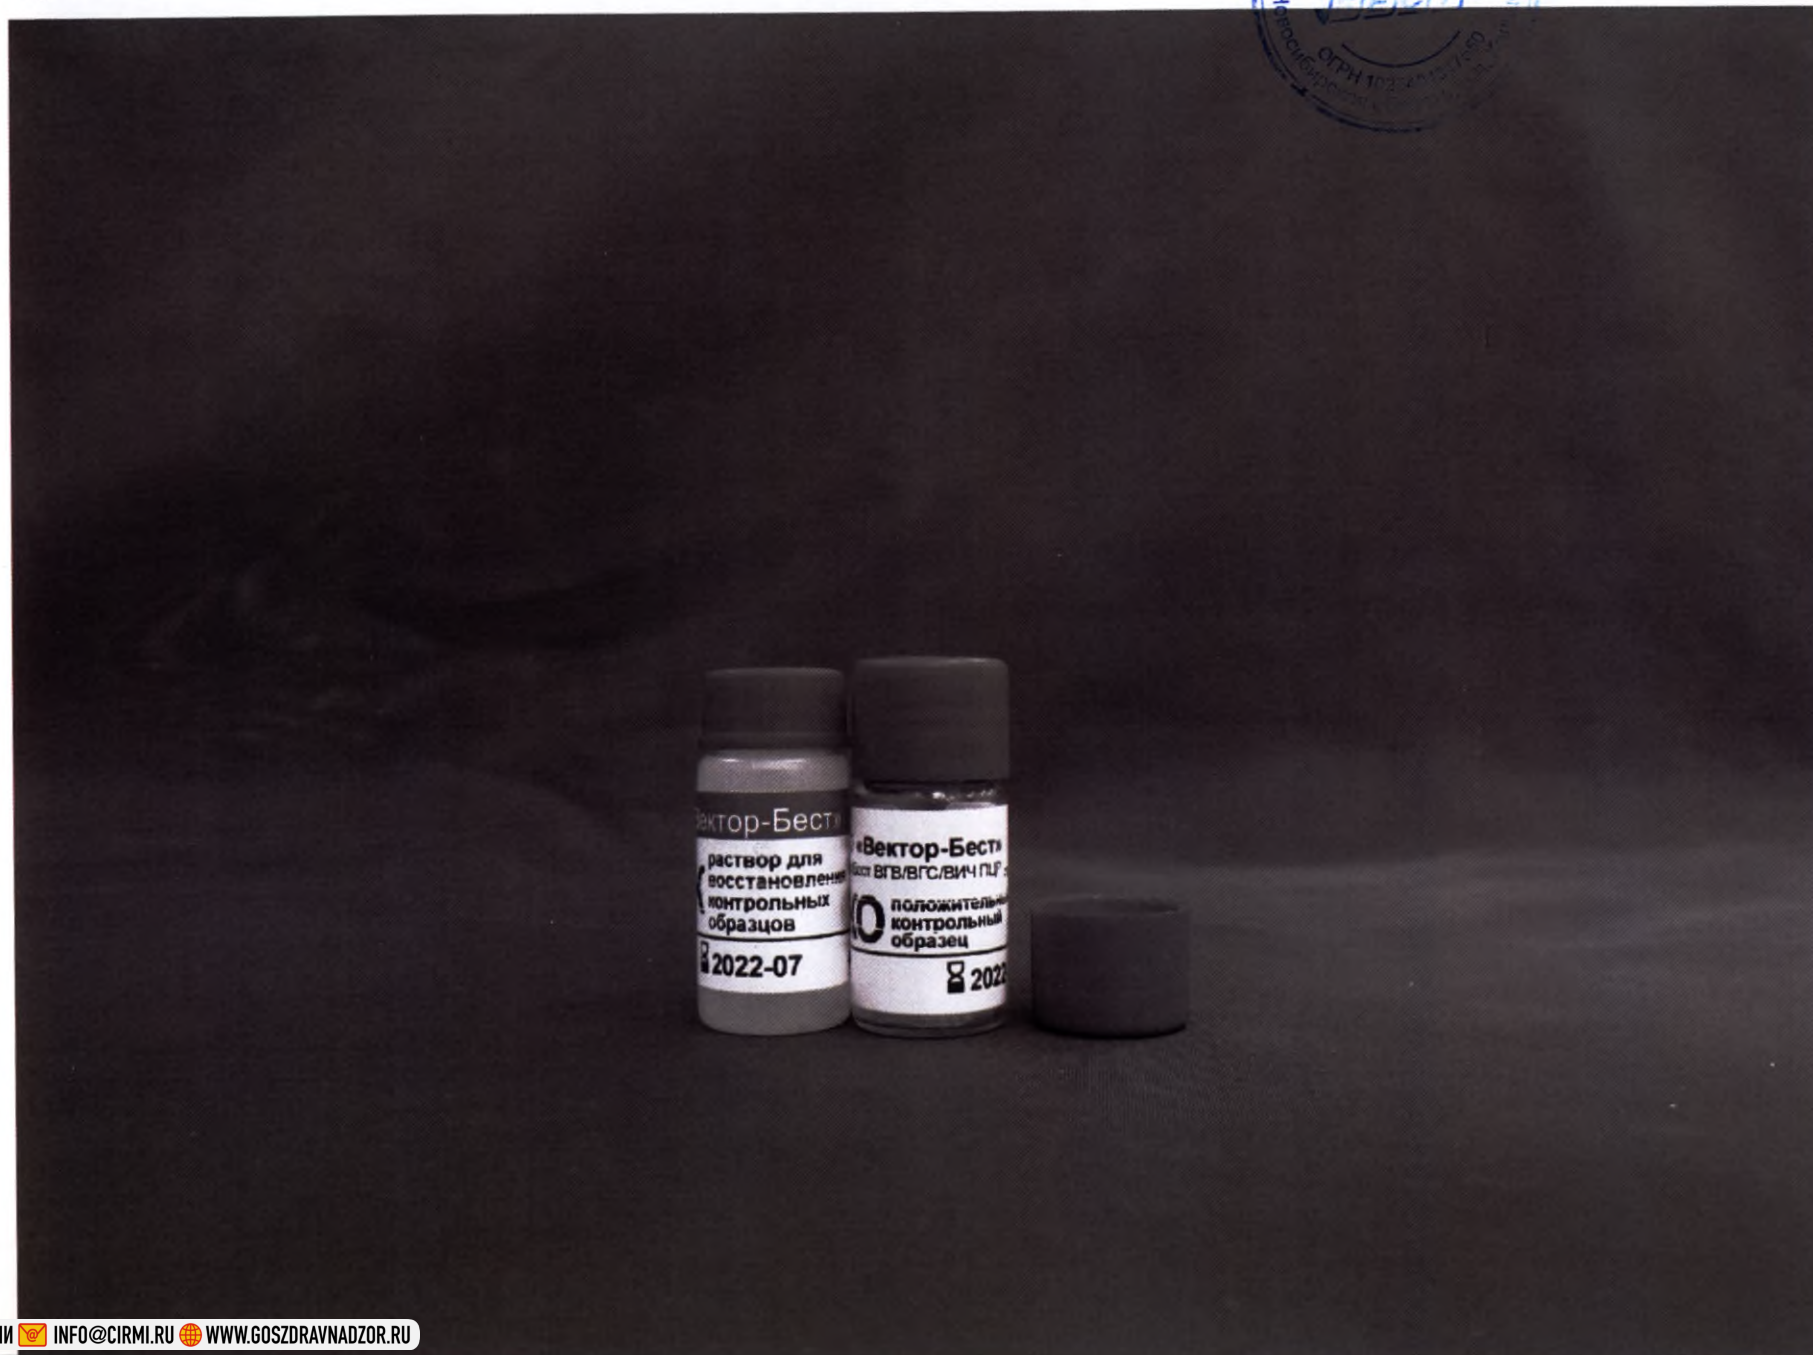



ВЕКТОР
БЕСТ

REF

X-XXXX

набор реагентов для дифференциального
выявления ДНК вируса гепатита В,
РНК вируса гепатита С и РНК вирусов
иммунодефицита человека 1 и 2 типов
методом ПЦР/ОТ-ПЦР
в режиме реального времени

РеалБест ВГВ/ВГС/ВИЧ ПЦР

LOT 2

СОСТАВ:

LOT

- | | | |
|--|------------|---|
| 1. Положительный контрольный образец | 1 фл. | 2 |
| 2. Готовая реакционная смесь для ПЦР/ОТ-ПЦР №1 | 48 пр. | 2 |
| 3. Готовая реакционная смесь для ОТ-ПЦР №2 | 48 пр. | 2 |
| 4. Раствор для восстановления контрольных образцов | 1 фл. 4 мл | 2 |
| 5. Оптическая пленка | 1,5 листа | |
| 6. Пластиковая крышка | 1 шт. | |
| 7. Вкладыш со штрих-кодом | 1 шт. | |

ТУ 21.20.23-071-23548172-2021

ру

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"РеалБест ВГВ/ВГС/ВИЧ ПЦР" № 2
серия 2

АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"02" 07 2021 г.





АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,

тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

E-mail: vbmarket@vector-best.ru

[www. vector-best.ru](http://www.vector-best.ru)