

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «САНРАЙС»

Мисюряев И.В.

20 22 г.



**Шаблоны маркировок
медицинского изделия**

Облучатель медицинский ультрафиолетовый
бактерицидный САНРАЙС
по ТУ 26.60.13-001-59883288-2021

1-Индивидуальная маркировка на примере варианта исполнения «Облучатель медицинский ультрафиолетовый бактерицидный САНРАЙС-УБРО»

Облучатель медицинский ультрафиолетовый бактерицидный САНРАЙС-УБРО

Рег.удостов: № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 26.60.13-001-59883288-2021

Серийный номер изделия _____

Изготовлено: _____ г.

220В

50 Гц

30 Вт

IP 30

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «САНРАЙС»,
(ООО «САНРАЙС»)

Класс защиты – II, тип BF

Россия, 606093, Нижегородская область, м. р-н Володарский,
г.п. Рабочий поселок Решетиха, рп Решетиха,
ул. Савельева, д. 31, помещ. 14А, +79101218881,
<https://sunrays52.ru>



2-Транспортная маркировка примере варианта исполнения «Облучатель медицинский ультрафиолетовый бактерицидный САНРАЙС-УБРО»

Облучатель медицинский ультрафиолетовый бактерицидный САНРАЙС по ТУ 26.60.13-001-59883288-2021:

Облучатель медицинский ультрафиолетовый бактерицидный САНРАЙС-УБРО
ТУ 26.60.13-001-59883288-2021

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «САНРАЙС», (ООО «САНРАЙС»), Россия, 606093, Нижегородская область, м: р-н Володарский, г.п. Рабочий поселок Решетиха, рп Решетиха, ул. Савельева, д. 31, помещ. 14А, +79101218881, sunrays.nino@gmail.com, <https://sunrays52.ru>

Рег.удостов: № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Серийный номер изделия _____

Изготовлено: _____ г.

Цвет: _____

Напряжение питания 220В

Частота питающей сети 50-55 Гц

Мощность 11 Вт

IP 30

Класс защиты – II тип BF

Порядок применения, хранения, гарантия изготовителя, срок службы:

См. руководство по эксплуатации.



3-Маркировка патрона

Максимальная
мощность, Вт

4 – Маркировка корпуса изделия для варианта исполнения «Облучатель медицинский ультрафиолетовый бактерицидный САНРАЙС-УБРО»



ВКЛ/ВЫКЛ вентилятора

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 3 (764)1

Генеральный директор
ООО "САНРАЙС"

Мисюряев И.В.





«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «САНРАЙС»

Мисюряев И.В.


2022 г.

**Фотографические изображения
медицинского изделия
Облучатель медицинский ультрафиолетовый бактерицидный САНРАЙС
по ТУ 26.60.13-001-59883288-2021**


1-Общий вид МИ Облучатель медицинский ультрафиолетовый бактерицидный
САНРАЙС-УБРО




2- Общий вид МИ Облучатель медицинский ультрафиолетовый бактерицидный
САНРАЙС-ОУФБ-9, ОУФБ-7, ОУФБ-5

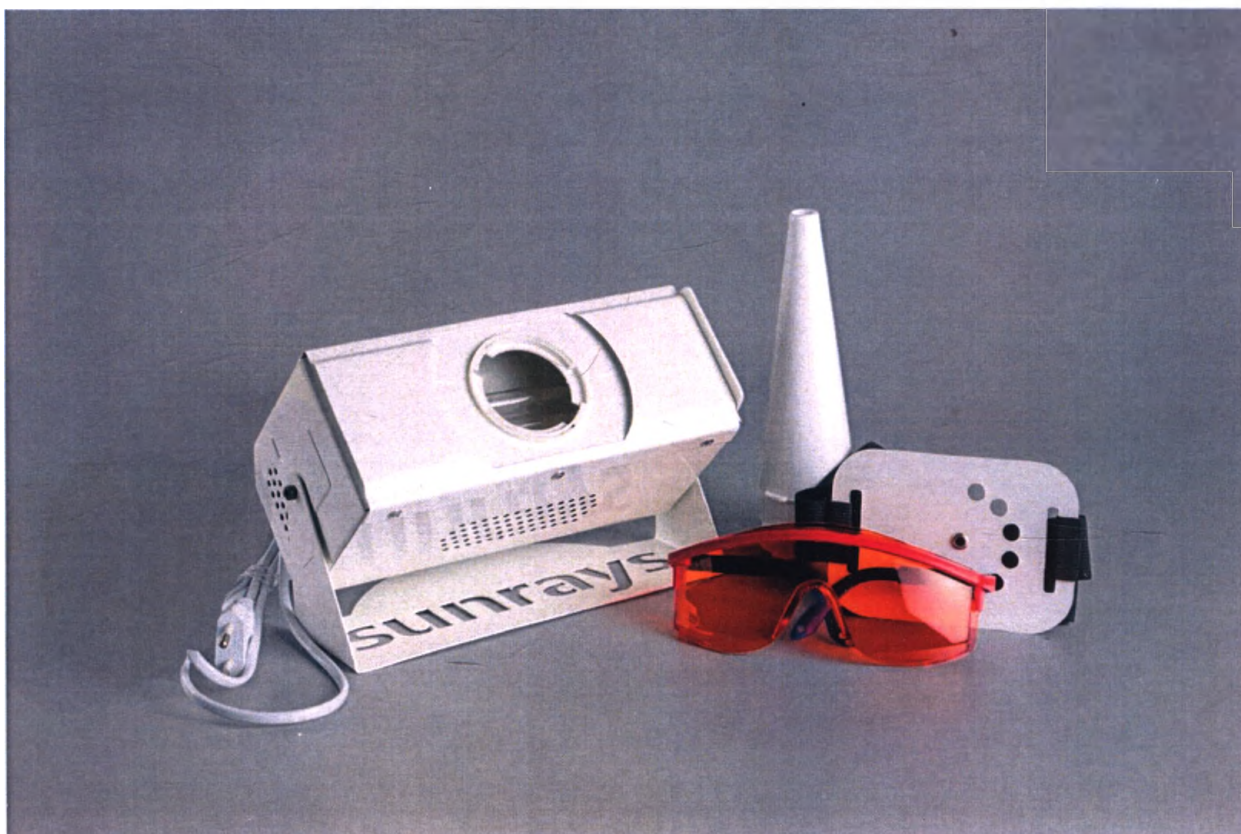


3- Общий вид МИ Облучатель медицинский ультрафиолетовый бактерицидный САНРАЙС-БР



4-Общий вид МИ с маркировкой на примере Облучатель медицинский ультрафиолетовый бактерицидный САНРАЙС-УБРО



5-Общий вид транспортной упаковки с маркировкой на примере Облучатель медицинский ультрафиолетовый бактерицидный САНРАЙС-УБРО



Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 4 (Петля)

Генеральный директор
ООО "САНРАЙС"

Мисюряев И.В.

