


Фотографические изображения

Набор контрольных сывороток PreciControl ThyroAB для контроля качества определения множества тиреоидных маркеров, связанных с заболеваниями щитовидной железы иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (PreciControl ThyroAB Elecsys and cobas e analyzers)

Набор контрольных сывороток PreciControl ThyroAB для контроля качества определения множества тироидных маркеров, связанных с заболеваниями щитовидной железы иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (PreciControl ThyroAB Elecsys and cobas e analyzers)



Набор контрольных сывороток PreciControl ThyroAB для контроля качества определения множества тироидных маркеров, связанных с заболеваниями щитовидной железы иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (PreciControl ThyroAB Elecsys and cobas e analyzers)

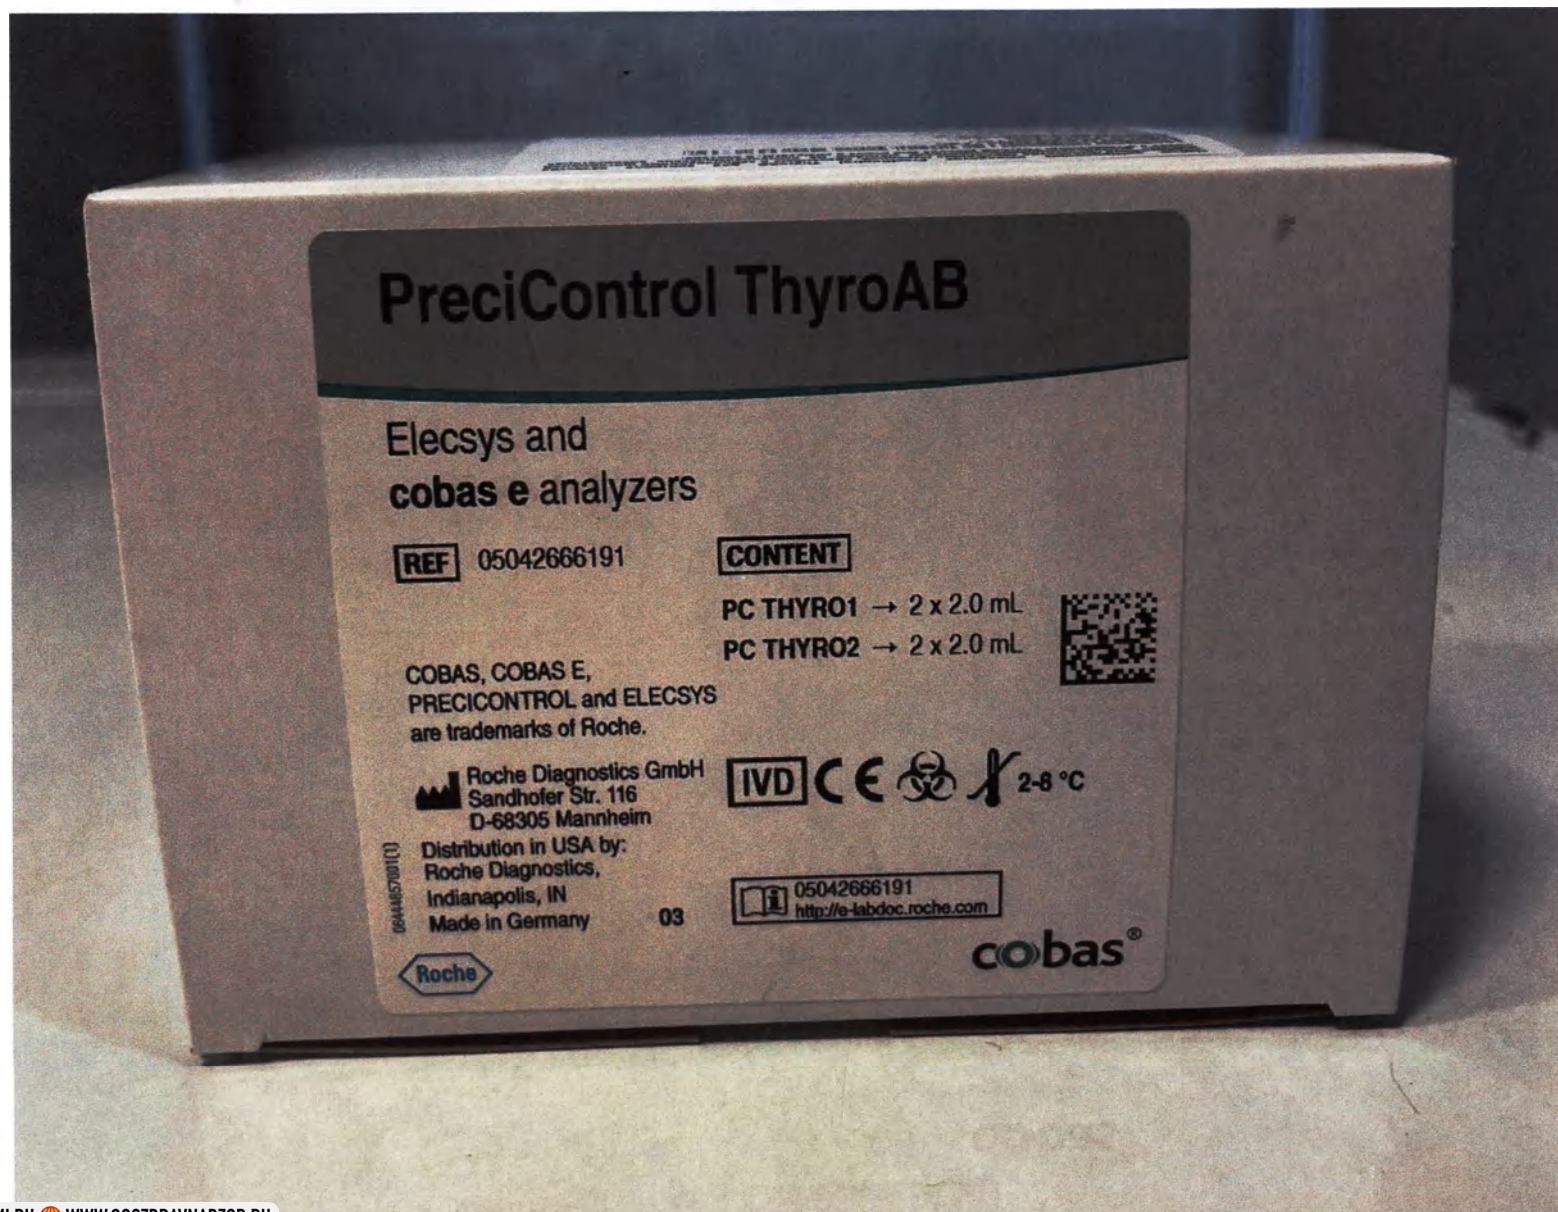

Набор контрольных сывороток PreciControl ThyroAB для контроля качества определения множества тиреоидных маркеров, связанных с заболеваниями щитовидной железы иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (PreciControl ThyroAB Elecsys and cobas e analyzers), в составе:

1. Сыворотка контрольная 1 (PC THYRO1), флакон, объем 2,0 мл – 2 шт.;
2. Сыворотка контрольная 2 (PC THYRO2), флакон, объем 2,0 мл – 2 шт.;
3. Наклейка со штрих-кодом – 2 шт.;
4. Лист со штрих-кодом – 1 шт.;
5. Флакон пустой – 4 шт.;
6. Этикетка для флакона – 12 шт.;
7. Инструкция по применению;
8. Паспорт присвоенных значений

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют


Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рох Диагностикс ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рох Диагностикс Рус» (ООО «Рох Диагностикс Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception2_dia@roche.com


Кат. номер 05042666191

Набор контрольных сывороток PreciControl ThyroAB для контроля качества определения множества тироидных маркеров, связанных с заболеваниями щитовидной железы иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (PreciControl ThyroAB Elecsys and cobas e analyzers)

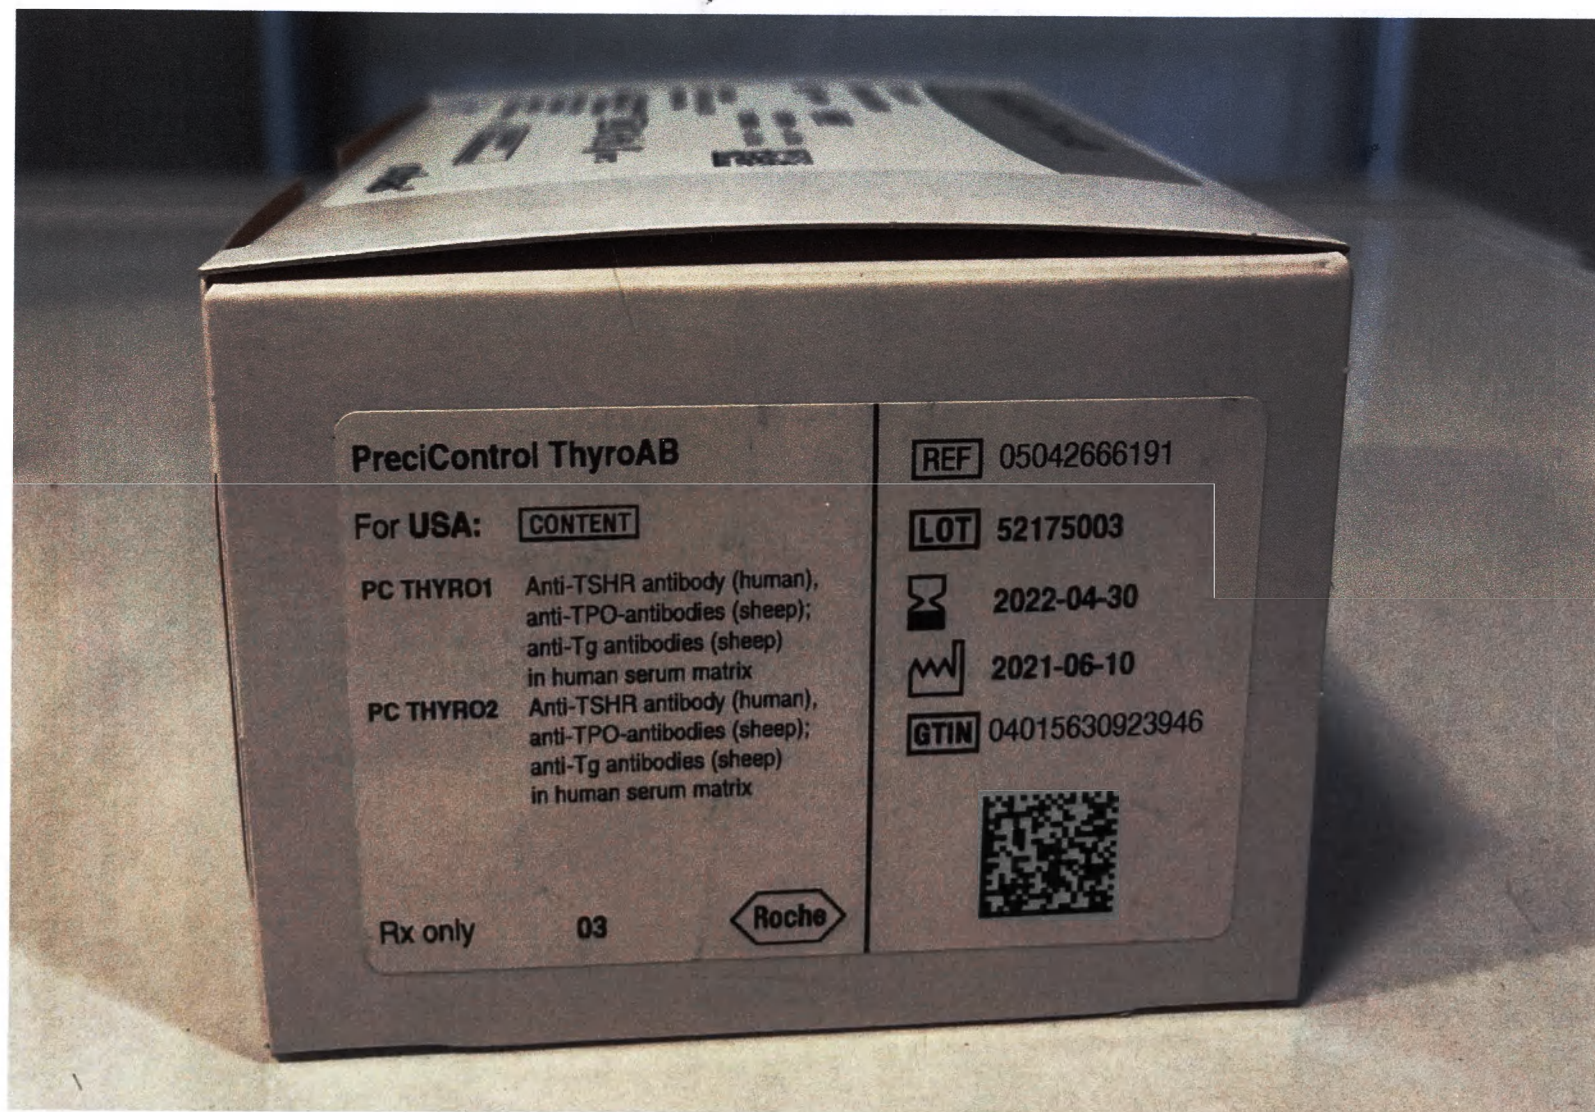


Набор контрольных сывороток PreciControl ThyroAB для контроля качества определения множества тироидных маркеров, связанных с заболеваниями щитовидной железы иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (PreciControl ThyroAB Elecsys and cobas e analyzers)

1. Сыворотка контрольная 1 (PC THYRO1), флакон, объем 2,0 мл

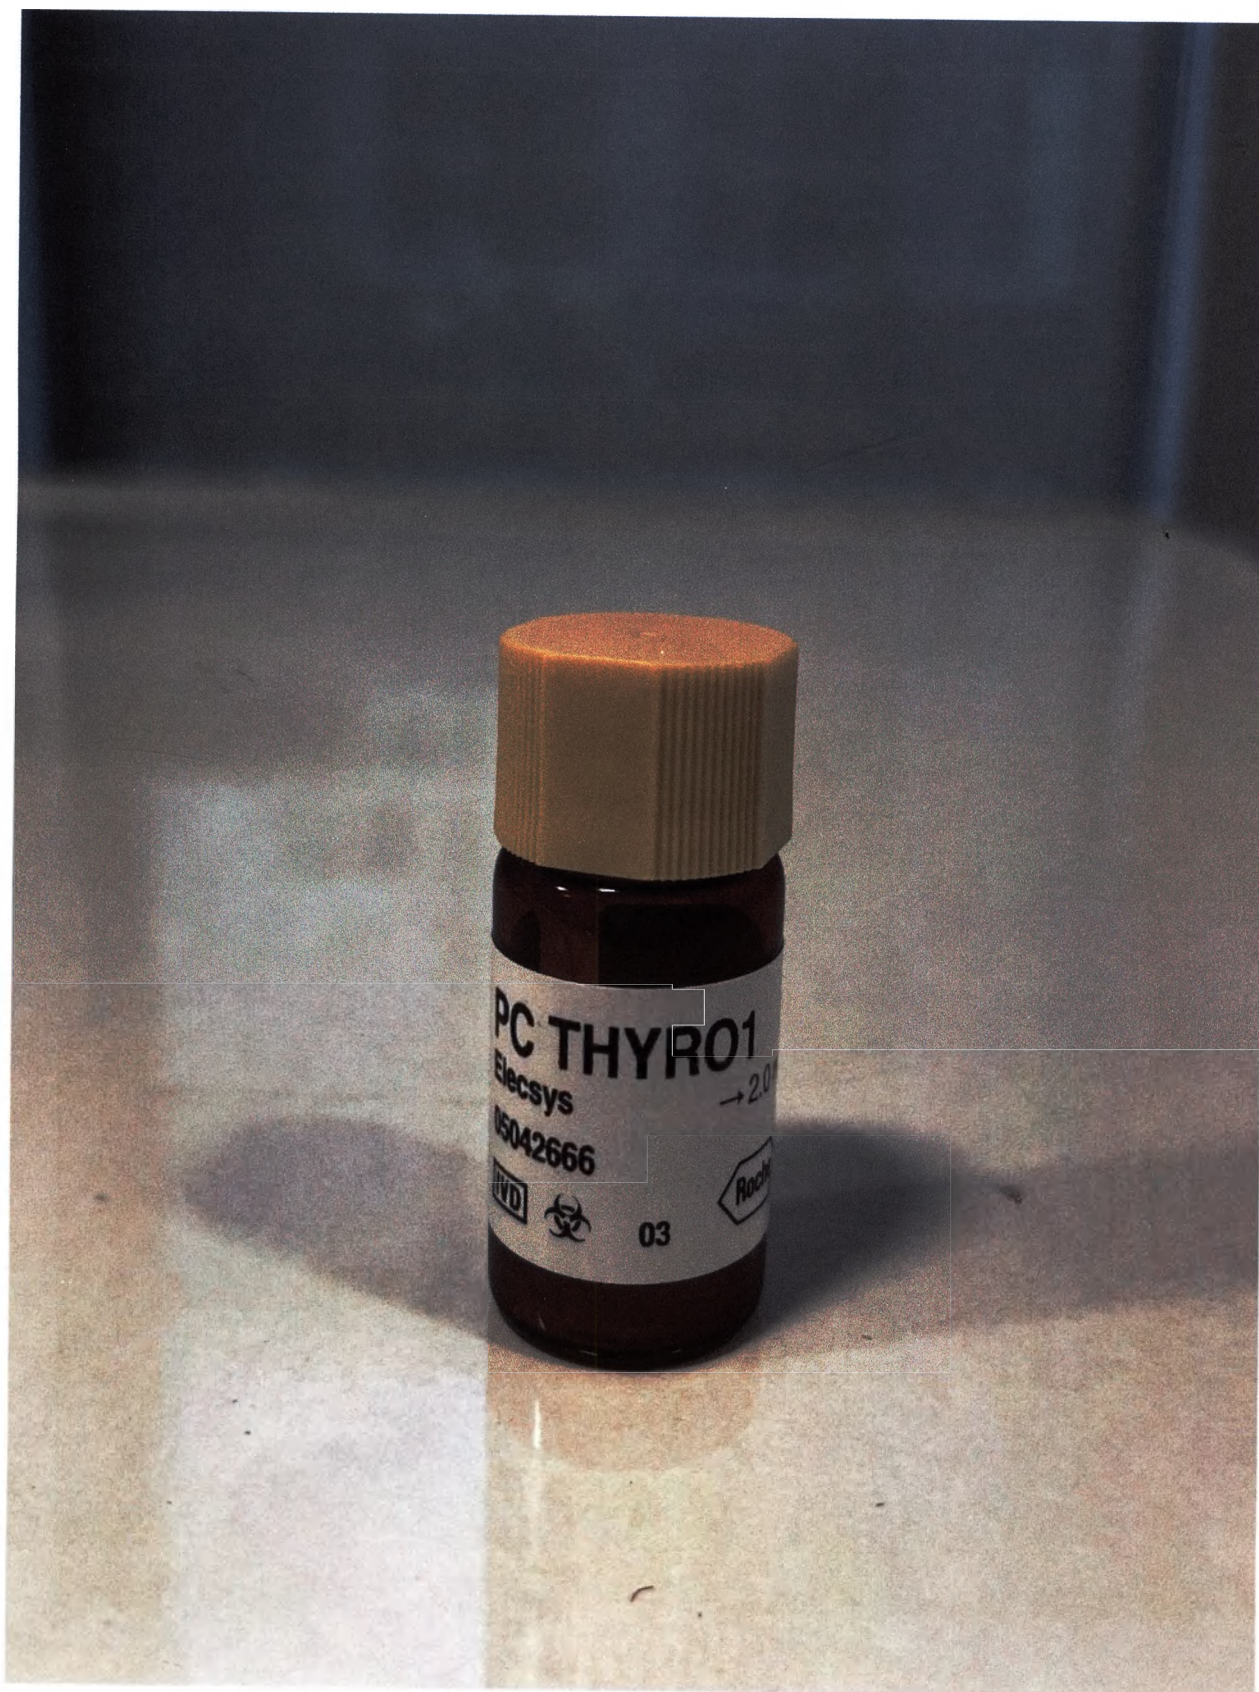


Набор контрольных сывороток PreciControl ThyroAB для контроля качества определения множества тироидных маркеров, связанных с заболеваниями щитовидной железы иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (PreciControl ThyroAB Elecsys and cobas e analyzers)

2. Сыворотка контрольная 2 (PC THYRO2), флакон, объем 2,0 мл

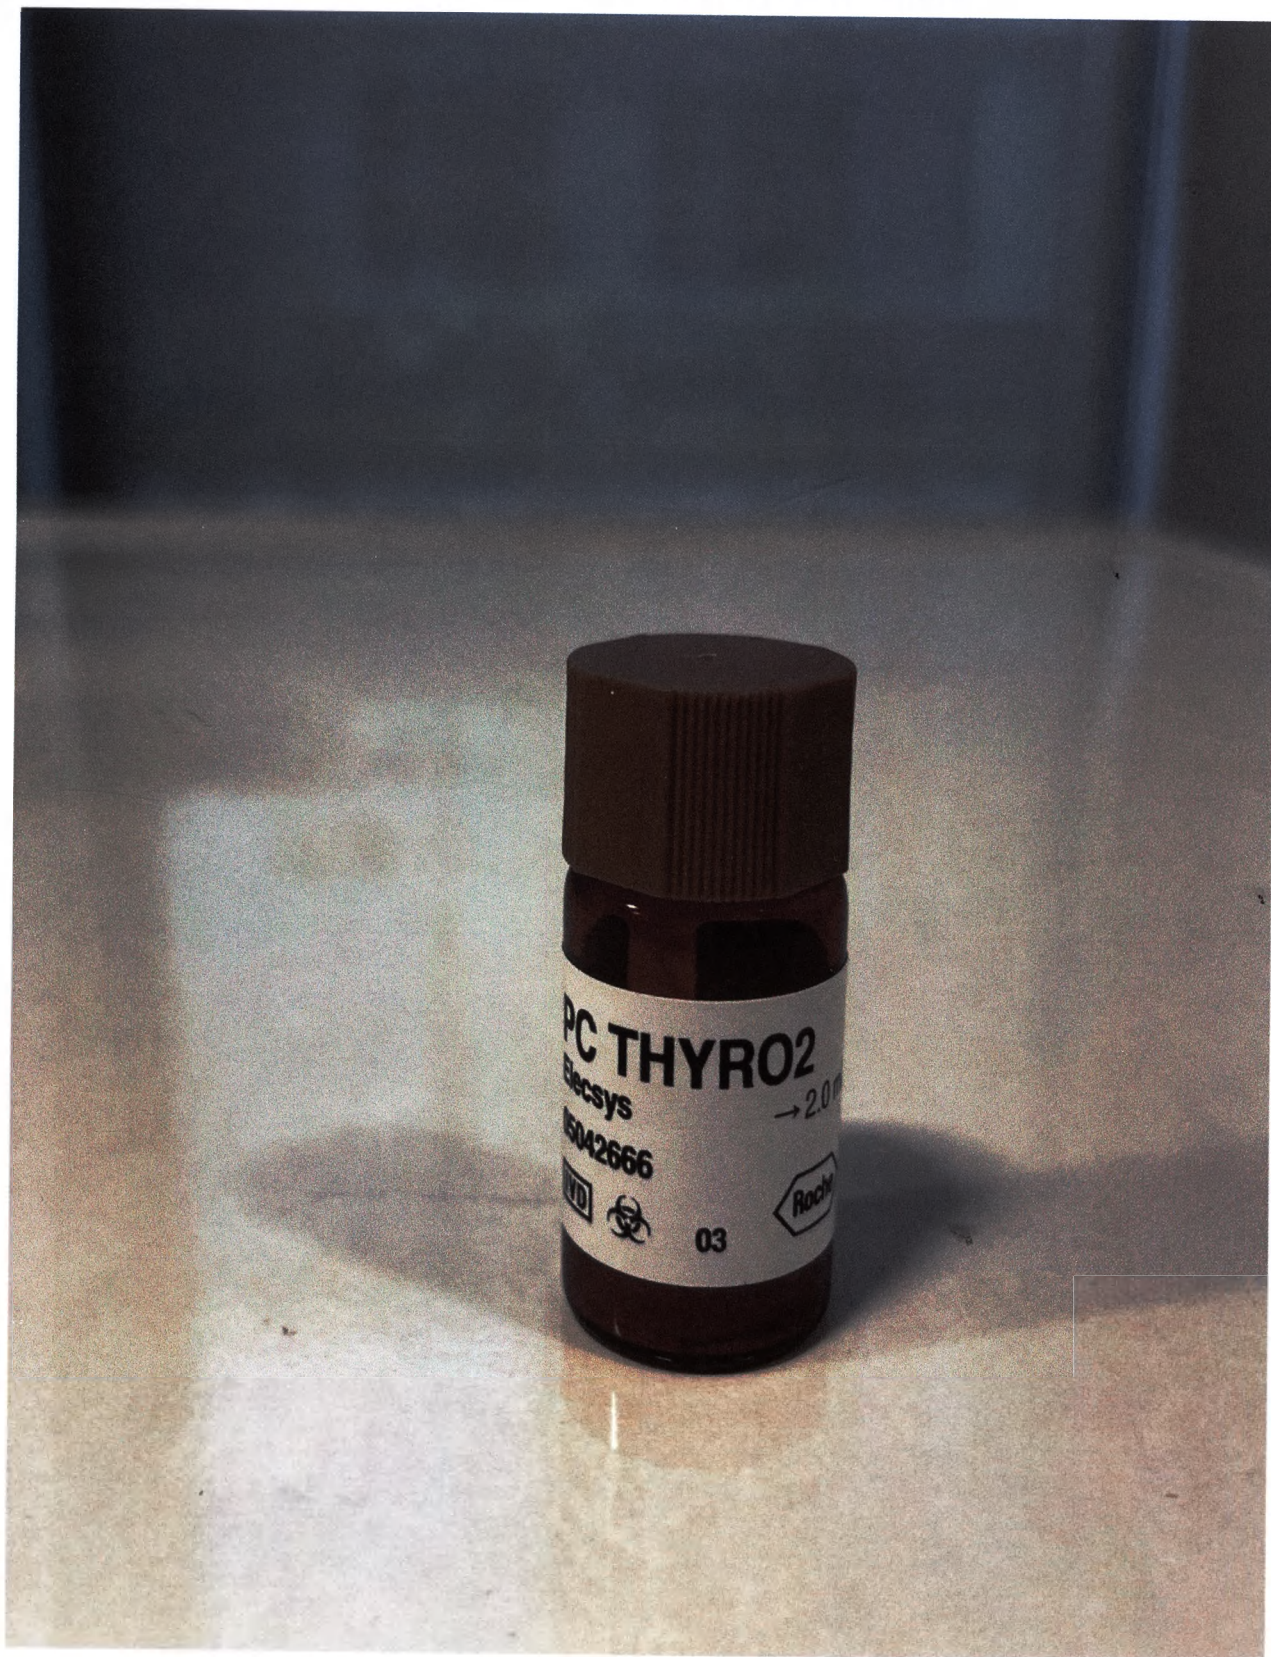

Набор контрольных сывороток PreciControl ThyroAB для контроля качества определения множества тироидных маркеров, связанных с заболеваниями щитовидной железы иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (PreciControl ThyroAB Elecsys and cobas e analyzers)

3. Наклейка со штрих-кодом

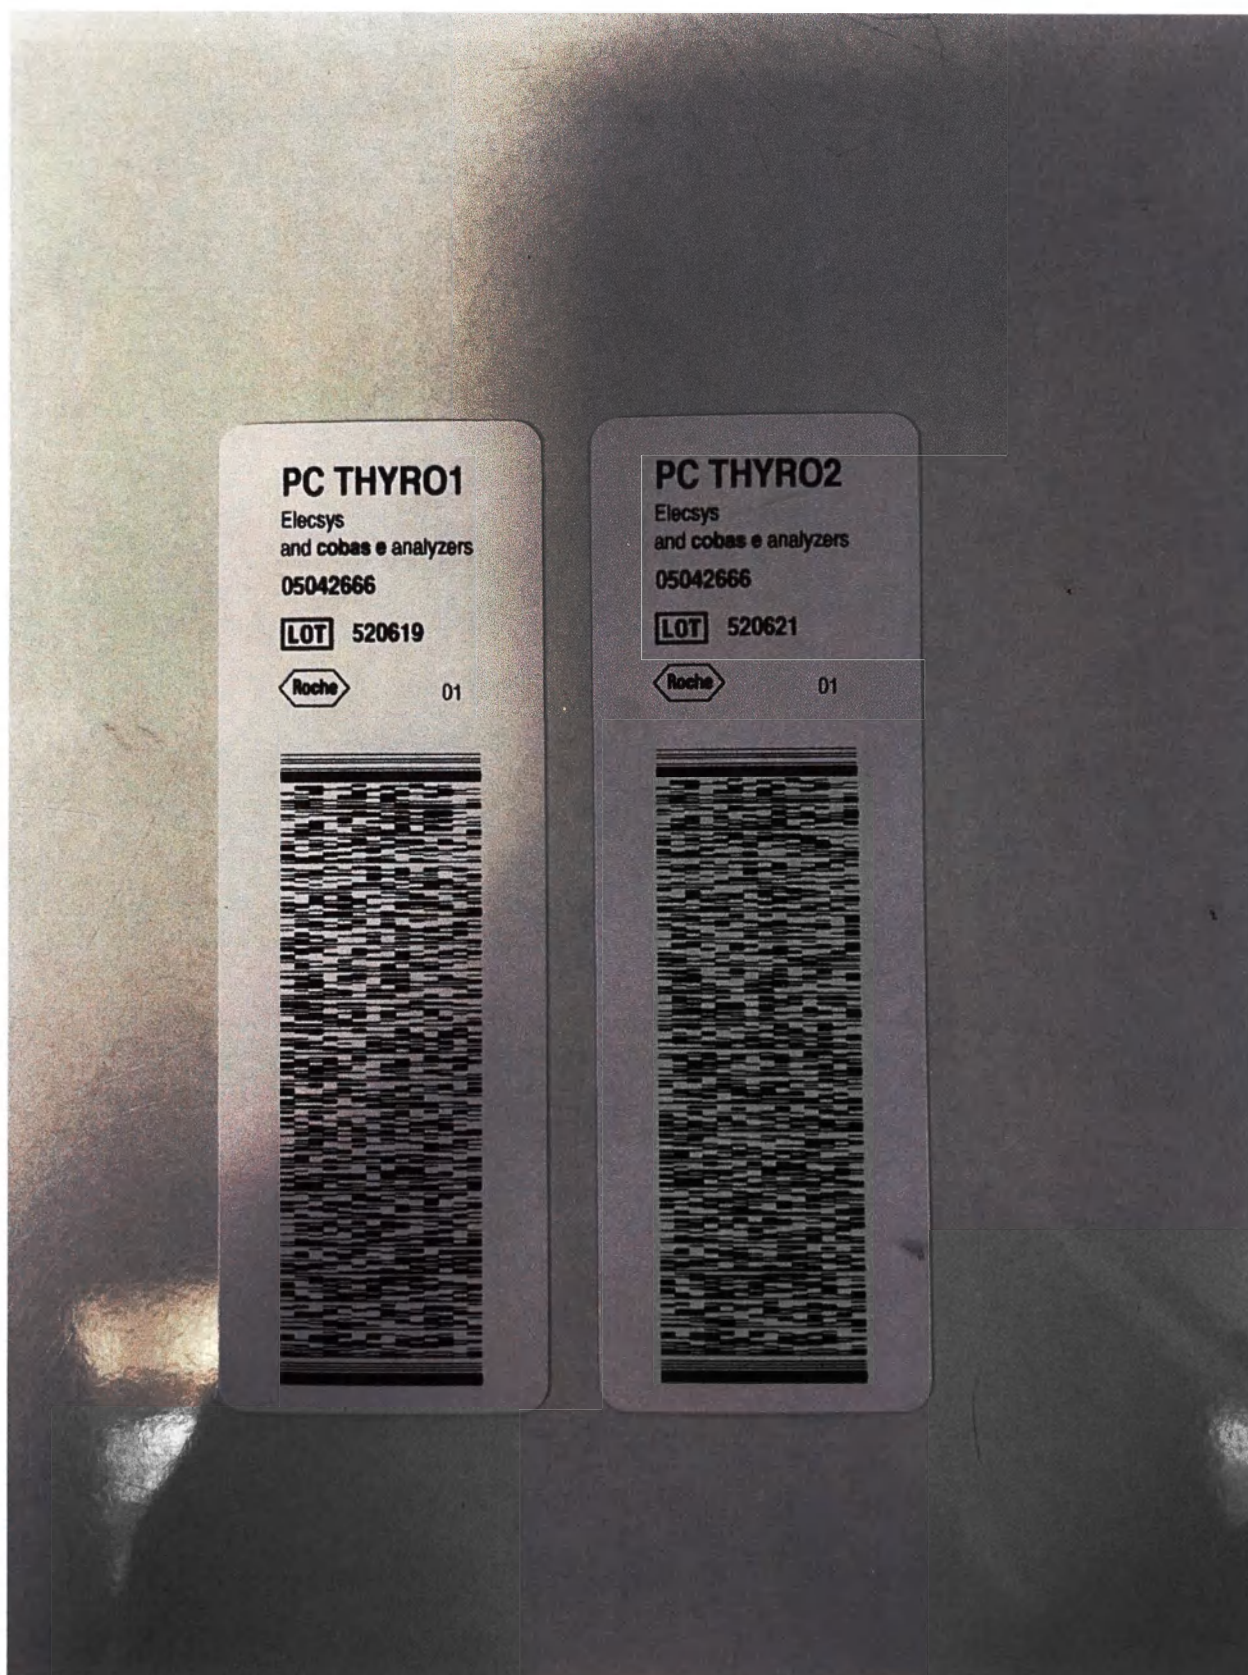


Набор контрольных сывороток PreciControl ThyroAB для контроля качества определения множества тироидных маркеров, связанных с заболеваниями щитовидной железы иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (PreciControl ThyroAB Elecsys and cobas e analyzers)

5. Флакон пустой



Набор контрольных сывороток PreciControl ThyroAB для контроля качества определения множества тироидных маркеров, связанных с заболеваниями щитовидной железы иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (PreciControl ThyroAB Elecsys and cobas e analyzers)

5. Флакон пустой

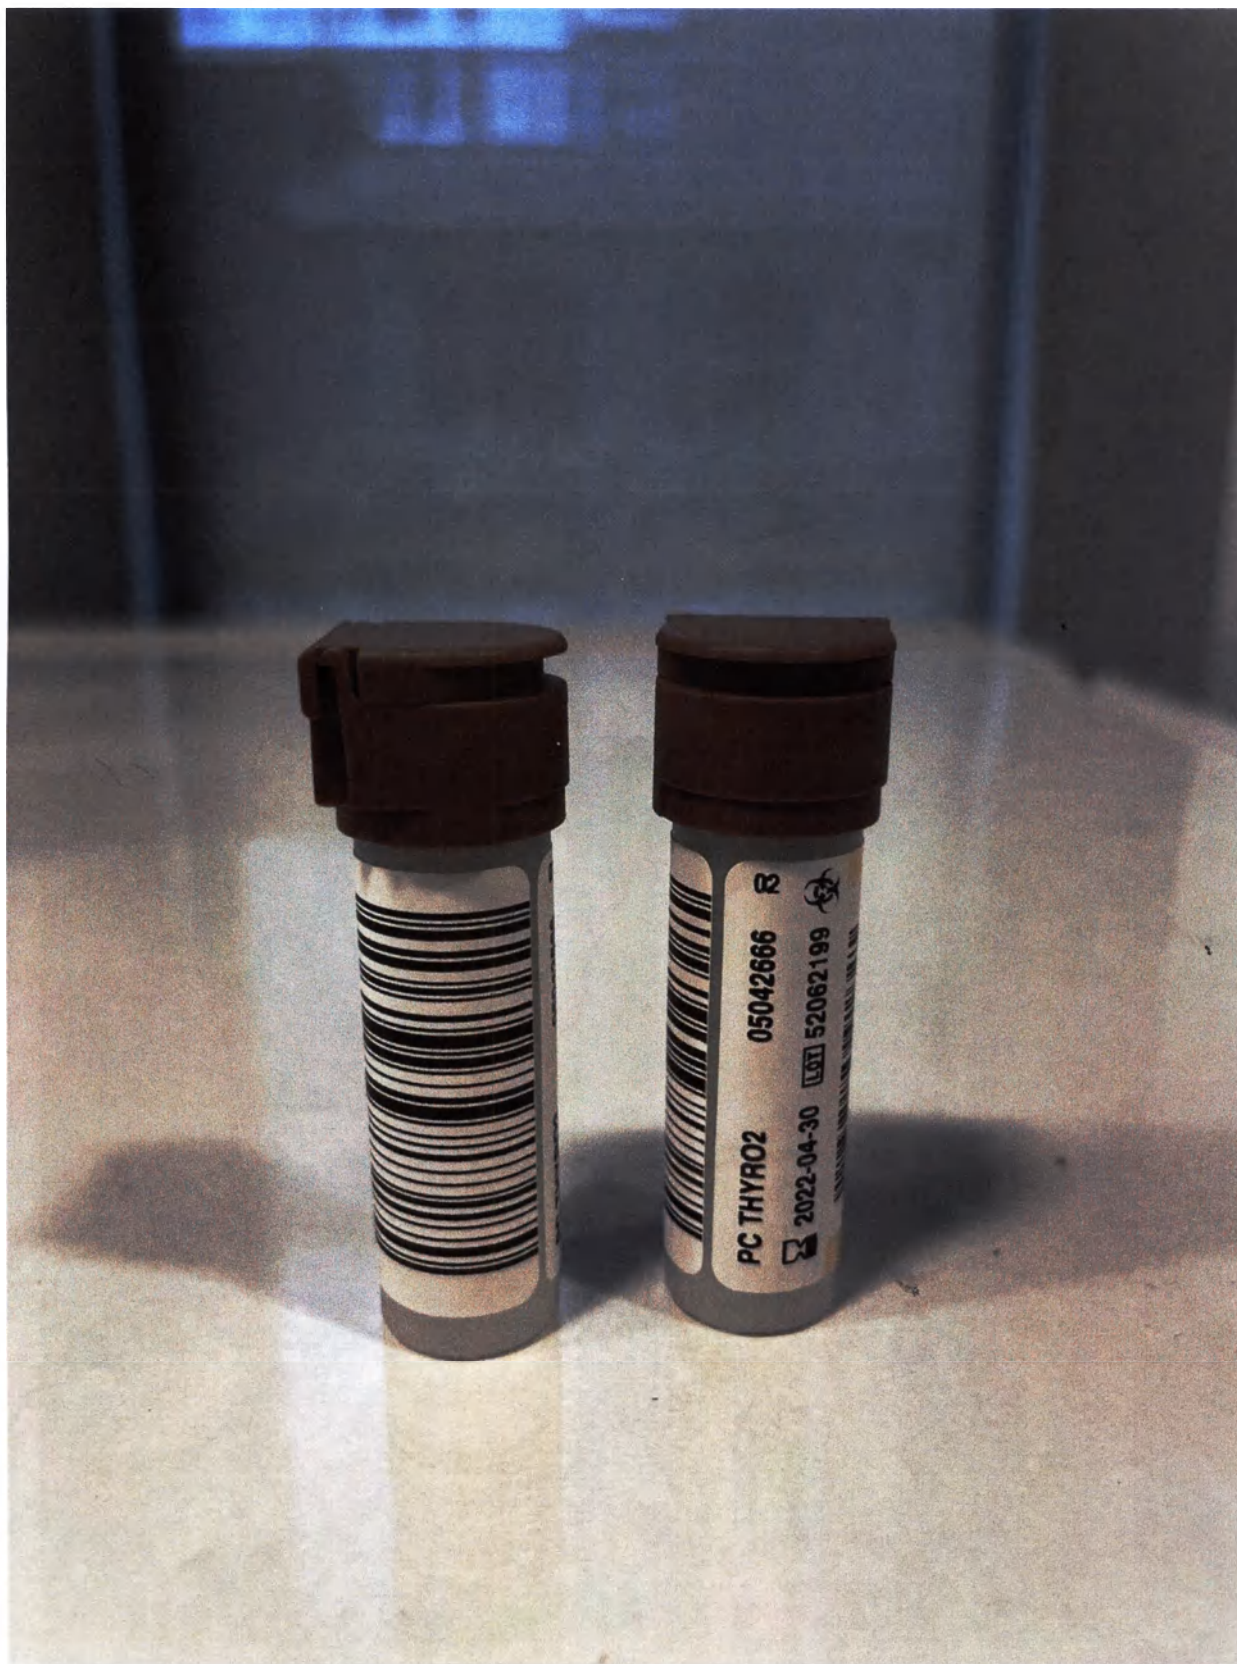


Набор контрольных*сывороток PreciControl ThyroAB для контроля качества определения множества тироидных маркеров, связанных с заболеваниями щитовидной железы иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (PreciControl ThyroAB Elecsys and cobas e analyzers)

6.Этикетка для флакона



Набор контрольных сывороток PreciControl ThyroAB для контроля качества определения множества тиреоидных маркеров, связанных с заболеваниями щитовидной железы иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (PreciControl ThyroAB Elecsys and cobas e analyzers)

7. Инструкция по применению

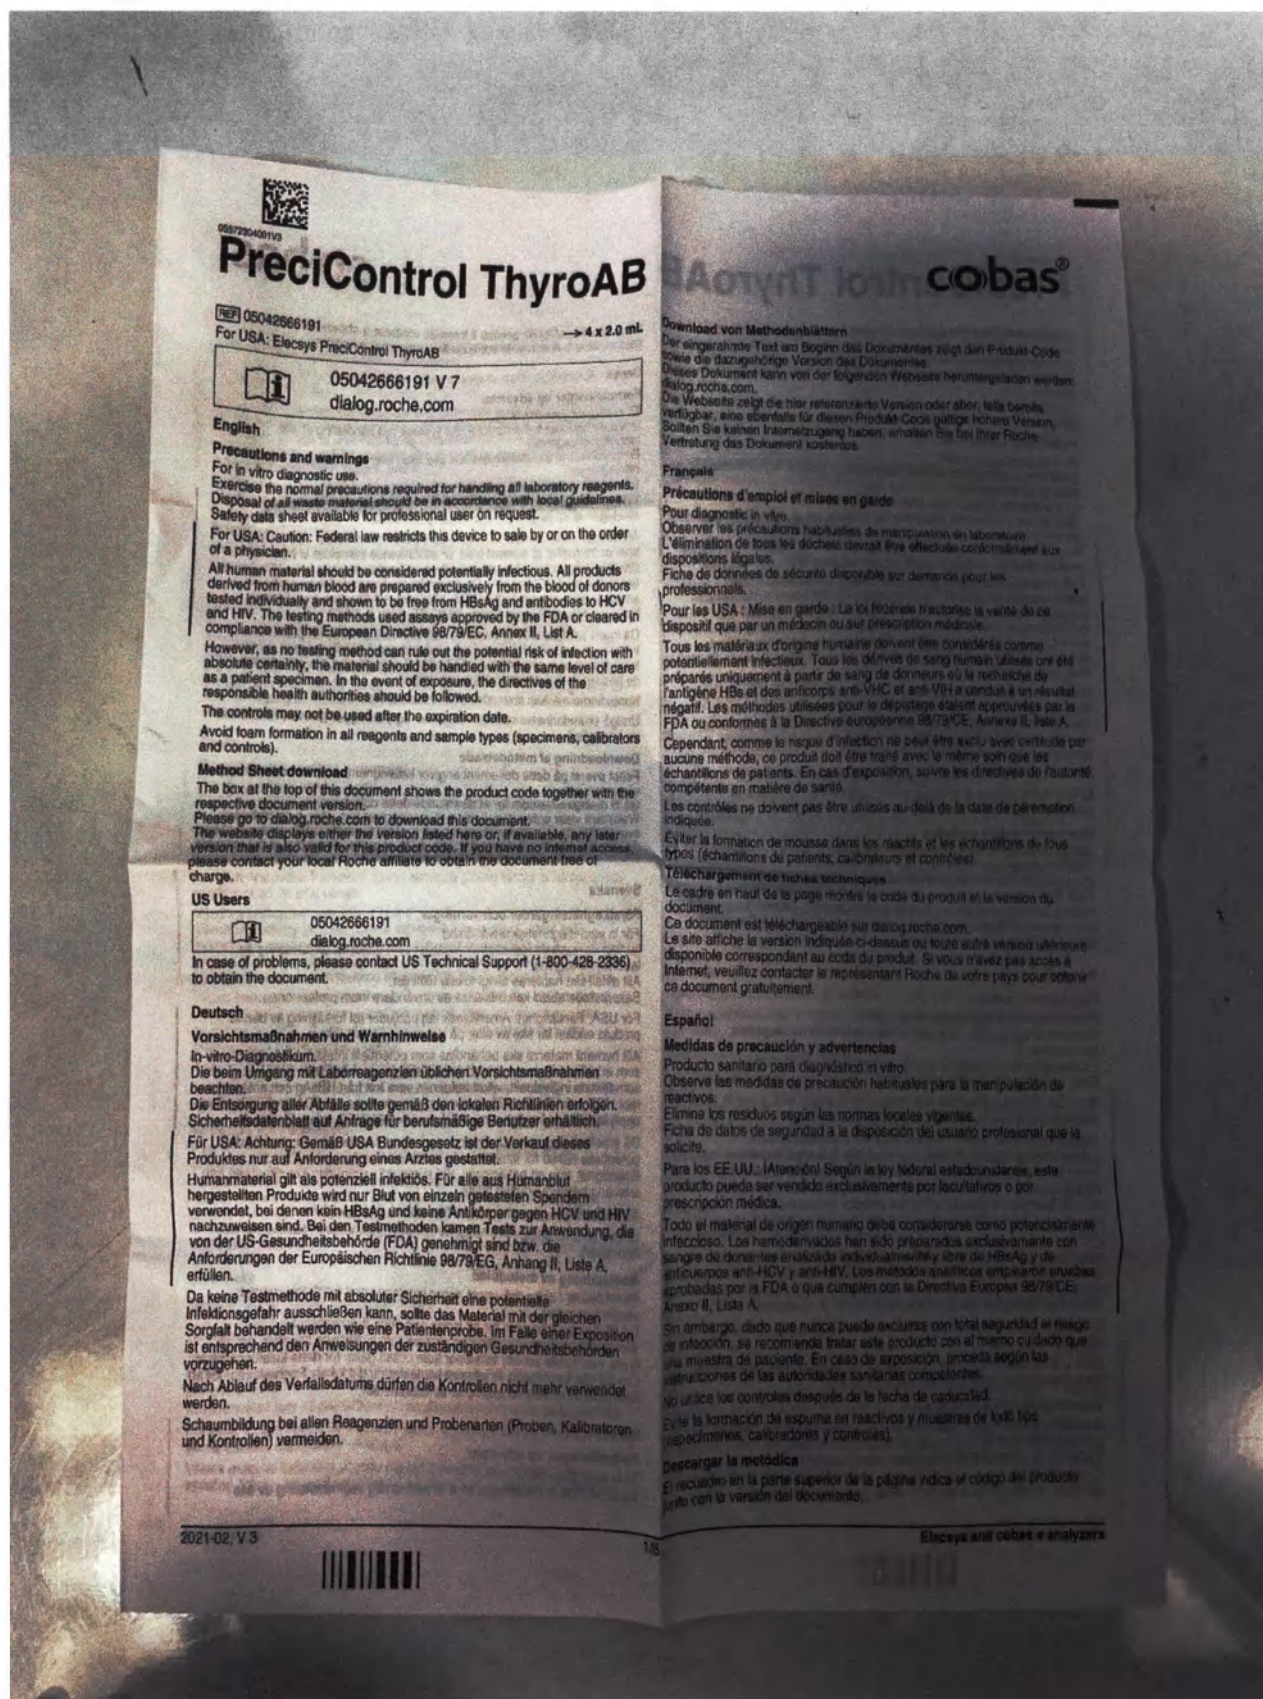

Набор контрольных сывороток PreciControl ThyroAB для контроля качества определения множества тиреоидных маркеров, связанных с заболеваниями щитовидной железы иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (PreciControl ThyroAB Elecsys and cobas e analyzers)

8. Паспорт присвоенных значений



№ 05042666191V42.0

PreciControl ThyroAB

REF 05042666 191

LOT 521750

cobas®

2022-04

Components	Method		PreciControl THYRO1 LOT 520619			PreciControl THYRO2 LOT 520621			Units
			Value	Range	1SD	Value	Range	1SD	
A-TG	Elecsys	e 411 (ACN 710)	69.7	62.8 - 117	8.97	198	139 - 257	19.8	IU/mL = kIU/L
	Anti-Tg 06368697	e 601/e 602 (ACN 133)	91.8	64.3 - 119	9.18	204	143 - 265	20.4	IU/mL = kIU/L
A-TG	Elecsys	e 411 (ACN 710)	98.3*	67.4 - 125	8.63	198	139 - 257	19.8	IU/mL = kIU/L
	Anti-Tg 06368697 LOT 452668								
A-TPO	Elecsys	e 411 (ACN 720)	39.1	27.4 - 50.8	3.91	91.4	72.2 - 111	6.40	IU/mL = kIU/L
	Anti-TPO 06368590	e 601/e 602 (ACN 137)	42.3	29.6 - 55.0	4.23	92.7	73.2 - 112	6.49	IU/mL = kIU/L
A-TPO	Elecsys	e 411 (ACN 720)	43.1*	30.2 - 56.0	4.31	96.9*	76.6 - 117	6.78	IU/mL = kIU/L
	Anti-TPO 06368590 LOT 457021								
A-TPO	Elecsys	e 411 (ACN 720)	46.8**	32.8 - 60.8	4.68	98.8**	78.1 - 120	6.92	IU/mL = kIU/L
	Anti-TPO 06368590 LOT 526585								
A-TSHR	Elecsys	e 411 (ACN 730)	3.17	2.22 - 4.12	0.32	16.8	13.3 - 20.3	1.18	IU/L
	Anti-TSHR 04388780	e 601/e 602 (ACN 266)	3.18	2.23 - 4.13	0.32	16.2	12.8 - 19.6	1.13	IU/L
A-TSHR	Elecsys	e 411 (ACN 1830)	3.26	2.28 - 4.24	0.33	15.7	12.4 - 19.0	1.10	IU/L
	Anti-TSHR 08496609	e 601/e 602 (ACN 488)	3.25	2.28 - 4.23	0.33	15.8	12.5 - 19.1	1.11	IU/L

For translations, see glossary at the end of this document. / Übersetzungen siehe Glossar am Ende des Dokumentes. / Pour connaître les traductions, consulter le glossaire à la fin de ce document. / Para las traducciones consulte el glosario al final de este documento. / Per le traduzioni, vedere il glossario alla fine del presente documento. / Para traduções, ver glossário no fim deste documento. / Veďte, prekladovacie a -se glossár na konci tohto dokumentu. / Prieklad pozri v glosári na konci tohto dokumentu. / Tłumaczenia, patrz słowniczek na końcu dokumentu. / A fordítási táblát a dokumentum végén találhatod foglaltatásban. / Για μεταφράσεις, δείτε το γλωσσάριο στο τέλος του εγγράφου. / Çeviriler için bu belgenin sonunda sözlüğe bakınız. / Se překlady, viz slovníček na konci dokumentu. / За превода, вижте глосария в края на този документ. / Tölgye közt vi káselewa dokumenti lõpus oleval sõnastiku. / Del vertney 22: ho dokumento pabaigje esanti glosarij. / Lai vertnu tulcošanu, skatiet glosariju šī dokumenta beigās. / Для перевода см. глоссарий в конце этого документа. / Pentru traduceri, consultați glosariul de la sfârșitul acestui document. / Переводы наведени у розділі в кінці цього документа.

2021-02, V42.0

1/3

cobas e analyzers



Всего г... нумеровано,
г... (ну) ...зано и
...репли ...печать
...листа (ов)



от 04.02.2021