



Фотографические изображения

**Набор контрольных материалов для контроля качества определения множества
аналитов клинической химии на анализаторах и модулях Roche/Hitachi cobas с и
Cobas Integra (PreciControl ClinChem Multi), варианты исполнения 1, 2, 3, 4**

Набор контрольных материалов для контроля качества определения множества аналитов клинической химии на анализаторах и модулях Roche/Hitachi cobas c и Cobas Integra (PreciControl ClinChem Multi), вариант исполнения 1 (PreciControl ClinChem Multi 1 Roche systems)

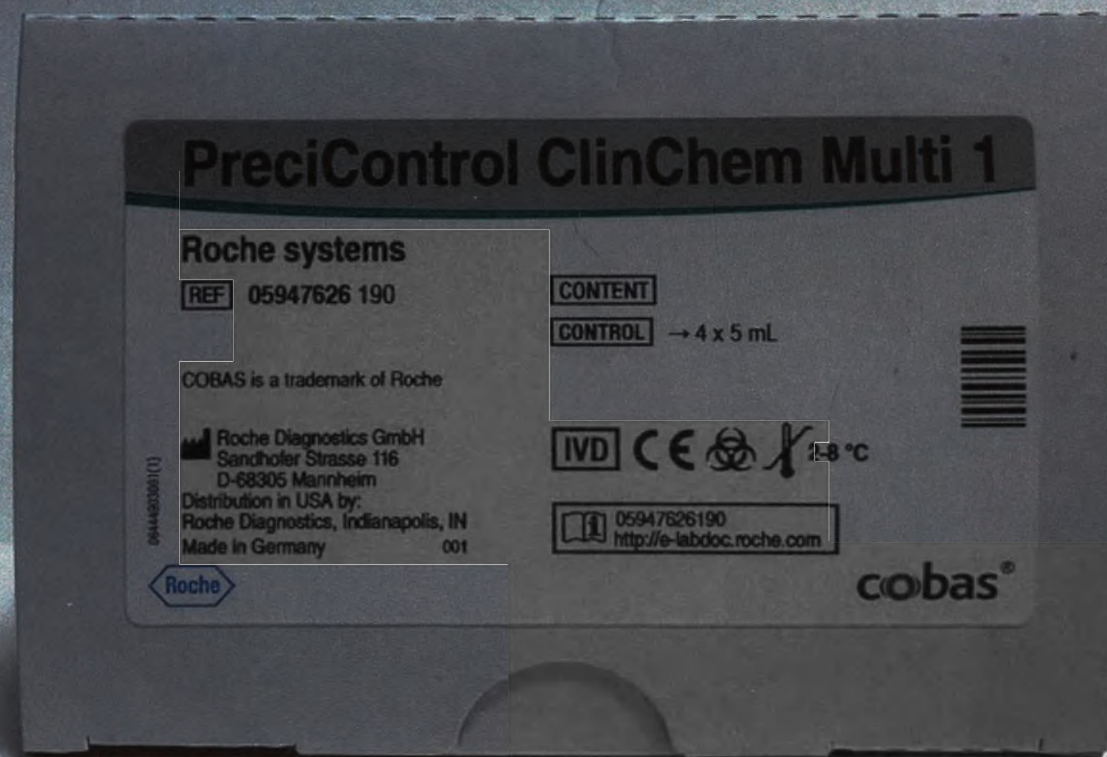

Набор контрольных материалов для контроля качества определения множества аналитов клинической химии на анализаторах и модулях Roche/Hitachi cobas c и Cobas Integra (PeciControl ClinChem Multi), вариант исполнения 1 (PeciControl ClinChem Multi 1 Roche systems)

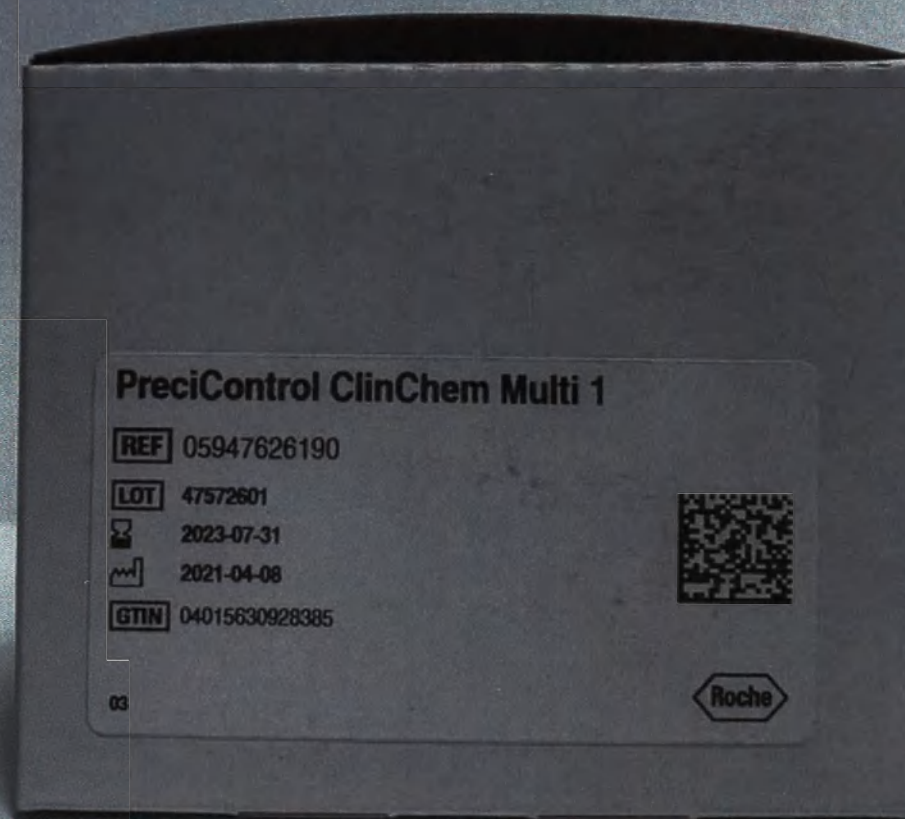

Набор контрольных материалов для контроля качества определения множества аналитов клинической химии на анализаторах и модулях Roche/Hitachi cobas c и Cobas Integra (PreciControl ClinChem Multi), вариант исполнения 1 (PreciControl ClinChem Multi 1 Roche systems)

Набор контрольных материалов для контроля качества определения множества аналитов клинической химии на анализаторах и модулях Roche/Hitachi cobas c и Cobas Integra (PreciControl ClinChem Multi), вариант исполнения 1 (PreciControl ClinChem Multi 1 Roche systems)

Состав:

1. Контрольный материал PreciControl ClinChem Multi 1 во флаконе, 5 мл, 4 шт.
2. Этикетка со значениями, 4 шт.
3. Паспорт ожидаемых значений
4. Инструкция по применению

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок годности см. на упаковке.

Дата производства см. на упаковке.

Температура хранения см. на упаковке.

Номер лота см. на упаковке

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBeAg отсутствуют

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рох Диалгностикс ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim, Germany, Германия

Использование предназначено только для диагностики in-vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рох Диалгностикс Рус» (ООО «Рох Диалгностикс Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception_dia@roche.com

Кат. номер 05947626 190

Набор контрольных материалов для контроля качества определения множества аналитов клинической химии на анализаторах и модулях Roche/Hitachi cobas c и Cobas Integra (PreciControl ClinChem Multi), вариант исполнения 1 (PreciControl ClinChem Multi 1 Roche systems)



Набор контрольных материалов для контроля качества определения множества аналитов клинической химии на анализаторах и модулях Roche/Hitachi cobas c и Cobas Integra (PreciControl ClinChem Multi), вариант исполнения 1 (PreciControl ClinChem Multi 1 Roche systems)



Набор контрольных материалов для контроля качества определения множества аналитов клинической химии на анализаторах и модулях Roche/Hitachi cobas c и Cobas Integra (PeciControl ClinChem Multi), вариант исполнения 1 (PeciControl ClinChem Multi 1 Roche systems)

PCCC1

Control
Codes 391




QC39147572600

cobas 8000
00391



00391020187475726



001

PCCC1

Control
Codes 391




QC39147572600

cobas 8000
00391



00391020188475726



001

PCCC1

Control
Codes 391




QC39147572600

cobas 8000
00391



00391020185475726



001

PCCC1

Control
Codes 391




QC39147572600

cobas 8000
00391



00391020186475726



001

Набор контрольных материалов для контроля качества определения множества аналитов клинической химии на анализаторах и модулях Roche/Hitachi cobas c и Cobas Integra (PreciControl ClinChem Multi), вариант исполнения 1 (PreciControl ClinChem Multi 1 Roche systems)

PreciControl ClinChem Multi 1 cobas®

REF 05947626190, 05117003190, 05117208922

Value sheet

Lot 475726 Ver.1 120 08 2023-07

Roche Diagnostics

VS05947626190_475726INT1400V1

Short name / Component	Method	ACN	Value	Range	1s	Unit
CRP4 C-Reactive Protein	particle enhanced immunoturbidimetric latex Gen 4 serum, plasma	266	8.74 82.7	7.79-11.69 74.1-111.3	0.05 0.2	mg/L mg/L
CRPHS C-Reactive Protein	particle enhanced turbidimetric latex high sensitive serum, plasma	217	10.9 104	9.4-12.4 89-119	0.5 5	mg/L mg/L
CRPLX C-Reactive Protein	particle enhanced turbidimetric latex serum, plasma	19	11.2 107	9.1-13.3 86-128	0.7 7	mg/L mg/L
CK Creatine Kinase	UV asc. to IFCC liquid serum, plasma	550	145 2.42	118-172 1.97-2.87	9 0.15	U/L μkat/L
CKL Creatine Kinase	IFCC liquid serum, plasma	57	145 2.42	118-172 1.97-2.87	9 0.15	U/L μkat/L
CKMB Creatine Kinase-MB	immunobeaded UV liquid serum, plasma	546	42.4 0.708	32.2-52.6 0.537-0.879	3.4 0.057	U/L μkat/L
CKMBL Creatine Kinase-MB	liquid serum, plasma	50	42.4 0.708	32.2-52.6 0.537-0.879	3.4 0.057	U/L μkat/L
CREJ2 Creatinine	2nd Gen 2 compensated serum, plasma	690	80.0 1.05	76.2-109.9 0.87-1.23	5.6 0.08	μmol/L μmol/L
CREP2 Creatinine	1st Gen 2 serum, plasma	632	85.4 0.965	70.1-100.7 0.791-1.139	5.1 0.068	μmol/L μmol/L
GGT-2 gamma-Glutamyltransferase	liquid ver 2 and IFCC serum, plasma	220	54.8 0.912	44.7-64.5 0.747-1.077	3.3 0.055	U/L μkat/L
GGT-2 gamma-Glutamyltransferase	liquid ver 2 and Statx serum, plasma	480	48.4 0.606	38.7-57.1 0.564-0.952	2.9 0.048	U/L μkat/L
GLUC2 Glucose	HK Gen 2 plasma-level hemoglobin	750 ¹	6.45 116	5.49-7.41 88-134	0.32 6	mmol/L mmol/L
GLUC2 Glucose	HK serum, plasma	767	5.81 105	4.94-6.68 90-120	0.29 5	mmol/L mmol/L
GLUH2 Glucose	HK Gen 2 hemoglobin	490 ¹	5.81 105	4.94-6.68 90-120	0.29 5	mmol/L mmol/L
NDLSC4 NDL-Standard	enzymatic colorimetric lat Gen 4 liquid, plasma	434	0.783 20.3	0.594-0.972 23.1-37.5	0.083 2.4	mmol/L mmol/L
IRON2 Iron	FerroZyme Gen 2 serum, plasma	681	18.5 120	15.9-23.1 83-130	1.2 7	μmol/L μmol/L



1720

Набор контрольных материалов для контроля качества определения множества аналитов клинической химии на анализаторах и модулях Roche/Hitachi cobas c и Cobas Integra (PreciControl ClinChem Multi), вариант исполнения 2 (PreciControl ClinChem Multi 1 Roche systems)

PreciControl ClinChem Multi 1

Roche systems

REF 05117003 190

CONTENT

CONTROL → 20 x 5 mL

COBAS is a trademark
of Roche

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
D-68305 Mannheim

Distribution in USA by:
Roche Diagnostics, Indianapolis, IN
Made in Germany 001

IVD CE  2-8 °C

05117003190
<http://e-labdoc.roche.com>

04460000101




cobas®

Набор контрольных материалов для контроля качества определения множества аналитов клинической химии на анализаторах и модулях Roche/Hitachi cobas c и Cobas Integra (PreciControl ClinChem Multi), вариант исполнения 2 (PreciControl ClinChem Multi 1 Roche systems)



Набор контрольных материалов для контроля качества определения множества аналитов клинической химии на анализаторах и модулях Roche/Hitachi cobas c и Cobas Integra (PreciControl ClinChem Multi), вариант исполнения 2 (PreciControl ClinChem Multi 1 Roche systems)

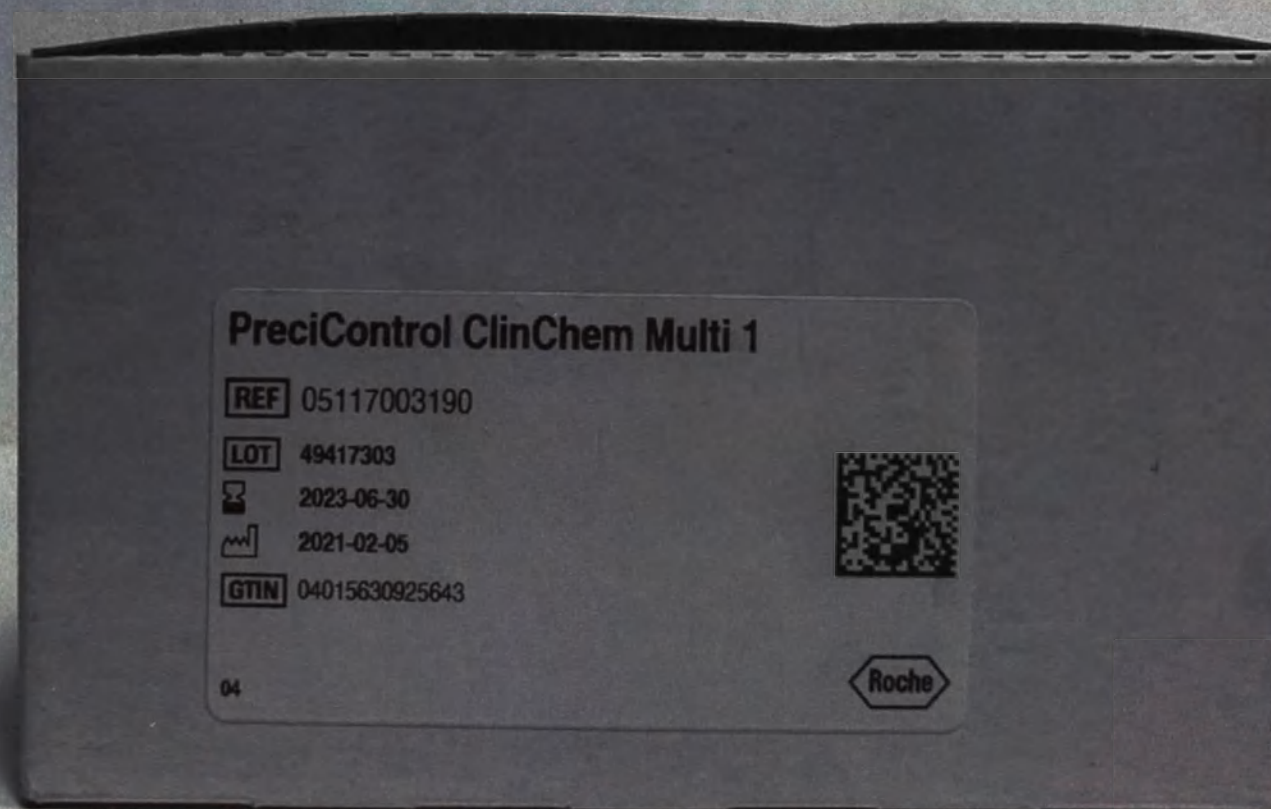

Набор контрольных материалов для контроля качества определения множества аналитов клинической химии на анализаторах и модулях Roche/Hitachi cobas c и Cobas Integra (PreciControl ClinChem Multi), вариант исполнения 2 (PreciControl ClinChem Multi 1 Roche systems)

Набор контрольных материалов для контроля качества определения множества аналитов клинической химии на анализаторах и модулях Roche/Hitachi cobas c и Cobas Integra (PreciControl ClinChem Multi), вариант исполнения 2 (PreciControl ClinChem Multi 1 Roche systems)

Состав:

1. Контрольный материал PreciControl ClinChem Multi 1 по флаконе, 5 мл, 20 шт.
2. Этикетка со штрих-кодами, 20 шт.
3. Паспорт ожидаемых значений
4. Инструкция по применению

Регистрационное удостоверение № ____ от ____

Срок годности см. на упаковке.

Дата производства см. на упаковке.

Температура хранения см. на упаковке.

Номер лота см. на упаковке

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рох Диагностикс ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in-vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рох Диагностика Рус» (ООО «Рох Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубиня площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception_dia@roche.com

Кат. номер 05117003 190

Набор контрольных материалов для контроля качества определения множества аналитов клинической химии на анализаторах и модулях Roche/Hitachi cobas c и Cobas Integra (PreciControl ClinChem Multi), вариант исполнения 2 (PreciControl ClinChem Multi 1 Roche systems)



Набор контрольных материалов для контроля качества определения множества аналитов клинической химии на анализаторах и модулях Roche/Hitachi cobas c и Cobas Integra (PreciControl ClinChem Multi), вариант исполнения 2 (PreciControl ClinChem Multi 1 Roche systems)



Positive outlets

800 420 5711 24/7

[illegible]

Набор контрольных материалов для контроля качества определения множества аналитов клинической химии на анализаторах и модулях Roche/Hitachi cobas c и Cobas Integra (PreciControl ClinChem Multi), вариант исполнения 3 (PreciControl ClinChem Multi 2 Roche systems)

PreciControl ClinChem Multi 2

REF 05947774190

LOT 46159501


 2023-01-31

 2021-11-25

GTIN 04015630928392



03



Набор контрольных материалов для контроля качества определения множества аналитов клинической химии на анализаторах и модулях Roche/Hitachi cobas с и Cobas Integra (PreciControl ClinChem Multi), вариант исполнения 3 (PreciControl ClinChem Multi 2 Roche systems)



Набор контрольных материалов для контроля качества определения множества аналитов клинической химии на анализаторах и модулях Roche/Hitachi cobas c и Cobas Integra (PreciControl ClinChem Multi), вариант исполнения 3 (PreciControl ClinChem Multi 2 Roche systems)



Набор контрольных материалов для контроля качества определения множества аналитов клинической химии на анализаторах и модулях Roche/Hitachi cobas c и Cobas Integra (PreciControl ClinChem Multi), вариант исполнения 3 (PreciControl ClinChem Multi 2 Roche systems)



Набор контрольных материалов для контроля качества определения множества аналитов клинической химии на анализаторах и модулях Roche/Hitachi cobas c и Cobas Integra (PreciControl ClinChem Multi), вариант исполнения 3 (PreciControl ClinChem Multi 2 Roche systems)

Набор контрольных материалов для контроля качества определения множества аналитов клинической химии на анализаторах и модулях Roche/Hitachi cobas c и Cobas Integra (PreciControl ClinChem Multi), вариант исполнения 3 (PreciControl ClinChem Multi 2 Roche systems)

Состав:

1. Контрольный материал PreciControl ClinChem Multi 2 по флакону, 5 мл, 4 шт.
2. Этикетки со штрих-кодами, 4 шт.
3. Паспорт овладениям значений
4. Инструкция по применению

Регистрационное удостоверение № ____ от ____

Срок годности см. на упаковке.

Дата производства см. на упаковке.

Температура хранения см. на упаковке.

Номер лота см. на упаковке.

Антитела к ВИЧ 1, 2 и маркеры гепатита С и HBsAg отсутствуют

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рох Диагностикс ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim, Germany, Германия

Идентификация предназначена только для диагностики in-vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рох Диагностикс Рус» (ООО «Рох Диагностикс Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: konsoledation_ru@roche.com

Кат. номер 05947774 190

Набор контрольных материалов для контроля качества определения множества аналитов клинической химии на анализаторах и модулях Roche/Hitachi cobas c и Cobas Integra (PreciControl ClinChem Multi), вариант исполнения 4 (PreciControl ClinChem Multi 2 Roche systems)



PreciControl ClinChem Multi 2

REF 05117216190

LOT 46159701


 2023-01-31


 2021-02-01

GTIN 04015630925667



03



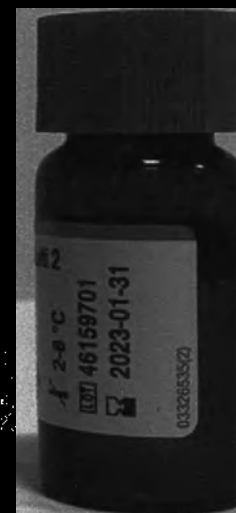

Набор инструментов предназначен для контроля качества обработки поверхности
внутренней канавочной части на шлифовальном станке. В комплект входит:
Область 1 (ProfiControl ClaClean Model), набор инструментов 4 (ProfiControl
ClaClean Model 2 Bebe system)

Состав:

1. Контрольный шаблон ProfiControl ClaClean Model 2 по фланцу, 5 мм, 20 шт.
2. Штанга со штифтами, 20 шт.
3. Штанга с окладом, 20 шт.
4. Штанга по обработке

Регистрационное удостоверение № _____

Срок годности от даты изготовления:

Линейный срок годности от даты изготовления:

Температурный срок годности от даты изготовления:

История от даты изготовления:

Адрес: 115, Д-4505 Мельник, Германия, Германия

История от даты изготовления: 115, Д-4505 Мельник, Германия, Германия

История от даты изготовления: 115, Д-4505 Мельник, Германия, Германия

История от даты изготовления: 115, Д-4505 Мельник, Германия, Германия

История от даты изготовления: 115, Д-4505 Мельник, Германия, Германия

История от даты изготовления: 115, Д-4505 Мельник, Германия, Германия

История от даты изготовления: 115, Д-4505 Мельник, Германия, Германия

История от даты изготовления: 115, Д-4505 Мельник, Германия, Германия

История от даты изготовления: 115, Д-4505 Мельник, Германия, Германия

История от даты изготовления: 115, Д-4505 Мельник, Германия, Германия

История от даты изготовления: 115, Д-4505 Мельник, Германия, Германия

История от даты изготовления: 115, Д-4505 Мельник, Германия, Германия

История от даты изготовления: 115, Д-4505 Мельник, Германия, Германия

История от даты изготовления: 115, Д-4505 Мельник, Германия, Германия

История от даты изготовления: 115, Д-4505 Мельник, Германия, Германия

История от даты изготовления: 115, Д-4505 Мельник, Германия, Германия

История от даты изготовления: 115, Д-4505 Мельник, Германия, Германия

История от даты изготовления: 115, Д-4505 Мельник, Германия, Германия

История от даты изготовления: 115, Д-4505 Мельник, Германия, Германия

История от даты изготовления: 115, Д-4505 Мельник, Германия, Германия

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью

24 листа (ов)



по доверенности
от 04.02.2021