

Фотографические изображения

Фото.1 Хронокардиограф «Скрин-Варио» (измеритель R-R интервалов для оценки вариабельности сердечного ритма (ВСР)) по ТУ 26.60.12-013-61357271-2019. Общий вид.



Фото.2 Хронокардиограф «Скрин-Варио» (измеритель R-R интервалов для оценки вариабельности сердечного ритма (ВСР)) по ТУ 26.60.12-013-61357271-2019. Вид сверху.



Фото.3 Хронокардиограф «Скрин-Варно» (измеритель R-R интервалов для оценки вариабельности сердечного ритма (ВСР)) по ТУ 26.60.12-013-61357271-2019. Вид слева.



Фото.4 Хронокардиограф «Скрин-Варно» (измеритель R-R интервалов для оценки вариабельности сердечного ритма (ВСР)) по ТУ 26.60.12-013-61357271-2019. Вид справа.



**Фото.5 Хронокардиограф «Скрин-Варио» (измеритель R-R интервалов для оценки
вариабельности сердечного ритма (ВСР)) по ТУ 26.60.12-013-61357271-2019 Вид сзади.**



Комплектующие Хронокардиографа «Скрин-Варио» (измерителя R-R интервалов для оценки вариабельности сердечного ритма (ВСР)) по ТУ 26.60.12-013-61357271-20199:

Фото.6 Электроды с кабелем

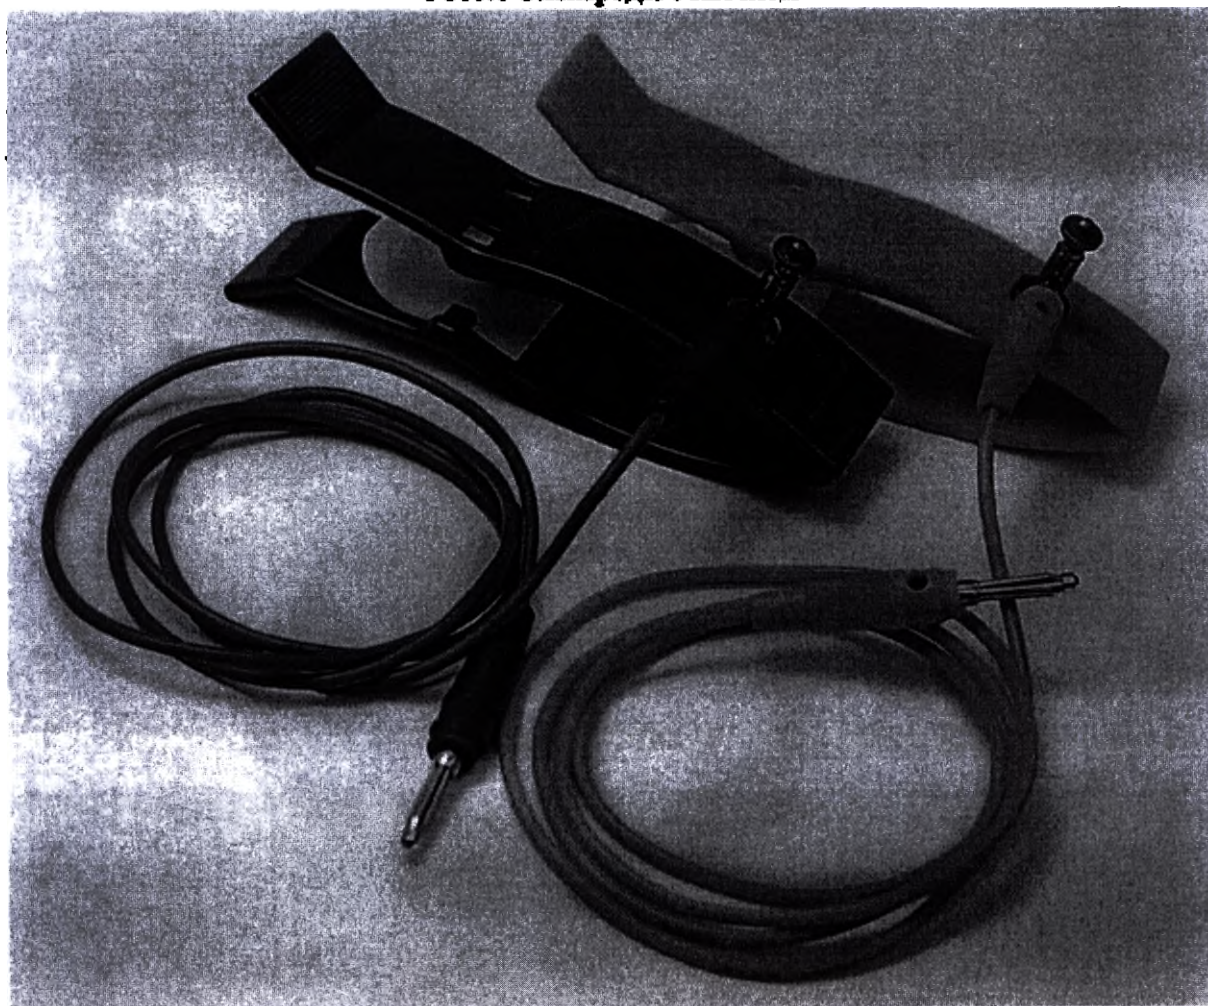


Фото.7 Кабели электродов

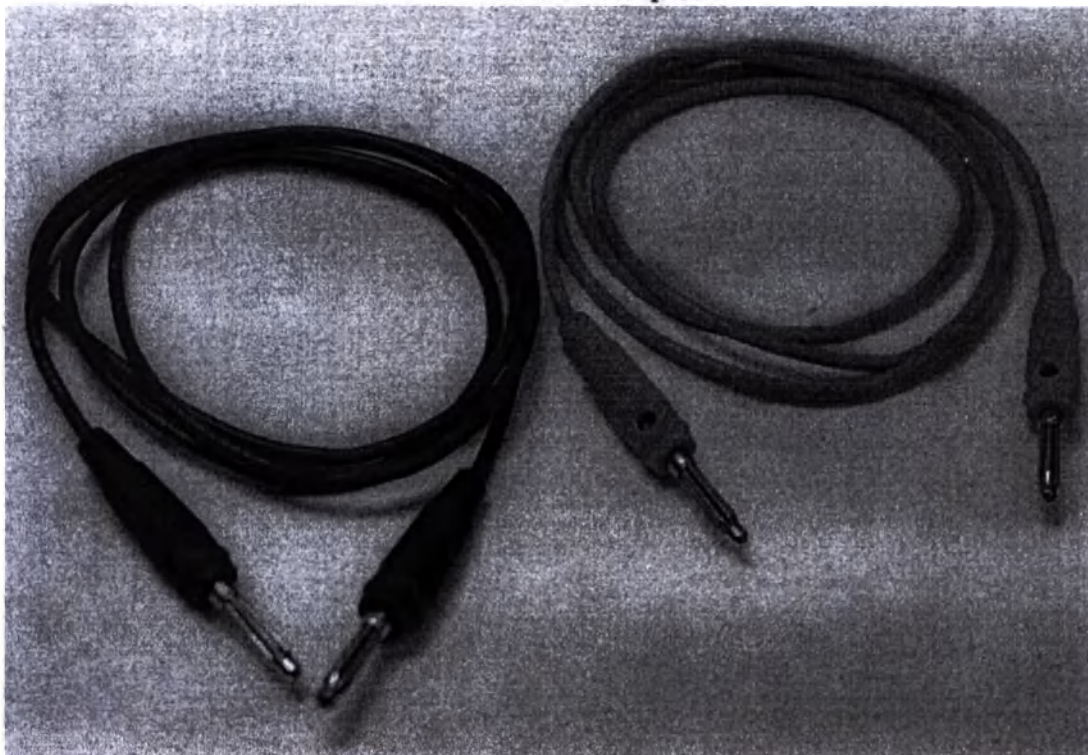


Фото.8 Штекер кабеля для подсоединения электрода и соединения с хронокардиографом.

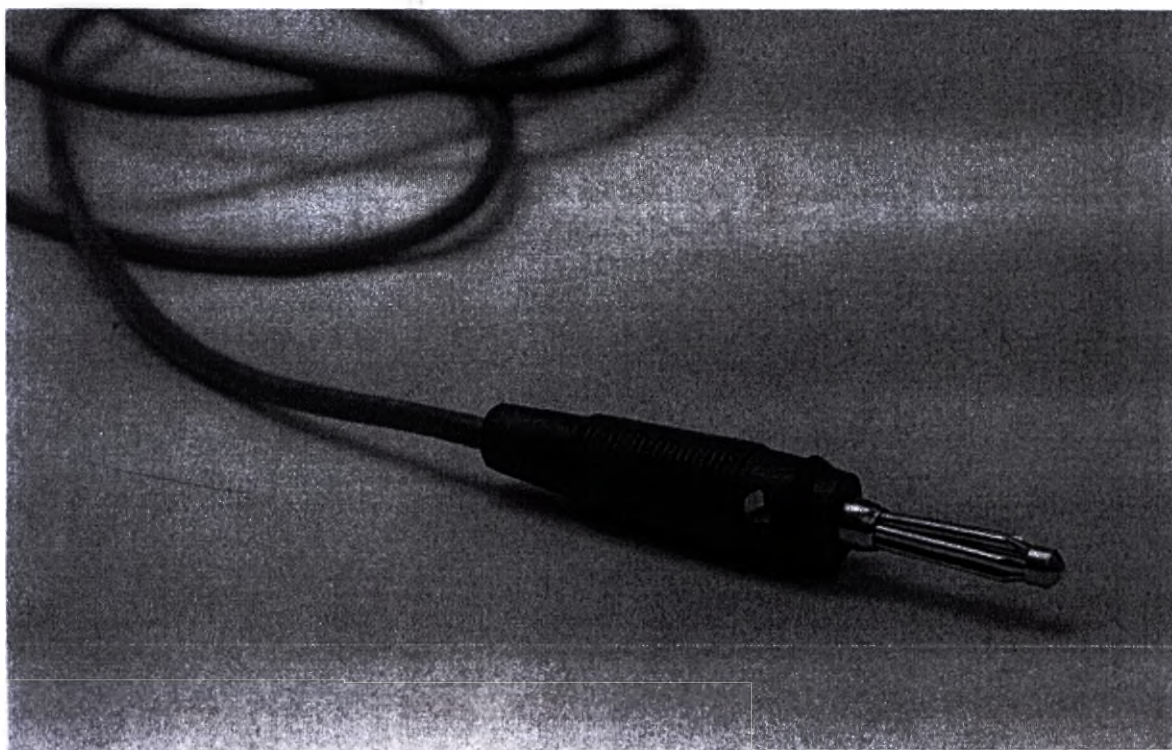


Фото.9 Электроды

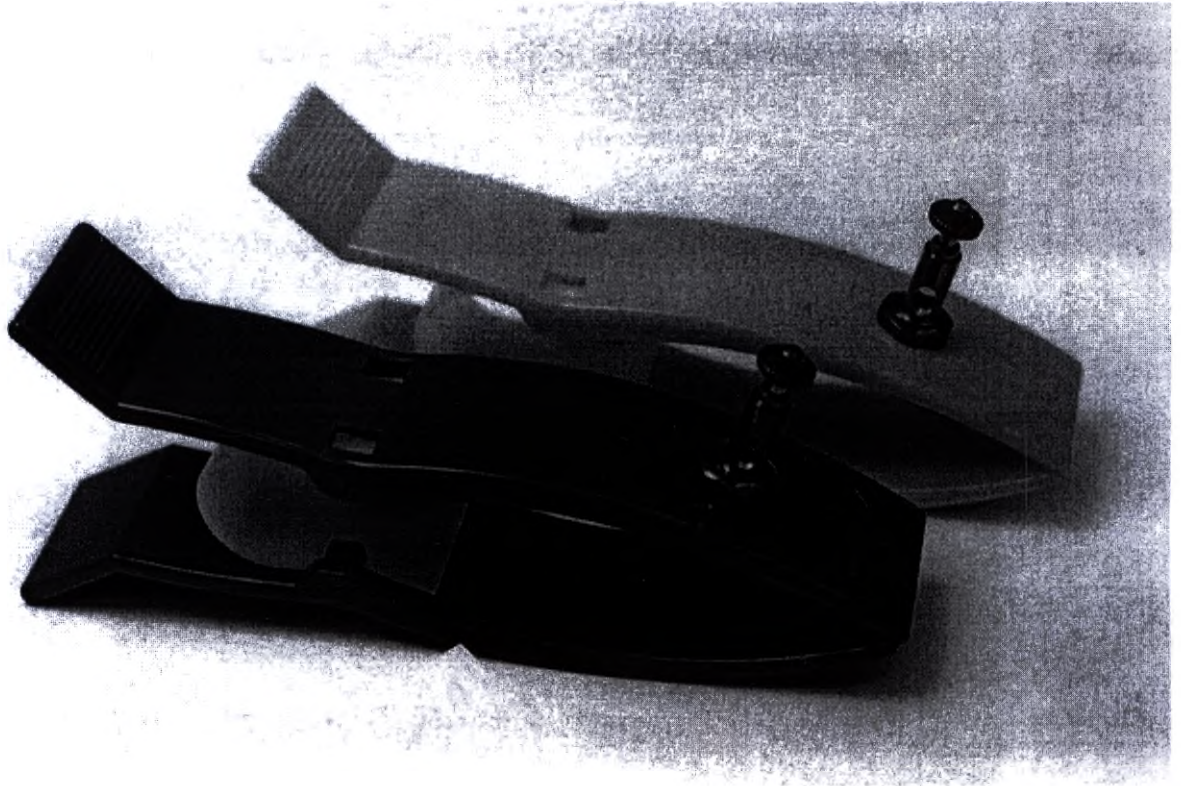


Фото. 10 Flash-диск с программным обеспечением (производитель может отличаться)



Фото 11. Шнур USB – microUSB. Общий вид.



Фото 12. Шнур USB – microUSB. Штекеры.



Фото 13. Фотографическое изображение образца маркировки (этикетки) хронокардиографа

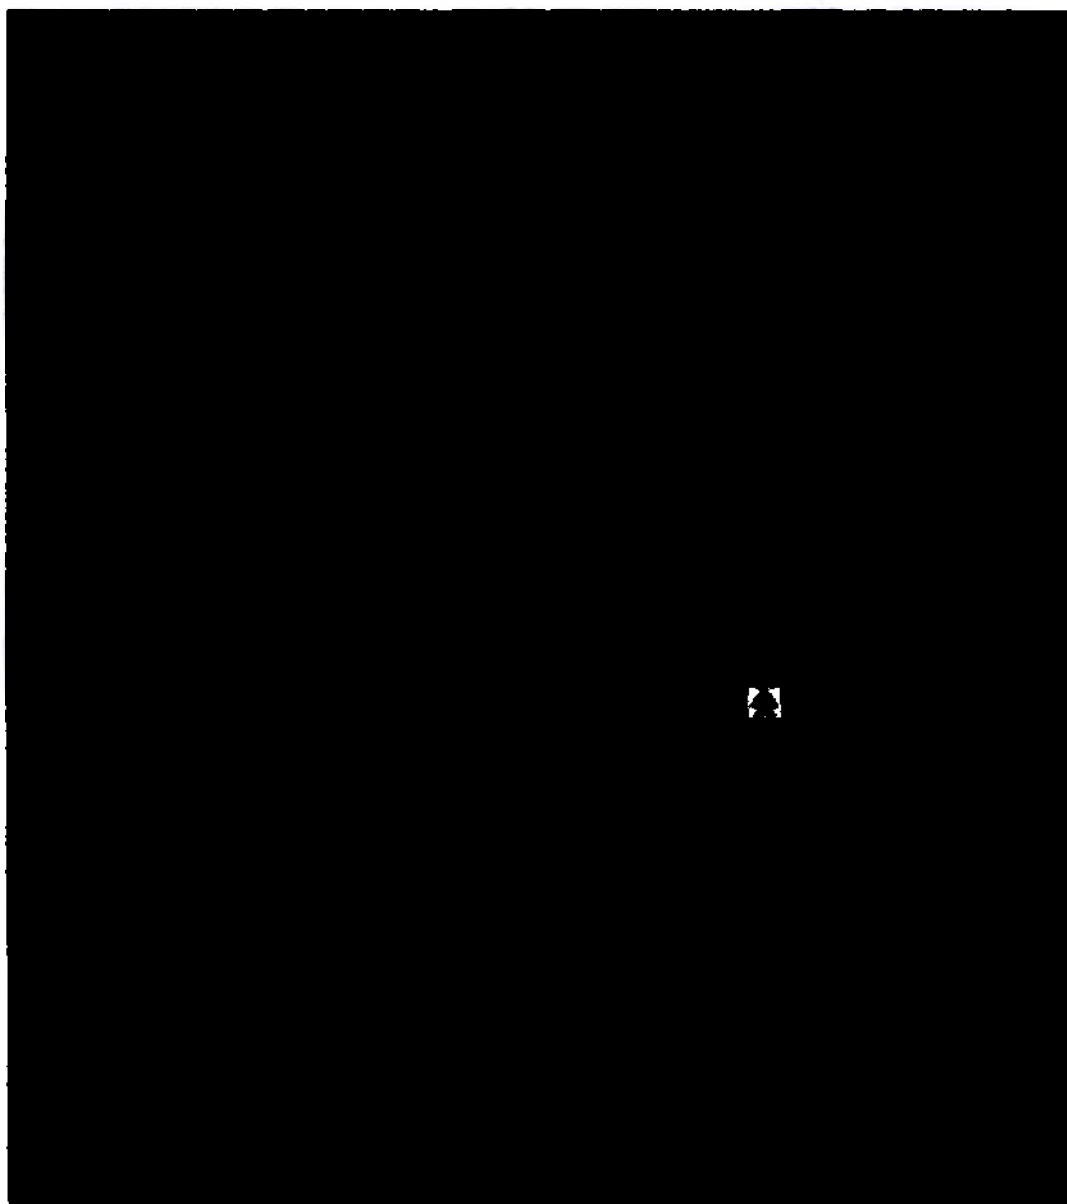


Фото 14. Фотографическое изображение образца маркировки на упаковках электродов:

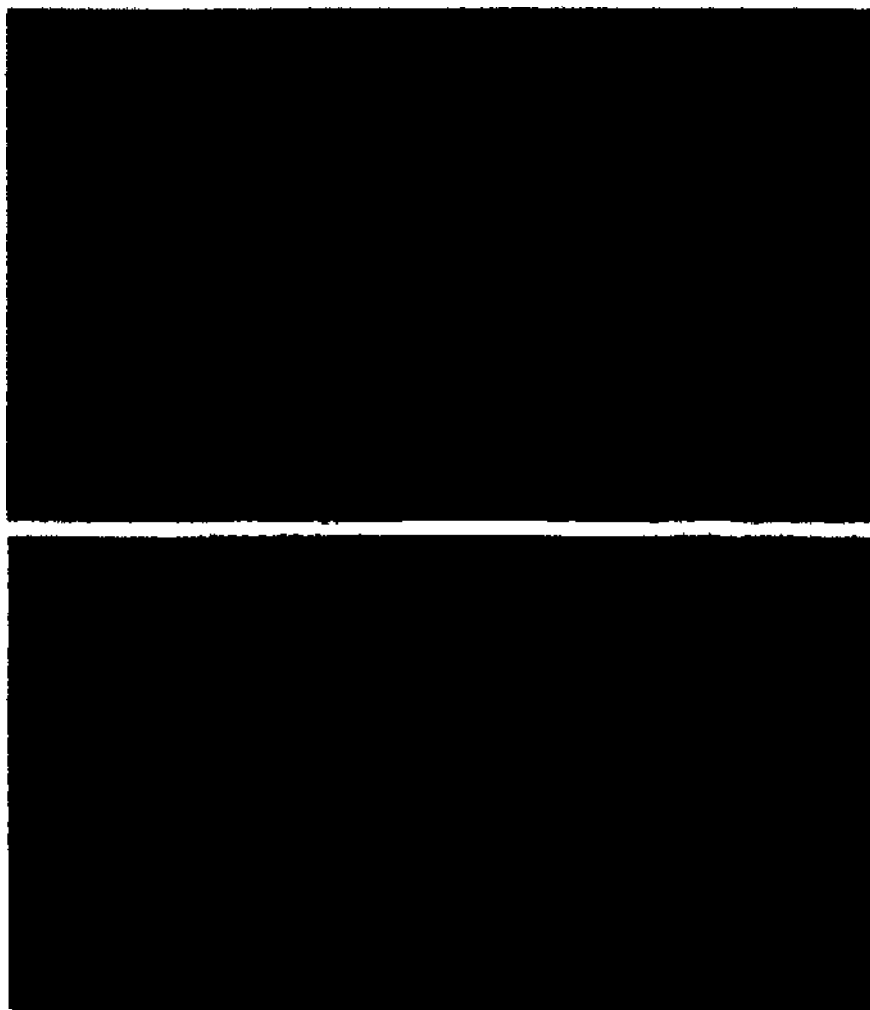


Фото 15. Фотографическое изображение образца транспортной маркировки (этикетки) хронокардиографа

Хронокардиограф «Скрин-Варио»

(измеритель R-R интервалов для оценки вариабельности сердечного ритма (BСР))

ТУ 26.60.12-013-61357271-2019



ООО "АФС52"

603057, Нижний Новгород,

просп. Гагарина, 50, Литера А1

Тел. +7 (831) 214-12-40

Сайт: afs52.ru

Сделано в России

