

Общество с ограниченной ответственностью

«ДГМ ФАРМА АППАРАТЕ РУС»

Россия, 121614, г. Москва, ул. Крылатские холмы, д. 30, корп. 9

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия:

Индикаторы контроля процесса паровой, газовой (оксидом этилена и парами формальдегида), плазменной и воздушной стерилизации марки «DGM Steriguard»

Утверждаю

Генеральный директор Г.А.Бордюгов



I. Индикаторы контроля процесса паровой стерилизации марки «DGM Steriguard»

1. Рулон индикаторный для контроля медицинской паровой стерилизации марки «DGM Steriguard» (класс 1) от 18 мм х 50 м до 25 мм х 50 м

Варианты исполнения:





DGM

Steriguard

Рулон индикаторный для паровой стерилизации 19mm * 50m, 48 шт в коробке

Autoclave Tape Steam 19mm * 50m, 48/case

Изготовлена 05.2016, годность до 11.2018, Лот 566127

Mfg. Date: 05.2016, Exp. Date: 11.2018, Lot No: 566127

Производитель: ДГМ Фарма Apparate Handel AG

Отгрузка: 36-04 Скилман Ав, Лонг Айленд Сити, Нью-Йорк, 11101 США

Представитель в РФ: ООО «Фармстандарт-Медтехника»

Producer: DGM Pharma-Apparate Handel Ag

Shipped from: 36-04 Skillman Av., Long Island City, NY 11101, USA

РУ ФСЗ №2012/12553 ОТ 12.10.2015



2. Комбинированные индикаторные самоклеящиеся этикетки для паровой стерилизации класс 1

DGM

Steriguard®



ПАР

STEAM



Оператор

Загрузка

Отделение

Дата стерилизации / Использовать до

Стерилизатор

www.dgm.su

После стерилизации/After process: Черный/Black

ГОСТ ISO 11140-1

Производитель:

DGM Pharma-Apparate Handel AG.
Baarerstrasse 8, Zug
Switzerland

Представитель в РФ:

ООО «Фармстандарт-Медтехника»
Российская Федерация
141700 Московская обл.
Г. Долгопрудный, Лихачевский
проезд, д. 5»Б»
Тел.: (495)7393948

Завод-изготовитель:

Propper Manufacturing
Company, Inc., 36-04 Skillman
Ave, Long Island City, New
York, 11101, USA.

Сделано в США**Quantity / Количество:** 100 шт.The logo features the letters "DGM" in a bold, italicized, red sans-serif font, followed by the word "Steriguard" in a black serif font with a registered trademark symbol (®) to its upper right.**Lot:****Exp.:**

**Комбинированные индикаторные
самоклеящиеся этикетки для
паровой стерилизации марки
"DGM Steriguard" класс 1**

ПУ ФСЗ №2012/12553 ОТ 12.10.2015

3. Индикатор теста Бови-Дик контрольный (пакет-укладка разовый)

Варианты исполнения :




DGM Steriguard®

**BOWIE AND DICK TEST STEAM
ИНДИКАТОР ТЕСТА БОВИ-ДИК**


**для паровых стерилизаторов с вакуумной
системой удаления воздуха из камеры**

Пакет укладка, одноразовая

134°C - 3,5 мин



ГОСТ Р ИСО 11140-1, Класс 2
ГОСТ Р ИСО 11140-4



Условия хранения до
стерилизации и после



Lot

Дата теста:



Аппарат №:

DGM Pharma-Apparate Handel AG
Baarerstrasse 8, Zug,
Switzerland
Made in USA / Сделано в США

Продает:
ООО "ДГМ Фарма-Аппарате РУС"
121614 Москва, ул. Крылатские холмы,
д. 30, корп. 9, тел.: (495) 739-39-49

PGM Steriguard

BOWIE AND DICK TEST STEAM

Индикатор теста Бови-Дика для
паровой стерилизации (134°C - 3,5 мин.)

LOT: D G 1 2



ДАТА

ЦИКЛ №

АППАРАТ №

КОНТРОЛЕР

ОПЕРАТОР

МЕСТО

ОТДЕЛЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТ

DGM Steriguard®

**BOWIE AND DICK TEST STEAM
ИНДИКАТОР ТЕСТА БОВИ-ДИК**

для паровых стерилизаторов с вакуумной
системой удаления воздуха из камеры

Пакет укладка, одноразовая

134°C - 3,5 мин

ПАР

DGM Steriguard®

ПАР



Условия хранения до
стерилизации и после



ГОСТ ISO 11140-1, Класс 2
ГОСТ ISO 11140-4



2016-10

Lot

F1234



2019-04



DGM Pharma Apparate Handel Ag
Baarerstrasse 8 Zug
Switzerland


Made in USA Сделано в США
Rev 05.16

Представитель в РФ
ООО Фармстандарт Медтехника
141700 Московская область
г. Долгопрудный
Лихачевский проезд д. 3 «Б»
Тел. (495) 759-3948

4. Индикатор химический одноразовый для контроля процесса паровой стерилизации марки «DGM Steriguard» класс 4 Тип А для использования внутри и снаружи упаковки:

121°C – 20 мин., 126°C – 10 мин., 134°C – 5 мин.

Варианты исполнения:

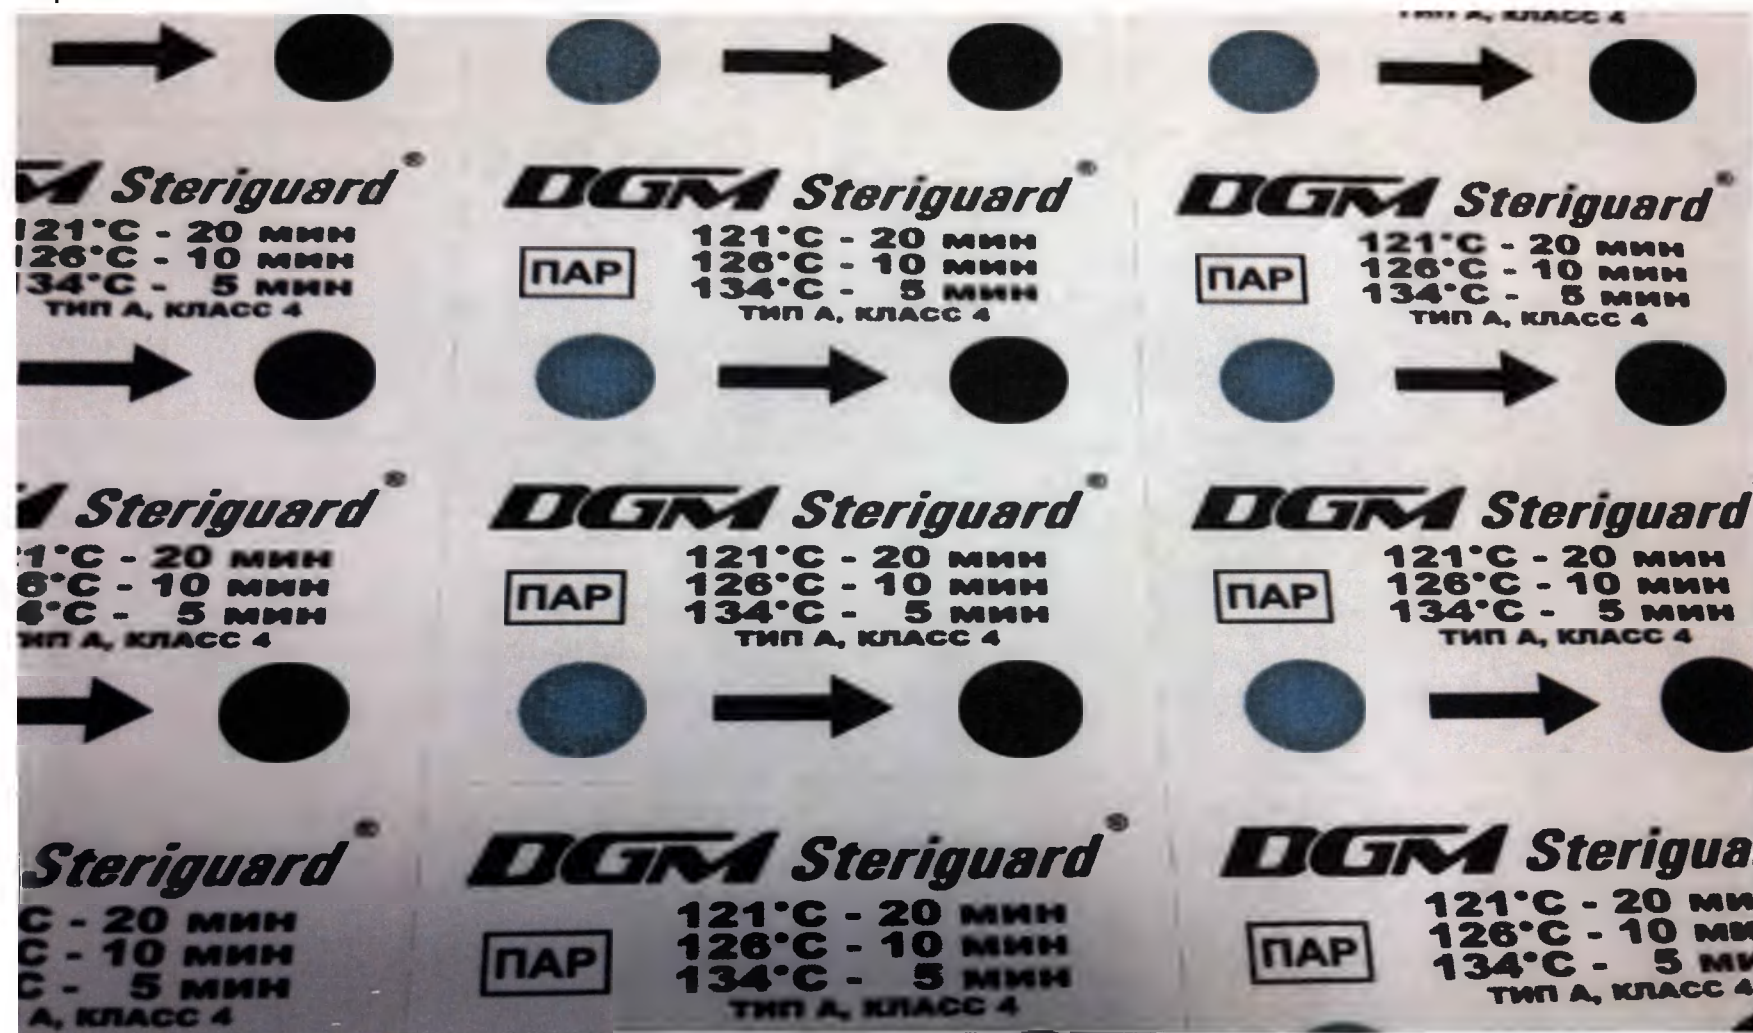

DGM Steriguard®

ПАР

121°C - 20 мин

126°C - 10 мин

134°C - 5 мин

ТИП А, КЛАСС 4



DGM Steriguard®

ПАР

121°C - 20 мин

126°C - 10 мин

134°C - 5 мин

ТИП А, КЛАСС 4



DGM Steriguard®

ПАР

121°C - 20 мин

126°C - 10 мин

134°C - 5 мин

ТИП А, КЛАСС 4



DGM Steriguard®

ПАР


121°C - 20 мин

126°C - 10 мин

134°C - 5 мин

ТИП А, КЛАСС 4



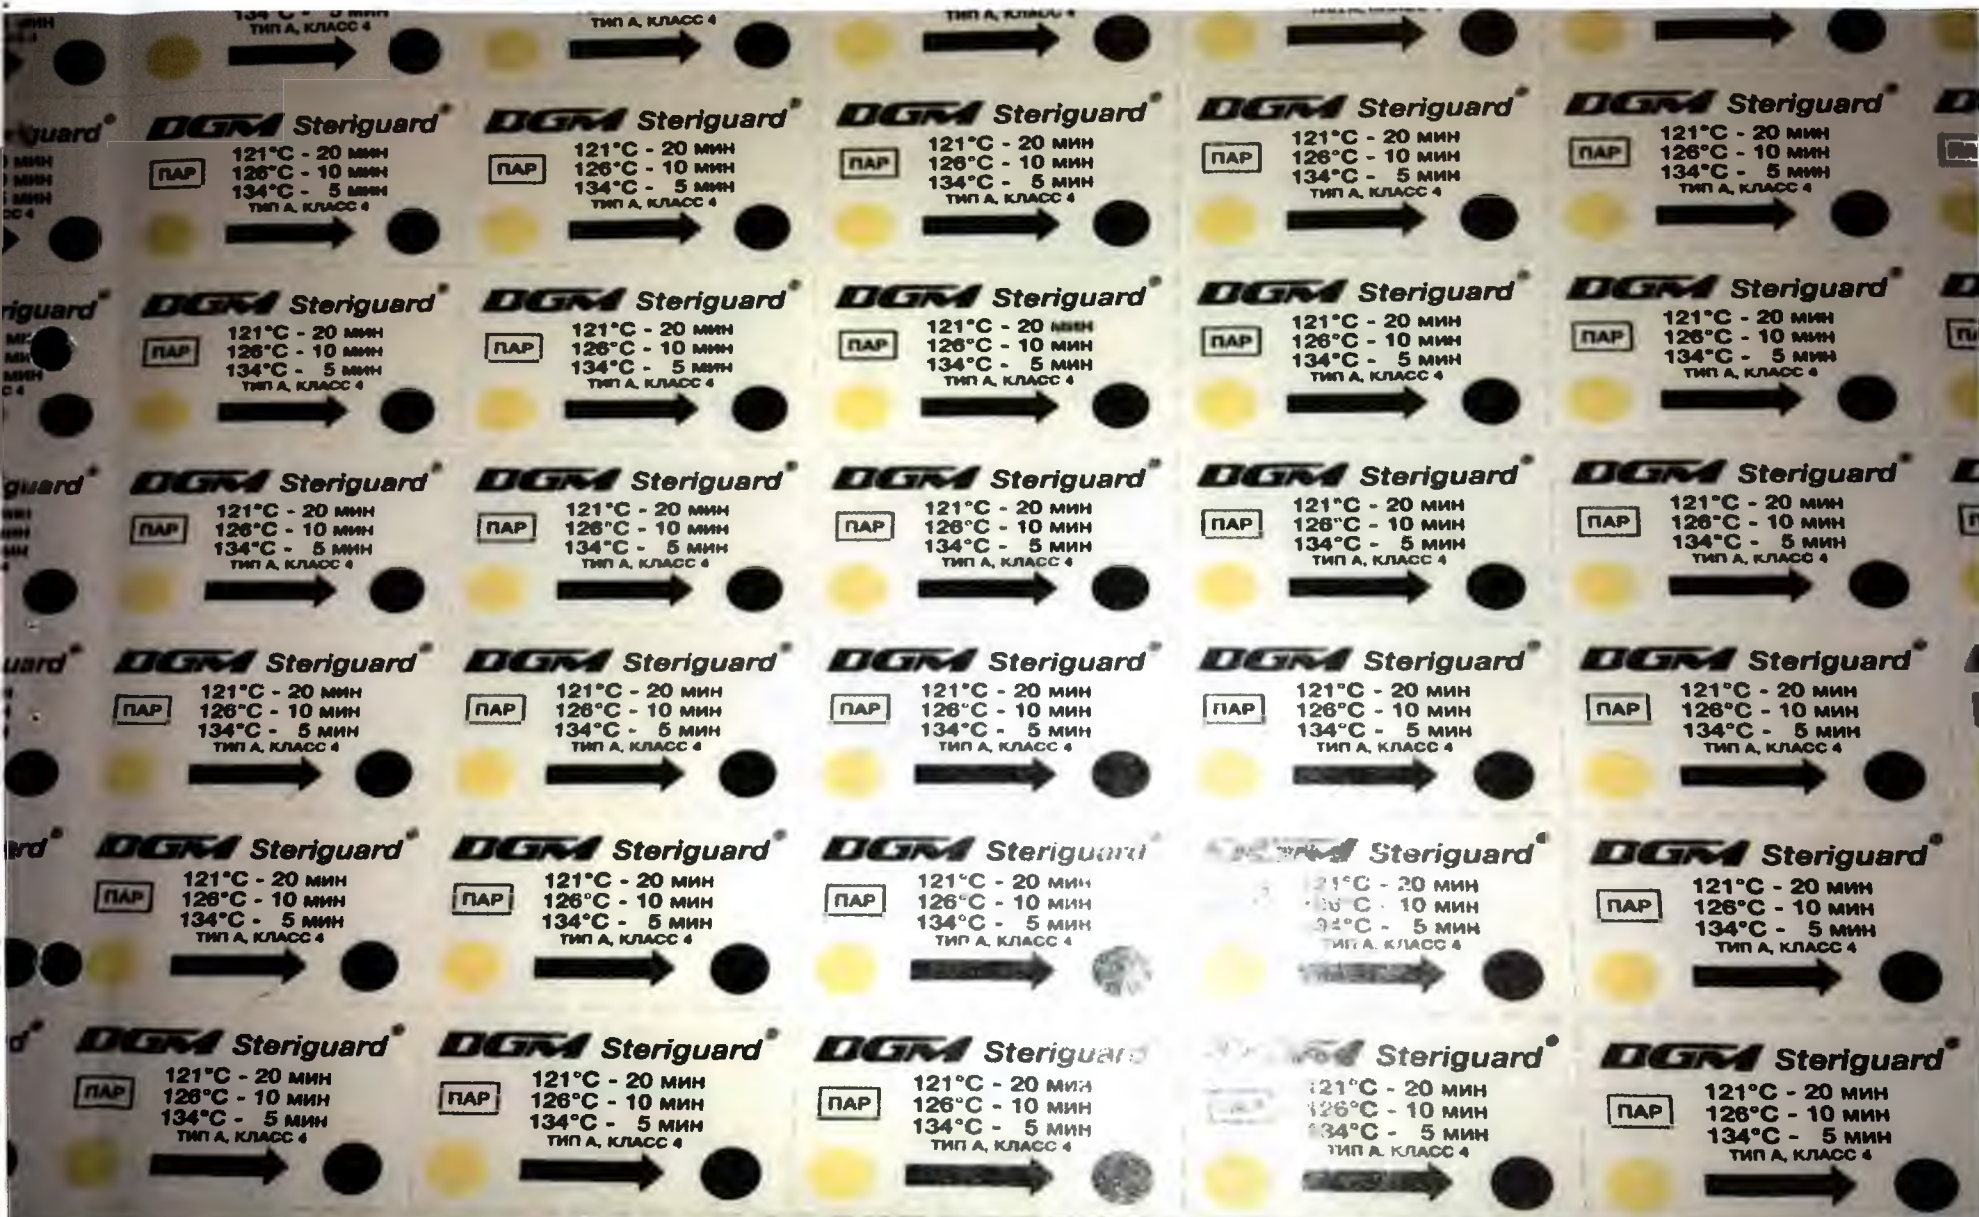



Производитель:
DGM Pharma-Apparate Handel AG
Baarerstrasse 8, Zug, Switzerland


Представитель в РФ:
ООО «Фармстандарт-Медтехника»
Российская Федерация
141700, Московская область,
г. Долгопрудный, Лихачевский проезд,
д. 5 «Б»
Тел.: (495)739-39-48

Сделано в России

Изготовитель:
ООО «ДГМ ФАРМА АППАРАТЕ РУС»
142105, Московская область, г. Подольск,
ул. Большая Серпуховская, 57 А

LOT-RUS04
2015.10.10
Exp 2020.10

Условия хранения
до стерилизации и после



- не использовать после
истечения срока годности
- хранить в прохладном
сухом месте, защищенном от
света в исходной упаковке
(конверте)

1000 шт./ pcs.

ПУ ФСЗ №2012/12553 от 12.10.2015

DGM Steriguard®

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ CHEMICAL INDICATOR КЛАСС 4, ТИП А

Индикатор химический, одноразовый, Типа А, предназначен для контроля соблюдения критических параметров паровой стерилизации: температуры, времени выдержки и наличия водяного насыщенного пара, в стерилизационной камере, а также внутри упаковок, в паровых стерилизаторах с удалением воздуха из стерилизационной камеры методом многоступенчатого вакуумирования.

Индикаторы Типа А могут использоваться во всех паровых стерилизаторах при циклах стерилизации 121°C, 126°C или 134°C. При расположении индикатора внутри упаковки рекомендуется, чтобы лицевая сторона индикатора располагалась в предполагаемой точке, наиболее трудной для проникновения пара.

После проведения цикла стерилизации индикаторная метка должна полностью изменить свой цвет на чёрный.

DGM Pharma-Apparate Handel AG
Baarenstrasse 8, Zug, Switzerland
Сделано в США


Продавец в России:
ООО «ДГМ Фарма-Аппарате РУС»
121614 Москва, ул. Крылатские
Холмы, д.30 корп 9,
Тел.: (495) 739-39-48

ПАР

ISO 11140-1
ГОСТ-Р-ИСО 11140-1

121°C - 20 мин
126°C - 10 мин
134°C - 5 мин

- Не использовать после истечения срока годности.
- Хранить в прохладном, сухом, защищенном от света месте в заводской упаковке.

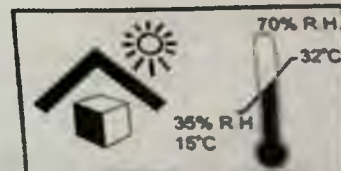

Условия хранения до
стерилизации и после

500 шт.



2014-09

LOT

D5-1409



2018-09

91261008 Rev. 5/13

Индикатор химический одноразовый для контроля процесса паровой стерилизации марки «DGM Steriguard» класс 4 Тип А для использования внутри и снаружи упаковки:

121°C – 20 мин., 126°C – 10 мин., 134°C – 7 мин.

Варианты исполнения:



DGM Steriguard®

ПАР

121°C - 20 МИН

126°C - 10 МИН

134°C - 7 МИН

ТИП А, КЛАСС 4



DGM Steriguard®


ПАР

121°C - 20 МИН

126°C - 10 МИН

134°C - 7 МИН

ТИП А, КЛАСС 4



DGM Steriguard®


ПАР

121°C - 20 МИН

126°C - 10 МИН

134°C - 7 МИН

ТИП А, КЛАСС 4



DGM Steriguard®

ПАР

121°C - 20 МИН

126°C - 10 МИН

134°C - 7 МИН

ТИП А, КЛАСС 4





DGM Steriguard®

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ CHEMICAL INDICATOR КЛАСС 4, ТИП А

Индикатор химический, одноразовый, Типа А, предназначен для контроля соблюдения критических параметров паровой стерилизации: температуры, времени выдержки и наличия водяного насыщенного пара, в стерилизационной камере, а также внутри упаковок, в паровых стерилизаторах с удалением воздуха из стерилизационной камеры методом многоступенчатого вакуумирования.

Индикаторы Типа А могут использоваться во всех паровых стерилизаторах при циклах стерилизации 121°C, 126°C или 134°C. При расположении индикатора внутри упаковки рекомендуется, чтобы лицевая сторона индикатора располагалась в предполагаемой точке, наиболее трудной для проникновения пара.

После проведения цикла стерилизации индикаторная метка должна полностью изменить свой цвет на чёрный.

DGM Pharma-Apparate Handel AG
Baarerstrasse 8, Zug, Switzerland
Сделано в США



Продавец в России:
ООО «ДГМ Фарма-Аппараты РУС»,
121614 Москва, ул. Крылатские
Холмы, д.30 корп 9.
Тел.: (495) 739-39-45

ПАР

ISO 11140-1
ГОСТ Р ИСО 11140-1

121°C - 20 мин
126°C - 10 мин
134°C - 7 мин

- Не использовать после истечения срока годности.
- Хранить в прокладном, сухом, защищенном от света месте в заводской упаковке.

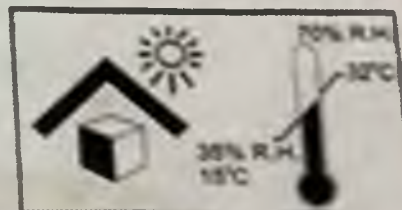

Условия хранения до
стерилизации и после

500 шт.



2014-09

LOT

D7-1409



2018-09

81261009 Rev. 5/13

DGM

Steriguard[®]

Индикатор химический
Класс 4, тип А
Chemical indicator

ПАР 121° C – 20 мин
126° C – 10 мин
134° C – 7 мин

для использования
внутри и снаружи
упаковки

ГОСТ ISO 11140-1

Производитель:
DGM Pharma-Apparate Handel AG
Baarerstrasse 8, Zug, Switzerland

Представитель в РФ:
ООО «Фармстандарт-Медтехника»
Российская Федерация.
141700, Московская область,
г. Долгопрудный, Лихачевский проезд,
д. 5 «Б»
Тел.: (495)739-39-48

Сделано в России

Изготовитель:
ООО «ДГМ ФАРМА АППАРАТЕ РУС»
142105, Московская область, г. Подольск,
ул. Большая Серпуховская, 57 А

1000 шт./ pcs.

РУ ФСЗ №2012/12553 от 12.10.2015

LOT:RUS04
Mfg 2016.10
Exp 2020.10

Условия хранения
до стерилизации и после



- не использовать после
истечения срока годности
- хранить в прохладном
сухом месте, защищенном от
света и заморозки (конверте)
(конверте)

DGM Pharma-Apparate Handel AG
Baarerstrasse 8, Zug
Switzerland

РУ ФСЗ №2012/12553
ОТ 12.10.2015

Количество: 40 000 шт.

Сделано в России

Изготовитель:

ООО «ДГМ ФАРМА АППАРАТЕ РУС»
142105, Московская область,
г. Подольск, ул. Большая
Серпуховская, 57 А

DGM Steriguard



Номер партии: LOT: 62300079



Произведен: 06/04/2016



Годен до: 06/04/2019

**ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ПАРОВОЙ
СТЕРИЛИЗАЦИИ КЛАСС 4 ТИП А:**

121° C – 20 мин

126° C – 10 мин

134° C – 7 мин


16.02.2017 16:13

5. Индикатор химический одноразовый для контроля процесса паровой стерилизации марки «DGM Steriguard» класс 4 тип В1 для использования внутри упаковки: 120°C – 45 мин., 132°C – 20 мин.

Варианты исполнения:



DGM Steriguard®



120°C - 45 МИН

132°C - 20 МИН

**ВНУТРИ УПАКОВКИ
ТИП В1, КЛАСС 4**





DGM

Steriguard

Индикатор химический
Класс 4, тип B1
Chemical indicator

ПАР 120° C – 45 мин
132° C – 20 мин

для использования
внутри упаковки

ГОСТ ISO 11140-1

Производитель:
DGM Pharma-Apparate Hancei AG
Baarerstrasse 8, Zug, Switzerland

Представитель в РФ:
ООО «Фармстандарт-Медтехника»
Российская Федерация,
141700, Московская область,
г. Долгопрудный, Лихачевский проезд,
д. 5 «Б»
Тел.: (495)739-39-48

Сделано в России


изготовитель:
ООО «ДГМ ФАРМА АППАРАТЕ РУС»
142105, Московская область, г. Подольск,
ул. Большая Серпуховская, 57 А

1000 шт./ pcs.

РУ ФСЗ №2012/12553 от 12.10.2015

Lot:RUS04
Mfg 2014.10
Exp. 2020.10

Условия хранения
до стерилизации и после



- не использовать после
истечения срока годности
- хранить в прохладном
сухом месте, защищенном от
света и повышенной влажности
(конверте)

DGM Pharma-Apparate Handel AG
Baarerstrasse 8, Zug
Switzerland

РУ ФСЗ №2012/12553
ОТ 12.10.2015

Количество: 40 000 шт.

Сделано в России

Изготовитель:

ООО «ДГМ ФАРМА АППАРАТЕ РУС»
142105, Московская область,
г. Подольск, ул. Большая
Серпуховская, 57 А

DGM Steriguard®



Номер партии: LOT: RUS04



Произведен: 10/2016



Годен до: 10/2020

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ПАРОВОЙ
СТЕРИЛИЗАЦИИ КЛАСС 4 ТИП В1:

120° C – 45 мин

132° C – 20 мин

DGM Steriguard®

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ CHEMICAL INDICATOR КЛАСС 4, ТИП В1

Индикатор химический, одноразовый, Типа В1, предназначен для контроля соблюдения критических параметров паровой стерилизации: температуры, времени выдержки и наличия водяного насыщенного пара внутри упаковок в паровых стерилизаторах с удалением воздуха из камеры методом продувки паром.

Индикаторы Типа В1 могут использоваться в паровых стерилизаторах при циклах стерилизации 120°C (45 мин.) или 132°C (20 мин.). Внутри упаковки рекомендуется размещать индикатор таким образом, чтобы лицевая сторона индикатора располагалась в предполагаемой точке, наиболее трудной для проникновения пара.

После проведения цикла стерилизации индикаторная метка должна полностью изменить свой цвет на тёмно-коричневый.

DGM Pharma-Apparate Handel AGG
Baarenstrasse 8, Zug, Switzerland
Сделано в США


Продавец в России:
ООО «ДГМ Фарма-Аппарате РУС»
121614 Москва, ул. Крылатские
Холмы, д. 30 корп 9
Тел.: (495) 739-39-48

ПАР

ISO 11140-1
ГОСТ-Р-ИСО 11140-1

120°C - 45 мин
132°C - 20 мин

- Не использовать после истечения срока годности.
- Хранить в прохладном, сухом, защищенном от света месте в заводской упаковке.

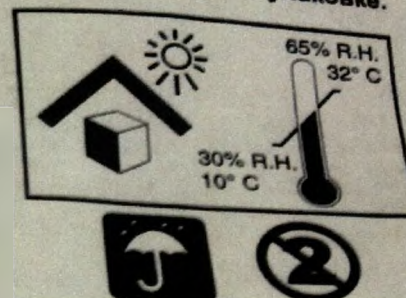

Условия хранения до
стерилизации и после

500 шт.



2014-09

LOT

DB1-1409



2017-03

91026014 Rev 8/13

6. Индикатор химический одноразовый для контроля процесса паровой стерилизации марки «DGM Steriguard» класс 4 В2 для использования снаружи упаковки: 120°C – 45 мин., 132°C – 20 мин.

Варианты исполнения



DGM Steriguard®

120°C - 45 MIN

132°C - 20 MIN

СНАРУЖИМ ПЛАКОВКИ

ТМП В2, КЛАСС 4



DGM Steriguard®

120°C - 45 MIN

132°C - 20 MIN

СНАРУЖИМ ПЛАКОВКИ

ТМП В2, КЛАСС 4





DGM

Steriguard®

Индикатор химический
Класс 4, тип В2
Chemical indicator



120° C – 45 мин
132° C – 20 мин

для использования
снаружи упаковки

ГОСТ ISO 11140-1

Производитель:
ООО «ДГМ Фарма Аппарате Рус»
Масляный В. Д.р. (И.С.С.С.С.)

Представитель в РФ:
ООО «Стеригуард-Медтехника»
Иркутская область,
Иркутск, Московская область,
г. Долгопрудный, Пискаревский проезд,
д. 5-Б-
Тел.: (495) 739-39-48

Сделано в России


Изготовитель:
ООО «ДГМ ФАРМА АППАРАТЕ РУС»
142105, Московская область, г. Подольск,
ул. Большая Серпуховская, 57 А

1000 шт./рсс.

РУ ФСЗ №2012/12553 от 12.10.2015

LOT-N111001
C¹⁴ 100% 7010 00
Exp 7020 00

Упаковка красным
для стерилизации и контроля



- не использовать после истечения срока годности
- хранить в прохладном сухом месте, защищенном от света в заводской упаковке (конверте)

DGM Steriguard®

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ CHEMICAL INDICATOR КЛАСС 4, ТИП В2

Индикатор химический одноразовый предназначен для контроля соблюдения критических параметров паровой стерилизации: температуры, времени выдержки и наличия водяного насыщенного пара в стерилизационной камере в паровых стерилизаторах с удалением воздуха из камеры методом продувки паром.

Индикаторы Типа В2 могут использоваться в паровых стерилизаторах при циклах стерилизации 120°C (45 мин.) или 132°C (20 мин.).

После проведения цикла стерилизации индикаторная метка должна полностью изменить свой цвет на **темно-коричневый**.



DGM Pharma-Apparate Handel Ag.
Baarerstrasse 8, Zug,
Switzerland

Сделано в США

Представитель в РФ:
«ООО Фармстандарт-Медтехника»
141700, Московская область,
г. Долгопрудный,
Лихачевский проезд, д.5 «Б»
Тел.: (495) 739-3948

ПАР

ISO 11140-1
ГОСТ-ИСО 11140-1

120°C - 45 мин
132°C - 20 мин

- Не использовать после истечения срока годности.
- Хранить в прохладном, сухом, защищенном от света месте в заводской упаковке.



Условия хранения до
стерилизации и после

500 шт.



2016-06

LOT

DB2-1606



2018-03

91026013 Rev. 5/16

7. Индикатор химический одноразовый для контроля процесса паровой стерилизации марки «DGM Steriguard» класс 5
Варианты исполнения




DGM *Steriguard*®

ПАР

**Индикатор
химический
одноразовый, класс 5**



DGM Steriguard®



ГОСТ ISO 11140-1
КЛАСС 5

ПАРАМЕТРЫ ДОСТИГНУТЫ



ХИМИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР ДЛЯ КОНТРОЛЯ
ПРОЦЕССА ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ

Производитель:

DGM Pharma-Apparate Handel Ag
Baarerstrasse 8, Zug, Switzerland

Представитель в РФ:

ООО «Фармстандарт-Медтехника»


Российская Федерация,

141700, Московская область,

г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д.5«Б»

Тел: (495)739-39-48

Made in USA / Сделано в США

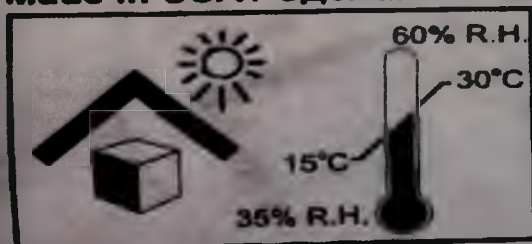

ПУ ФСЗ № 2012/12553 от 12.10.2015

2016-10

16090

2020-10

250 шт.

Индикаторы контроля процесса паровой
стерилизации марки "DGM Steriguard®":
Индикатор химический одноразовый для
контроля процесса паровой стерилизации
марки "DGM Steriguard®" класс 5

Химический индикатор класса 5 предназначен для
реагирования на все критические переменные
паровой стерилизации: время, температура,
насыщенный пар и контроля стерилизации внутри
упаковок во всех циклах паровой стерилизации в
диапазоне температур 120-135°C

1. Вскройте пакет с помощью ножниц или потяните за
край пакета в месте расположения выемки.

2. Поместите индикатор в каждую упаковку так,
чтобы его лицевая сторона находилась в
предполагаемой точке, наиболее труднодоступной
для проникновения пара.

3. После цикла стерилизации убедитесь, что темное
окрашивание распространилось в область окна,
маркированного "ДА". Это означает, что параметры
паровой стерилизации были достигнуты.

4. Если после цикла стерилизации темное
окрашивание осталось в области окна,
маркированного "НЕТ", то это означает, что условия
для эффективной стерилизации не были соблюдены.
Не используйте данную упаковку!

5. Оставшиеся неиспользованные индикаторы
необходимо хранить в данной упаковке. После
вскрытия плотно закрывайте упаковку путем
загибания краёв упаковки несколько раз.

6. Индикаторы рекомендуется хранить при влажности
в пределах, указанных на упаковке.

Изделие для однократного применения. Предназначено
для стерилизации. Не токсично.

91269129 Rev. 10/16

DGM

Steriguard

Индикатор химический
Класс 5
Chemical indicator

ПАЛ

для использования
внутри упаковки
ГОСТ ISO 11140-1

Поставитель:
DGM Pharma Apparate Handel AG
Barmenstrasse 8, Zug, Switzerland

Представитель в РФ:
ООО «Фармстандарт-Мастер-Хелп»
Российская Федерация,
г. Долгопрудный, Лихачевский проезд,
д. 3-Б
Тел. (485) 739-35-48

Сделано в России

Импортер:
ООО «ДГМ ФАРМА КОМПАТЕ РУС»
142708, Московская область, г. Подольск
ул. Вильям Сиргусовская, 17 А

ИЗМЕРЕНИЕ
внутри упаковки
внутри упаковки

Условия хранения
по инструкции и паспорту



НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ
истечения срока годности
- применять в соответствии с
условиями хранения и
сроком годности, указанного в
паспорте и на упаковке упаковки

1000 шт / пач.

РФ GCS M2910.12551 от 12.11.2016

DGM

Steriguard®

Индикатор химический
Класс 5
Chemical indicator

ПАР

для использования
внутри упаковки

ГОСТ ISO 11140-1

Государственный
Центр Фарма-Аппаратных Технологий
Федеральный Центр Стандартизации

Представитель в РФ
ООО «Центр Фарма-Аппаратных Технологий»
Российская Федерация,
141700, Московская область,
г. Долгопрудный, Лыжневский проезд,
д. 1-Б
Тел.: (495) 739-39-48

Сделано в России

Изготовитель:
ООО «ДГМ ФАРМА АППАРАТЫ РУСЬ»
142105, Московская область, г. Подольск,
ул. Большая Серпуховская, 57 А

141700
141700
141700

Условия хранения
до стерилизации и т.д.



- не использовать после
истечения срока годности
- хранить в прохладном
сухом месте, защищенном от
света в заводской упаковке
(конверте)

РУ ФСЗ 100912/12553 от 12.10.2015

8. Индикатор химический одноразовый для контроля процесса паровой стерилизации марки «DGM Steriguard» класс 6 тип А.

Индикатор химический одноразовый для контроля процесса паровой стерилизации «DGM Steriguard» класс 6 тип А:
121°C – 15 мин., 134°C – 5 мин.

Варианты исполнения




DGM *Steriguard*®

ПАР

**134 С - 5 мин
121 С - 15 мин**

**внутри и снаружи
упаковки, тип А, класс 6**

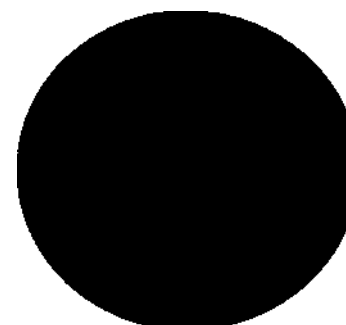


Индикатор химический одноразовый для контроля процесса паровой стерилизации «DGM Steriguard» класс 6 тип А:
121°C – 20 мин., 134°C – 7 мин.

DGM Steriguard[®]

ПАР

**134 С - 7 мин
121 С - 20 мин**

**внутри и снаружи
упаковки, тип А, класс 6**

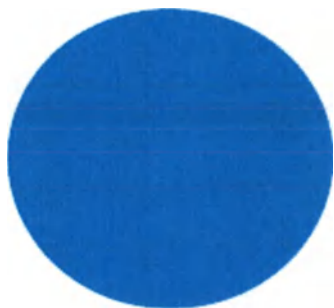

DGM Steriguard®



ISO 11140-1
ГОСТ-ИСО 11140-1


Индикатор химический
одноразовый для контроля
процесса паровой стерилизации класс
6 тип А 121°C – 15 мин, 134°C – 5 мин
250 шт.
Chemical indicator for steam
sterilization class 6 type A
121°C – 15 min, 134°C – 5 min.



Хранить в прохладном сухом месте в заводской упаковке
без воздействия прямых солнечных лучей, паров
дезинфицирующих средств и химических реактивов.

Индикатор предназначен для контроля параметров
паровой стерилизации: температуры, времени выдержки
и наличия водяного насыщенного пара, в
стерилизационной камере, а также внутри упаковок.

После проведения цикла стерилизации индикаторная
метка должна полностью изменить свой цвет на
коричневый.

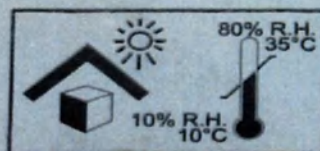

2016-06

LOT

D15-1606



2019-06

Условия хранения до стерилизации и после

DGM Pharma-Apparate Handel Ag.
Baarerstrasse 8, Zug, Switzerland

Представитель в РФ:

«ООО Фармстандарт-Медтехника»
141700, Московская область, г. Долгопрудный,
Лихачевский проезд, д.5 «Б»
Тел.: (495) 739-3948

Сделано в США
Made in USA

91266121 Rev 05/16

DGM

Steriguard

Индикатор химический
Класс 6, тип А
Chemical Indicator

газ

121° C – 20 мин

134° C – 7 мин

для использования
внутри и снаружи
упаковки

ГОСТ ISO 11140-1

Производитель:
DGM Pharma-Apparate GmbH AG
Kunzeallee 1, 74474 Schwanau

Почтовый адрес:
(О.О.) - Фирма "Цирми" Медицинские
Российские Индикаторы
142105, Московская область,
г. Дзержинский, Рязанский проезд,
д. 5-4
Тел.: 8(495) 719-20-40

1000011001
РФ 4922 0000 2 00000 00 00 0000

LOT: 000004
- 00 000 00
- Exp: 000 00

Упаковку хранить
до стерилизации в сухом

Сделано в России

Исполнитель:
ООО «ЦМ БАЙМА АППАРАТЕ РУС»
142105, Московская область, г. Дзержинский,
ул. Колхозная Барусская, 57 А



не использовать после
истечения срока годности
хранить в прохладном
сухом месте, защищенном от
света и заедания упаковки
(влажность)

9. Индикатор химический одноразовый для контроля процесса паровой стерилизации марки «DGM Steriguard» класс 6
тип B1


DGM Steriguard®

ПАР

120 С - 45 мин

132 С - 20 мин

**внутри упаковки,
тип B1, класс 6**

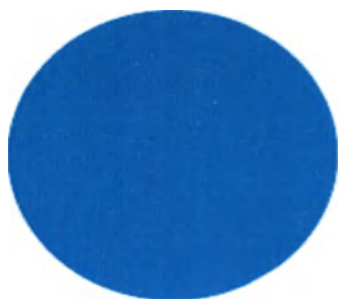

Образец маркировки



10. Индикатор химический одноразовый для контроля процесса паровой стерилизации марки «DGM Steriguard»
класс 6 тип B2

DGM Steriguard®

ПАР


120 С - 45 мин

132 С - 20 мин

**снаружи упаковки,
тип B2, класс 6**



Образец маркировки

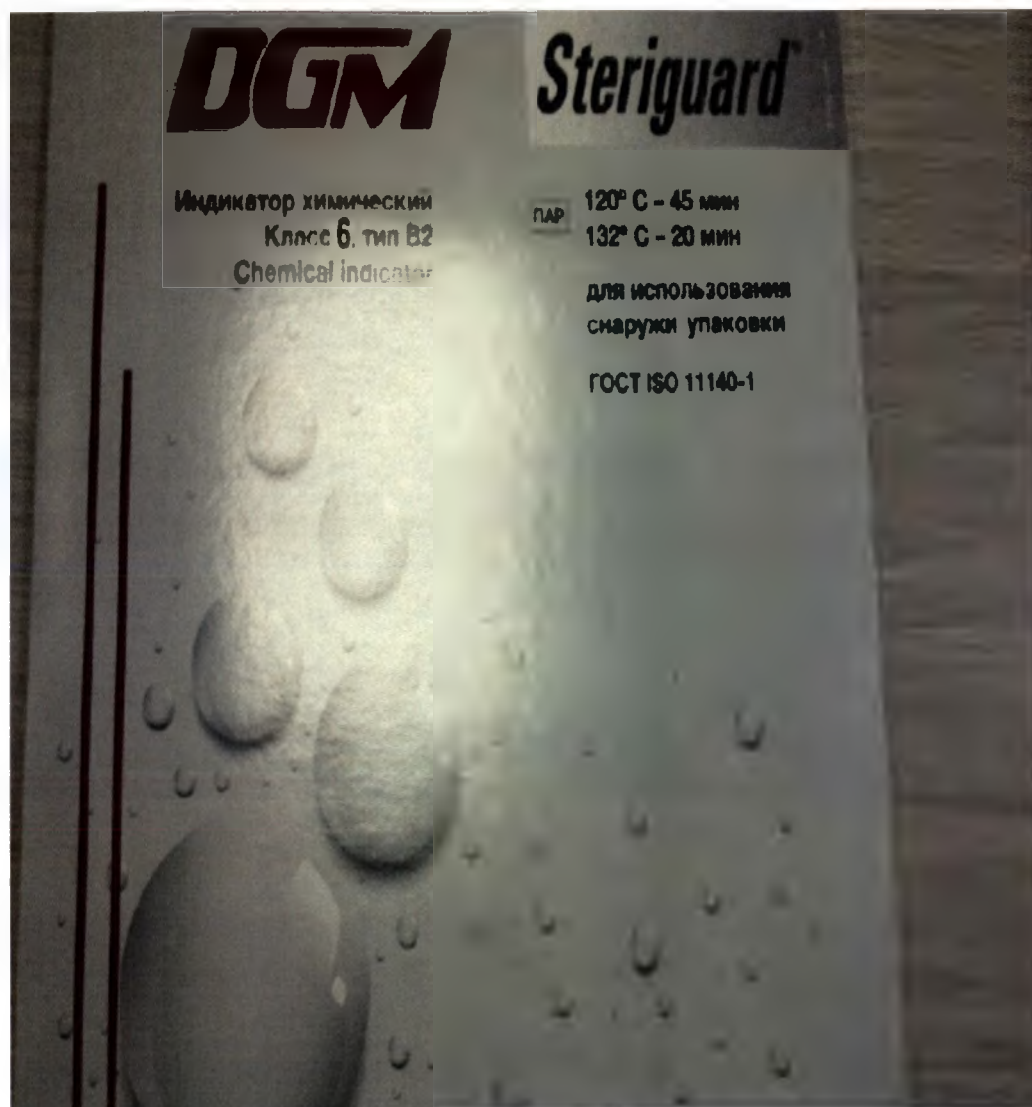

11. Индикатор биологический одноразовый для контроля процесса паровой стерилизации марки «DGM Steriguard»



Образец маркировки:

Производитель: DGM Pharma-Apparate Handel AG. Baarerstrasse 8, Zug Switzerland	Завод-изготовитель: Propper Manufacturing Company, Inc., 36-04 Skillman Ave, Long Island City, New York, 11101, USA. Сделано в США	Quantity / Количество: 100 шт.
Представитель в РФ: ООО «Фармстандарт-Медтехника» Российская Федерация 141700 Московская обл. Г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5»Б» Тел.: (495)7393948		
		
Индикатор биологический одноразовый для контроля процесса паровой стерилизации марки "DGM Steriguard"		
 Exp.:		РУ ФСЗ №2012/12553 ОТ 12.10.2015

II. Индикаторы контроля процесса газовой стерилизации (оксидом этилена и парами формальдегида) марки «DGM Steriguard»

1. Рулон индикаторный для контроля процесса газовой стерилизации оксидом этилена марки «DGM Steriguard» 1 класс) от 18 мм х 50 м до 25 мм х 50 м



Образец маркировки

Производитель: DGM Pharma-Apparate Handel AG. Baarerstrasse 8, Zug Switzerland	Завод-изготовитель: Propper Manufacturing Company, Inc., 36-04 Skillman Ave, Long Island City, New York, 11101, USA. Сделано в США	Quantity / Количество: 100 шт. Size/ Размер: 18 мм x 50 м
Представитель в РФ: ООО «Фармстандарт-Медтехника» Российская Федерация 141700 Московская обл. Г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5»Б» Тел.: (495)7393948		
 Lot:  Exp.: Рулон индикаторный для контроля медицинской газовой стерилизации оксидом этилена марки "DGM Steriguard" (класс 1) ПУ ФСЗ №2012/12553 ОТ 12.10.2015		

2. Комбинированные индикаторные самоклеящиеся этикетки для стерилизации оксидом этилена класс 1



Производитель: DGM Pharma-Apparate Handel AG. Baarerstrasse 8, Zug Switzerland	Завод-изготовитель: Propper Manufacturing Company, Inc., 36-04 Skillman Ave, Long Island City, New York, 11101, USA. Сделано в США	Quantity / Количество: 100 шт.
Представитель в РФ: ООО «Фармстандарт-Медтехника» Российская Федерация 141700 Московская обл. Г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5«Б» Тел.: (495)7393948		
   		
Lot:  Exp.: Комбинированные индикаторные самоклеящиеся этикетки для газовой стерилизации оксидом этилена марки "DGM Steriguard" класс 1 ПУ ФСЗ №2012/12553 ОТ 12.10.2015		

3. Индикатор химический одноразовый для контроля процесса газовой стерилизации оксидом этилена марки "DGM Steriguard" класс 1

Индикатор контроля газовой
стерилизации оксидом этилена
DGM Steriguard®

DGM *Steriguard*®

Класс 1/ Class 1

LOT RUS-P50-156

 **Mfg.:** 2016.10

 **Exp.:** 2021.10



30

E0

Образец маркировки

Производитель: DGM Pharma-Apparate Handel AG. Baarerstrasse 8, Zug Switzerland	Завод-изготовитель: Propper Manufacturing Company, Inc., 36-04 Skillman Ave, Long Island City, New York, 11101, USA. Сделано в США	Quantity / Количество: 100 шт.
Представитель в РФ: ООО «Фармстандарт-Медтехника» Российская Федерация 141700 Московская обл. Г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5»Б» Тел.: (495)7393948		
   	Индикатор химический одноразовый для контроля процесса газовой стерилизации оксидом этилена марки "DGM Steriguard" класс 1 РУ ФСЗ №2012/12553 ОТ 12.10.2015	
Lot:		
 Exp.:		

4. Индикатор химический одноразовый для контроля процесса газовой стерилизации оксидом этилена марки "DGM Steriguard" класс 4

Индикатор контроля газовой
стерилизации оксидом этилена
DGM Steriguard®

DGM Steriguard®

Класс 4/ Class 4

LOT RUS-P50-156

 **Mfg.:** 2016.10

 **Exp.:** 2021.10



30

E0

Производитель: DGM Pharma-Apparate Handel AG. Baarerstrasse 8, Zug Switzerland	Завод-изготовитель: Propper Manufacturing Company, Inc., 36-04 Skillman Ave, Long Island City, New York, 11101, USA. Сделано в США	Quantity / Количество: 100 шт.
Представитель в РФ: ООО «Фармстандарт-Медтехника» Российская Федерация 141700 Московская обл. Г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5«Б» Тел.: (495)7393948		
	Индикатор химический одноразовый для контроля процесса газовой стерилизации оксидом этилена марки "DGM Steriguard" класс 4 ПУ ФСЗ №2012/12553 ОТ 12.10.2015	
Lot:		
Exp.:		

5. Индикатор химический одноразовый для контроля процесса газовой стерилизации оксидом этилена марки "DGM Steriguard" класс 5

Индикатор контроля газовой
стерилизации оксидом этилена
DGM Steriguard®

DGM *Steriguard*®

Класс 5/ Class 5

LOT RUS-P50-156


  
 **Mfg.:** 2016.10

 **Exp.:** 2021.10

ЭО

EO


Образец маркировки

Производитель: DGM Pharma-Apparate Handel AG. Baarerstrasse 8, Zug Switzerland	Завод-изготовитель: Propper Manufacturing Company, Inc., 36-04 Skillman Ave, Long Island City, New York, 11101, USA. Сделано в США	Quantity / Количество: 100 шт.	
Представитель в РФ: ООО «Фармстандарт-Медтехника» Российская Федерация 141700 Московская обл. Г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5»Б» Тел.: (495)7393948			
   			Индикатор химический одноразовый для контроля процесса газовой стерилизации оксидом этилена марки "DGM Steriguard" класс 5 ПУ ФСЗ №2012/12553 ОТ 12.10.2015
Lot:			
 Exp.:			

6. Рулон индикаторный для контроля медицинской газовой стерилизации парами формальдегида марки "DGM Steriguard" (класс 1) от 18 мм х 50 м до 25 мм х 50 м



Образец маркировки:

Производитель: DGM Pharma-Apparate Handel AG. Baarerstrasse 8, Zug Switzerland	Завод-изготовитель: Propper Manufacturing Company, Inc., 36-04 Skillman Ave, Long Island City, New York, 11101, USA. Сделано в США	Quantity / Количество: 100 шт. Size/ Размер: 18 мм x 50 м
Представитель в РФ: ООО «Фармстандарт-Медтехника» Российская Федерация 141700 Московская обл. Г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5»Б» Тел.: (495)7393948		
   		
Рулон индикаторный для контроля медицинской газовой стерилизации парами формальдегида марки "DGM Steriguard" (класс 1) ПУ ФСЗ №2012/12553 ОТ 12.10.2015		
 Exp.:		

7. Комбинированные индикаторные самоклеящиеся этикетки для газовой стерилизации парами формальдегида марки "DGM Steriguard" класс 1


ФОРМ
PROCESS DATE



ISO-11140-1



EXPIRY DATE

Производитель: DGM Pharma-Apparate Handel AG. Baarerstrasse 8, Zug Switzerland	Завод-изготовитель: Propper Manufacturing Company, Inc., 36-04 Skillman Ave, Long Island City, New York, 11101, USA. Сделано в США	Quantity / Количество: 100 шт.		
Представитель в РФ: ООО «Фармстандарт-Медтехника» Российская Федерация 141700 Московская обл. Г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5»Б» Тел.: (495)7393948				
   			Комбинированные индикаторные самоклеящиеся этикетки для газовой стерилизации парами формальдегида марки "DGM Steriguard" класс 1 ПУ ФСЗ №2012/12553 ОТ 12.10.2015	
Lot:				
 Exp.:				

8. Индикатор химический одноразовый для контроля процесса газовой стерилизации парами формальдегида марки "DGM Steriguard" класс 1

Индикатор химический одноразовый для
контроля процесса газовой стерилизации
парами формальдегида марки
DGM Steriguard®

Класс 1/ Class 1

LOT RUS-P50-156

 **Mfg.:** 2016.10

 **Exp.:** 2021.10


DGM *Steriguard*®



ФОРМ

FORM

Образец маркировки

Производитель: DGM Pharma-Apparate Handel AG. Baarerstrasse 8, Zug Switzerland	Завод-изготовитель: Propper Manufacturing Company, Inc., 36-04 Skillman Ave, Long Island City, New York, 11101, USA. Сделано в США	Quantity / Количество: 100 шт.						
Представитель в РФ: ООО «Фармстандарт-Медтехника» Российская Федерация 141700 Московская обл. Г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5»Б» Тел.: (495)7393948								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td data-bbox="163 768 851 899" style="width: 30%;">     </td> <td data-bbox="851 768 2048 1268" style="width: 70%; text-align: center;"> Индикатор химический одноразовый для контроля процесса газовой стерилизации парами формальдегида марки "DGM Steriguard" класс 1 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="163 907 851 1007"> Lot: </td> <td data-bbox="851 907 2048 1007"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="163 1014 851 1268">  Exp.: </td> <td data-bbox="851 1014 2048 1268" style="text-align: right;"> РУ ФСЗ №2012/12553 ОТ 12.10.2015 </td> </tr> </table>			   	Индикатор химический одноразовый для контроля процесса газовой стерилизации парами формальдегида марки "DGM Steriguard" класс 1	Lot:		 Exp.:	РУ ФСЗ №2012/12553 ОТ 12.10.2015
   	Индикатор химический одноразовый для контроля процесса газовой стерилизации парами формальдегида марки "DGM Steriguard" класс 1							
Lot:								
 Exp.:	РУ ФСЗ №2012/12553 ОТ 12.10.2015							

9. Индикатор химический одноразовый контроля процесса газовой стерилизации парами формальдегида марки «DGM Steriguard» класс 4



Образец маркировки:


DCM Steriguard®

250 псв./ шт

**Индикатор химический одноразовый для контроля
процесса газовой стерилизации парами формальдегида
Класс 4**


- В коробке содержатся 250 индикаторных полосок
- Располагайте химические индикаторы в центре загрузки
- При загрузке индикаторная полоска должна располагаться индикаторными чернилами вверх
- После стерилизационного цикла сравните цвет индикаторных чернил с референтной отметкой зеленого цвета. После стерилизации различные оттенки зеленого являются допустимыми
- Не используйте поврежденные индикаторы
- Индикаторы должны храниться при комнатной температуре (25 градусов С)

ПУ ФСЗ №2012/12553
срок действия сертификата не ограничен



10. Индикатор биологический одноразовый для контроля процесса газовой стерилизации (оксидом этилена и парами формальдегида) марки "DGM Steriguard"




Производитель: DGM Pharma-Apparate Handel AG. Baarerstrasse 8, Zug Switzerland	Завод-изготовитель: Proper Manufacturing Company, Inc., 36-04 Skillman Ave, Long Island City, New York, 11101, USA. Сделано в США	Quantity / Количество: 100 шт.
Представитель в РФ: ООО «Фармстандарт-Медтехника» Российская Федерация 141700 Московская обл. Г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5»Б» Тел.: (495)7393948		
   	Индикатор биологический одноразовый для контроля процесса газовой стерилизации (оксидом этилена и парами формальдегида) марки "DGM Steriguard"	
Lot:		
 Exp.:		
		РУ ФСЗ №2012/12553 ОТ 12.10.2015

III. Индикаторы контроля процесса плазменной стерилизации (с применением паров перекиси водорода):


1. Рулон индикаторный для контроля медицинской плазменной стерилизации марки «DGM Steriguard» (от 18 мм x 50 м до 25 мм x 50 м

Варианты исполнения:



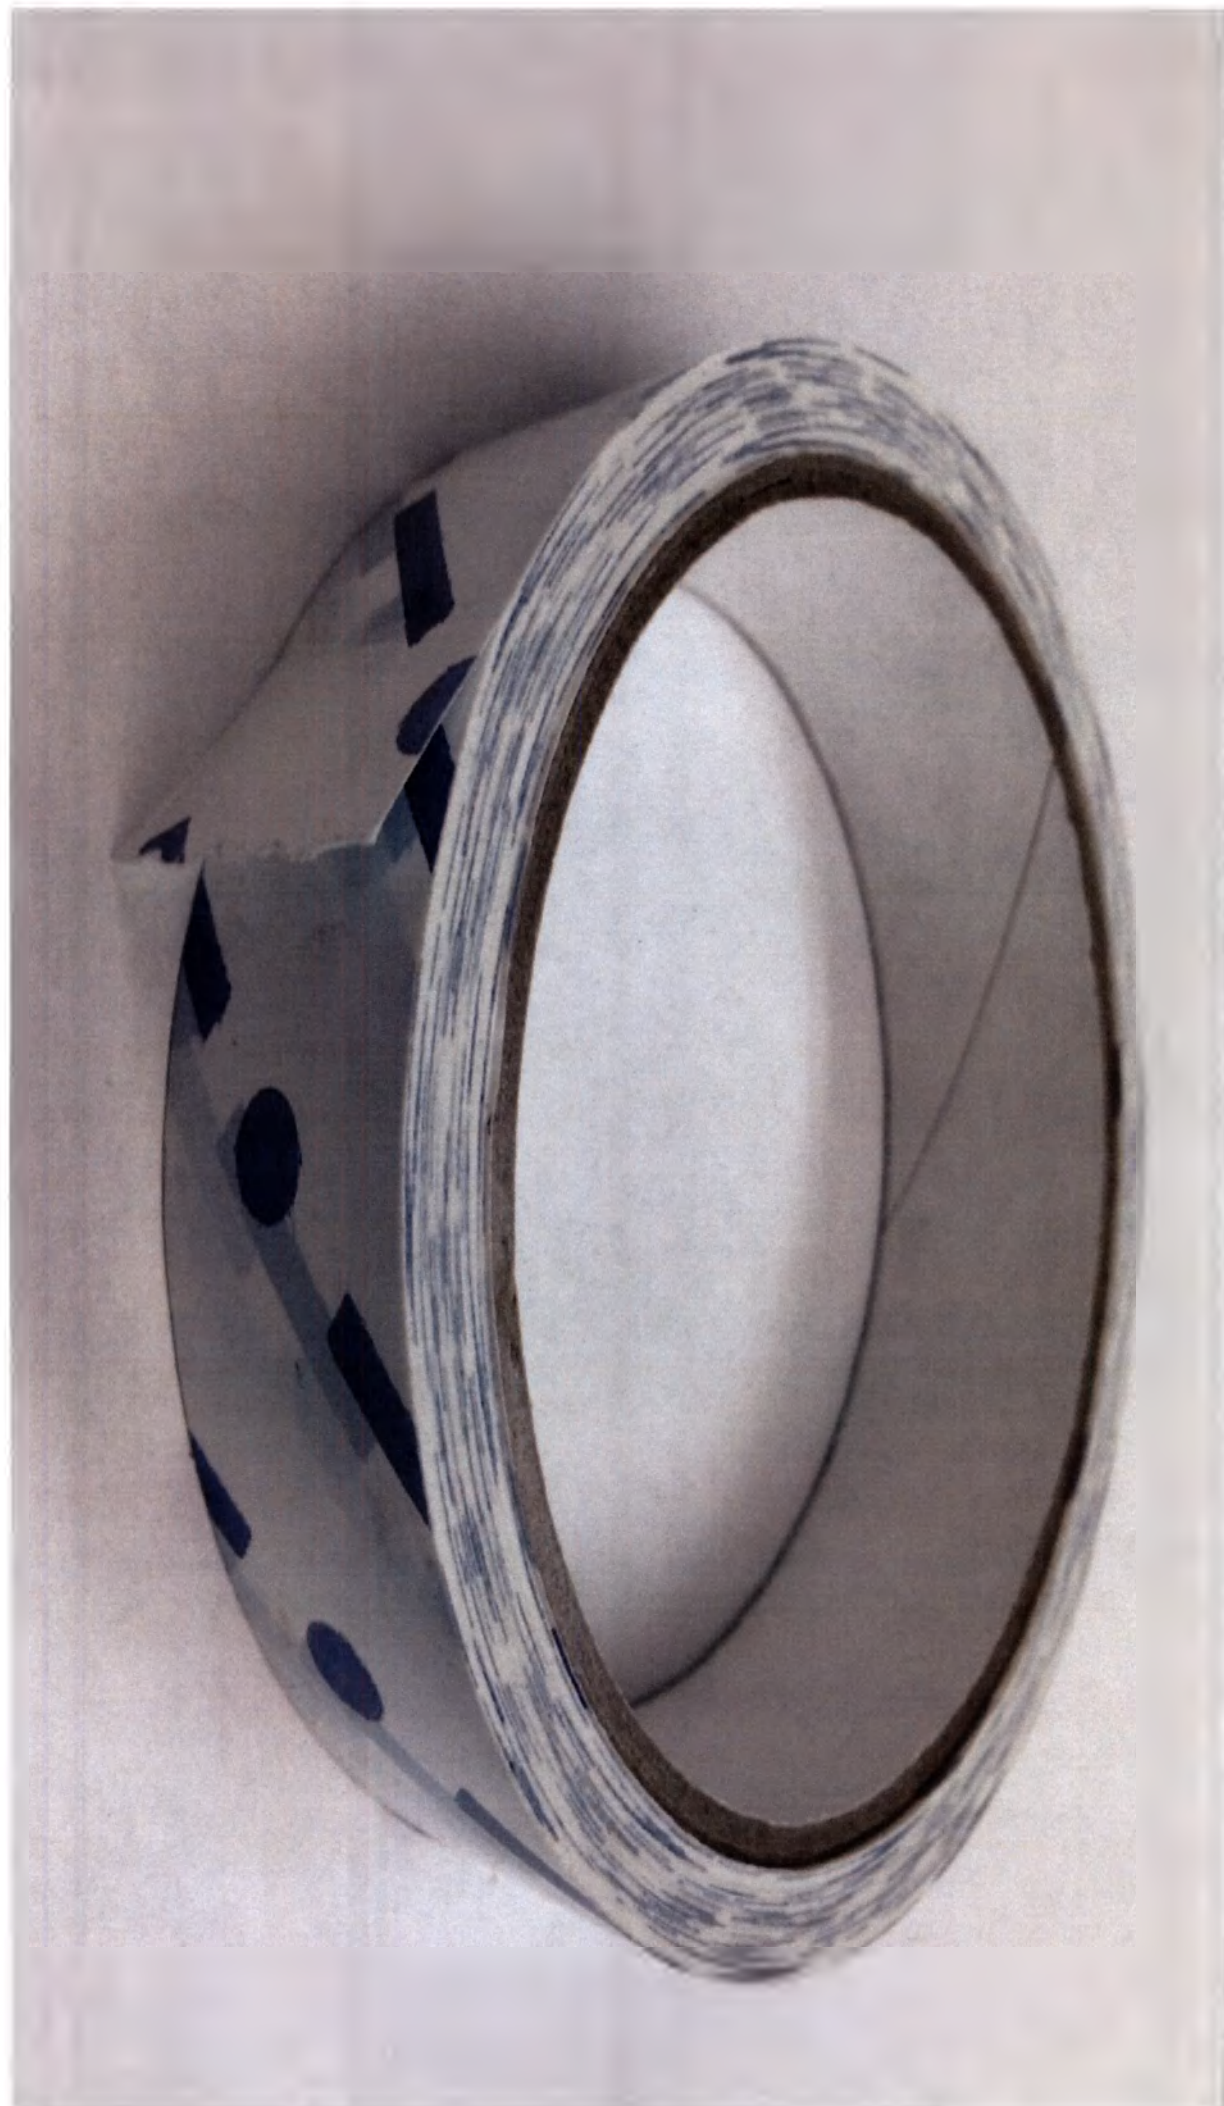

DGM Steriguard[®]



PLASMA STERILIZATION TAPE - 19mm X 50m

**Индикаторы контроля процесса плазменной стерилизации
(с применением паров перекиси водорода):**

**Рулон индикаторный для контроля медицинской плазменной
стерилизации марки**

LOT : RUS-P50-155

📅: 2016 / 10

🕒: 2021 / 10

Производитель: DGM Pharma-Apparate
Handel AG, Baarerstrasse, 8, Zug, Switzerland

РУ ФСЗ №2012/12553 от 12 октября 2015
срок действия сертификата не ограничен



Производитель:

DGM Pharma-Apparate Handel AG.
Baarerstrasse 8, Zug
Switzerland

Представитель в РФ:

ООО «Фармстандарт-Медтехника»
Российская Федерация
141700 Московская обл.
Г. Долгопрудный, Лихачевский
проезд, д. 5»Б»
Тел.: (495)7393948

Завод-изготовитель:

Propper Manufacturing
Company, Inc., 36-04 Skillman
Ave, Long Island City, New
York, 11101, USA.

Сделано в США

Quantity / Количество: 100 шт.

Size/ Размер: 18 мм x 50 м

DGM Steriguard®



Lot:



Exp.:

**Рулон индикаторный для
контроля медицинской
плазменной стерилизации марки
"DGM Steriguard"**

РУ ФСЗ №2012/12553 ОТ 12.10.2015

2. Комбинированные индикаторные самоклеящиеся этикетки для плазменной стерилизации марки «DGM Steriguard»



Образец маркировки:

Производитель: DGM Pharma-Apparate Handel AG. Baarerstrasse 8, Zug Switzerland	Завод-изготовитель: Propper Manufacturing Company, Inc., 36-04 Skillman Ave, Long Island City, New York, 11101, USA. Сделано в США	Quantity / Количество: 100 шт.
Представитель в РФ: ООО «Фармстандарт-Медтехника» Российская Федерация 141700 Московская обл. Г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5»Б» Тел.: (495)7393948		
 Lot:  Exp.: Комбинированные индикаторные самоклеящиеся этикетки для плазменной стерилизации марки "DGM Steriguard" ПУ ФСЗ №2012/12553 ОТ 12.10.2015		

3. Индикатор химический одноразовый для контроля процесса плазменной стерилизации марки «DGM Steriguard» класс



Образец маркировки:

Инструкции по применению: Индикатор предназначен для контроля процесса плазменной стерилизации в плазменных стерилизаторах (с применением плазмы низкого давления). В связи с недопустимостью применения метода стерилизации индикатор изготовлен из материала, не вступающего в реакцию с парами перекиси водорода. Поместите индикаторную полосу в стерилизационную упаковку. На индикаторе не должны располагаться стерилизуемые изделия, это затруднит проникновение стерилизующего агента. После прохождения стерилизационного цикла цвет индикатора желтый. Различные оттенки желтого допустимы. Промежуточные цвета между красным и желтым свидетельствуют о течении недостаточного времени. Цвет чернил индикатора при хранении не меняется, и индикатор после стерилизации не теряет своих свойств.

Меры предосторожности: Индикатор не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, а также агрессивных окислителей (гипохлорида натрия, надуксусной кислоты, глутарового альдегида, формальдегида и оксида этилена) и других химических веществ.


Стандарт: ISO 11140-1:2005

Регулятор ФСЗ №2012/12553

ДТ 12.10.2015



LOT



H 764 / I 781 10-2016
10-2019

DGM
Steriguard®

**Индикатор плазменной
стерилизации**

VH2O2

ПЕР

Желтый после
стерилизации

Changes to yellow

200 шт./ 200 pcs.

4. Индикатор биологический одноразовый для контроля процесса-плазменной стерилизации марки «DGM Steriguard»




DCGM Steriguard®

Индикаторы контроля процесса плазменной стерилизации (с применением паров перекиси водорода): Индикатор биологический однократный для контроля процесса плазменной стерилизации марки DGM Steriguard®

Индикатор биологический предназначен для контроля эффективности плазменной стерилизации изделий медицинского назначения. Индикатор представляет собой пластиковую пробирку с размещенной внутри стеклянной ампулой с питательной средой краснооранжевого цвета и высушенными спорами бактерий *Bacillus stearothermophilus* в количестве не менее 10⁶. По окончании цикла индикаторы извлечь из стерилизационной камеры и совместно с одним контрольным индикатором (необработанным в стерилизационном цикле) инкубировать при температуре 55±1°C.

Результаты контроля индикаторами верны только после 24 часов инкубации. Сохранение исходного оранжево-красного цвета питательной среды всех обработанных в стерилизаторе индикаторов указывает на обеспечение необходимой эффективности стерилизации. При этом контрольный индикатор (необработанный в стерилизаторе, но той же партии) должен изменить свой цвет на желтый. Изделие для однократного применения. Предназначено для стерилизации. Не токсично.

РУ ФСЗ №2012/12553 от 12.10.2015

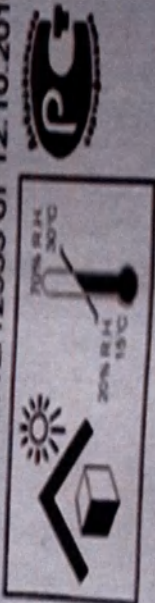

Произведено в Швейцарии:
 DGM Pharma-Apparate Handel AG
 Baarerstrasse 8, Zug, Switzerland
 Сделано в Швейцарии

Made in USA

Не использовать индикаторы истекшим сроком годности, индикаторы разбитой стеклянной ампулой, индикаторы с цветом питательной среды отличной от красно-оранжевого. Хранить в прохладном сухом месте в заводской упаковке без воздействия прямых солнечных лучей, паров дезинфицирующих средств и химических реактивов.

2016-10
 LOT H16101
 2018-10

Представитель в РФ:
 «ООО Фармстандарт-Медтехника»
 141700, Московская область,
 г. Долгопрудный,
 Лихачевский проезд, д.5 «Б»
 Тел.: (495) 739-3948

13:58

2017-11-13


21.02.2017

IV. Индикаторы контроля процесса воздушной стерилизации

1. Рулон индикаторный для контроля медицинской воздушной стерилизации марки "DGM Steriguard" (класс 1) от 18 мм х 50 м до 25 мм х 50 м



Образец маркировки:

Производитель: DGM Pharma-Apparate Handel AG. Baarerstrasse 8, Zug Switzerland	Завод-изготовитель: Propper Manufacturing Company, Inc., 36-04 Skillman Ave, Long Island City, New York, 11101, USA. Сделано в США	Quantity / Количество: 100 шт. Size/ Размер: 18 мм x 50 м
Представитель в РФ: ООО «Фармстандарт-Медтехника» Российская Федерация 141700 Московская обл. Г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5»Б» Тел.: (495)7393948		
		
Рулон индикаторный для контроля медицинской воздушной стерилизации марки "DGM Steriguard"		
 Exp.: РУ ФСЗ №2012/12553 ОТ 12.10.2015		

2. Комбинированные индикаторные самоклеящиеся этикетки для воздушной стерилизации марки "DGM Steriguard"

ВОЗД
PROCESS DATE



ISO-11140-1



EXPIRY DATE

Производитель: DGM Pharma-Apparate Handel AG. Baarerstrasse 8, Zug Switzerland	Завод-изготовитель: Propper Manufacturing Company, Inc., 36-04 Skillman Ave, Long Island City, New York, 11101, USA. Сделано в США	Quantity / Количество: 100 шт.
Представитель в РФ: ООО «Фармстандарт-Медтехника» Российская Федерация 141700 Московская обл. Г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5«Б» Тел.: (495)7393948		
   		
Lot: Комбинированные индикаторные самоклеящиеся этикетки для воздушной стерилизации марки "DGM Steriguard"		
 Exp.: РУ ФСЗ №2012/12553 ОТ 12.10.2015		

3. Индикатор химический одноразовый для контроля процесса воздушной стерилизации марки "DGM Steriguard" класс 1

Индикатор контроля
воздушной стерилизации
DGM Steriguard®

DGM *Steriguard*®



ВОЗД

Класс 1/ Class 1

LOT RUS-P50-156

 **Mfg.:** 2016.10

 **Exp.:** 2021.10

Производитель:

DGM Pharma-Apparate Handel AG.
Baarerstrasse 8, Zug
Switzerland

Представитель в РФ:

ООО «Фармстандарт-Медтехника»
Российская Федерация
141700 Московская обл.
Г. Долгопрудный, Лихачевский
проезд, д. 5»Б»
Тел.: (495)7393948

Завод-изготовитель:

Propper Manufacturing
Company, Inc., 36-04 Skillman
Ave, Long Island City, New
York, 11101, USA.

Сделано в США

Quantity / Количество: 100 шт.

DGM Steriguard®



Lot:



Exp.:

**Индикатор химический
одноразовый для контроля
процесса воздушной стерилизации
марки "DGM Steriguard" класс 1**

ПУ ФСЗ №2012/12553 ОТ 12.10.2015

4. Индикатор химический одноразовый для контроля процесса воздушной стерилизации марки «DGM Steriguard» класс 4 для использования внутри и снаружи упаковки:

180°C – 60 мин.

Варианты исполнения:





Образец маркировки:

DGM Pharma-Apparate Handel AG
Baarerstrasse 8, Zug
Switzerland

Сделано в России

Изготовитель:
ООО «ДГМ ФАРМА АППАРАТЕ РУС»
142105, Московская область,
г. Подольск, ул. Большая
Серпуховская, 57 А

РУ ФСЗ №2012/12553
ОТ 12.10.2015

Количество: 40 000 шт.

DGM Steriguard®



Номер партии: LOT: 62300474



Произведен: 10/2016



Годен до: 10/2019

**ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ВОЗДУШНОЙ
СТЕРИЛИЗАЦИИ КЛАСС 4**

180° C – 60 мин

DGM

Steriguard®

Индикатор химический
Класс 4
Chemical indicator

ВОЗД

180° С – 60 мин

для использования
внутри и снаружи
упаковки

ГОСТ ISO 11140-1

Производитель:
DGM Pharma-Apparate Handel AG
Saarstrasse 5, Zug, Switzerland

Представитель в РФ
ООО «Фармстандарт-Медтехника»
Российская Федерация,
141700, Московская область,
г. Долгопрудный, Лихачевский проезд,
д. 5-Б-
Тел.: (495) 739-39-48

Сделано в России

Изготовитель:
ООО «ДГМ ФАРМА АППАРАТЕ РУС»
142105, Московская область, г. Подольск,
ул. Большая Серпуховская, 57 А

LOT: RUS04
EXP 2020.10

Условия хранения
до стерилизации и после



- не использовать после истечения срока годности
- хранить в прохладном сухом месте, защищенном от света в заводской упаковке (конверте)

DGM Steriguard®

Индикатор химический для контроля
воздушной стерилизации, Класс 4
Chemical Indicator for dry heat sterilization, Class 4

Индикатор химический однократный предназначен для контроля соблюдения критических параметров воздушной стерилизации: времени и температуры, в стерилизационной камере, а также внутри упаковок, в воздушных стерилизаторах (сухожаровых шкафах).

Индикаторы могут использоваться во всех воздушных стерилизаторах (сухожаровых шкафах) при цикле стерилизации 180°C - 60 минут. При расположении индикатора внутри упаковки рекомендуется, чтобы лицевая сторона индикатора располагалась в предполагаемой точке, наиболее трудной для прогрева. После проведения цикла стерилизации индикаторная метка должна полностью изменить свой цвет на коричневый.



DGM Pharma-Apparate Handel Ag.
Baarerstrasse 8, Zug,
Switzerland

Сделано в США



Представитель в РФ:
«ООО Фармстандарт-Медтехника»
141700, Московская область,
г. Долгопрудный,
Лихачевский проезд, д.5 «Б»
Тел.:(495) 739-3948

ВОЗД

ISO 11140-1
ГОСТ-ИСО 11140-1

180°C - 60 мин

• Не использовать после истечения срока годности.
• Хранить в прохладном, сухом, защищенном от света месте в оригинальной упаковке.

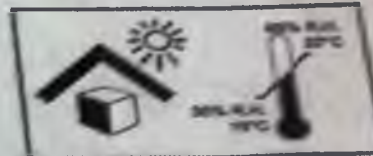

Условия хранения до
стерилизации и после

500 шт.



2016-06

LOT

D60-1606




2018-03

91261007 Rev. 05/16

5. Индикатор химический одноразовый для контроля процесса воздушной стерилизации марки "DGM Steriguard" класс 5



Производитель: DGM Pharma-Apparate Handel AG. Baarerstrasse 8, Zug Switzerland	Завод-изготовитель: Propper Manufacturing Company, Inc., 36-04 Skillman Ave, Long Island City, New York, 11101, USA. Сделано в США	Quantity / Количество: 100 шт.
Представитель в РФ: ООО «Фармстандарт-Медтехника» Российская Федерация 141700 Московская обл. Г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5»Б» Тел.: (495)7393948		
   	Индикатор химический одноразовый для контроля процесса воздушной стерилизации марки "DGM Steriguard" класс 5	
Lot:		
 Exp.:		

ПУ ФСЗ №2012/12553 ОТ 12.10.2015

6. Индикатор биологический одноразовый для контроля процесса процесса воздушной стерилизации марки «DGM Steriguard»



Производитель:

DGM Pharma-Apparate Handel AG.
Baarerstrasse 8, Zug
Switzerland

Представитель в РФ:

ООО «Фармстандарт-Медтехника»
Российская Федерация
141700 Московская обл.
Г. Долгопрудный, Лихачевский
проезд, д. 5»Б»
Тел.: (495)7393948

Завод-изготовитель:

Propper Manufacturing
Company, Inc., 36-04 Skillman
Ave, Long Island City, New
York, 11101, USA.

Сделано в США

Quantity / Количество: 100 шт.

DGMTM Steriguard[®]



Lot:



Exp.:

**Индикатор биологический
одноразовый для контроля
процесса воздушной стерилизации
марки "DGM Steriguard"**

РУ ФСЗ №2012/12553 ОТ 12.10.2015

ПРОВЕДЕНО И
ПРОНУМЕРОВАНО
«17» (сентябрь) 2015 г. / ОВ

