

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Компания «БиВи»

Т.А. Носова

2021 г.



по доверенности
77 АГ 5987789
ЖУСАНДЛО Р.В.

Фотографические изображения изделия:

Набор реагентов для быстрого количественного определения сердечного тропонина I (сTn I) иммунофлуоресцентным методом на анализаторе Fineware™ FIA для диагностики in vitro (сTn I Rapid Quantitative Test)

Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.
(Гуанчжоу Вондфо Биотех Ко., Лтд.), Китай

Finecare™



Finecare™

cTn I Rapid Quantitative Test

For Finecare™ FIA System Use Only

CONTENTS:

Test Cartridge in a sealed pouch with desiccant 25
Detection Buffer 25
Pipette Tip 25
ID Chip 1
Instructions for Use 1

W203
F2031470E AD
2020-10-27
2022-10-26
Storage: 4°C - 30°C


Rev. A1 Rev. 20180111



For *in-vitro* diagnostic use only
For professional use only




Общий вид медицинского изделия, вид сверху (Набор реагентов для быстрого количественного определения сердечного тропонина I (сTn I) иммунофлуоресцентным методом на анализаторе Finecare™ FIA для диагностики *in vitro* (сTn I Rapid Quantitative Test))

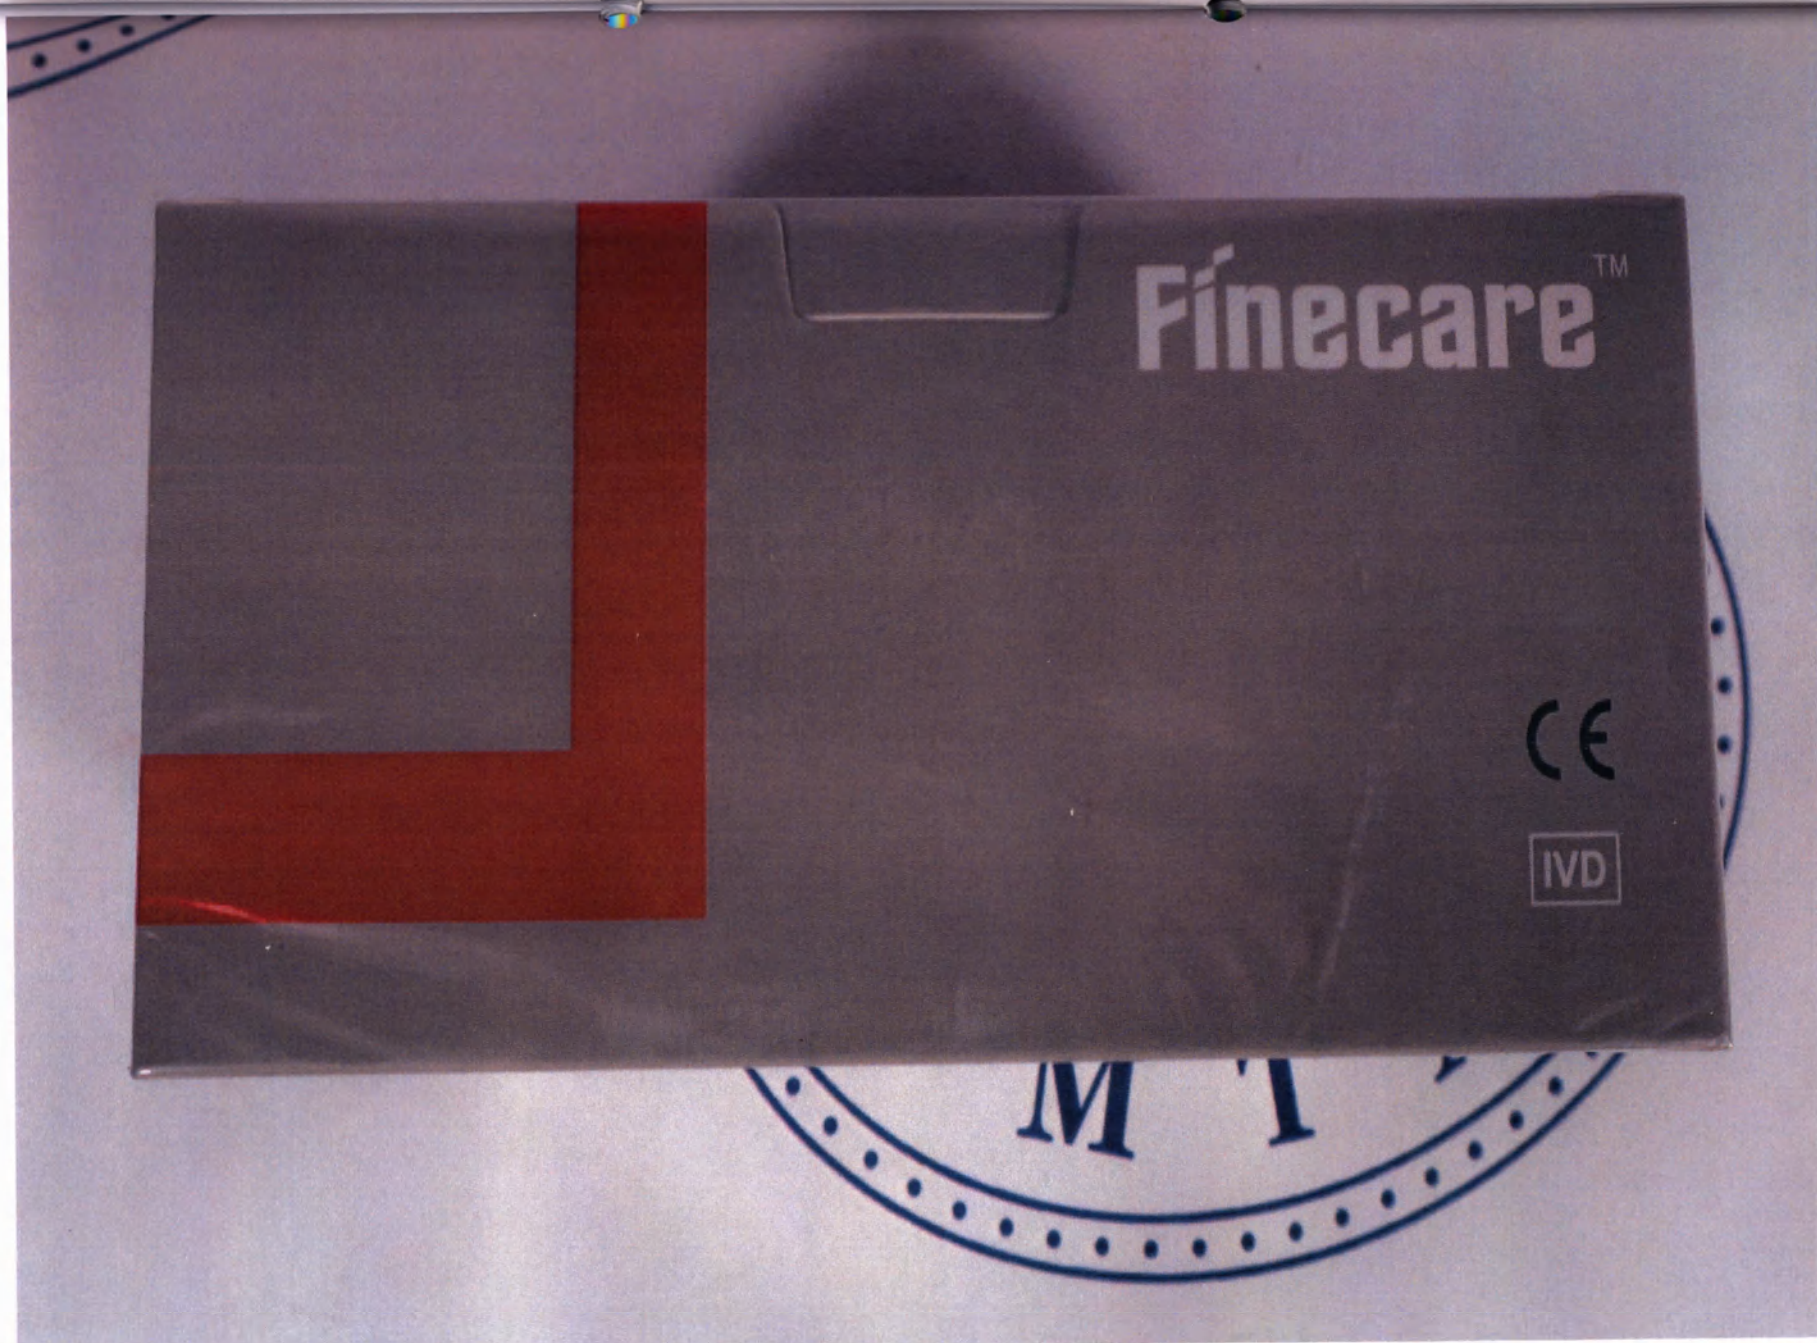

Общий вид медицинского изделия, вид спереди (Набор реагентов для быстрого количественного определения сердечного тропонина I (сTn I) иммунофлуоресцентным методом на анализаторе Finecare™ FIA для диагностики in vitro (сTn I Rapid Quantitative Test))




Общий вид медицинского изделия, вид с правой стороны (Набор реагентов для быстрого количественного определения сердечного тропонина I (сTn I) иммунофлуоресцентным методом на анализаторе Fineware™ FIA для диагностики in vitro (сTn I Rapid Quantitative Test))

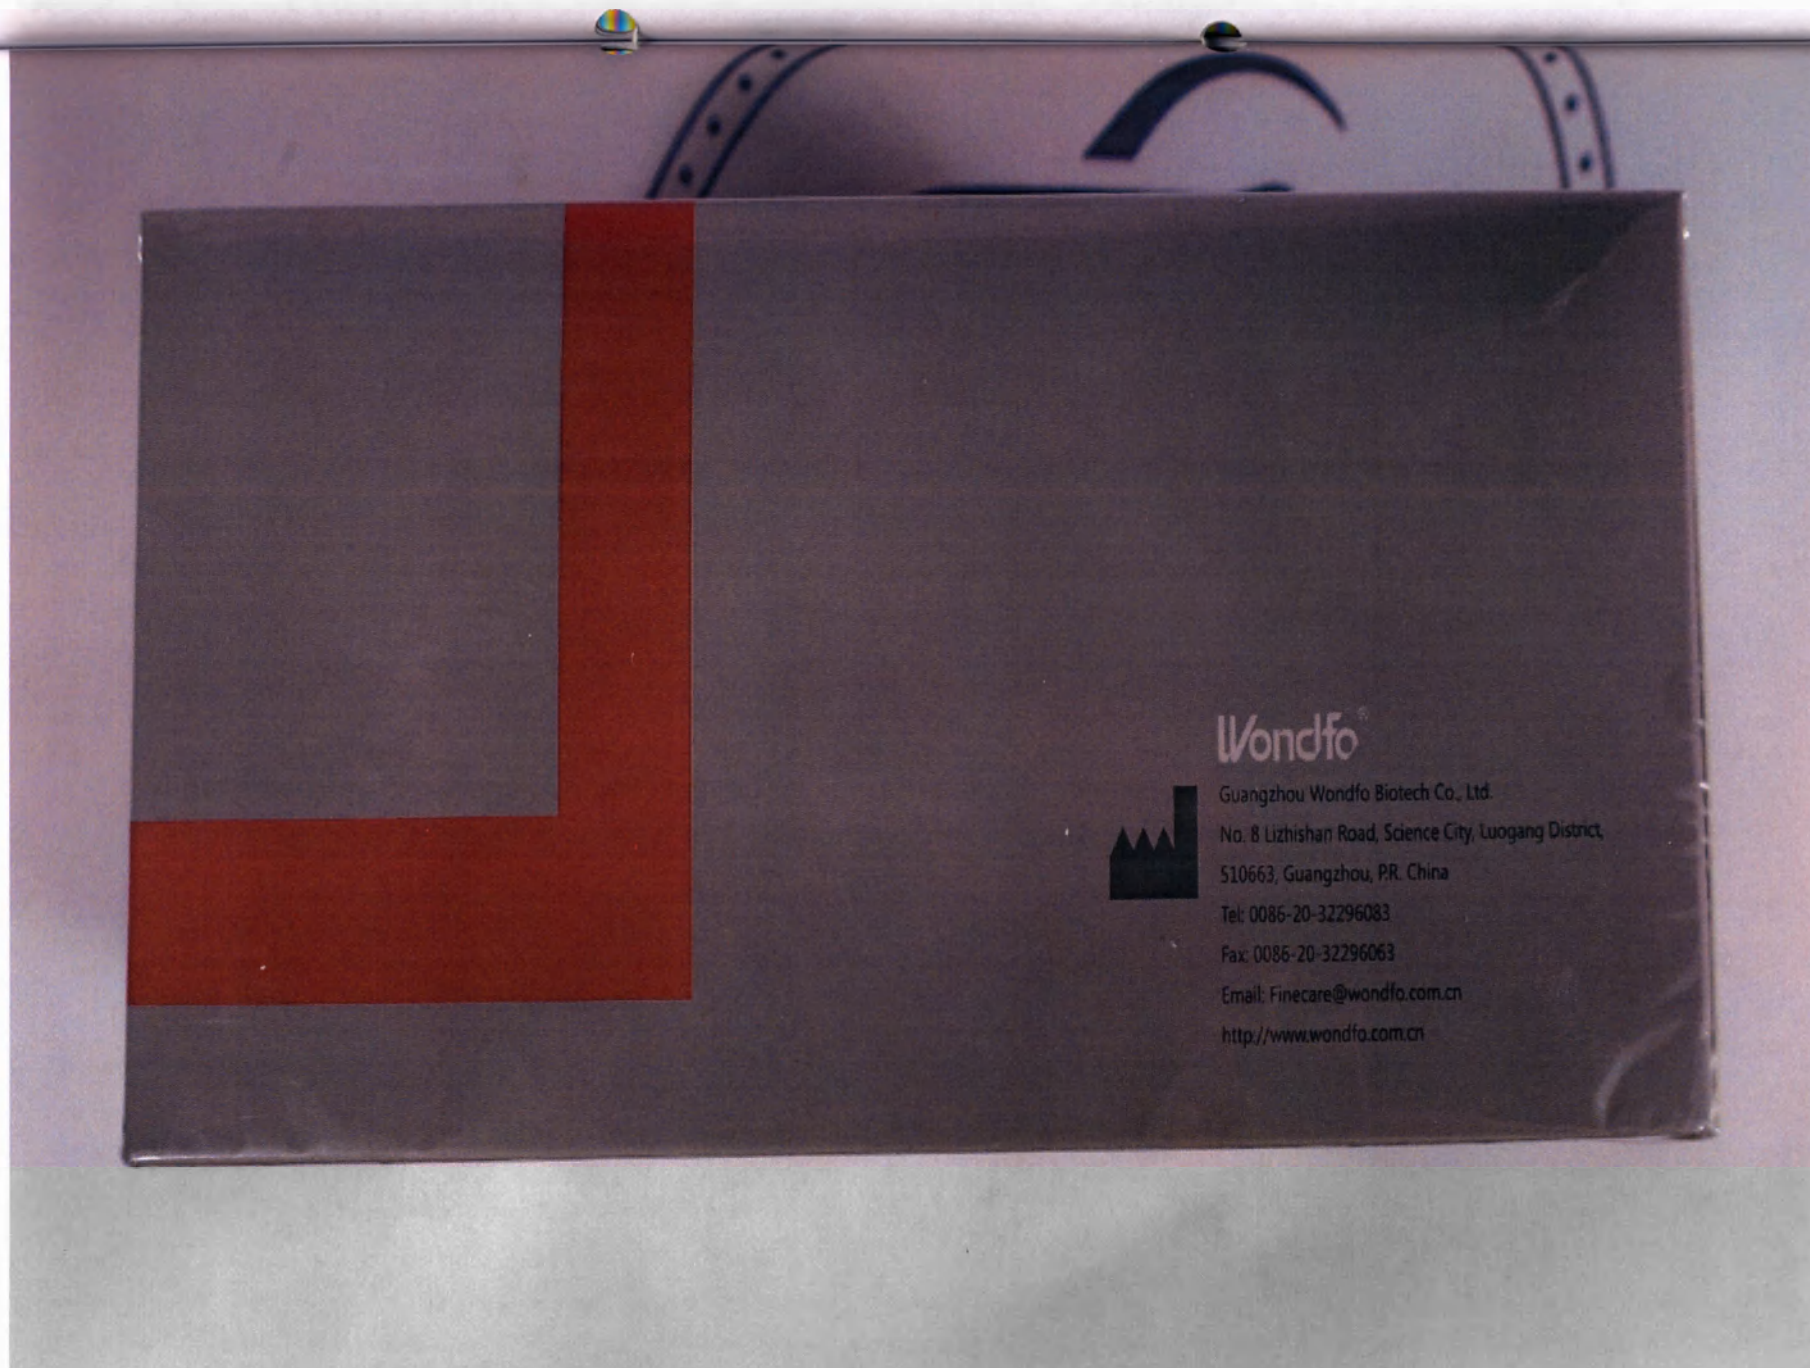

Общий вид медицинского изделия, вид сзади (Набор реагентов для быстрого количественного определения сердечного тропонина I (сTn I) иммунофлуоресцентным методом на анализаторе Finecare™ FIA для диагностики in vitro (сTn I Rapid Quantitative Test))



Общий вид медицинского изделия, вид с левой стороны (Набор реагентов для быстрого количественного определения сердечного тропонина I (сTn I) иммунофлуоресцентным методом на анализаторе Finecare™ FIA для диагностики in vitro (сTn I Rapid Quantitative Test))

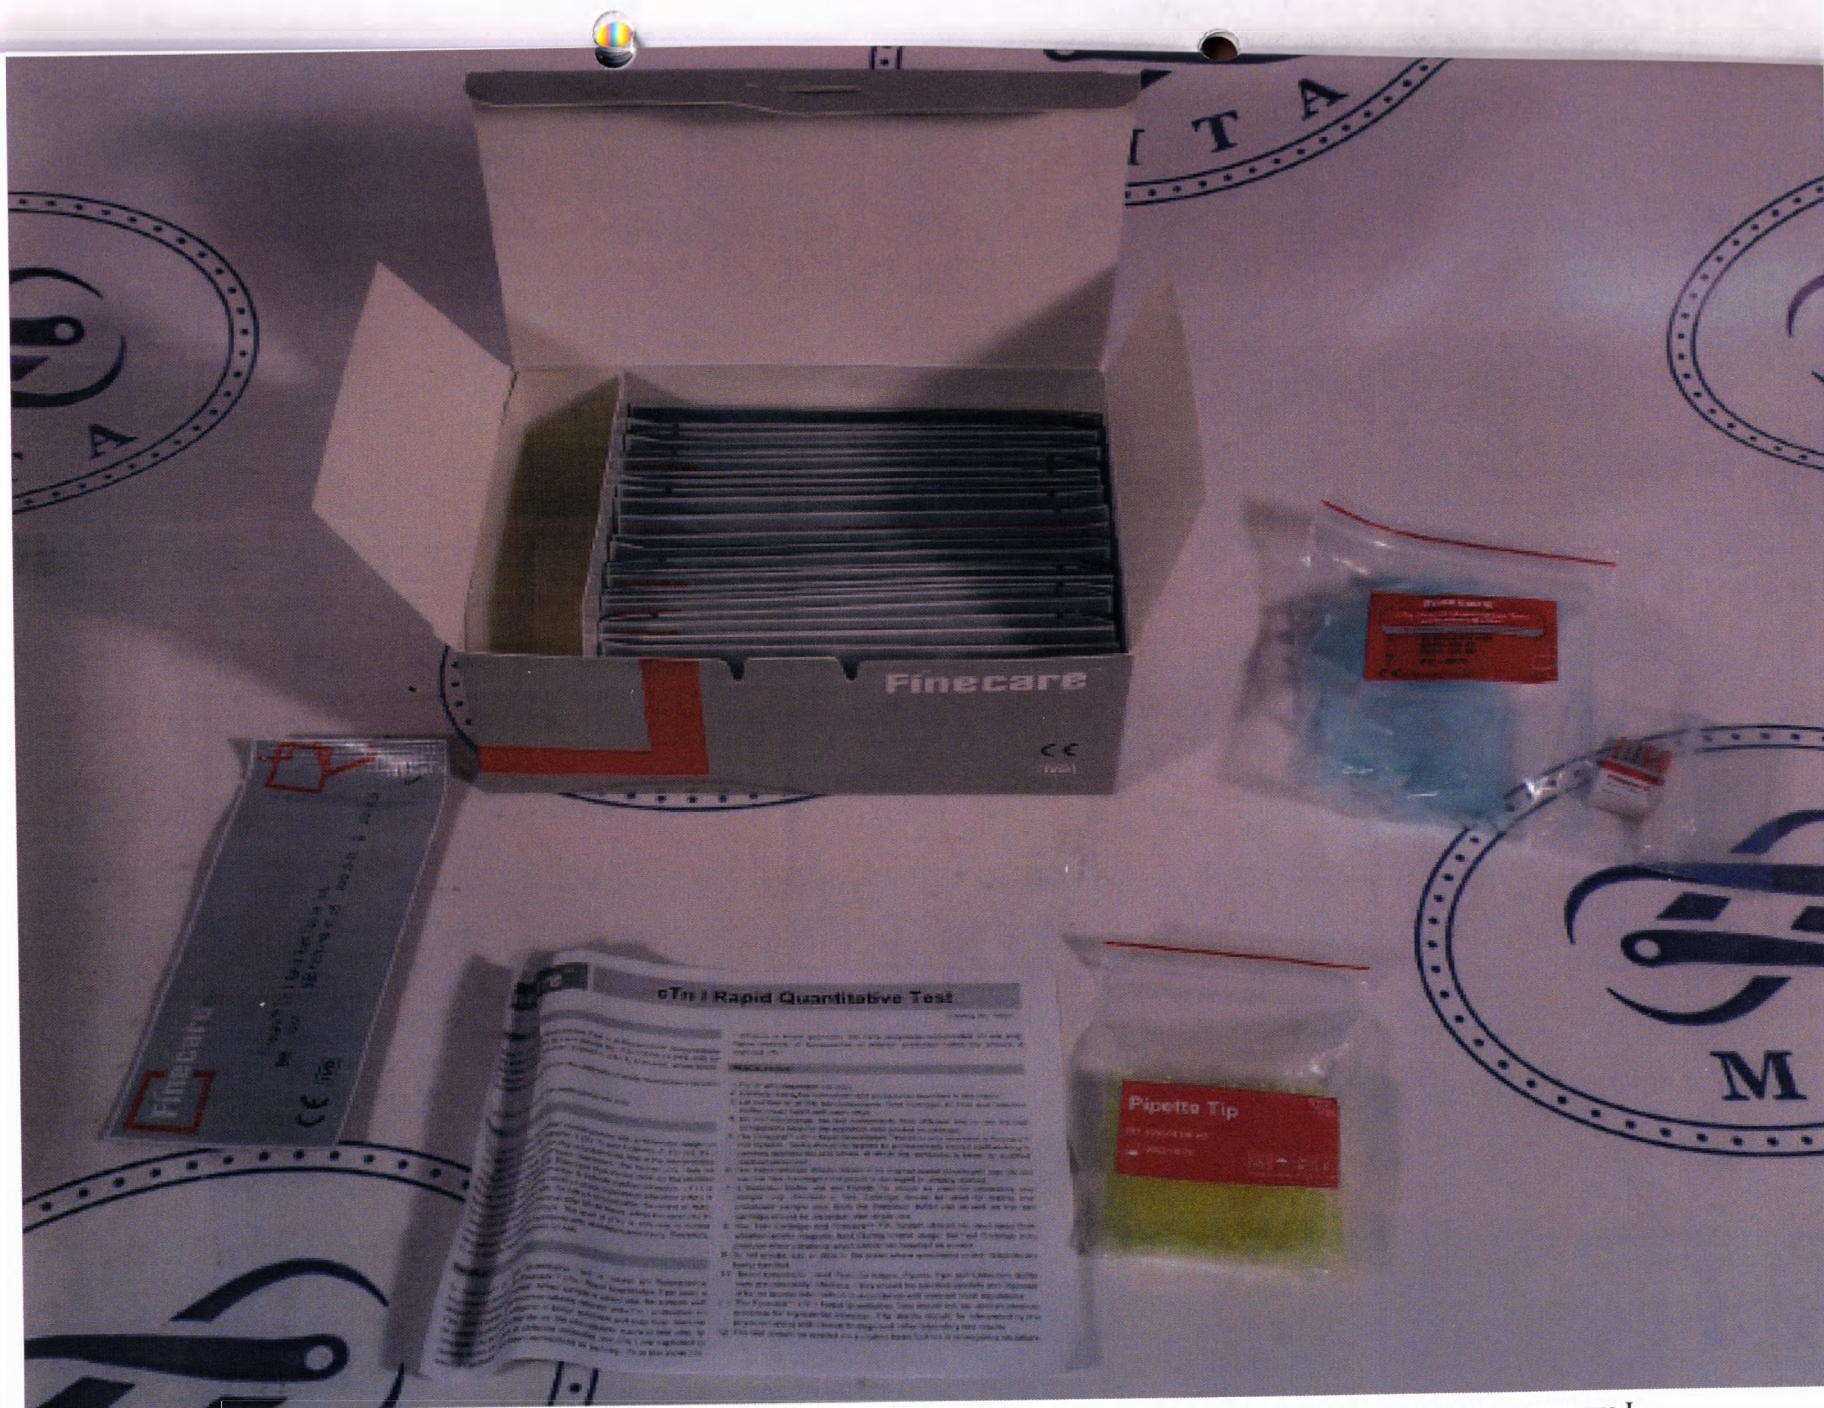

Компоненты медицинского изделия (Набор реагентов для быстрого количественного определения сердечного тропонина I (cTn I) иммунофлуоресцентным методом на анализаторе Finecare™ FIA для диагностики in vitro (cTn I Rapid Quantitative Test))



Finecare™ cTn I Rapid Quantitative Test

REF

00000

LOT

F3001470E AD



2020-10-27



2022-10-26



IVD



Тест-картридж, вид спереди (Набор реагентов для быстрого количественного определения сердечного тропонина I (сTn I) иммунофлуоресцентным методом на анализаторе Finecare™ FIA для диагностики in vitro (cTn I Rapid Quantitative Test))


Wondfo®




Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.
No.8 Lizhishan Road, Science City, Luogang
District, 510663, Guangzhou, P.R.China
Tel: 0086-20-32296083
Fax: 0086-20-32296063
E-mail: Finecare@wondfo.com.cn
Website: www.wondfo.com.cn

Rev.A1 Rel:2020/08/21

Тест-картридж, вид сзади (Набор реагентов для быстрого количественного определения сердечного тропонина I
(cTn I) иммунофлуоресцентным методом на анализаторе Finecare™ FIA для диагностики in vitro (cTn I Rapid Quantitative Test))

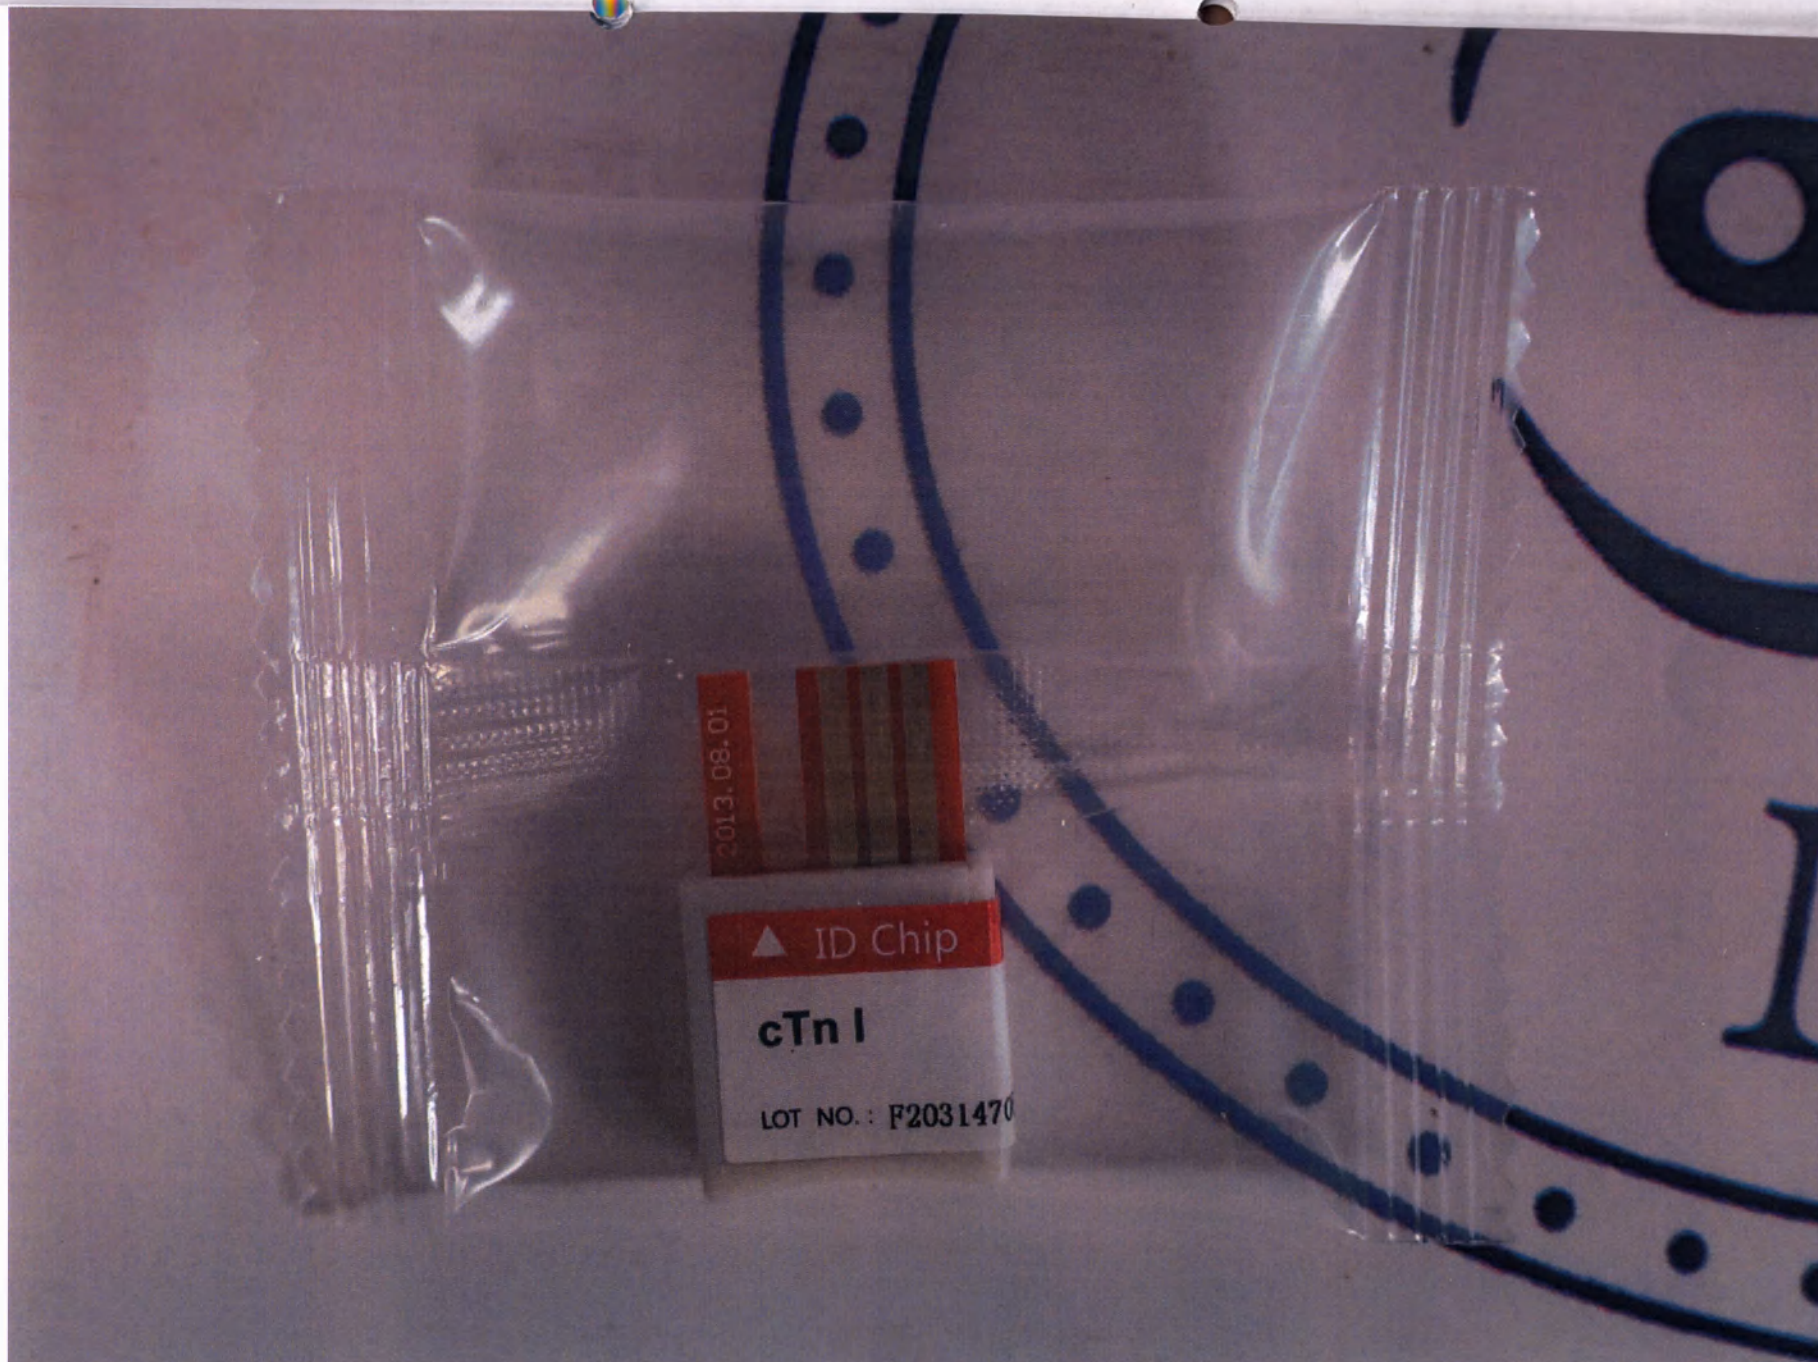

ID чип (Набор реагентов для быстрого количественного определения сердечного тропонина I (сTn I) иммунофлуоресцентным методом на анализаторе Fineware™ FIA для диагностики in vitro (сTn I Rapid Quantitative Test))

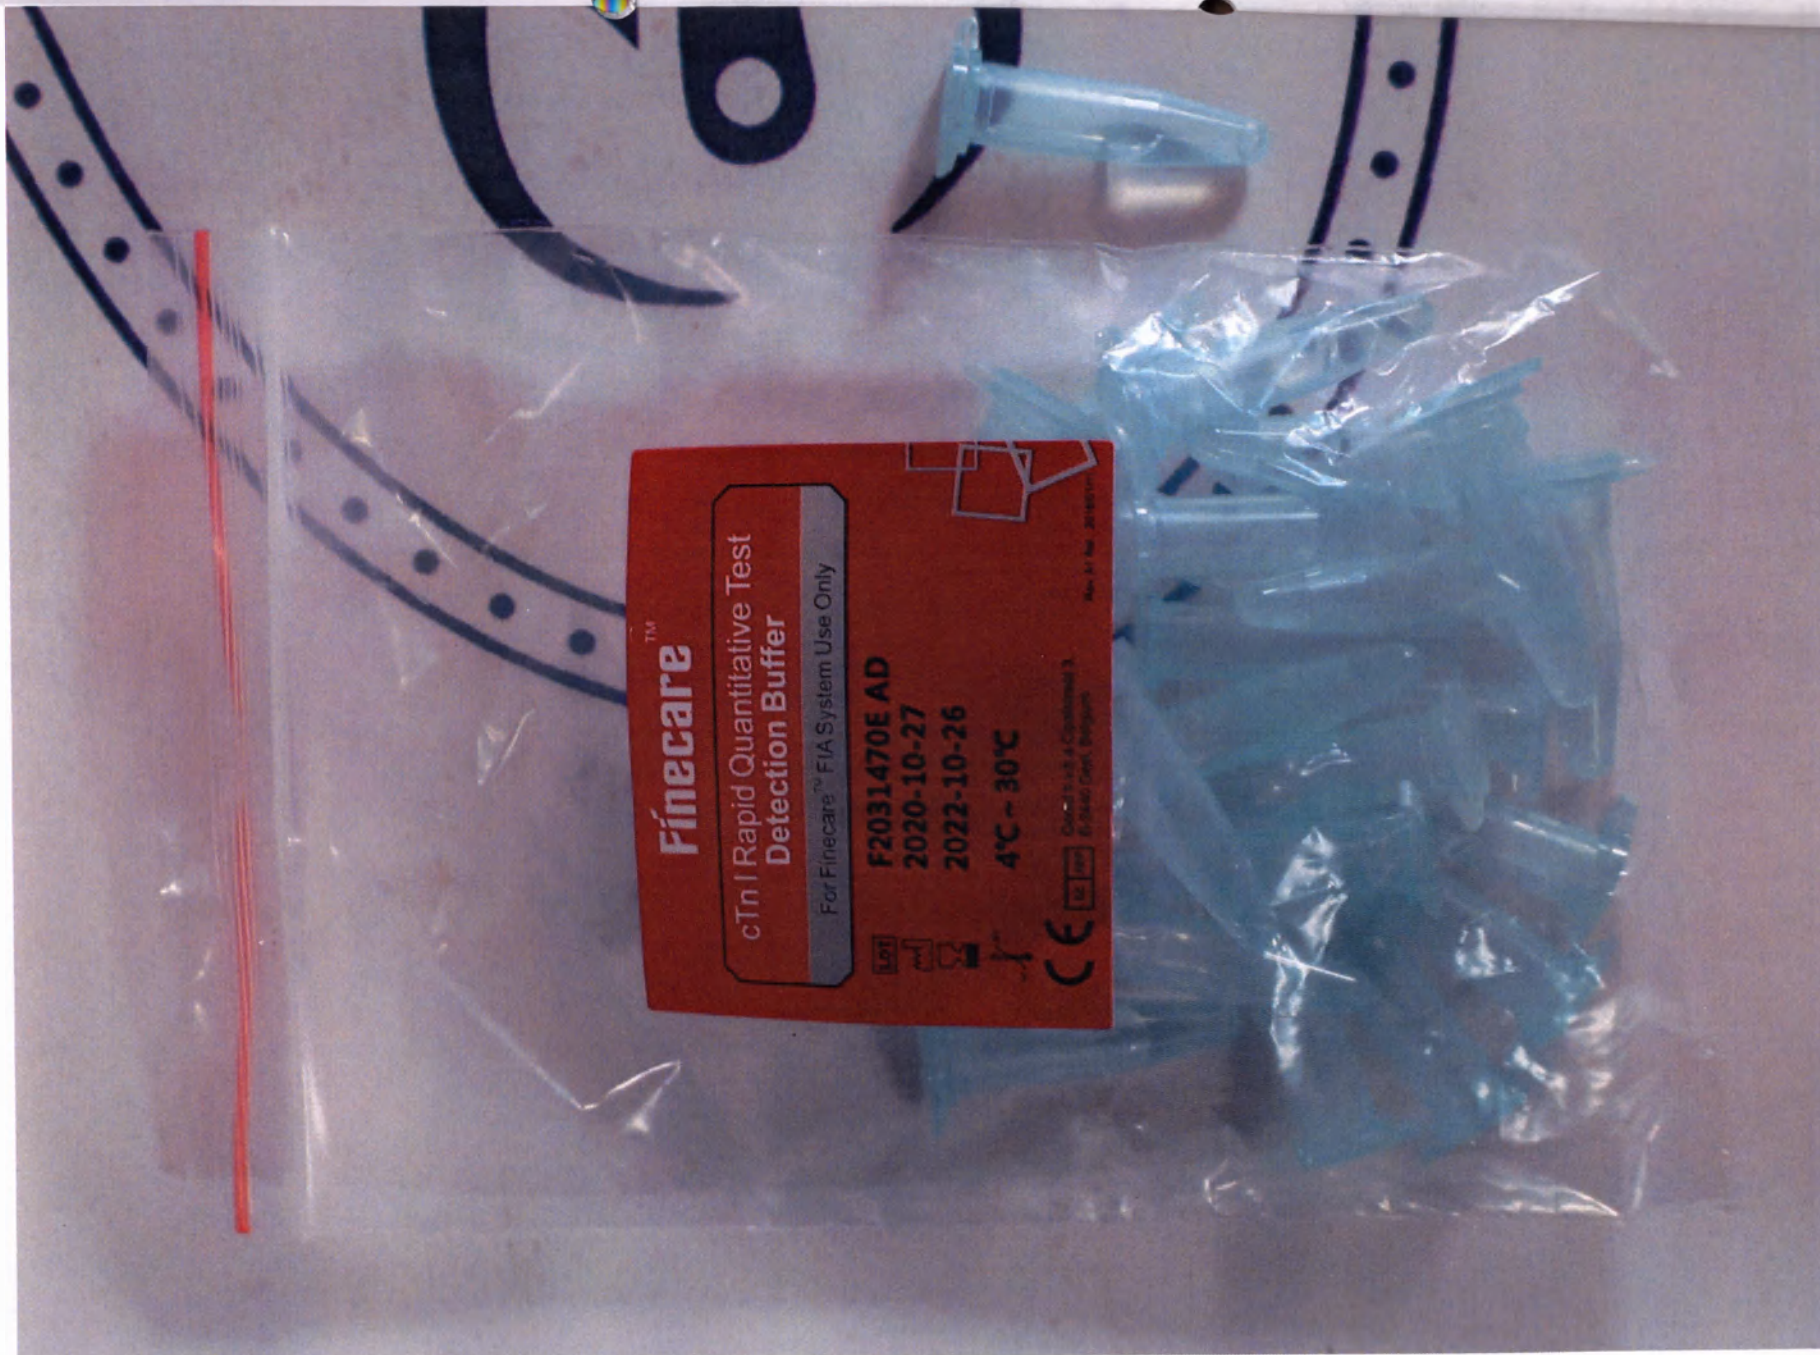

Буфер обнаружения (Набор реагентов для быстрого количественного определения сердечного тропонина I (сTn I) иммунофлуоресцентным методом на анализаторе Finecare™ FIA для диагностики in vitro (сTn I Rapid Quantitative Test))



Наконечник для пипетки (Набор реагентов для быстрого количественного определения сердечного тропонина I (сTn I) иммунофлуоресцентным методом на анализаторе Finecare™ FIA для диагностики in vitro (сTn I Rapid Quantitative Test))

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 12 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А
М.П.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 5987789
КУСАЙЛО Р.В.

