

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Компания «БиВи»

Т.А. Носова

2021 г.



ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77/АГ 5987789


КУСАЙЛО Р.В.

Фотографические изображения изделия:

**Набор реагентов для быстрого количественного определения D-димера (DD)
иммунофлуоресцентным методом на анализаторе Finecare™ FIA для диагностики in vitro
(D-Dimer Rapid Quantitative Test)**

Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.
(«Гуанчжоу Вондфо Биотех Ко., Лтд.»), Китай

FinecareTM



FinecareTM


D-Dimer Rapid Quantitative Test

For FinecareTM FIA System Use Only

CONTENTS:

Test Cartridge in a sealed pouch with desiccant
Detection Buffer
Pipette Tip
ID Chip
Instructions for Use


25
25
25
1
1




W211
F21114903 AD
2020-10-16
2022-10-15

Storage: 4°C ~ 30°C


Rev. A1 Rel. 2018/01/11




For *in-vitro* diagnostic use only
For professional use only




Общий вид медицинского изделия, вид сверху (Набор реагентов для быстрого количественного определения D-димера (DD) иммунофлуоресцентным методом на анализаторе FinecareTM FIA для диагностики *in vitro* (D-Dimer Rapid Quantitative Test))

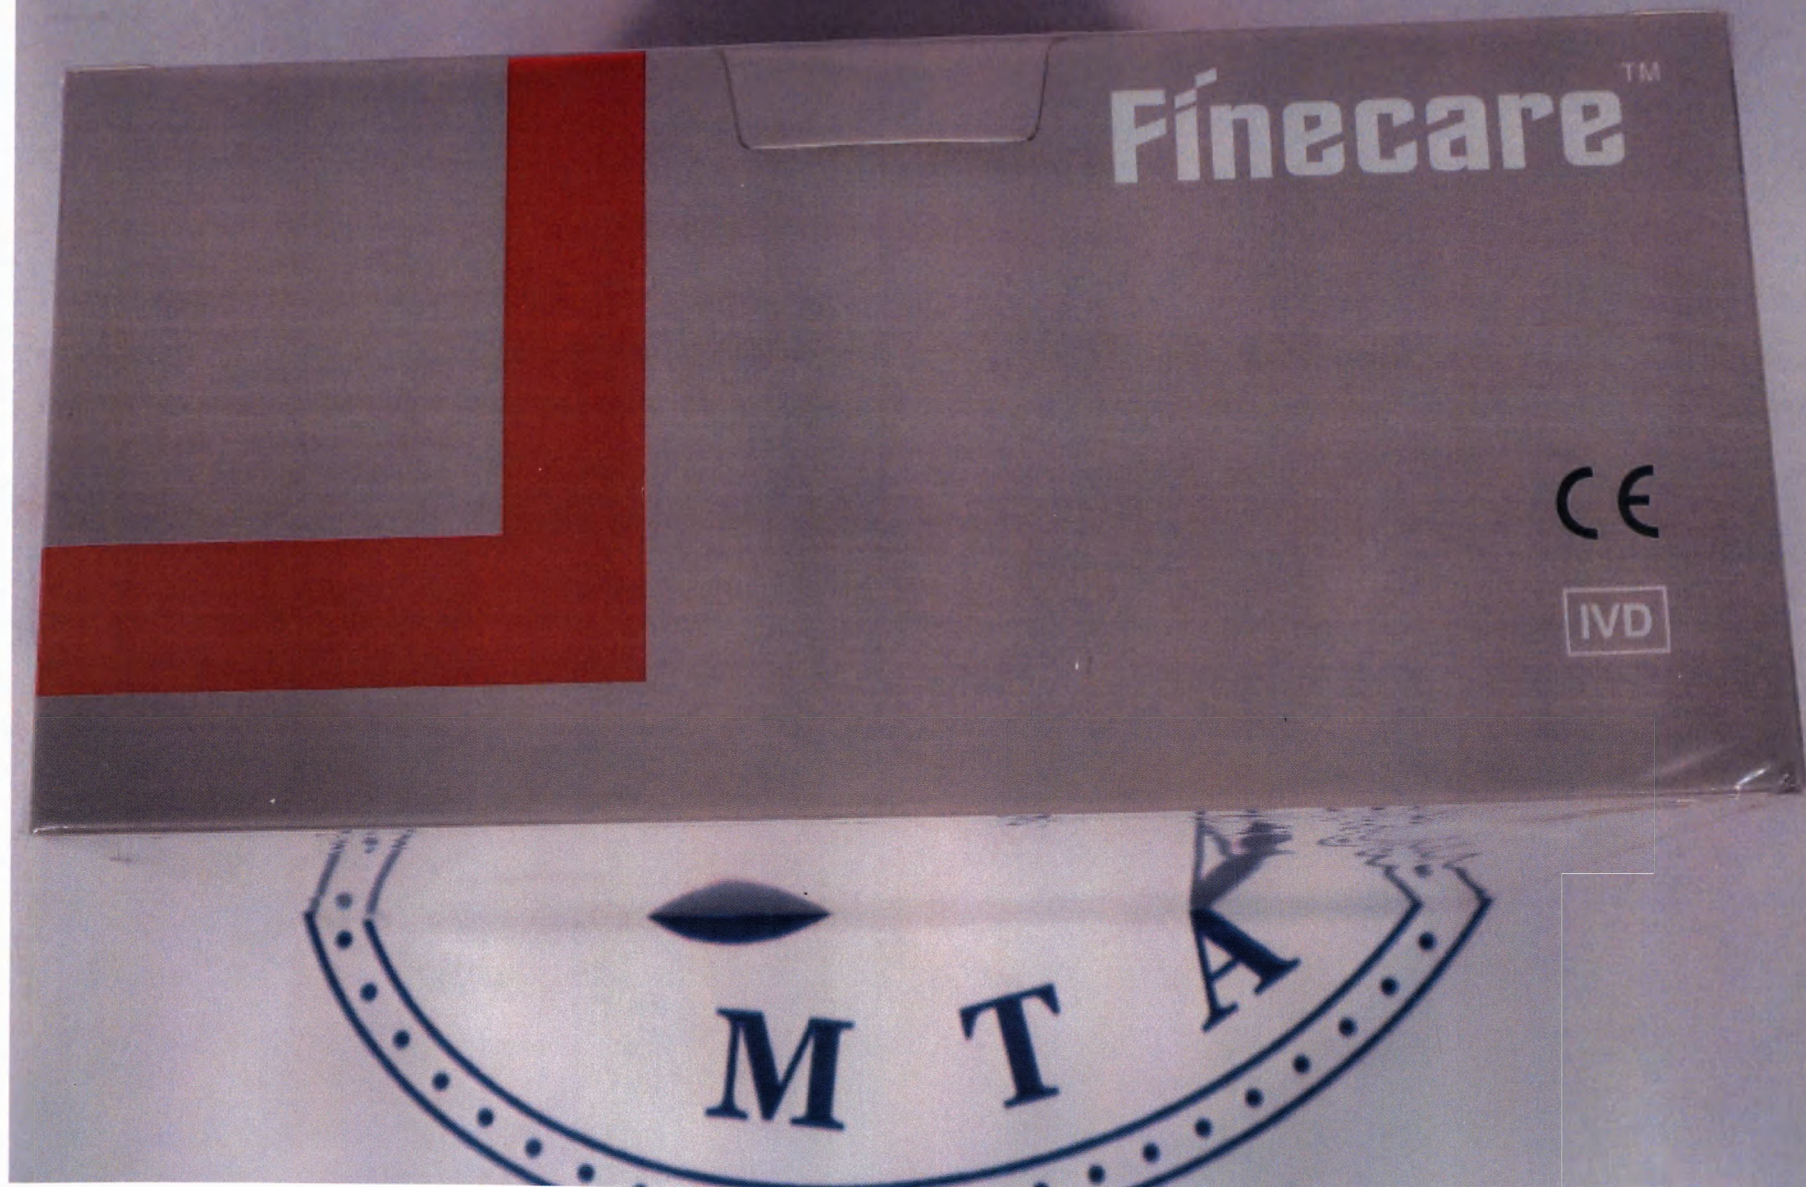

Общий вид медицинского изделия, вид спереди (Набор реагентов для быстрого количественного определения D-димера (DD) иммунофлуоресцентным методом на анализаторе Finecare™ FIA для диагностики in vitro (D-Dimer Rapid Quantitative Test))

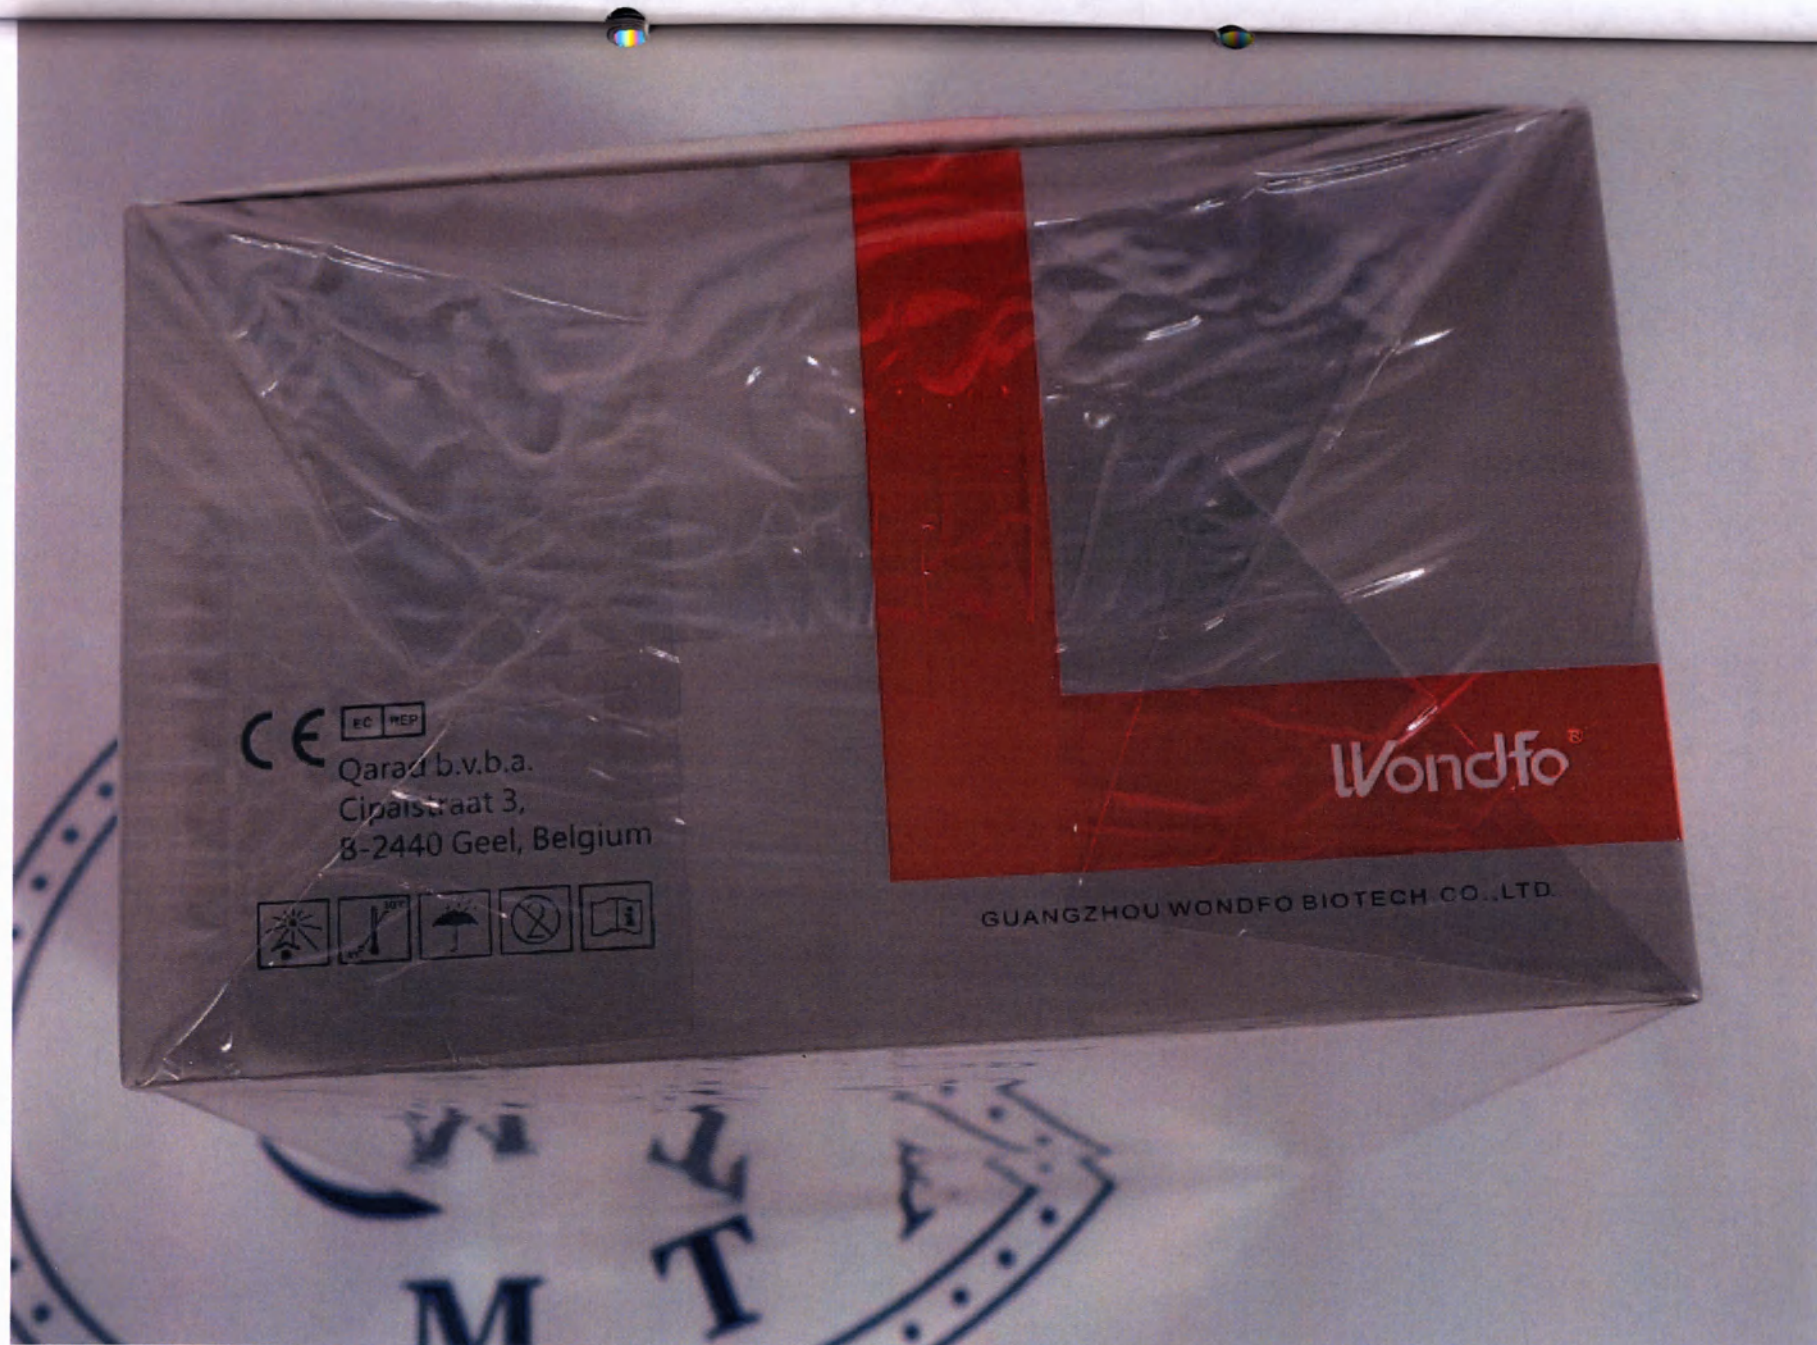

Общий вид медицинского изделия, вид с правой стороны (Набор реагентов для быстрого количественного определения D-димера (DD) иммунофлуоресцентным методом на анализаторе Finescare™ FIA для диагностики in vitro (D-Dimer Rapid Quantitative Test))

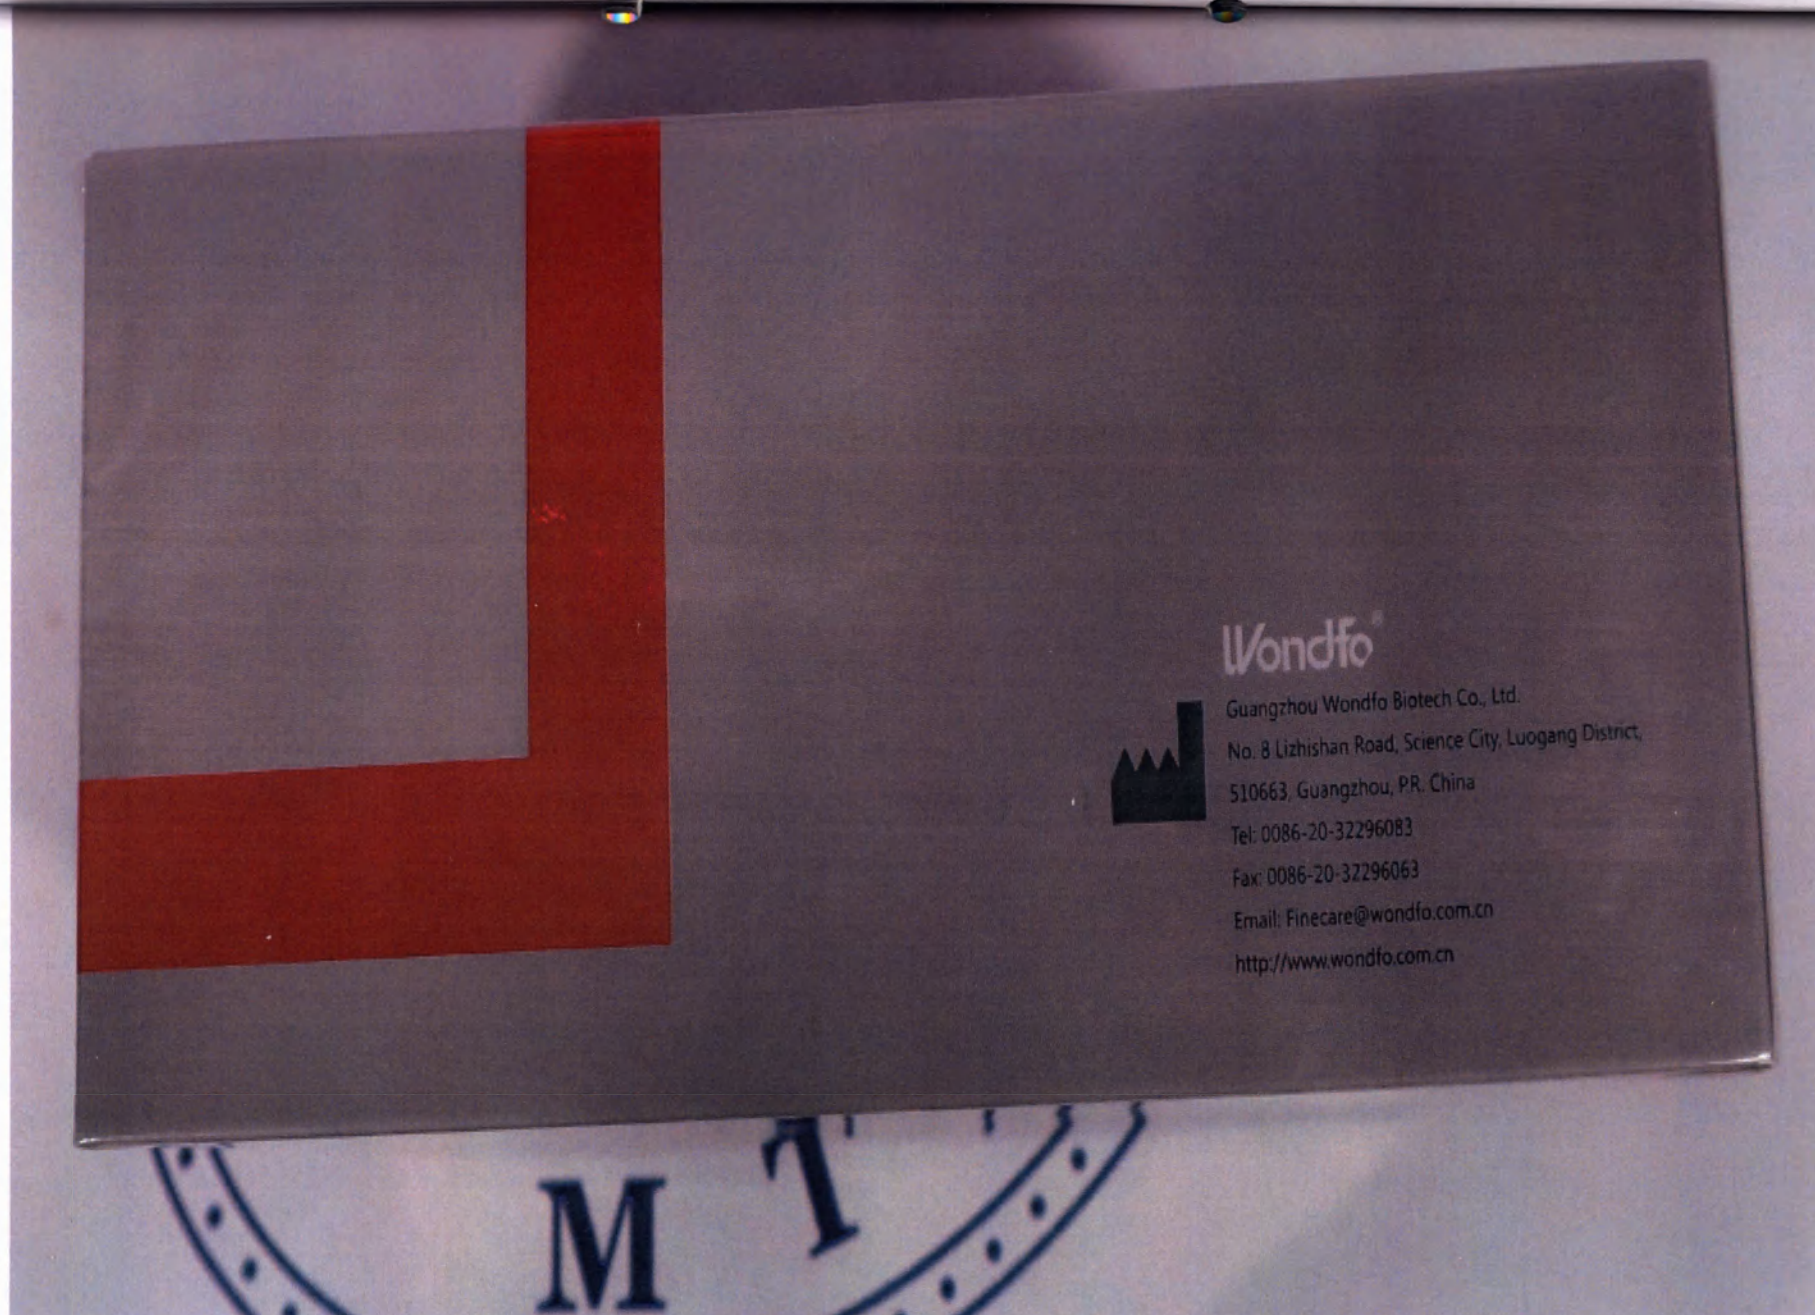


Wondfo®



Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.
No. 8 Lizhishan Road, Science City, Luogang District,
510663, Guangzhou, P.R. China
Tel: 0086-20-32296083
Fax: 0086-20-32296063
Email: Finecare@wondfo.com.cn
<http://www.wondfo.com.cn>


Общий вид медицинского изделия, вид сзади (Набор реагентов для быстрого количественного определения D-димера (DD) иммунофлуоресцентным методом на анализаторе Finecare™ FIA для диагностики in vitro (D-Dimer Rapid Quantitative Test))

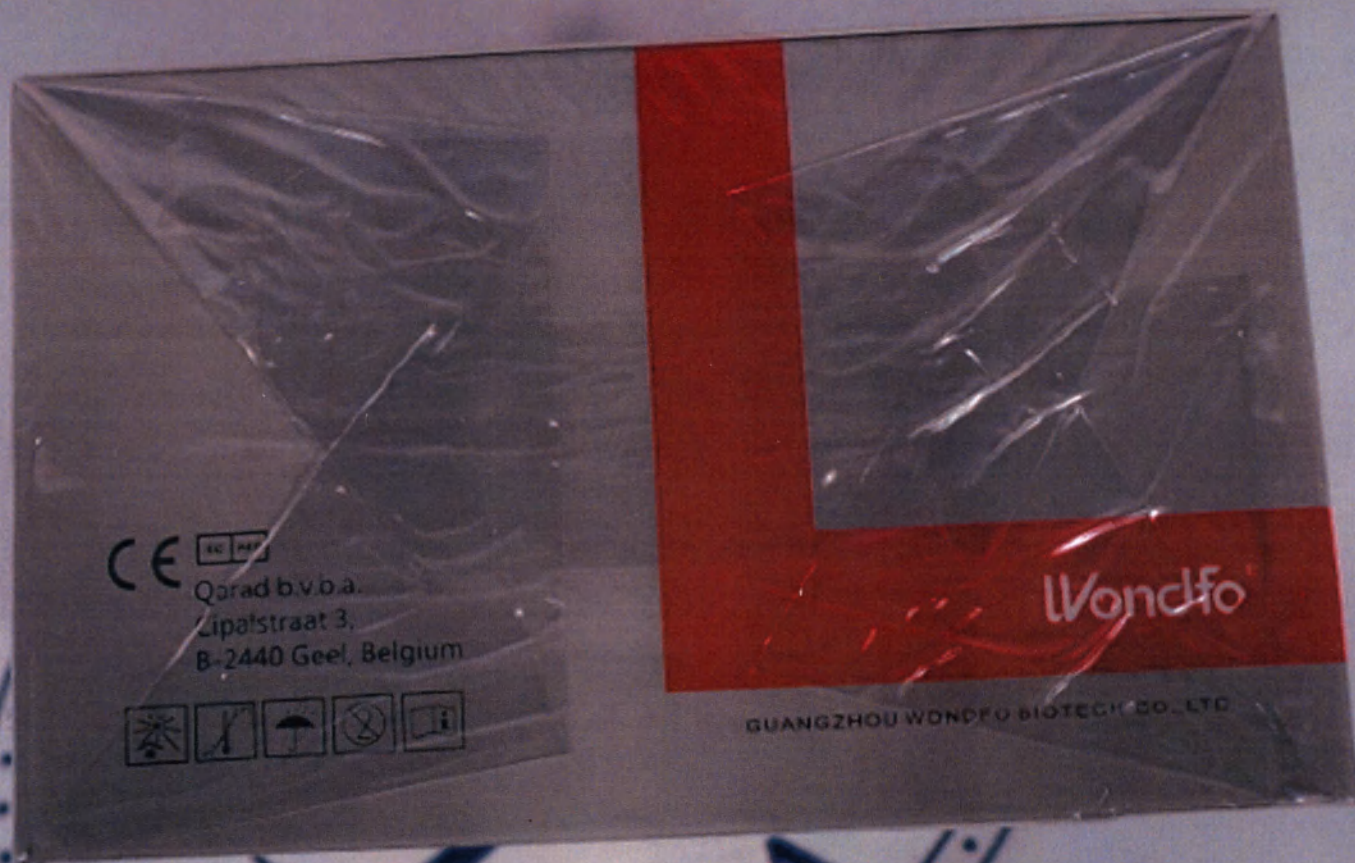

Общий вид медицинского изделия, вид с левой стороны (Набор реагентов для быстрого количественного определения D-димера (DD) иммунофлуоресцентным методом на анализаторе Finecare™ FIA для диагностики in vitro (D-Dimer Rapid Quantitative Test))



Компоненты медицинского изделия (Набор реагентов для быстрого количественного определения D-димера (DD) иммунофлуоресцентным методом на анализаторе Fineware™ FIA для диагностики in vitro (D-Dimer Rapid Quantitative Test))

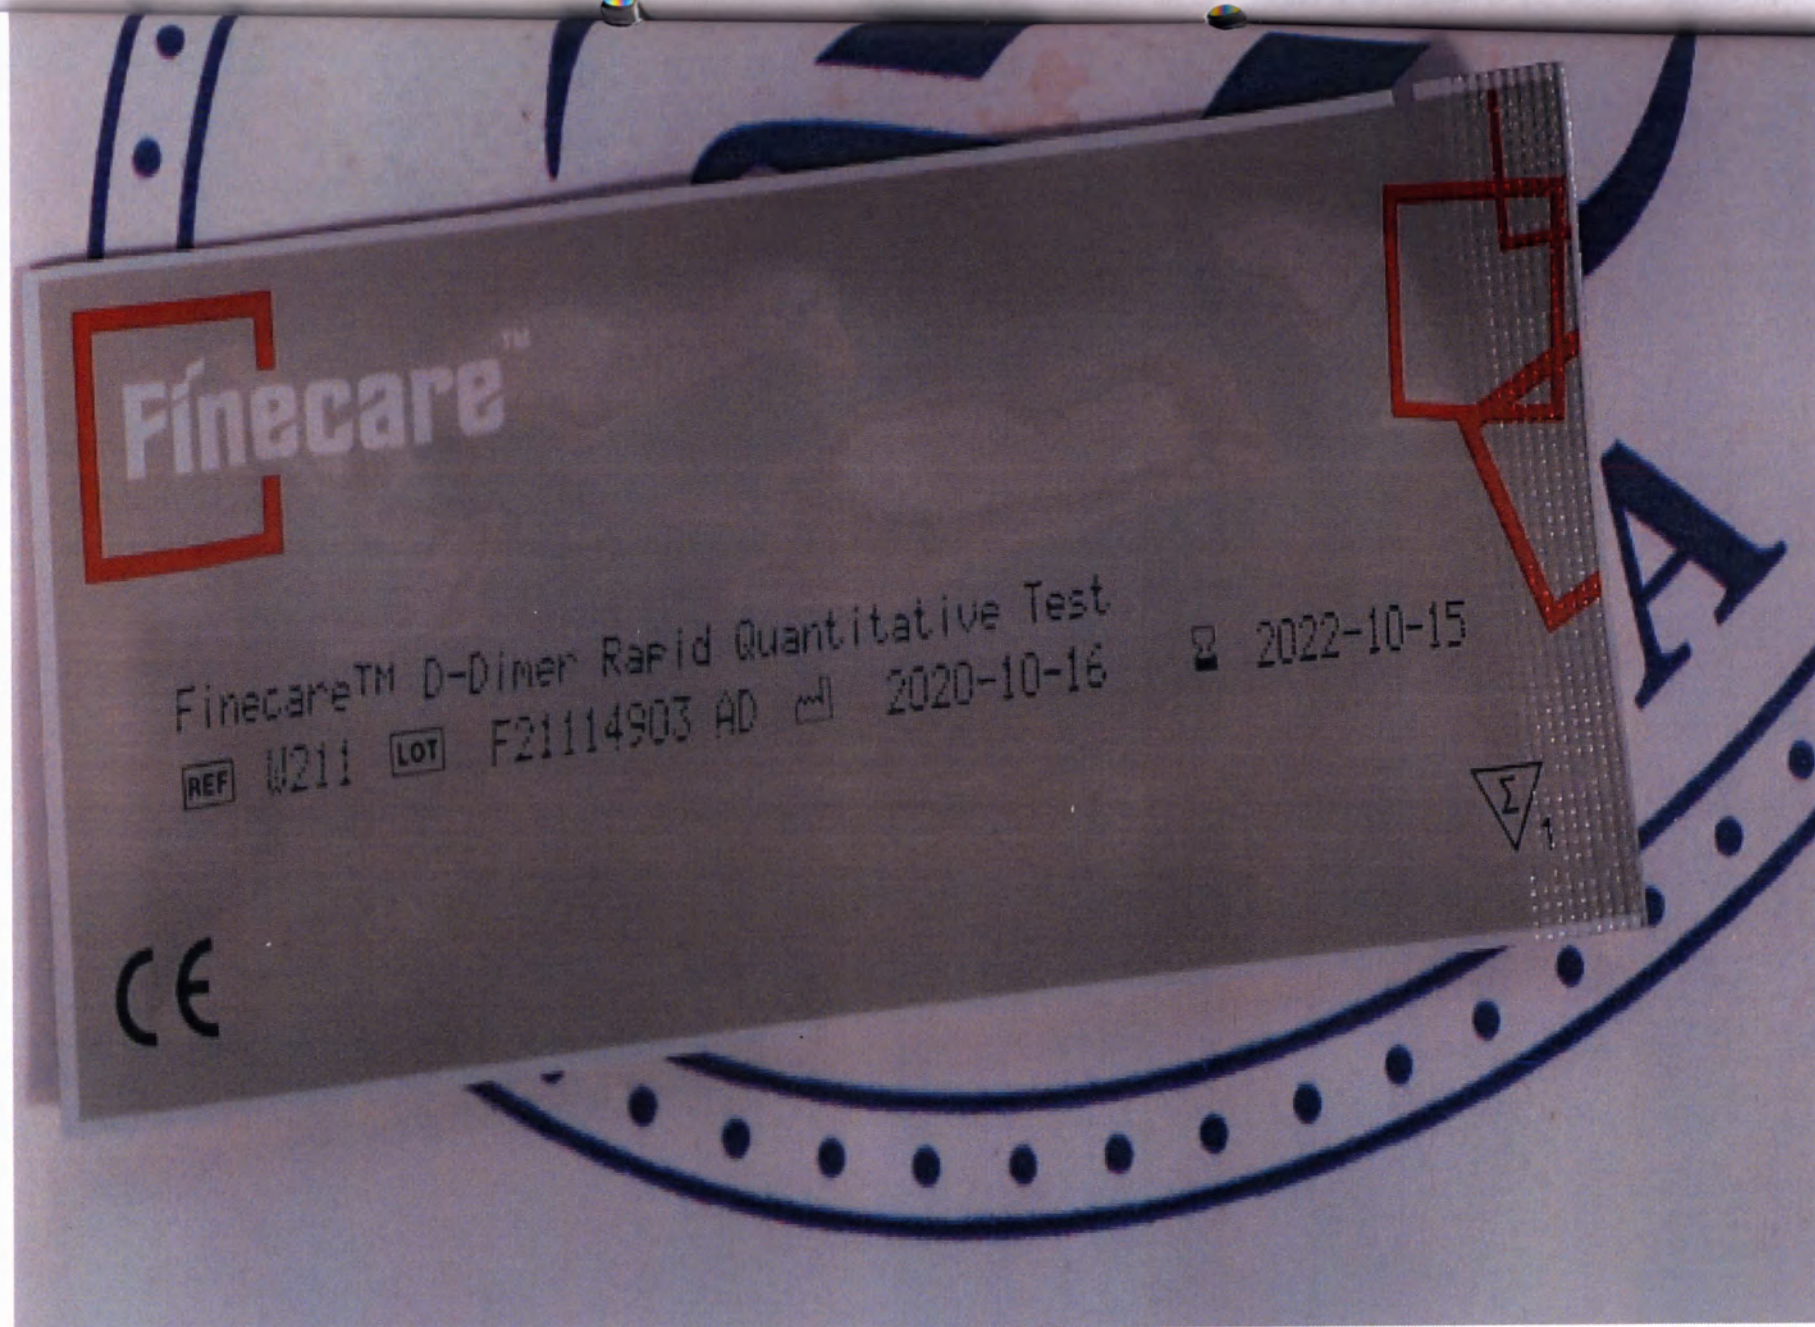


Тест-картридж, вид спереди (Набор реагентов для быстрого количественного определения D-димера (DD) иммунофлуоресцентным методом на анализаторе Finecare™ FIA для диагностики in vitro (D-Dimer Rapid Quantitative Test))

- Storage:
1. Store at 4~30°C up to the expiration date.
 2. If removes from refrigerator, allow the Test Device for 30 minutes to return to room temperature before testing.
 3. Do not remove the Test Device from the pouch until ready to use.
- The Test Device should be used within 1 hour once opened.

Wondfo®



Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.
No. 8 Lizhishan Road, Science City, Luogang
District, 510663, Guangzhou, P.R. China
Tel: 0086-20-32296083
Fax: 0086-20-32296063
Email: Finecare@wondfo.com.cn
<http://www.wondfo.com.cn>

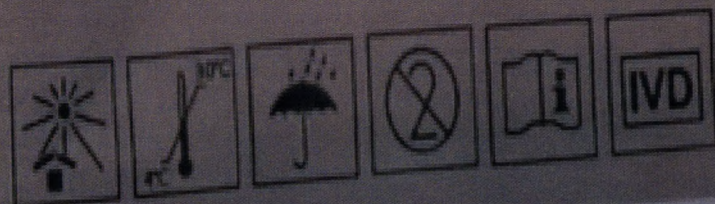

Тест-картридж, вид сзади (Набор реагентов для быстрого количественного определения D-димера (DD) иммунофлуоресцентным методом на анализаторе Finescare™ FIA для диагностики in vitro (D-Dimer Rapid Quantitative Test))



ID чип (Набор реагентов для быстрого количественного определения D-димера (DD) иммунофлуоресцентным методом на анализаторе Fineware™ FIA для диагностики in vitro (D-Dimer Rapid Quantitative Test))



Буфер обнаружения (Набор реагентов для быстрого количественного определения D-димера (DD) иммунофлуоресцентным методом на анализаторе Finescare™ FIA для диагностики in vitro (D-Dimer Rapid Quantitative Test))



Наконечник для пипетки (Набор реагентов для быстрого количественного определения D-димера (DD) иммунофлуоресцентным методом на анализаторе Finecare™ FIA для диагностики in vitro (D-Dimer Rapid Quantitative Test))

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 12 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А
М.П.



ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 5987789
КУСАЙЛО Р.В.