



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2022 года № РЗН 2022/17835

На медицинское изделие

Анализатор автоматический осадка мочи UD-1320 с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Акционерное общество "СОЛТ"

(АО "СОЛТ"), Россия,

197046, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 3, литер Б, оф. 308

Производитель

"УРИТ Медикал Электроник Ко., Лтд.", Китай,

URIT Medical Electronic Co., Ltd., № D-07, Information Industry District, High-tech
Zone, Guilin, Guangxi 541004, P.R. China

Место производства медицинского изделия

URIT Medical Electronic Co., Ltd., No. D-07 Information Industry District, High-
Tech Zone, Guilin, Guangxi 541004, P.R. China

Номер регистрационного досье № РД-48694/96004 от 24.03.2022


Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 26.60.12.119

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 26 июля 2022 года № 6851
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

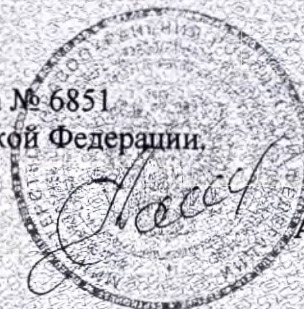

А.В. Самойлова

0064322

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2022 года

№ РЗН 2022/17835

Лист 1

На медицинское изделие

Анализатор автоматический осадка мочи UD-1320 с принадлежностями:

I. Состав:

1. Анализатор автоматический осадка мочи UD-1320 - 1 шт.:

- основной блок анализатора - 1 шт.;
- краткое руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- пособие о запуске - 1 шт.;
- сертификат товара - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- атлас осадков мочи (при необходимости) - 1 шт.;
- загрузчик образцов (SS модуль) - 1 шт.;
- раствор для фокусировки камеры FC 23 (4 фл. по 8 мл) - не более 2 шт.;
- ключ для снятия крышек - 1 шт.;
- кабель питания - 1 шт.;
- кабель соединительный - 2 шт.;
- трубка для раствора проточных измерений - 1 шт.;
- трубка наружная сливная к баку сливному 20 л - 1 шт.;
- трубка пластиковая АВН02017 (1/4X3/81NCH) для сливной жидкости, 5 м - 1 шт. (при необходимости);
- штатив для образцов - не более 20 шт.;
- пробирка центрифужная с завинчивающейся крышкой объемом 10 мл - 1 уп. x 100 шт.;
- адаптер для пробирок с диаметром 13 мм, высотой 100 мм - 1 уп. x 100 шт.;
- модуль управления - 1 шт.;
- монитор Lenovo T2254A - 1 шт.;
- клавиатура - 1 шт.;
- манипулятор «мышь» - 1 шт.;
- свитч, 100 М - 1 шт.;
- сканер штрих-кода ручной - 1 шт.;
- кабель к модулю управления - 1 шт.;
- держатель монитора - 1 шт.


2. Тумба с креплением для автоматического анализатора осадка мочи UD-1320 - не более 6 шт.

3. Парковочная станция - 1 шт.

4. Тумба для парковочной станции - 1 шт.

5. Модуль подачи образцов - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

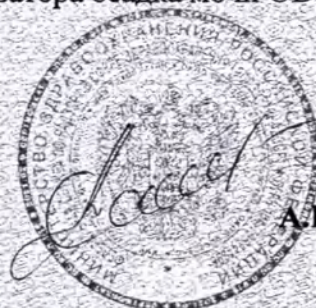

А.В. Самойлова

0105470

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2022 года

№ РЗН 2022/17835

Лист 2

6. Тумба для модуля подачи образцов с креплением и суппортом кронштейна монитора - 1 шт.
 7. Раствор проточных измерений S11 для анализатора автоматического осадка мочи UD-1320 (20 л) - не более 2 шт.
 8. Раствор промывающий D16 для анализатора автоматического осадка мочи UD-1320 (35 мл) - не более 2 шт.
 9. Контрольный материал QC22 Уровень 1 (4 фл. по 8 мл в уп.) - не более 2 уп.
 10. Контрольный материал QC22 Уровень 2 (4 фл. по 8 мл в уп.) - не более 2 уп.
 11. Контрольный материал QC22 Уровень 3 (4 фл. по 8 мл в уп.) - не более 2 уп.
- II. Принадлежности:
- кабель заземления, 3 м - не более 2 шт.;
 - кабель соединительный, 3 м - 1 шт.;
 - кабель сетевой, 1,5 м - 1 шт.;
 - коврик для «мыши» - 1 шт.;
 - удлинитель 1,8 м (2500W-10A) - 2 шт.;
 - бак сливной 20 л - 1 шт.;
 - удлинитель USB 1,5 м - 1 шт.;
 - болт 6 -ти-гранный ключ M3x10 (1 уп. по 30 шт.) - 1 уп.;
 - болт под крестообразную отвертку M4x8 (1 уп. по 30 шт.) - 1 уп.;
 - болт 6 -ти-гранный ключ M4x20 (1 уп. по 12 шт.) - 1 уп.;
 - болт 6 -ти-гранный ключ M6x20 (1 уп. по 15 шт.) - 1 уп.;
 - болт 6 -ти-гранный ключ M6x30 (1 уп. по 6 шт.) - 1 уп.

З

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0105471