

Фотографические изображения медицинского изделия

**«Клипсы хирургические титановые для
лапароскопических операций,
стерильные, КХЛ-"ТЕТ"
по ТУ 32.50.13-003-17004522-2019»**

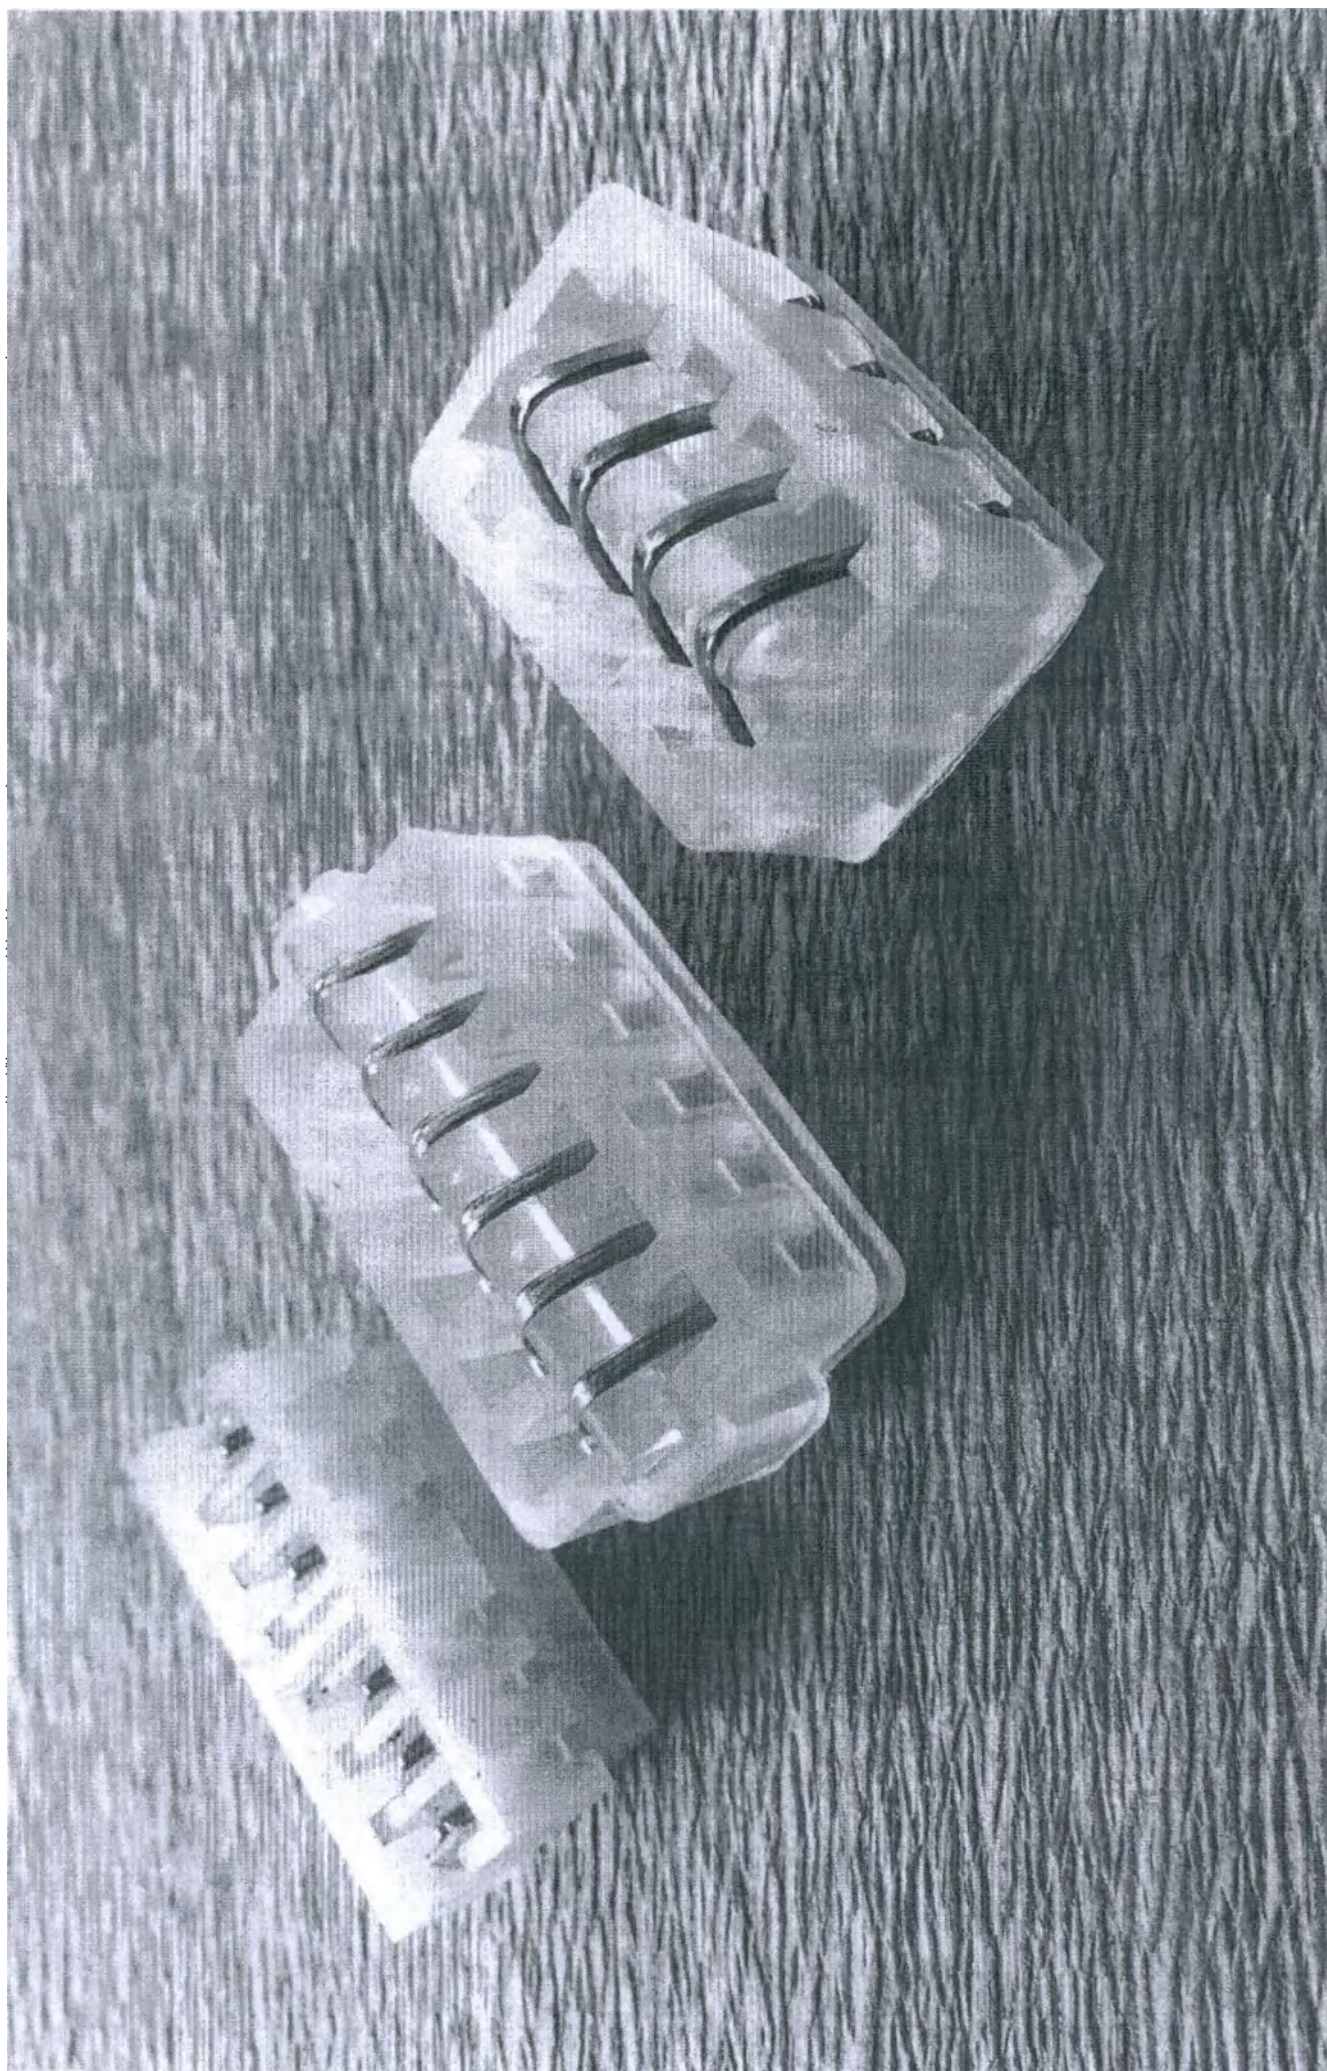


Рис.1 – Общий вид. «Клипсы хирургические титановые для лапароскопических операций, стерильные, КХЛ-“ТЕТ” по ТУ 32.50.13-003-17004522-2019»

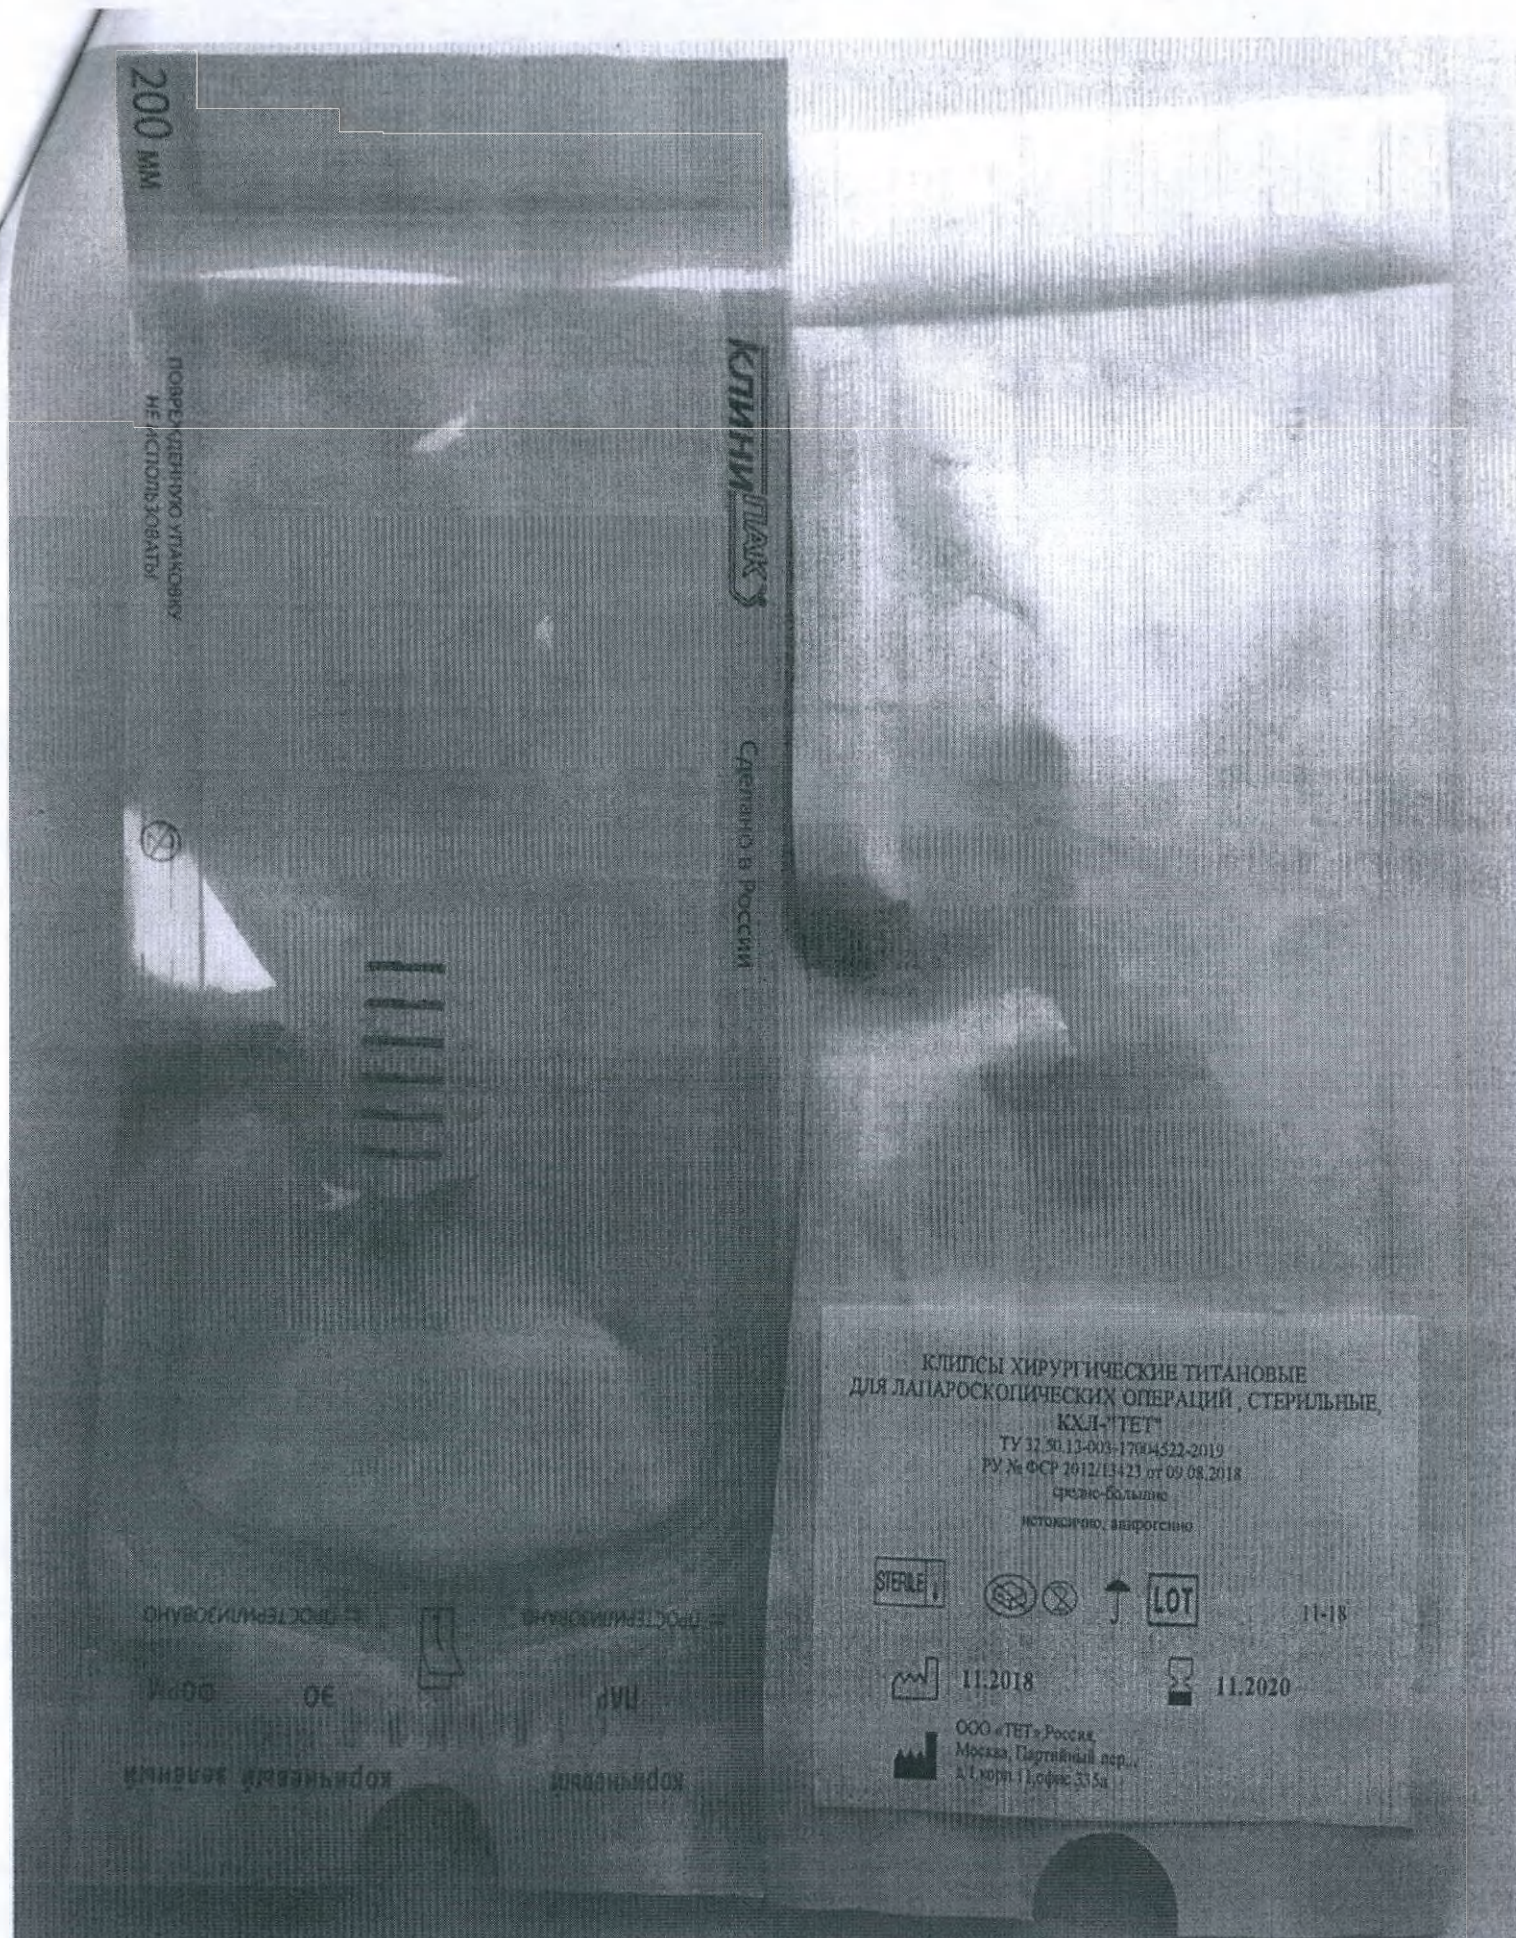


Рис.2 – Магазин с клипсами в индивидуальной упаковке «Клипсы хирургические титановые для лапароскопических операций, стерильные, КХЛ-"ТЕТ" по ТУ 32.50.13-003-17004522-2019»

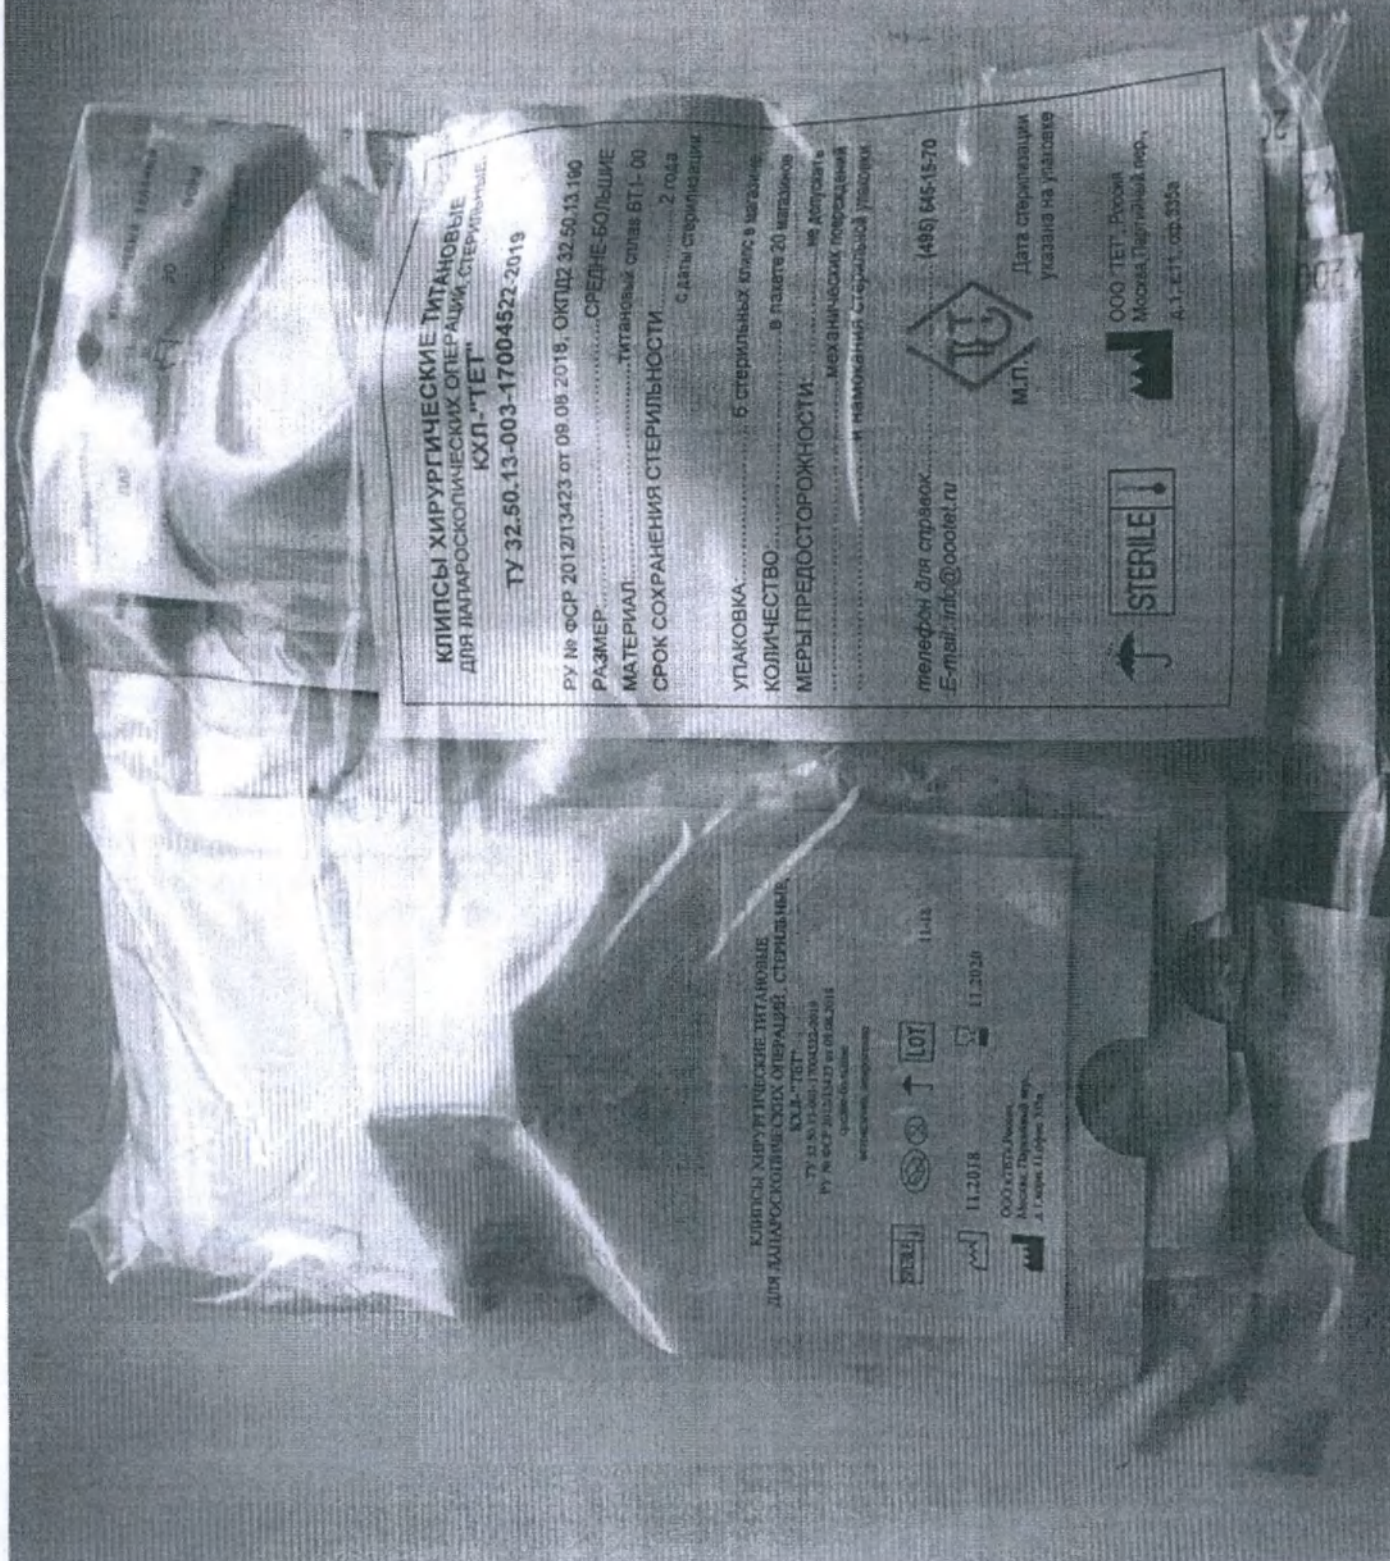


Рис.3 – Упаковка. «Клипсы хирургические титановые для лапароскопических операций, стерильные, КХЛ-"ТЕТ" по ТУ 32.50.13-003-17004522-2019»




Рис.4 – Транспортная маркировка. «Клипсы хирургические титановые для лапароскопических операций, стерильные, КХЛ-"ТЕТ" по ТУ 32.50.13-003-17004522-2019»

**КЛИПСЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ТИТАНОВЫЕ
для лапароскопических операций, СТЕРИЛЬНЫЕ,
КХЛ-"ТЕТ"**

ТУ 32.50.13-003-17004522-2019

ПУ № ФСР 2012/13423 от 09.08.2018, ОКПД2 32.50.13.190

РАЗМЕР:.....СРЕДНЕ-БОЛЬШИЕ

МАТЕРИАЛ:.....титановый сплав BT1- 00

СРОК СОХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ..... 2 года
с даты стерилизации

УПАКОВКА:..... 6 стерильных клипс в магазине

КОЛИЧЕСТВО:..... в пакете 20 магазинов

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:..... не допускать
..... механических повреждений
..... и намокания стерильной упаковки

телефон для справок.....


(495) 645-15-70

E-mail: info@oootet.ru



М.П.

Дата стерилизации
указана на упаковке



ООО "ТЕТ", Россия
Москва, Партийный пер.,
д.1, к.11, оф.335а

Рис.5 – Вкладыш. «Клипсы хирургические титановые для лапароскопических операций, стерильные, КХЛ-"ТЕТ" по ТУ 32.50.13-003-17004522-2019»