

**Фотографические изображения упаковки и макета
маркировки, содержащие сведения на русском языке, для
медицинского изделия
Сепаратор плазмы – EVACLIO[™]
Модели: ЕС-2С20, ЕС-3С20, ЕС-4С20**

Сепаратор плазмы Evaclio™ EC-2C20.

РУ: №

Производитель: «Кавасуми Лабораториз, Инк.», Япония.

Условия хранения и транспортировки: +4/+30°C

Количество штук в упаковке: 1шт.

Дата производства; код партии; использовать до: см. на упаковке

Официальный представитель в России:

ООО НПФ «ПОКАРД»

e-mail: info@pocard.ru www.pocard.ru

Тел.8(495)414-68-15

121552, Москва, 3-я Черепковская ул., д.15а, стр.2, ком.33

Сепаратор плазмы Evaclio™ EC-3C20.

РУ: №

Производитель: «Кавасуми Лабораториз, Инк.», Япония.

Условия хранения и транспортировки: +4/+30°C

Количество штук в упаковке: 1шт.

Дата производства; код партии; использовать до: см. на упаковке

Официальный представитель в России:

ООО НПФ «ПОКАРД»

e-mail: info@pocard.ru www.pocard.ru

Тел.8(495)414-68-15

121552, Москва, 3-я Черепковская ул., д.15а, стр.2, ком.33

Сепаратор плазмы Evaclio™ EC-4C20.

РУ: №

Производитель: «Кавасуми Лабораториз, Инк.», Япония.

Условия хранения и транспортировки: +4/+30°C

Количество штук в упаковке: 1шт.

Дата производства; код партии; использовать до: см. на упаковке




Официальный представитель в России:

ООО НПФ «ПОКАРД»

e-mail: info@pocard.ru www.pocard.ru

Тел.8(495)414-68-15

121552, Москва, 3-я Черепковская ул., д.15а, стр.2, ком.33

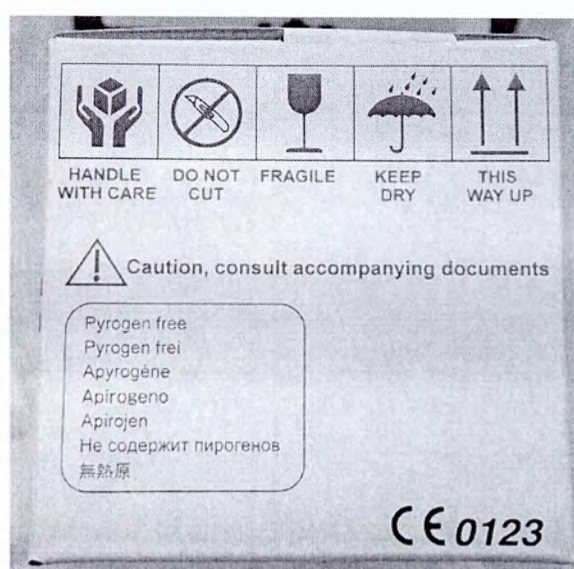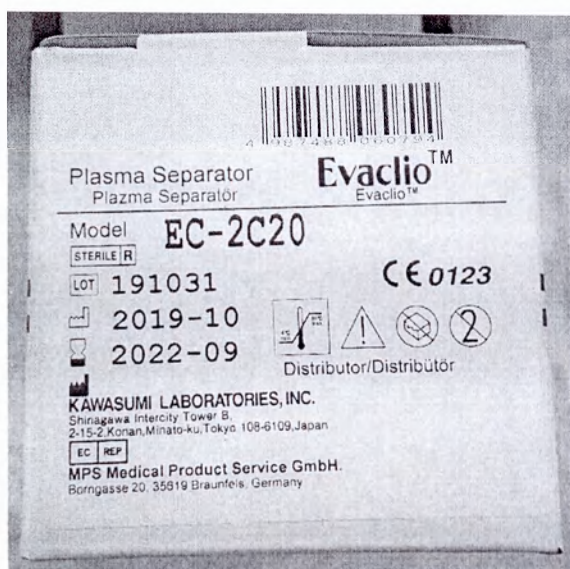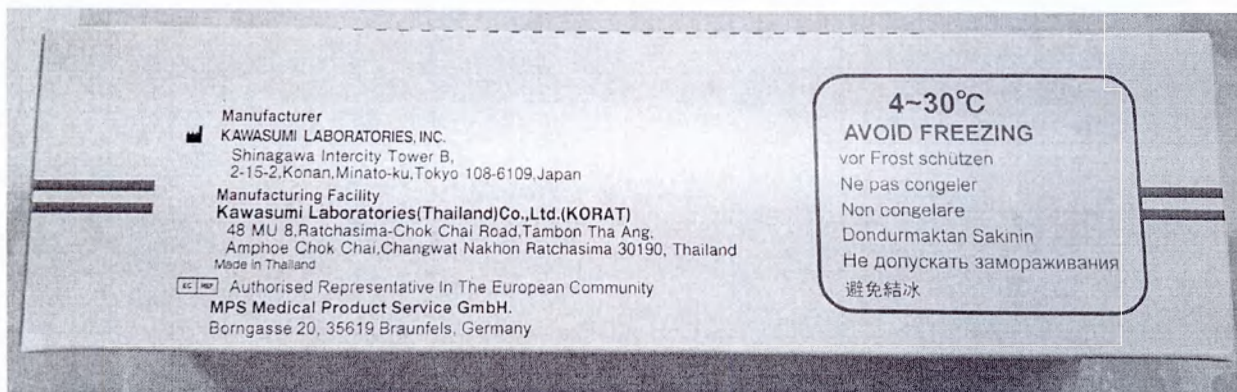

Сепаратор плазмы Evaclio™ EC-3C20.
 1 шт. в п/у.
 Производитель: Кавасуми Лаборауторис, Оми, Япония.
 Класификация: класс стерилизации: 100°C.
 Временная температура: 14°C.
 Дата производства: 2019-10-10.
 Официальный представитель в России:
 ООО НПФ «ПОСЕРВИС»
 e-mail: info@poscard.ru, www.poscard.ru
 Тел: 8 (495) 414-68-15
 12557, Москва, Вн. Спасский проезд, д. 11А, стр. 2, этаж 3/3

Evaclio™

Plasma Separator

CE 0123

Manufacturer
KAWASUMI LABORATORIES, INC.
 Shinagawa Intercity Tower B,
 2-15-2, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-6109, Japan

Manufacturing Facility
Kawasumi Laboratories(Thailand)Co.,Ltd.(KORAT)
 48 MU 8, Ratchasima-Chok Chai Road, Tambon Tha Ang,
 Amphoe Chok Chai, Changwat Nakhon Ratchasima 30190, Thailand
 Made in Thailand

EC REP Authorised Representative In The European Community
MPS Medical Product Service GmbH.
 Borngasse 20, 35619 Braunfels, Germany

4~30°C
AVOID FREEZING
 vor Frost schützen
 Ne pas congeler
 Non congelare
 Dondurmaktan Sakinin
 Не допускать замораживания
 避免結冰

1 pc.

Plasma Separator

Evaclio™

For use only in plasma separation
 Nur zur Plasmasparation verwenden
 A n'utiliser que pour la séparation plasmétique
 Solo per l'uso in separazione del plasma

Sadece plazma separasyonunda kullanmak için
 Использовать только для плазмосепарации
 僅限用於血漿分離



Plasma Separator
 Plazma Separator

Evaclio™
 Evaclio®


Model **EC-3C20**

STERILE R

LOT 191031

2019-10

2022-09




Distributor/Distribütör

KAWASUMI LABORATORIES, INC.
 Shinagawa Intercity Tower B,
 2-15-2, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-6109, Japan

EC REP

MPS Medical Product Service GmbH.
 Borngasse 20, 35619 Braunfels, Germany

CE 0123



HANDLE
WITH CARE

DO NOT
CUT

FRAGILE

KEEP
DRY

THIS
WAY UP



Caution, consult accompanying documents

Pyrogen free
 Pyrogen frei
 Apyrogène
 Apirogeno
 Apirojen
 Не содержит пирогенов
 無熱原

CE 0123

Сепаратор плазмы Evaclio™ EC-4C20.
 177.33
 Промышленные плазменные сепараторы, Япония, Япония.
 Устойчив к коррозии и транспортировке: < 1% 30°C.
 Количество циклов: неограниченно.
 Дата производства, код партии, информация по см. на
 упаковке.
 Официальный представитель в России:
 ООО МПЗ «ПЛАЗМА»
 Контактная информация: www.mpsd.ru
 Тел. +7 (495) 924 48 15
 121552, Москва, 5-я Череповецкая ул., д. 31А, этаж, код 31

Evaclio™

Plasma Separator

CE 0123

Manufacturer
KAWASUMI LABORATORIES, INC.
 Shinagawa Intercity Tower B,
 2-15-2, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-6109, Japan
Manufacturing Facility
Kawasumi Laboratories(Thailand)Co.,Ltd.(KORAT)
 48 MU 8 Ratchasima-Chok Chai Road, Tambon Tha Ang,
 Amphoe Chok Chai, Changwat Nakhon Ratchasima 30190, Thailand
 Made in Thailand
EC REP Authorised Representative In The European Community
MPS Medical Product Service GmbH.
 Bornegasse 20, 35619 Braunfels, Germany

4~30°C
AVOID FREEZING
 vor Frost schützen
 Ne pas congeler
 Non congelare
 Dondurmaktan Sakinin
 Не допускать замораживания
 避免結冰

1 pc.

Plasma Separator
Evaclio™

For use only in plasma separation
 Nur zur Plasmasparation verwenden
 A n'utiliser que pour la separation plasmatique
 Solo per l'uso in separazione del plasma

Sadece plazma separasyonunda kullanmak için
 Использовать только для плазмаосепарации
 僅限用於血漿分離

Plasma Separator
 Plasma Separator

Evaclio™
 Evaclio™

Model **EC-4C20**


STERILE R

LOT 191031

2019-10

2022-09

CE 0123



Distributor/Distribütör

KAWASUMI LABORATORIES, INC.
 Shinagawa Intercity Tower B,
 2-15-2, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-6109, Japan

EC REP

MPS Medical Product Service GmbH.
 Bornegasse 20, 35619 Braunfels, Germany



HANDLE WITH CARE DO NOT CUT FRAGILE KEEP DRY THIS WAY UP




Caution, consult accompanying documents

Pyrogen free
 Pyrogen frei
 Apyrogène
 Apirogeno
 Apirojen
 Не содержит пирогенов
 無熱原

CE 0123

Всего прошито и скреплено 5 (пять) листов.
Генеральный директор ООО НПФ «ПОКАРД»



Адамова И.Ю.

