

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ
Устройство для исследования проб крови Microvette APT с K2ЭДТА



Рис 1. Устройство для исследования проб крови Microvette APT с K2ЭДТА
Microvette APT 250: 20.1331



Рис 2. Устройство для исследования проб крови Microvette APT с К2ЭДТА
Microvette APT 250; 20.1331.100

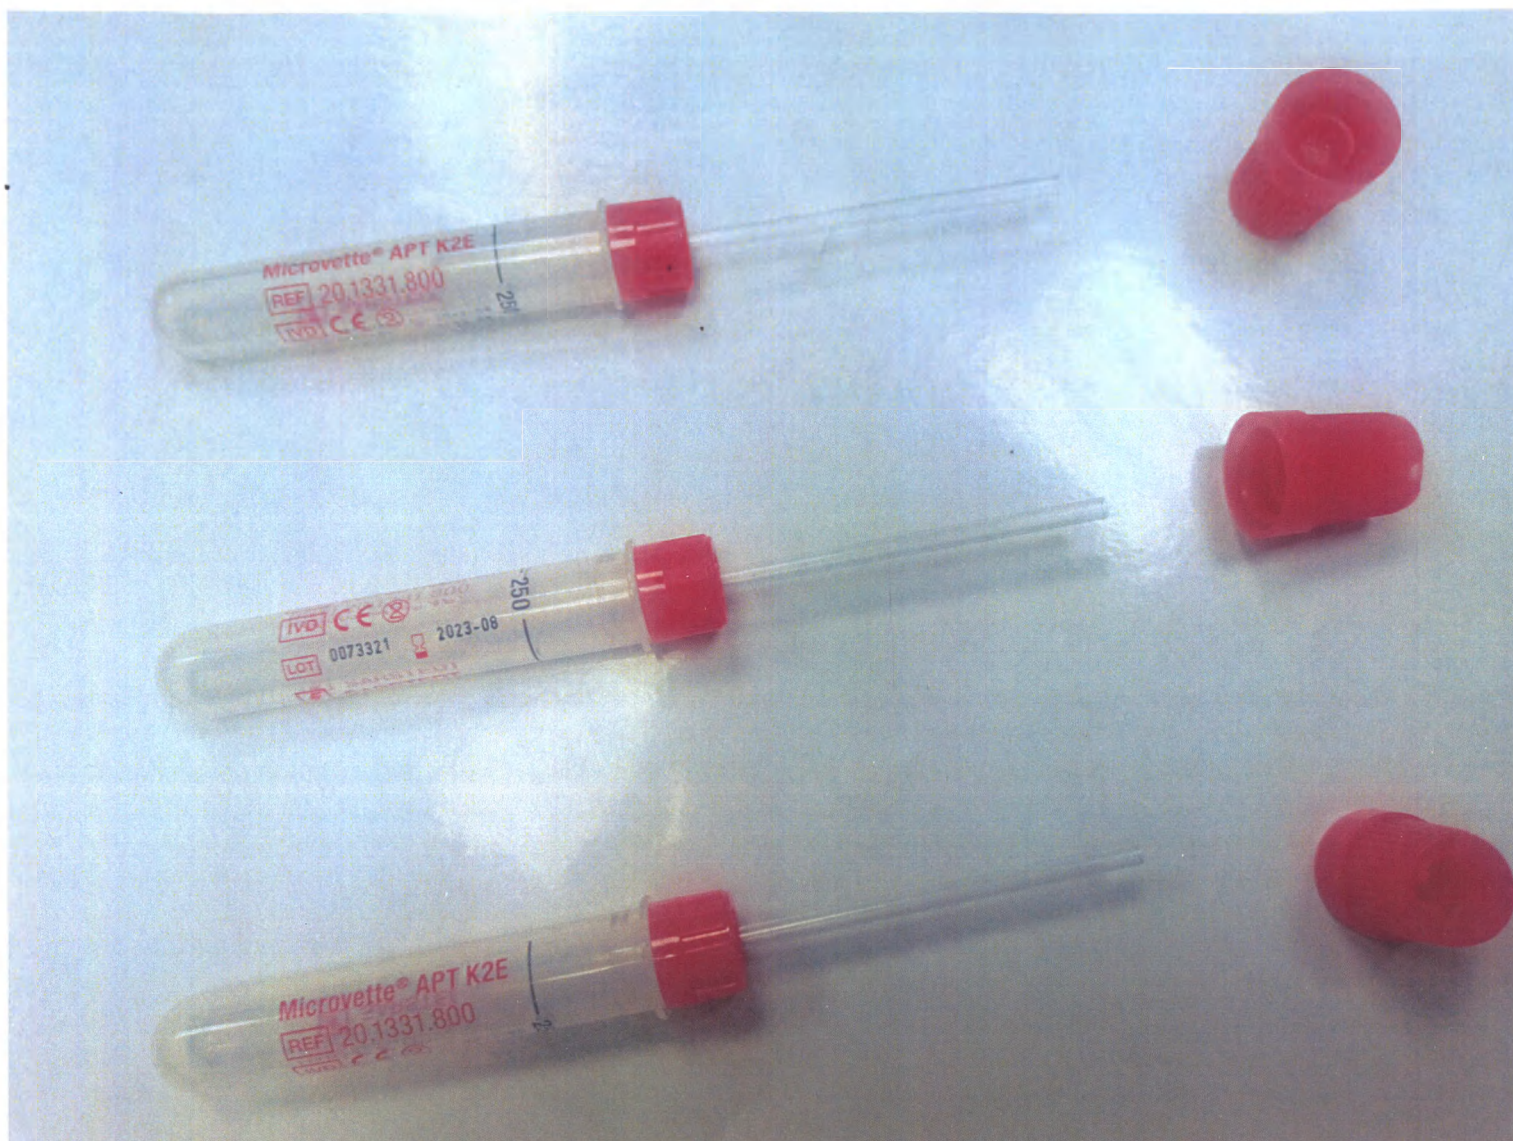


Рис 3. Устройство для исследования проб крови Microvette APT с K2ЭДТА
Microvette APT 250: 20.1331.800



Рис 4. Устройство для исследования проб крови Microvette APT с К2ЭДТА
Microvette APT 250: 20.1331.801



Рис 5. Устройство для исследования проб крови Microvette APT с К2ЭДТА
Microvette APT 500: 20.1330



Рис 6. Устройство для исследования проб крови Microvette APT с К2ЭДТА
Microvette APT 500: 20.1330.100



Рис 7. Устройство для исследования проб крови Microvette APT с К2ЭДТА
Microvette APT 500: 20.1330.800



Рис 8. Устройство для исследования проб крови Microvette APT с K2ЭДТА
Microvette APT 500: 20.1330.801

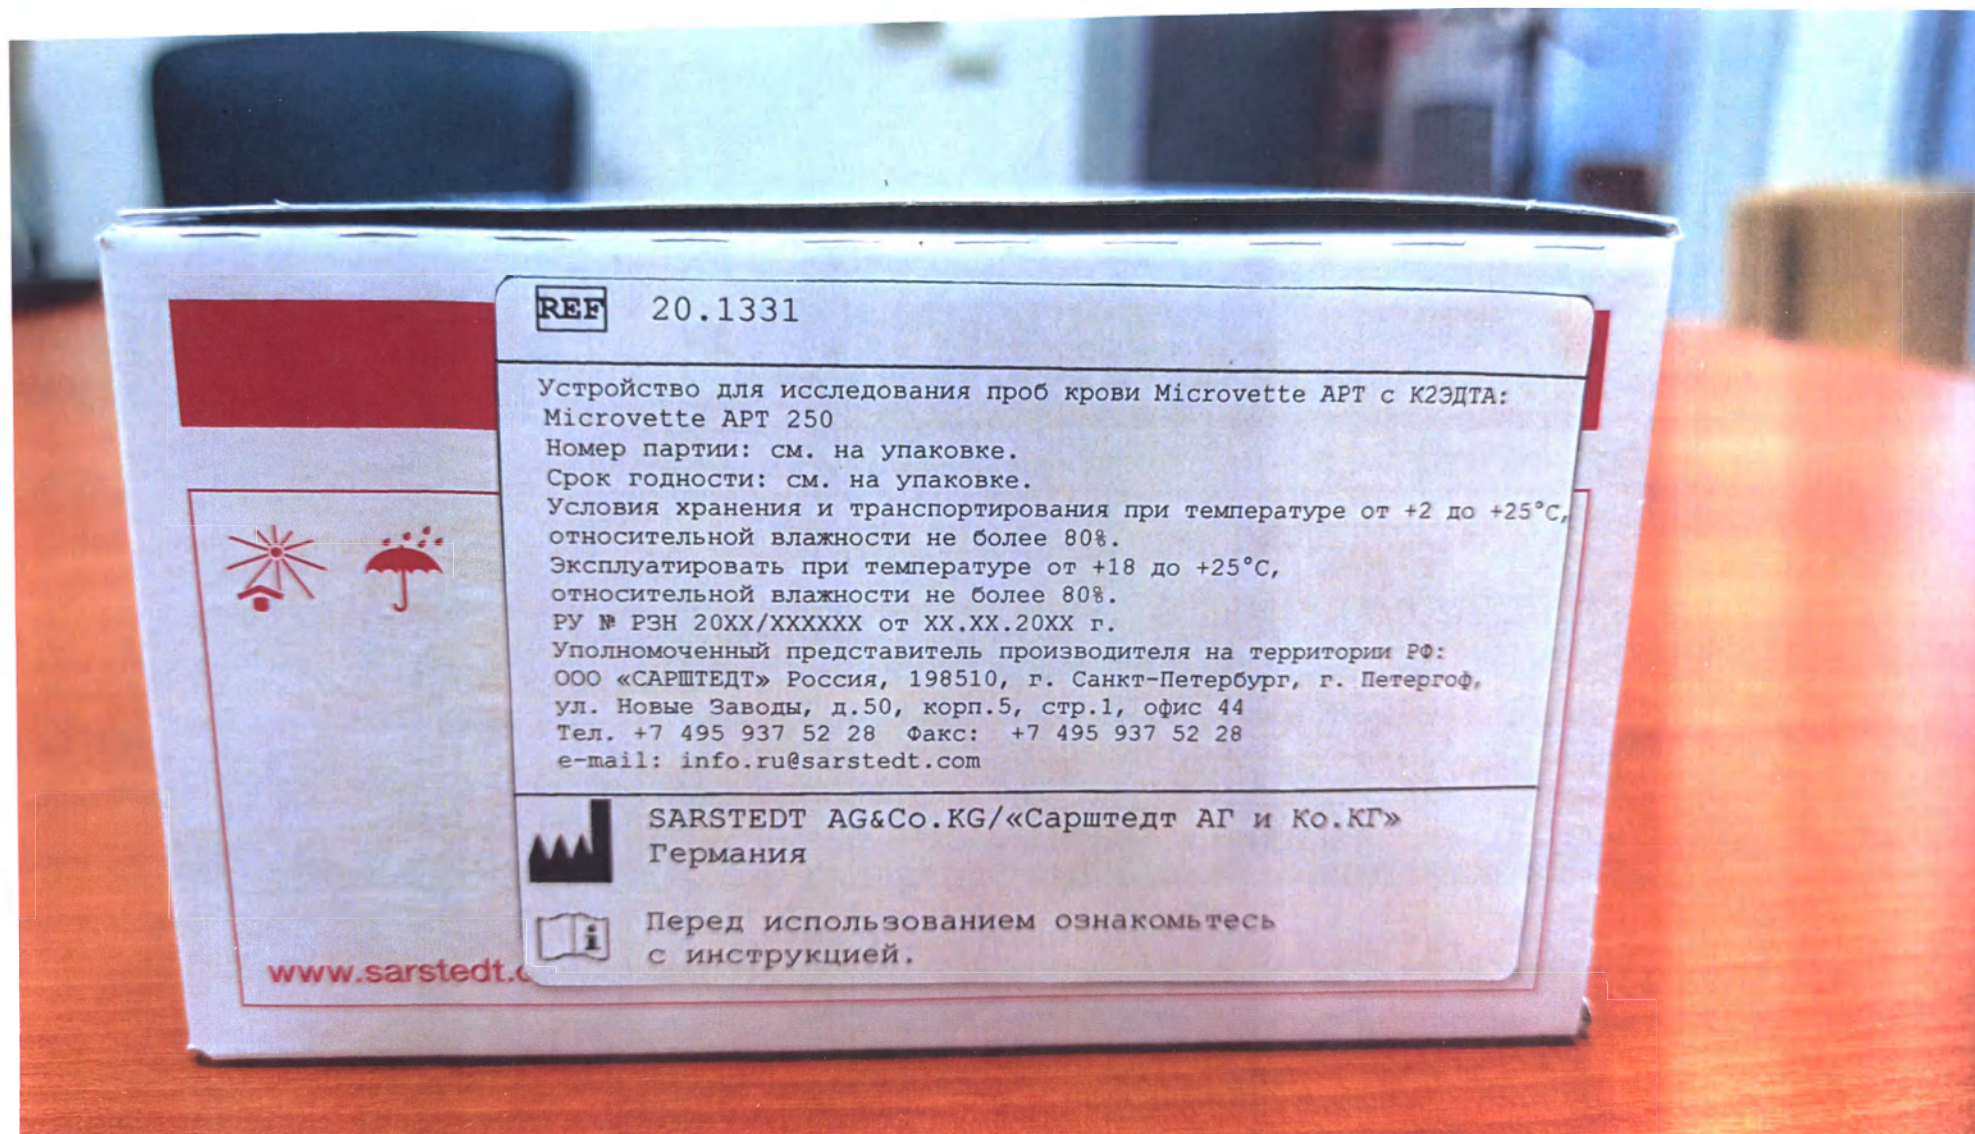


Рис 9. Маркировка групповой упаковки на русском языке. Устройство для исследования проб крови Microvette APT с К2ЭДТА
Microvette APT 250: 20.1331



Рис 10. Маркировка групповой упаковки оригинальная. Устройство для исследования проб крови Microvette APT с K2ЭДТА
Microvette APT 250; 20.1331



Рис 11. Маркировка групповой упаковки оригинальная. Устройство для исследования проб крови Microvette APT с К2ЭДТА
Microvette APT 250: 20.1331.100

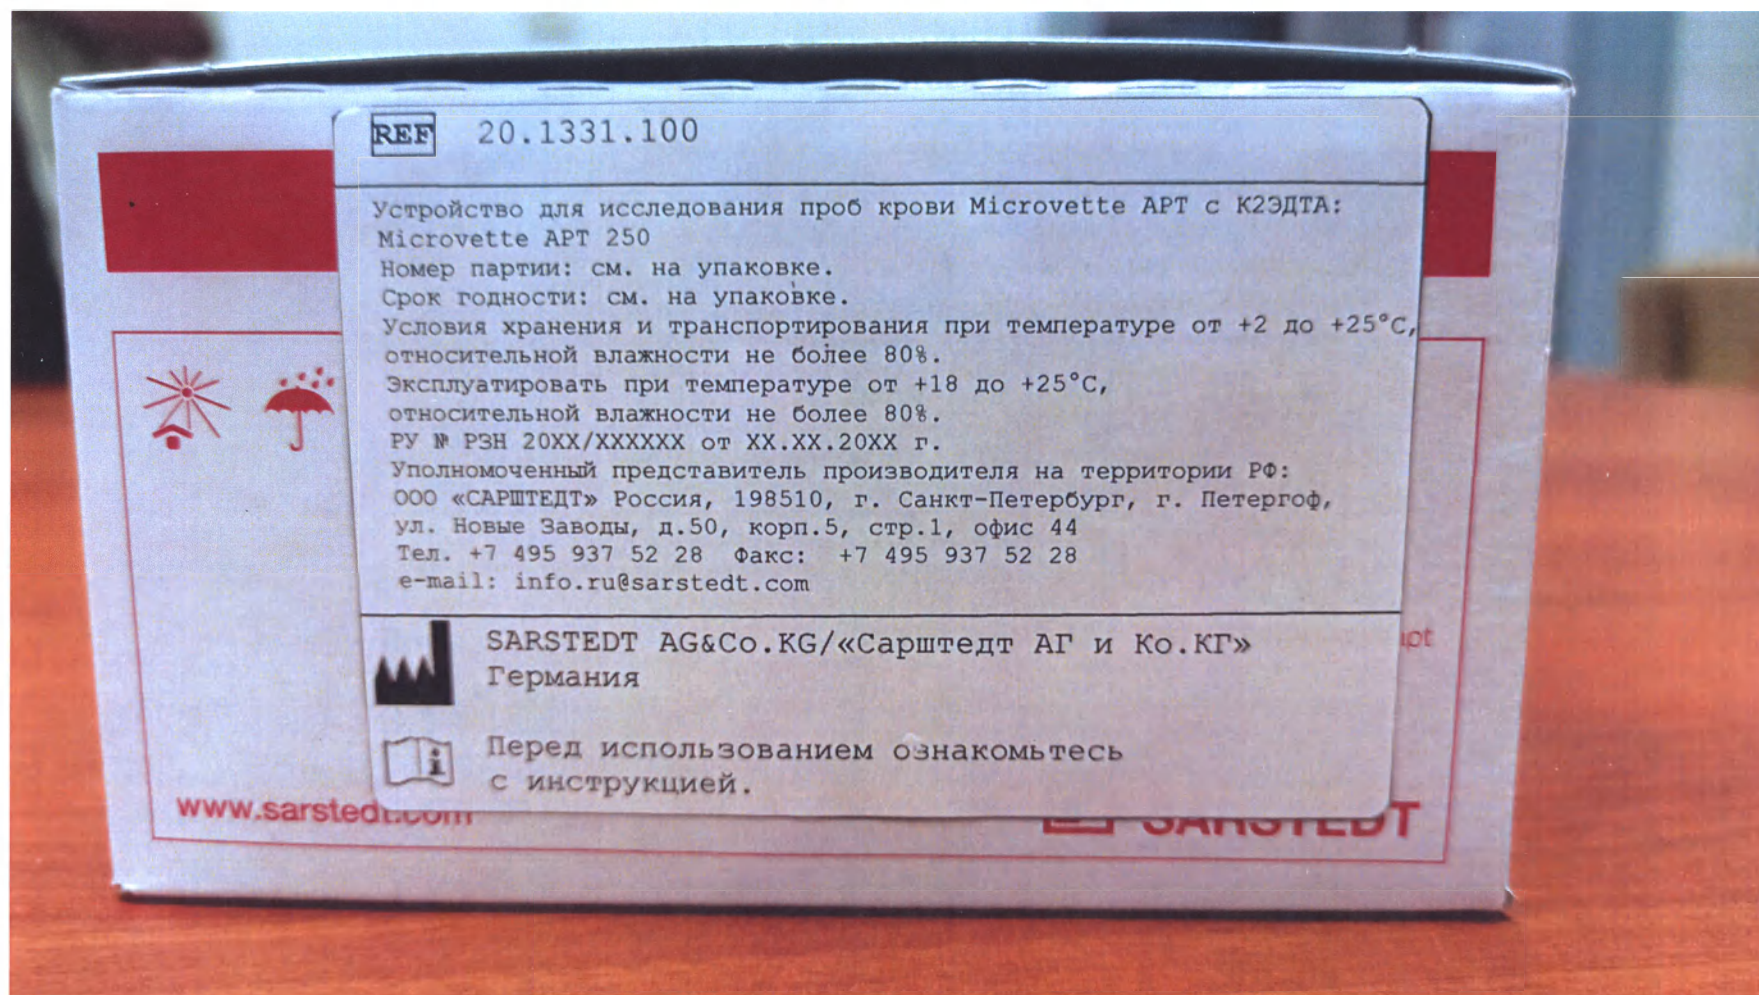


Рис 12. Маркировка групповой упаковки на русском языке. Устройство для исследования проб крови Microvette APT с K2ЭДТА
Microvette APT 250: 20.1331.100

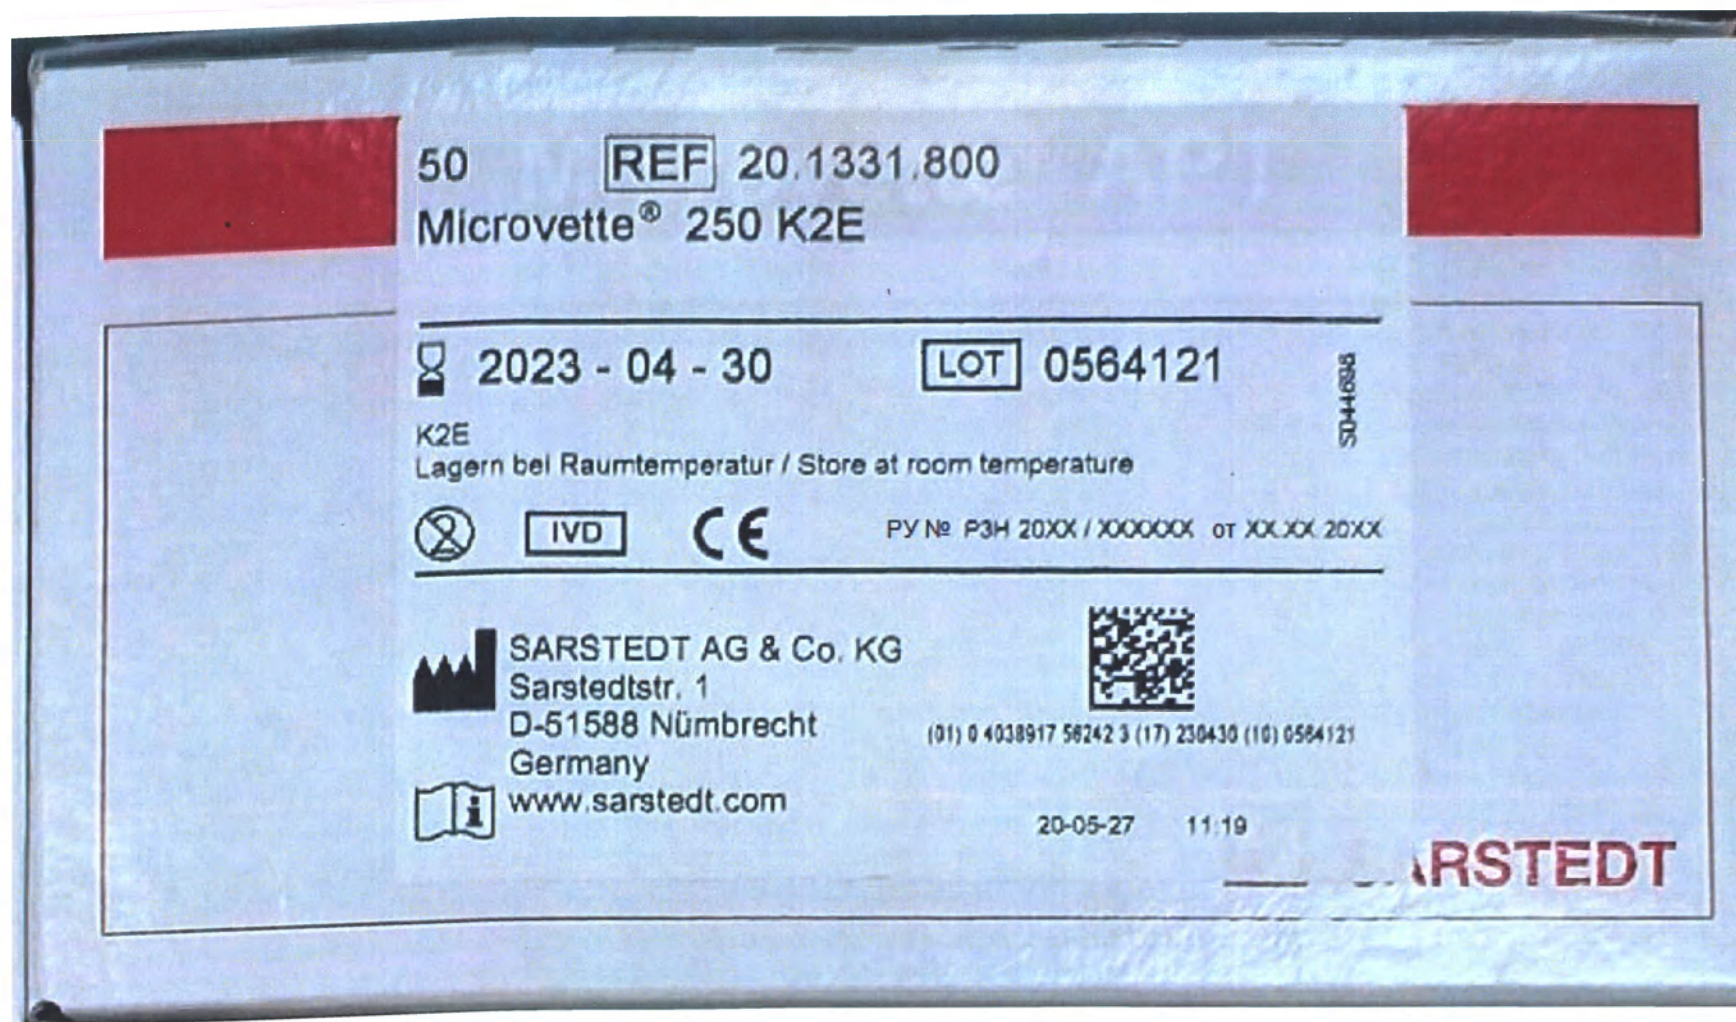


Рис 13. Маркировка групповой упаковки оригинальная. Устройство для исследования проб крови Microvette APT с K2ЭДТА
Microvette APT 250: 20.1331.800

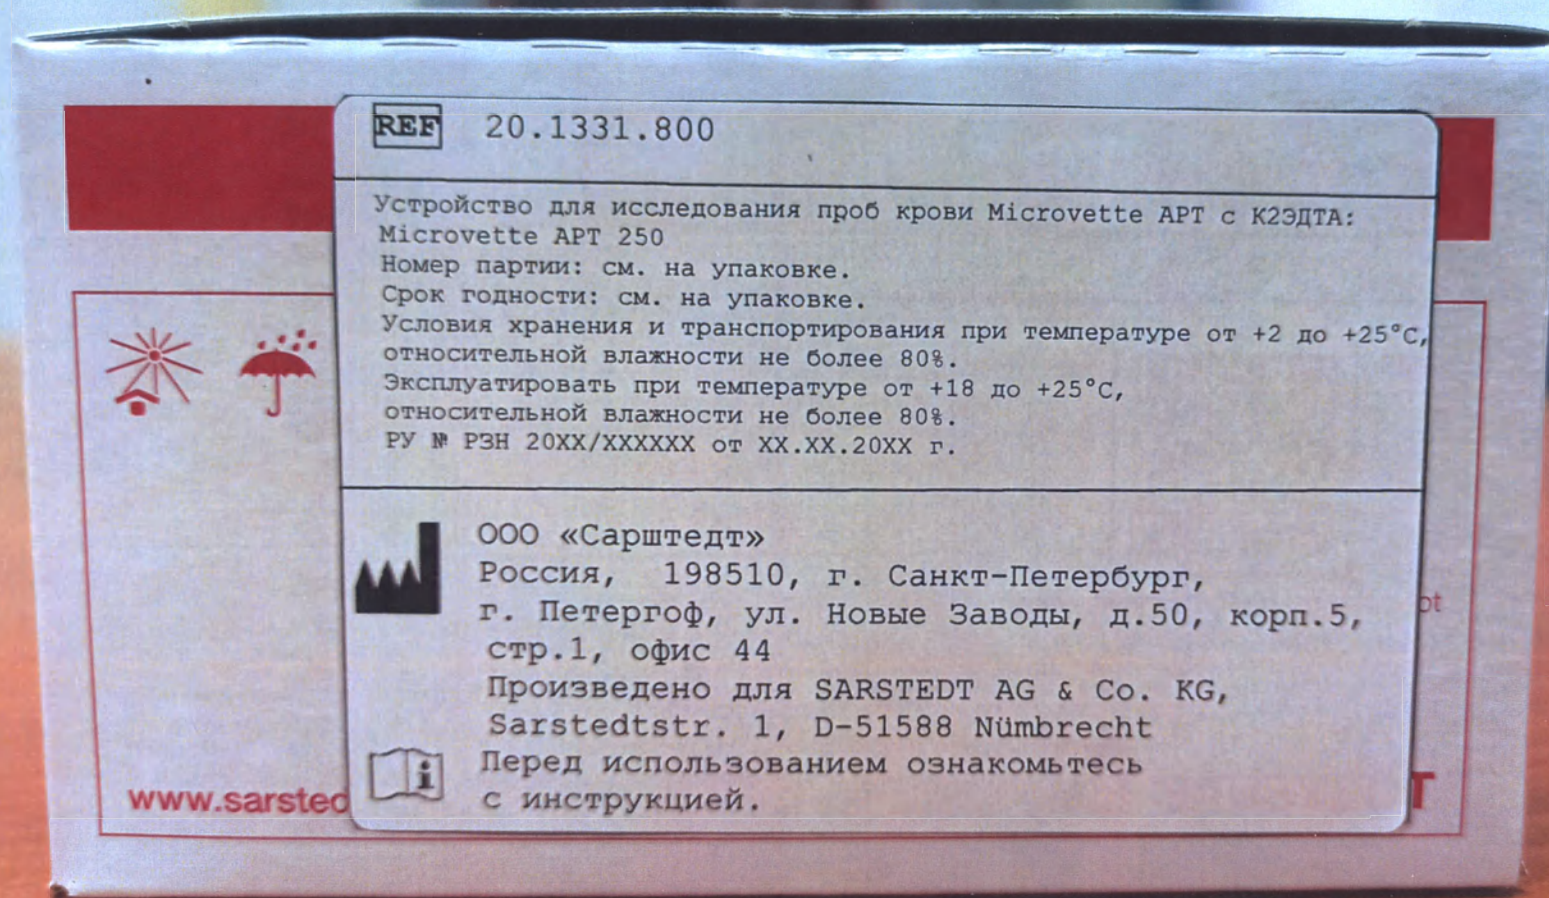


Рис 14. Маркировка групповой упаковки на русском языке. Устройство для исследования проб крови Microvette APT с K2ЭДТА
Microvette APT 250: 20.1331.800

50 **REF** 20.1331.801

Microvette® 250 K2E

 2023 - 04 - 30

LOT 0564221

S044698

K2E

Lagern bei Raumtemperatur / Store at room temperature



IVD



PY № P3H 20XX / XXXXXX от XX.XX.20XX



SARSTEDT AG & Co. KG

Sarstedtstr. 1

D-51588 Nümbrecht

Germany




www.sarstedt.com



(01) 0 4038917 58238 6 (17) 230430 (10) 0564221

20-05-27

11:20



SARSTEDT

Рис 15. Маркировка групповой упаковки оригинальная. Устройство для исследования проб крови Microvette APT с К2ЭДТА
Microvette APT 250: 20.1331.801

100 · **REF** 20.1330
Microvette® APT 500 K2E

 2023 - 04 - 30

LOT 0563421

5044698

K2E

Lagern bei Raumtemperatur / Store at room temperature



IVD



PY № P3H 20XX / XXXXXX or XX XX 20XX



SARSTEDT AG & Co. KG

Sarstedtstr. 1

D-51588 Nümbrecht

Germany

www.sarstedt.com



(21) 0 4038917 52473 5 (17) 230430 (10) 0563421

Made in Germany

20-05-27 7 40



SARSTEDT

Рис 16. Маркировка групповой упаковки оригинальная. Устройство для исследования проб крови Microvette APT с К2ЭДТА
Microvette APT 500: 20.1330

REF 20.1330

Устройство для исследования проб крови Microvette APT с К2ЭДТА:
Microvette APT 500

Номер партии: см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Условия хранения и транспортирования при температуре от +2 до +25°C,
относительной влажности не более 80%.

Эксплуатировать при температуре от +18 до +25°C,
относительной влажности не более 80%.

РУ № РЗН 20XX/XXXXXX от XX.XX.20XX г.

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «САРШТЕДТ» Россия, 198510, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф,
ул. Новые Заводы, д.50, корп.5, стр.1, офис 44

Тел. +7 495 937 52 28 Факс: +7 495 937 52 28

e-mail: info.ru@sarstedt.com



www.sarstedt.com



SARSTEDT AG&Co.KG/«Сарштедт АГ и Ко.КГ»
Германия



Перед использованием ознакомьтесь
с инструкцией.



www.sarstedt.com/microvette-apt



SARSTEDT

Рис 17. Маркировка групповой упаковки на русском языке. Устройство для исследования проб крови Microvette APT с К2ЭДТА
Microvette APT 500: 20.1330

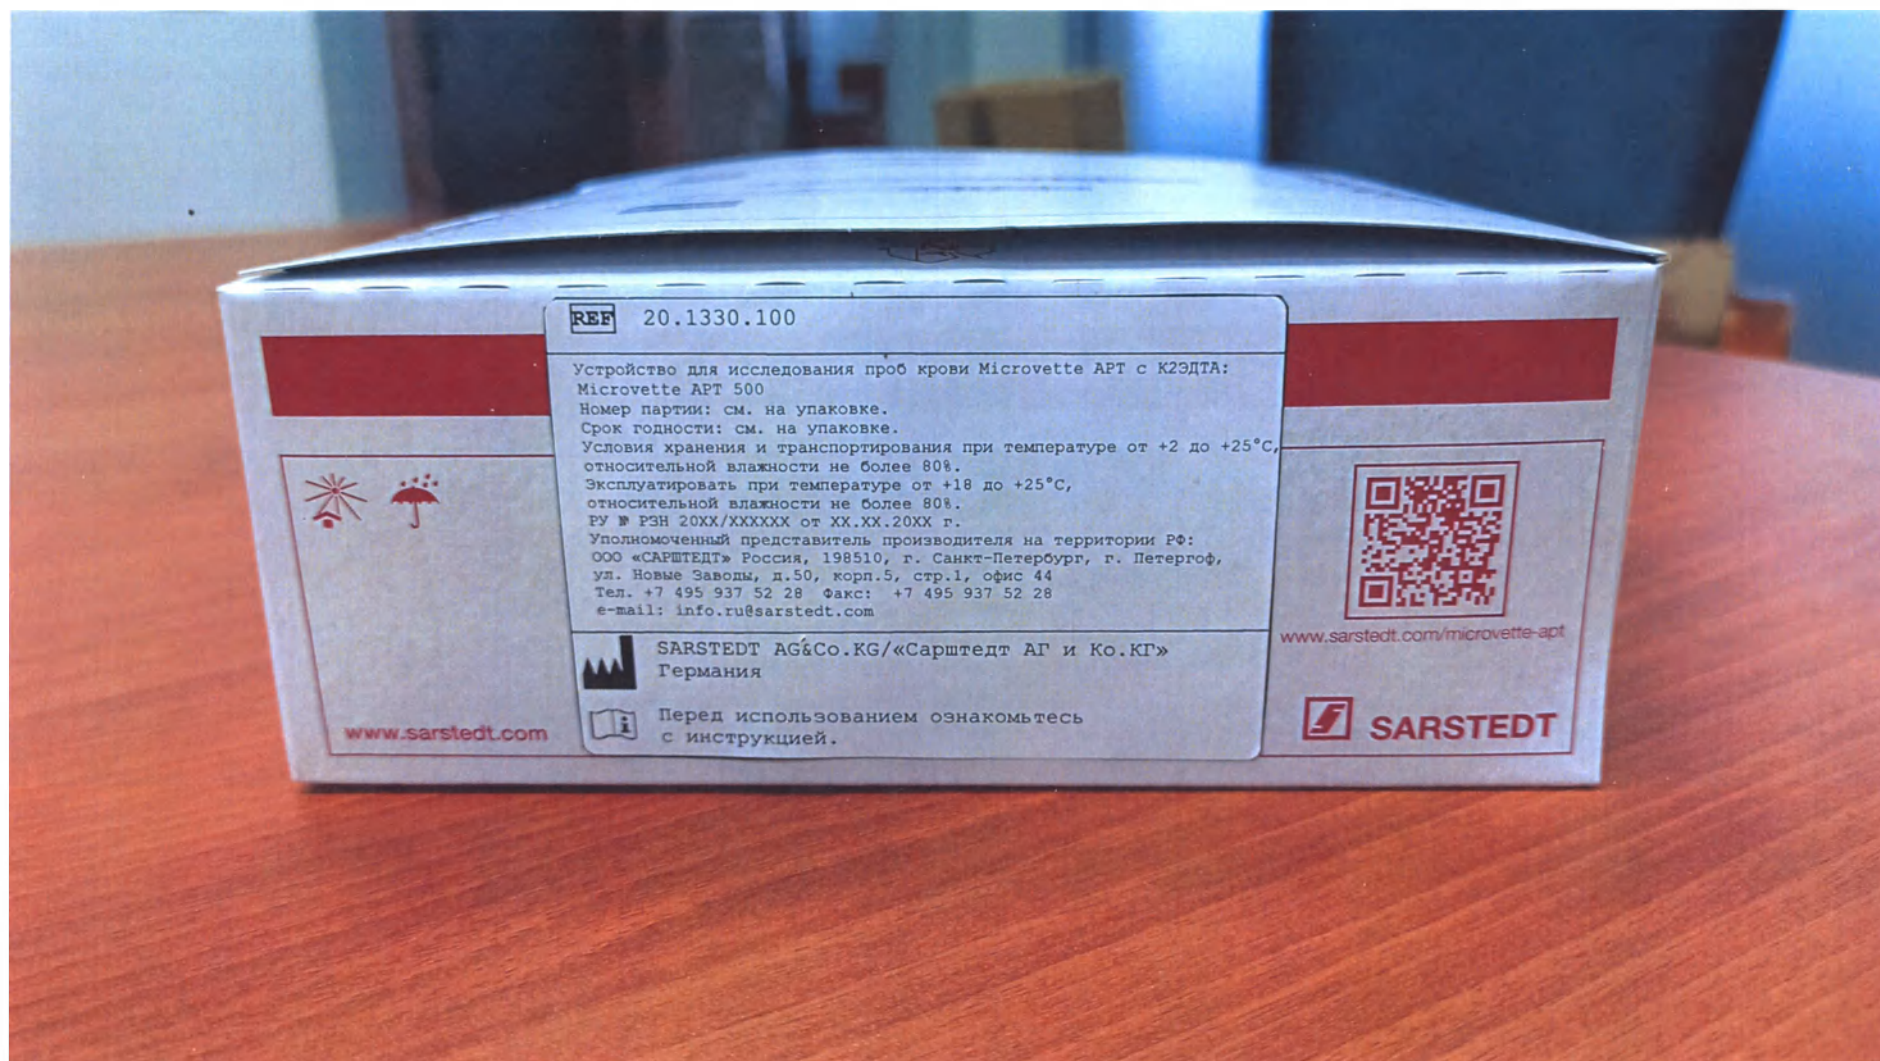


Рис 18. Маркировка групповой упаковки на русском языке. Устройство для исследования проб крови Microvette APT с К2ЭДТА
Microvette APT 500: 20.1330.100



**Рис 19. Маркировка групповой упаковки оригинальная. Устройство для исследования проб крови Microvette APT с К2ЭДТА
Microvette APT 500: 20.1330.100**

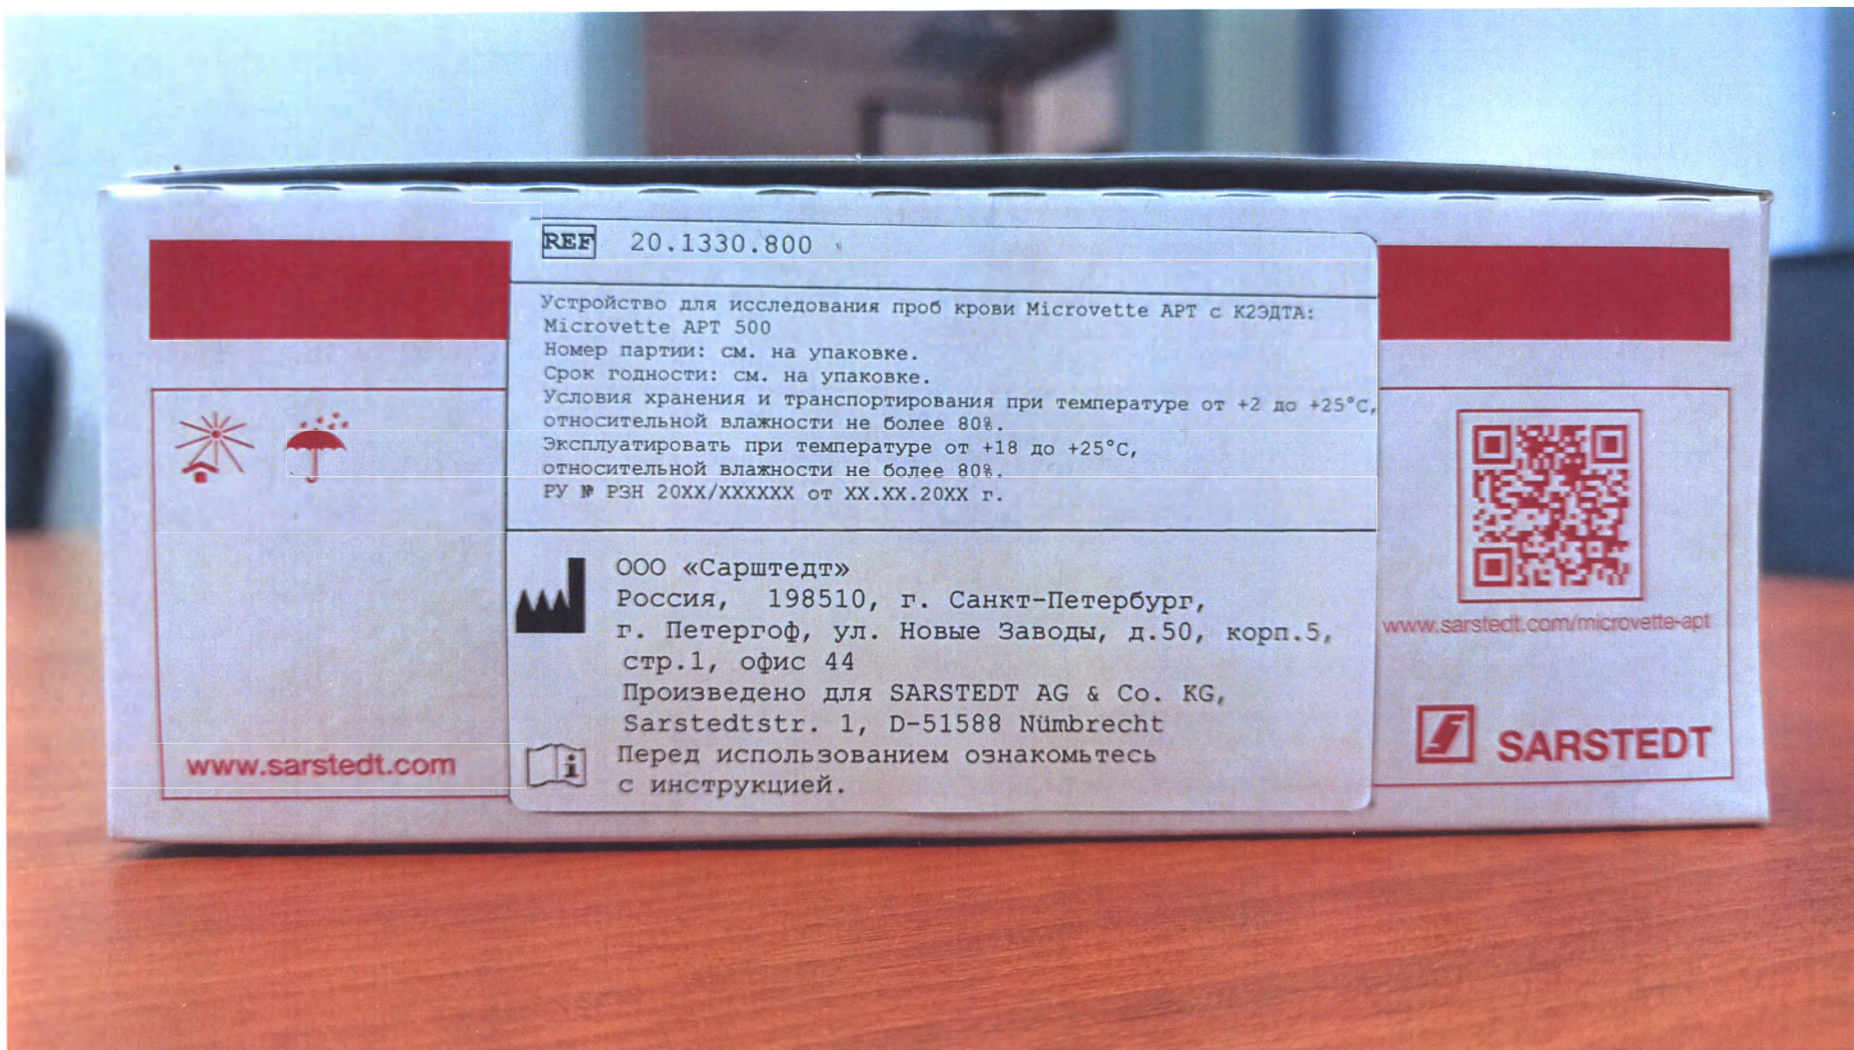


Рис 20. Маркировка групповой упаковки на русском языке. Устройство для исследования проб крови Microvette APT с К2ЭДТА
Microvette APT 500: 20.1330.800

100	REF 20.1330.800	
Microvette® 500 K2E		
 2023 - 04 - 30	LOT 0563821	S044698
K2E		
Lagern bei Raumtemperatur / Store at room temperature		
	IVD 	PY № P3H 20XX / XXXXXX от XX.XX.20XX
 SARSTEDT AG & Co. KG Sarstedtstr. 1 D-51588 Nümbrecht Germany  www.sarstedt.com	 (01) 0 4039017 50250 8 (17) 230430 (10) 0563821 20-05-27 11:16	

Рис 21. Маркировка групповой упаковки оригинальная. Устройство для исследования проб крови Microvette APT с К2ЭДТА
Microvette APT 500: 20.1330.800



Рис 22. Маркировка групповой упаковки оригинальная. Устройство для исследования проб крови Microvette APT с K2ЭДТА
Microvette APT 500: 20.1330.801

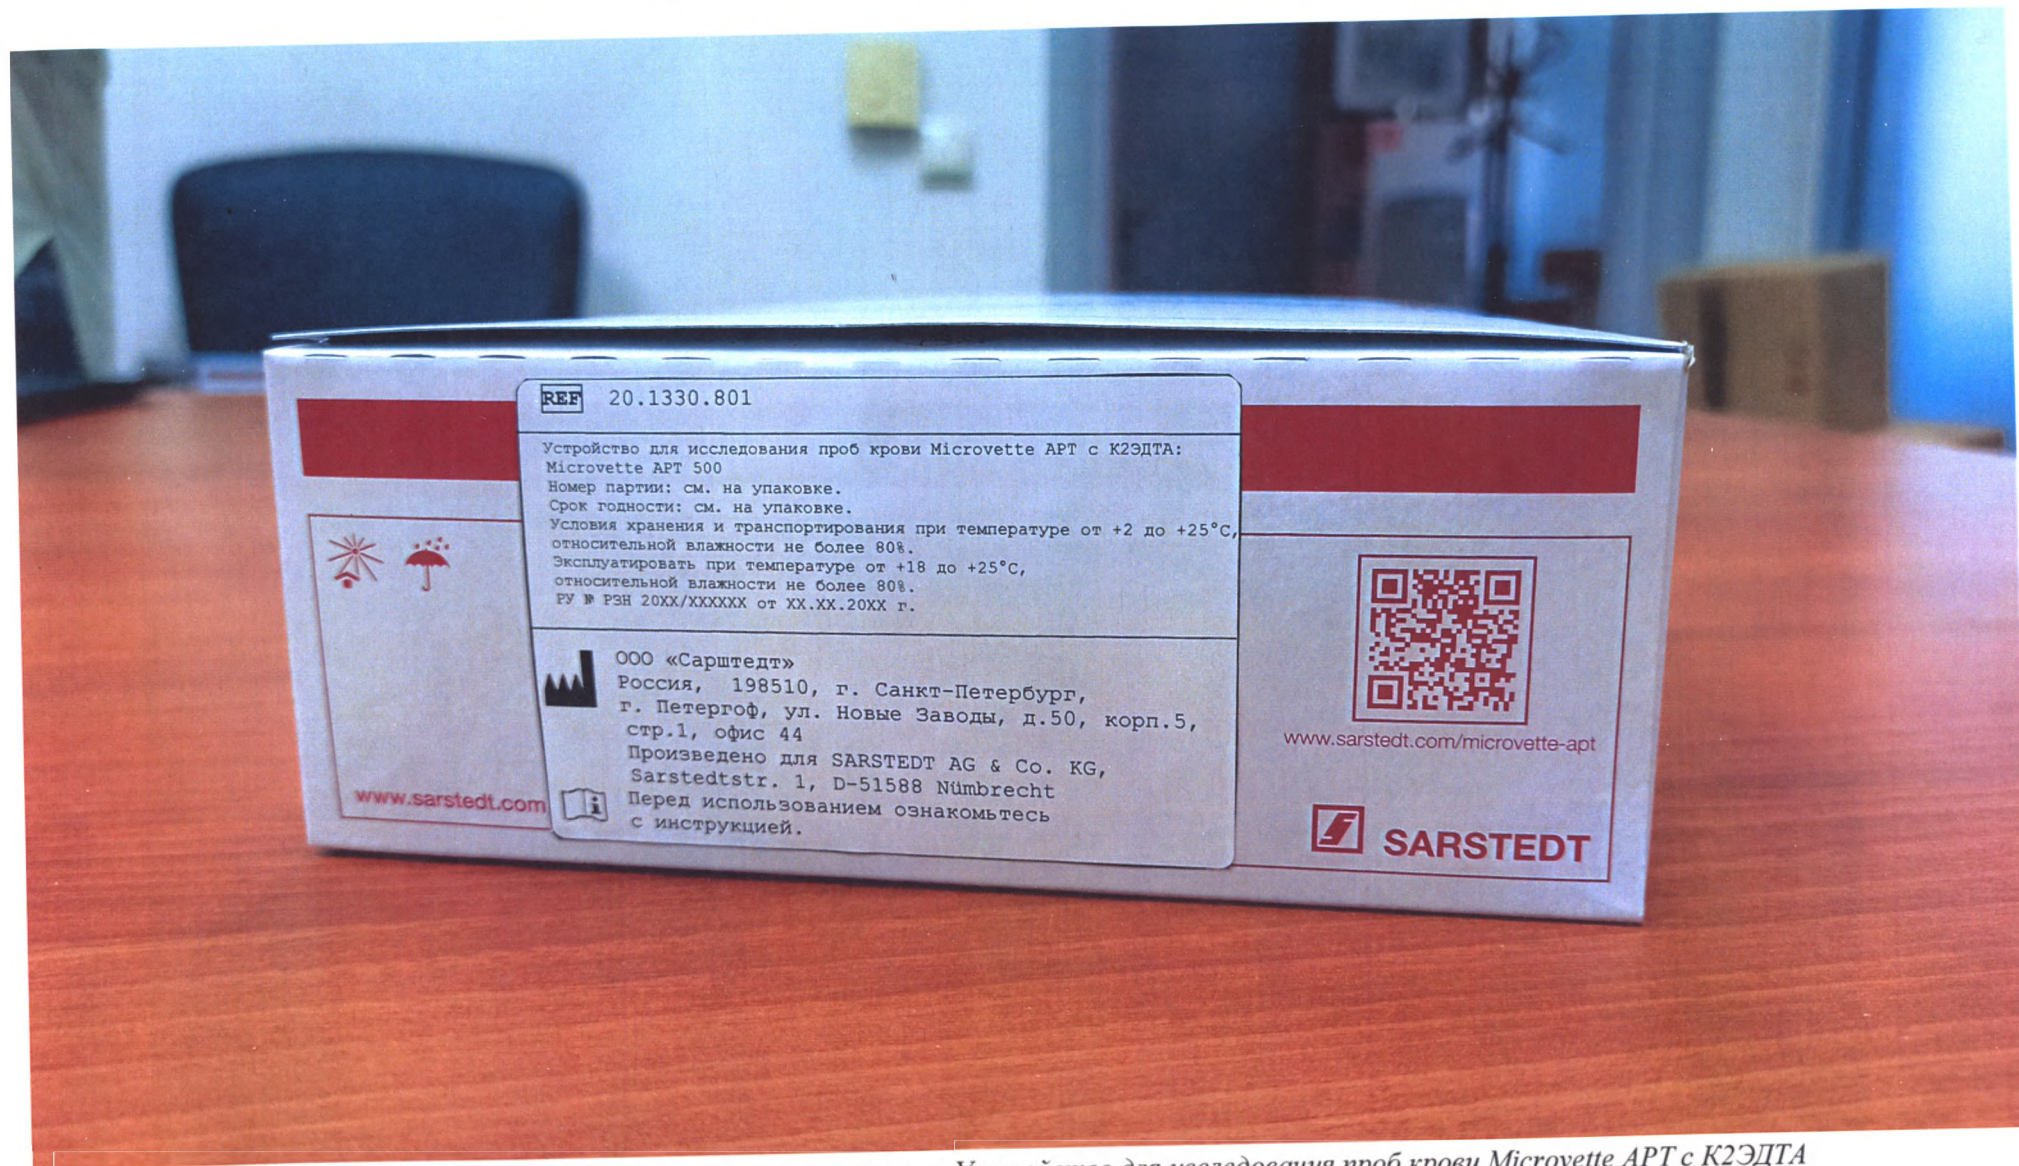


Рис 23. Маркировка групповой упаковки на русском языке. Устройство для исследования проб крови Microvette APT с К2ЭДТА
Microvette APT 500: 20.1330.801



Рис 24. Групповая упаковка изделий: Устройство для исследования проб крови Microvette APT с К2ЭДТА
Microvette APT 250: 20.1331, 20.1331.100, 20.1331.800, 20.1331.801

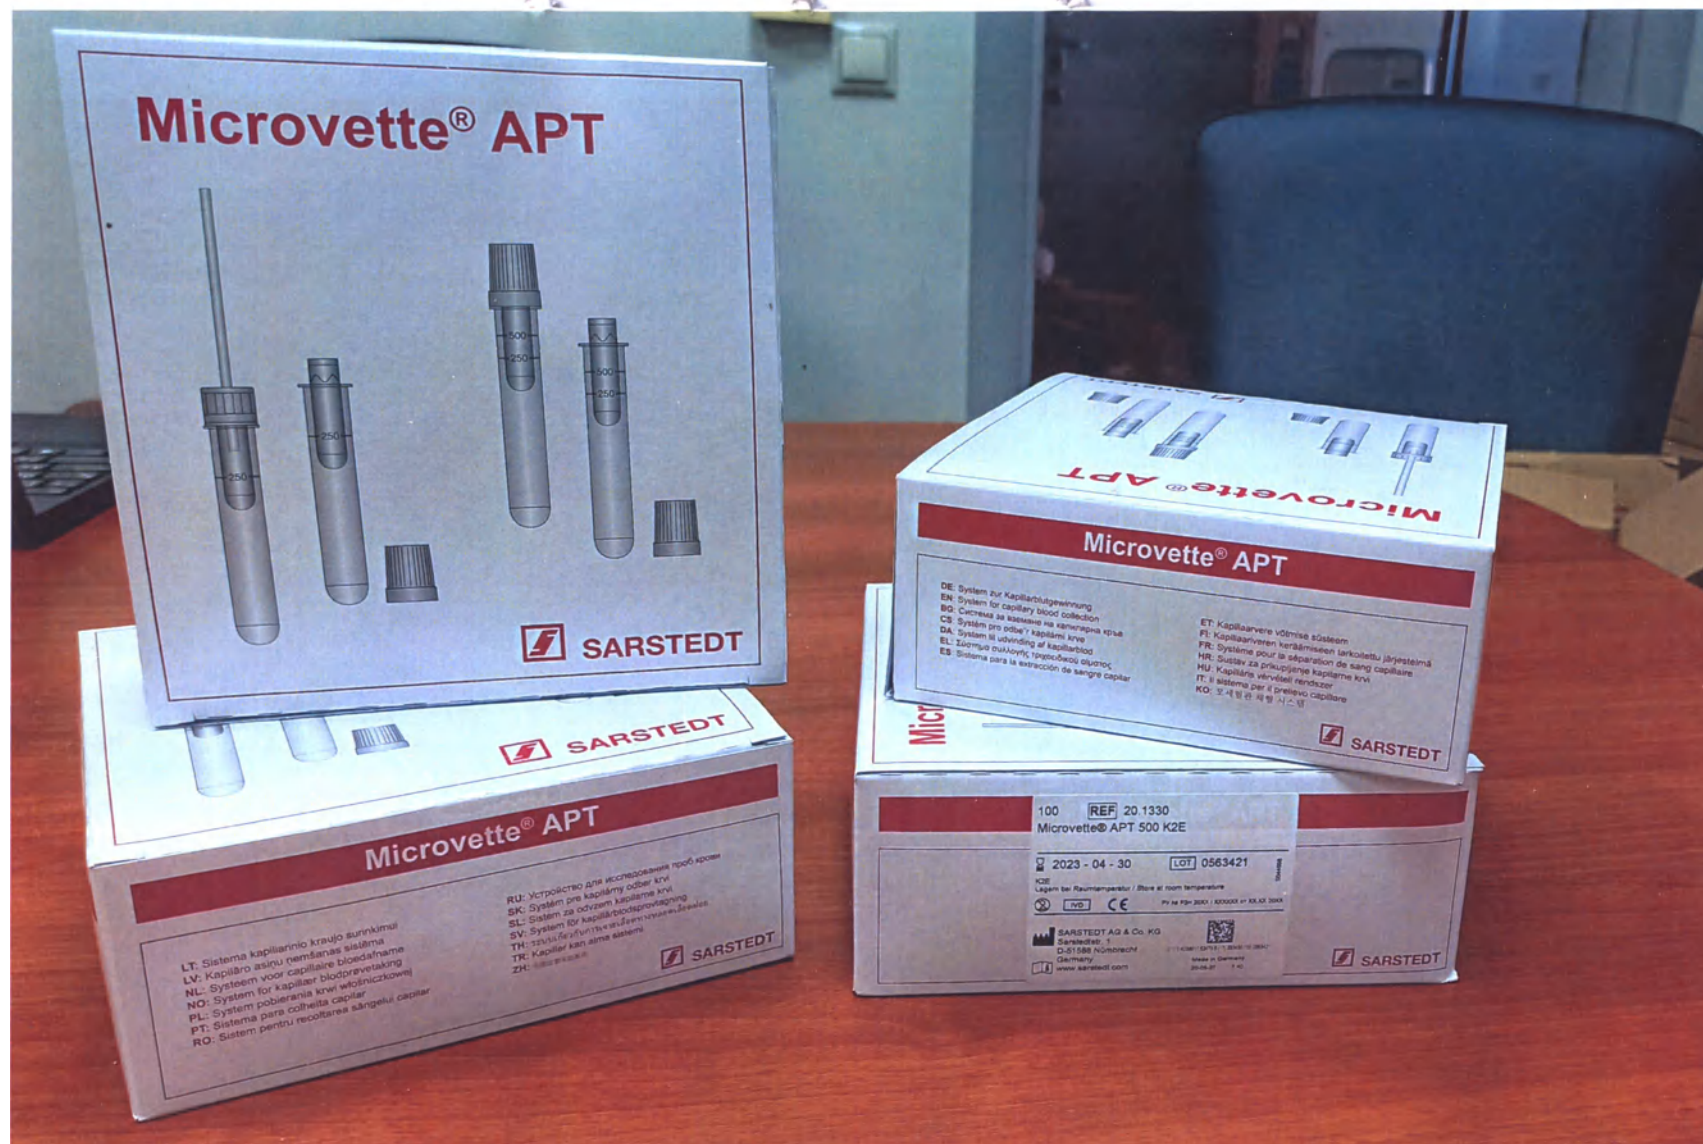


**Рис 25. Групповая упаковка изделий: Устройство для исследования проб крови Microvette APT с К2ЭДТА
 Microvette APT 500: 20.1330, 20.1330.100, 20.1330.800, 20.1330.801**



Рис 26. Пример транспортной упаковки. Устройство для исследования проб крови Microvette APT с К2ЭДТА
Microvette APT 250: 20.1331

Пронумеровано прошито и
скреплено печатью

26 фактами нет) листа(-ов)

Генеральный директор

ООО «САРШТЕДТ»

Белунин А.В.

