

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор

ОО «СОЛТ»

В.В. Заяц

2021 г.


**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Анализатор автоматический мочевой сухой химии UC-1800 в составе с
принадлежностями (см. Приложение),**


производства

URIT Medical Electronic Co., Ltd. (УРИТ Медикал Электроник КО., ЛТД), Китай.


Общий вид анализатора UC-1800.

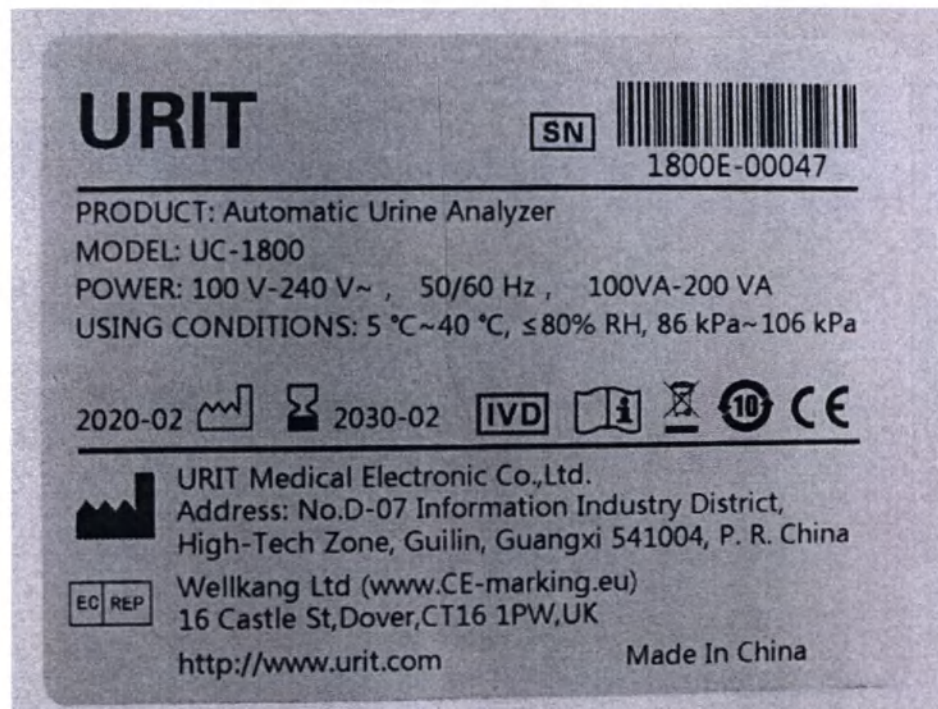

Основной блок анализатора

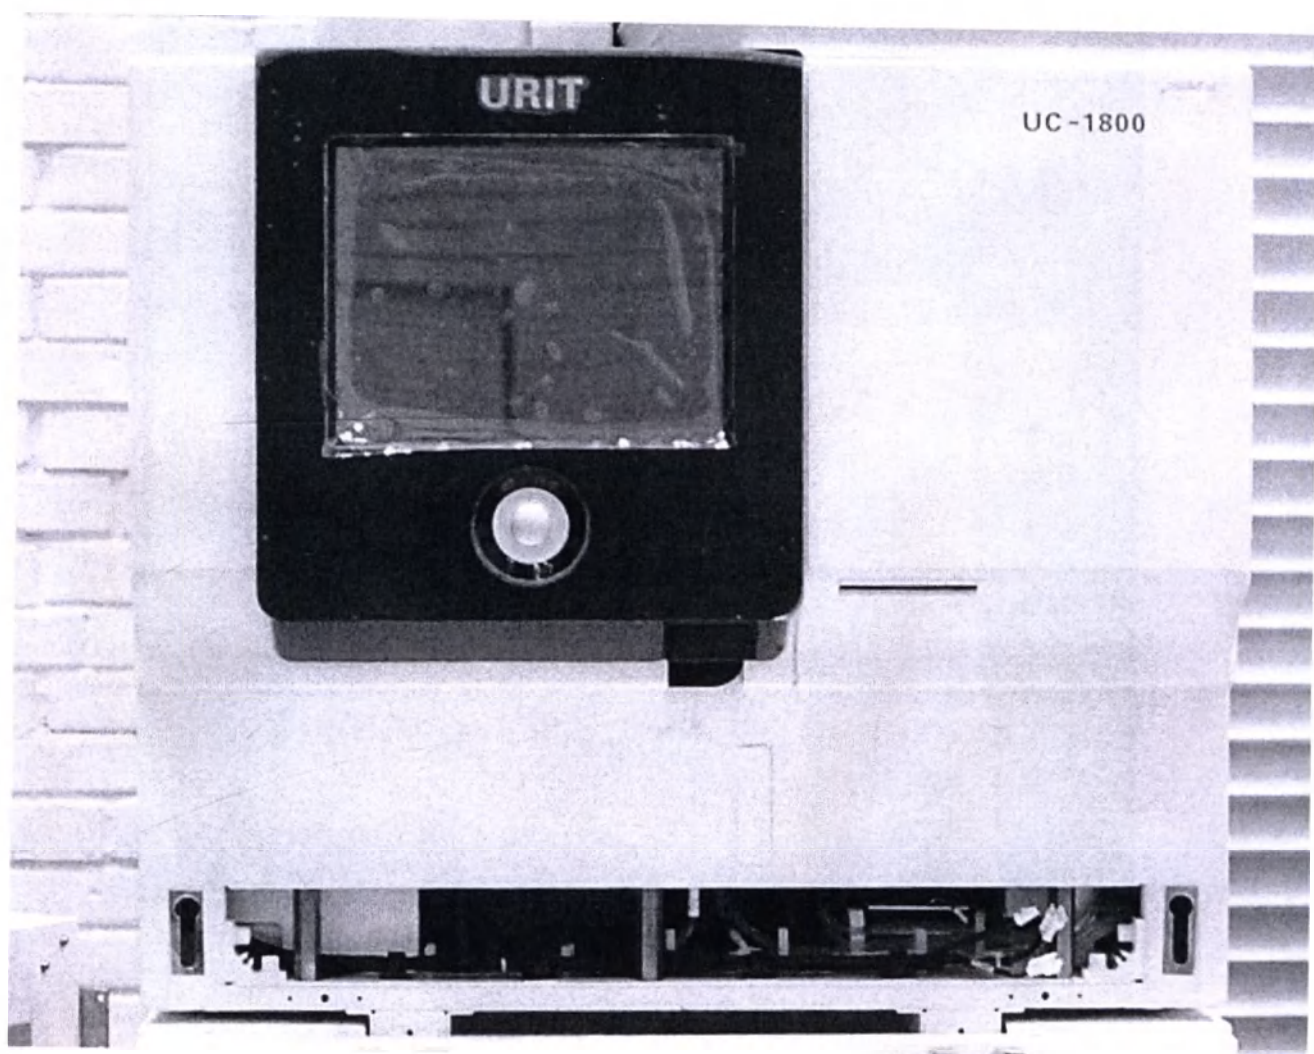

Руководство пользователя

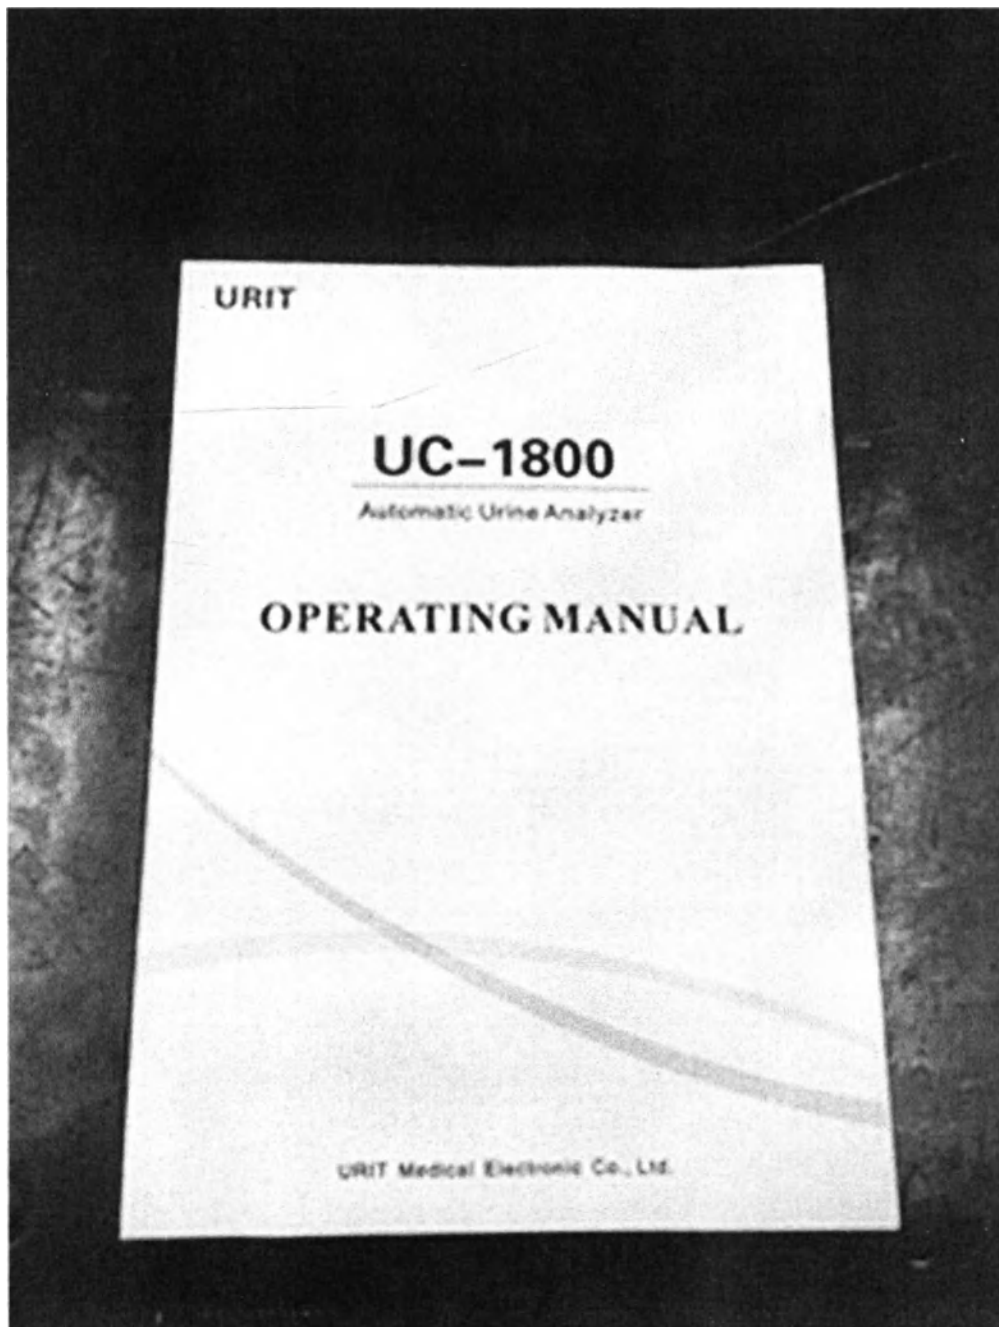


Бутыль для промывающего раствора, 5 л




Бак сливной, 5 л




Кабель сетевой, 3м

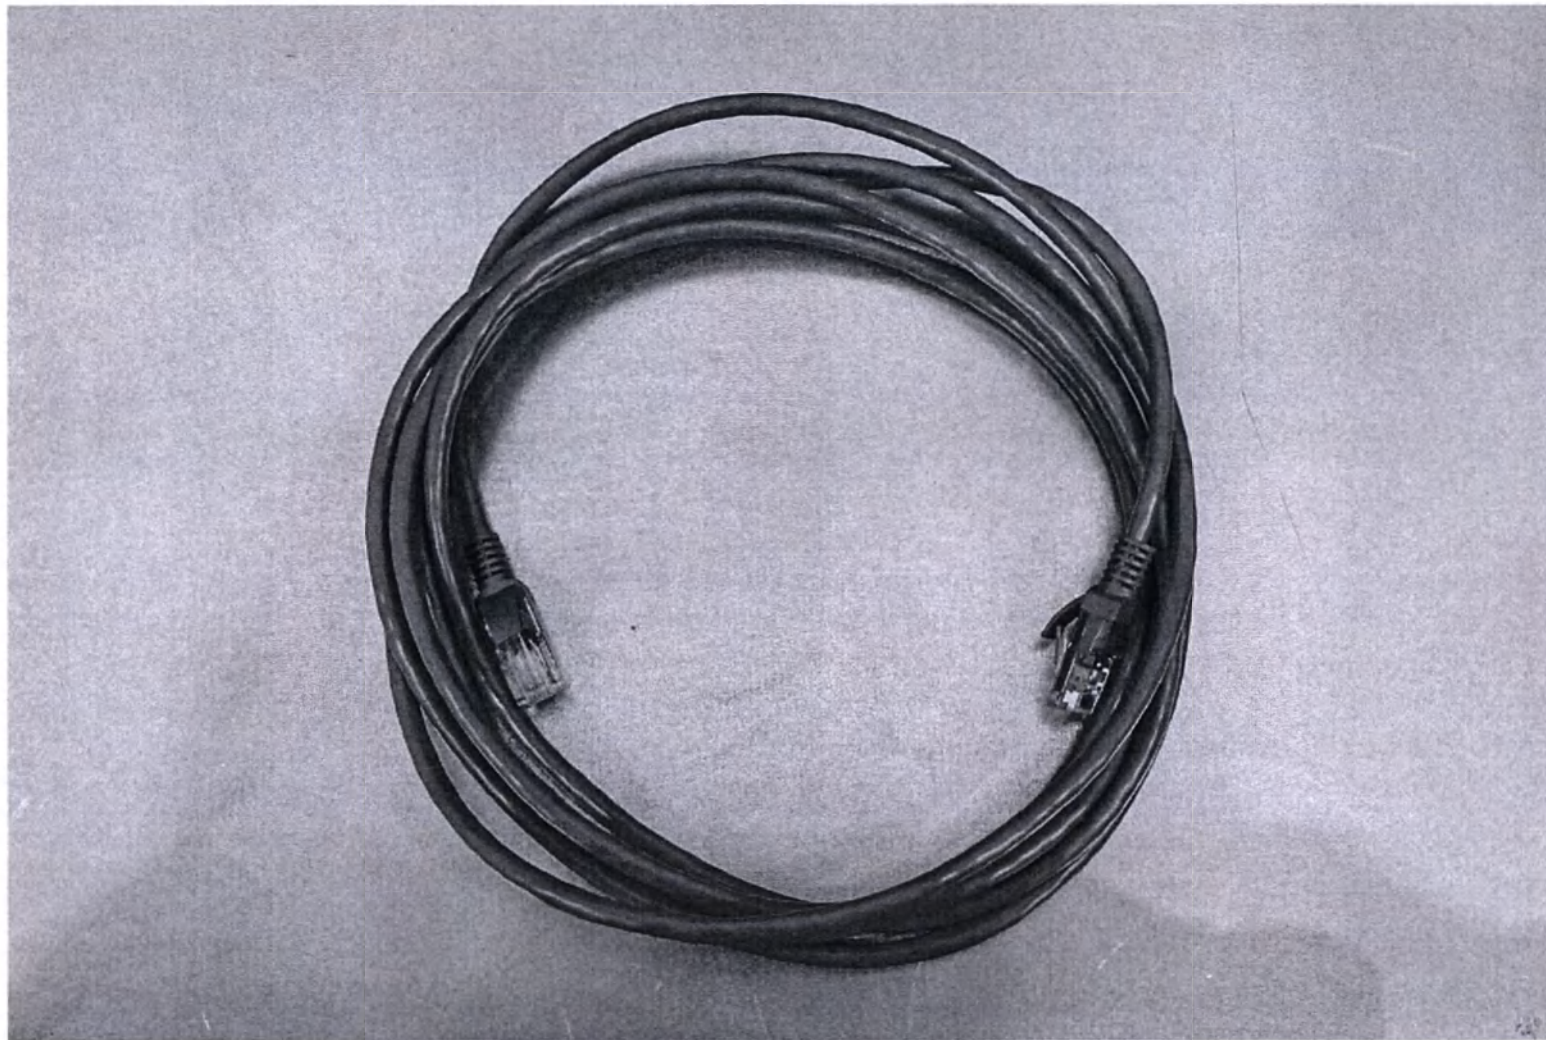


Штатив для образцов (№ 1-10)

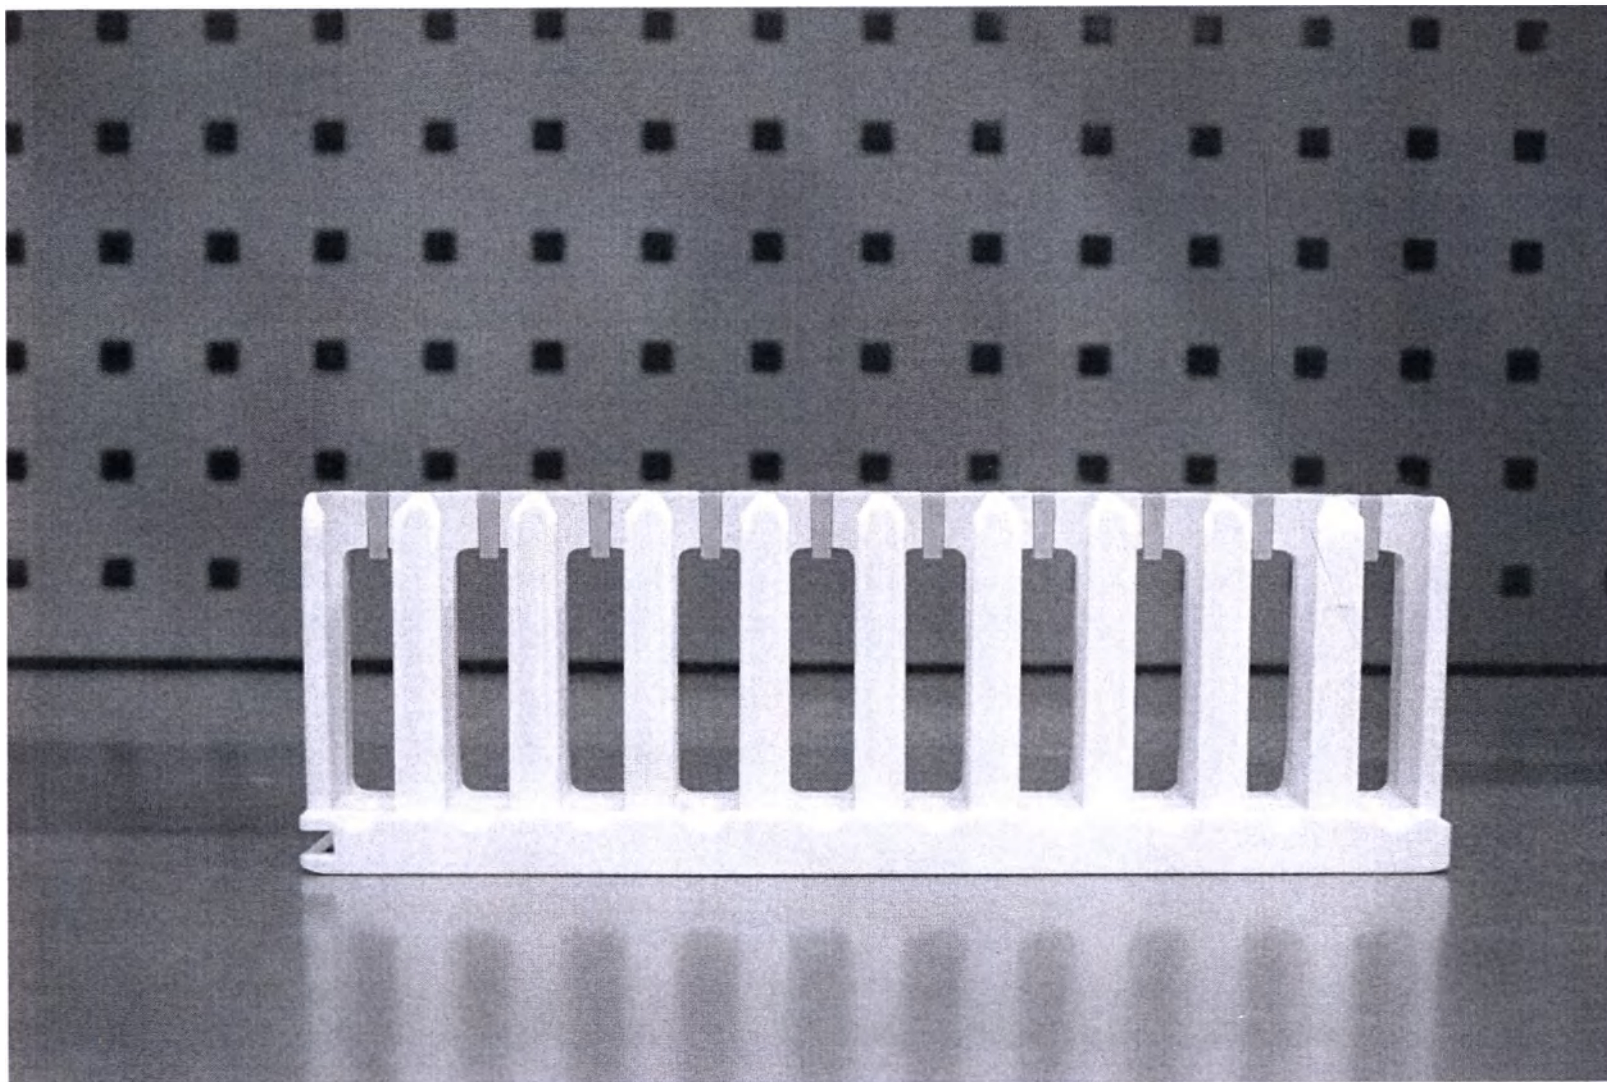


Пробирка центрифужная с завинчивающейся крышкой объемом 10 мл

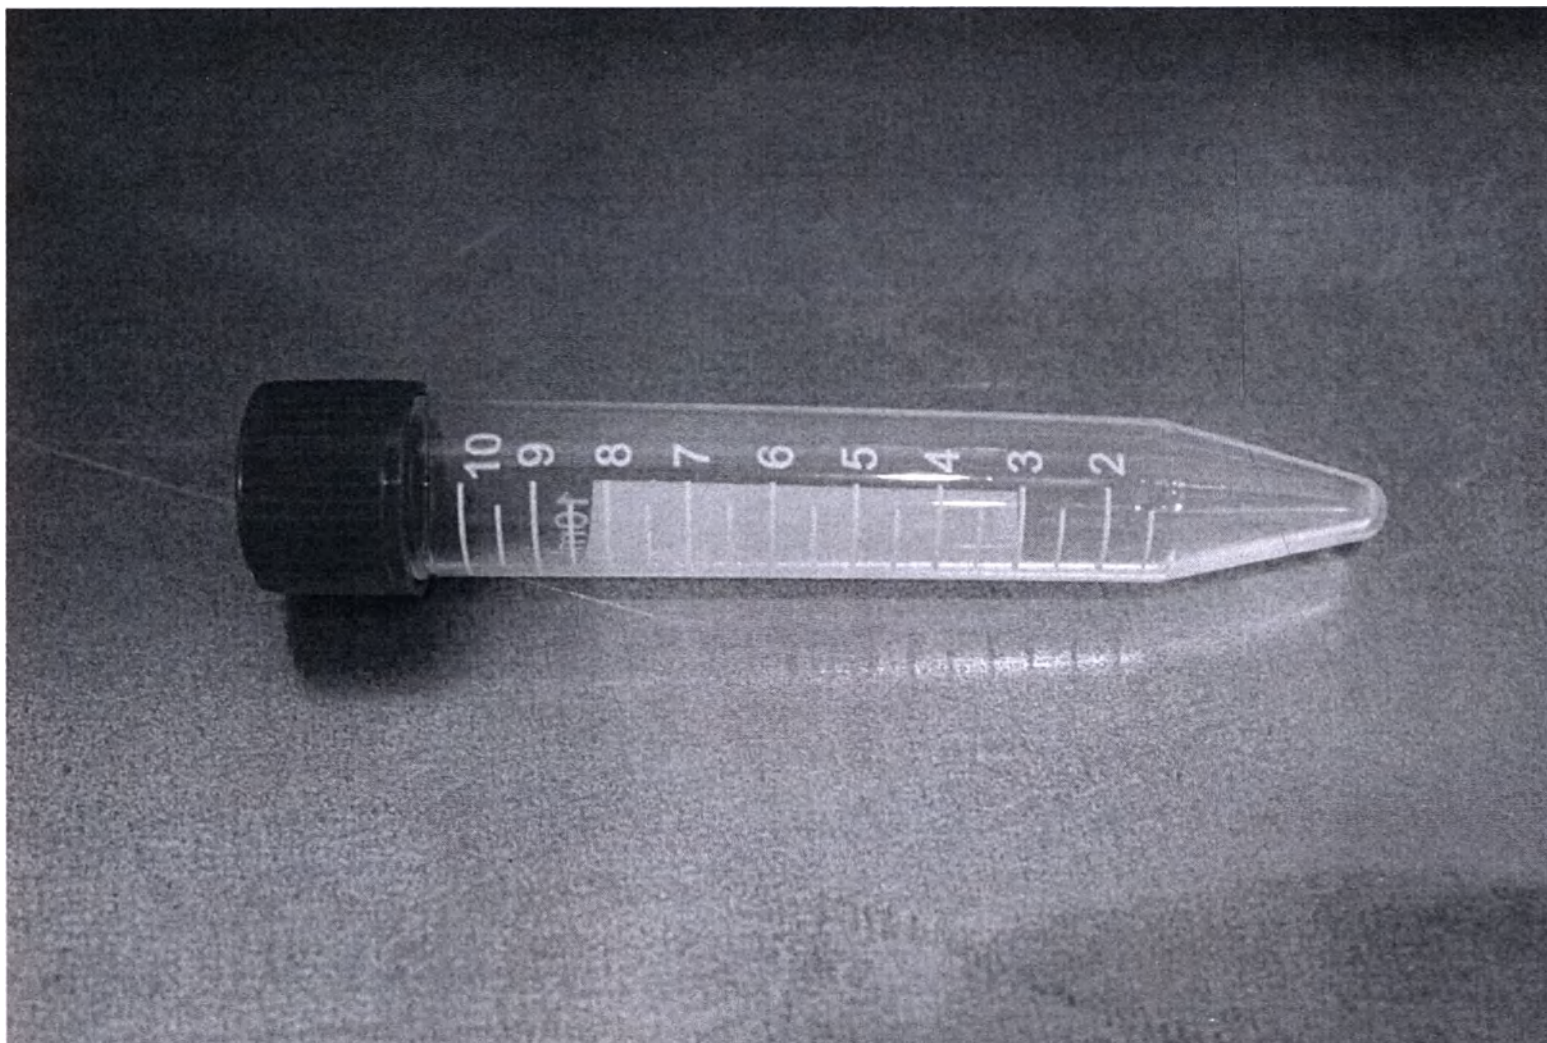


Адаптер для пробирок диаметром 13 мм и высотой 100 мм

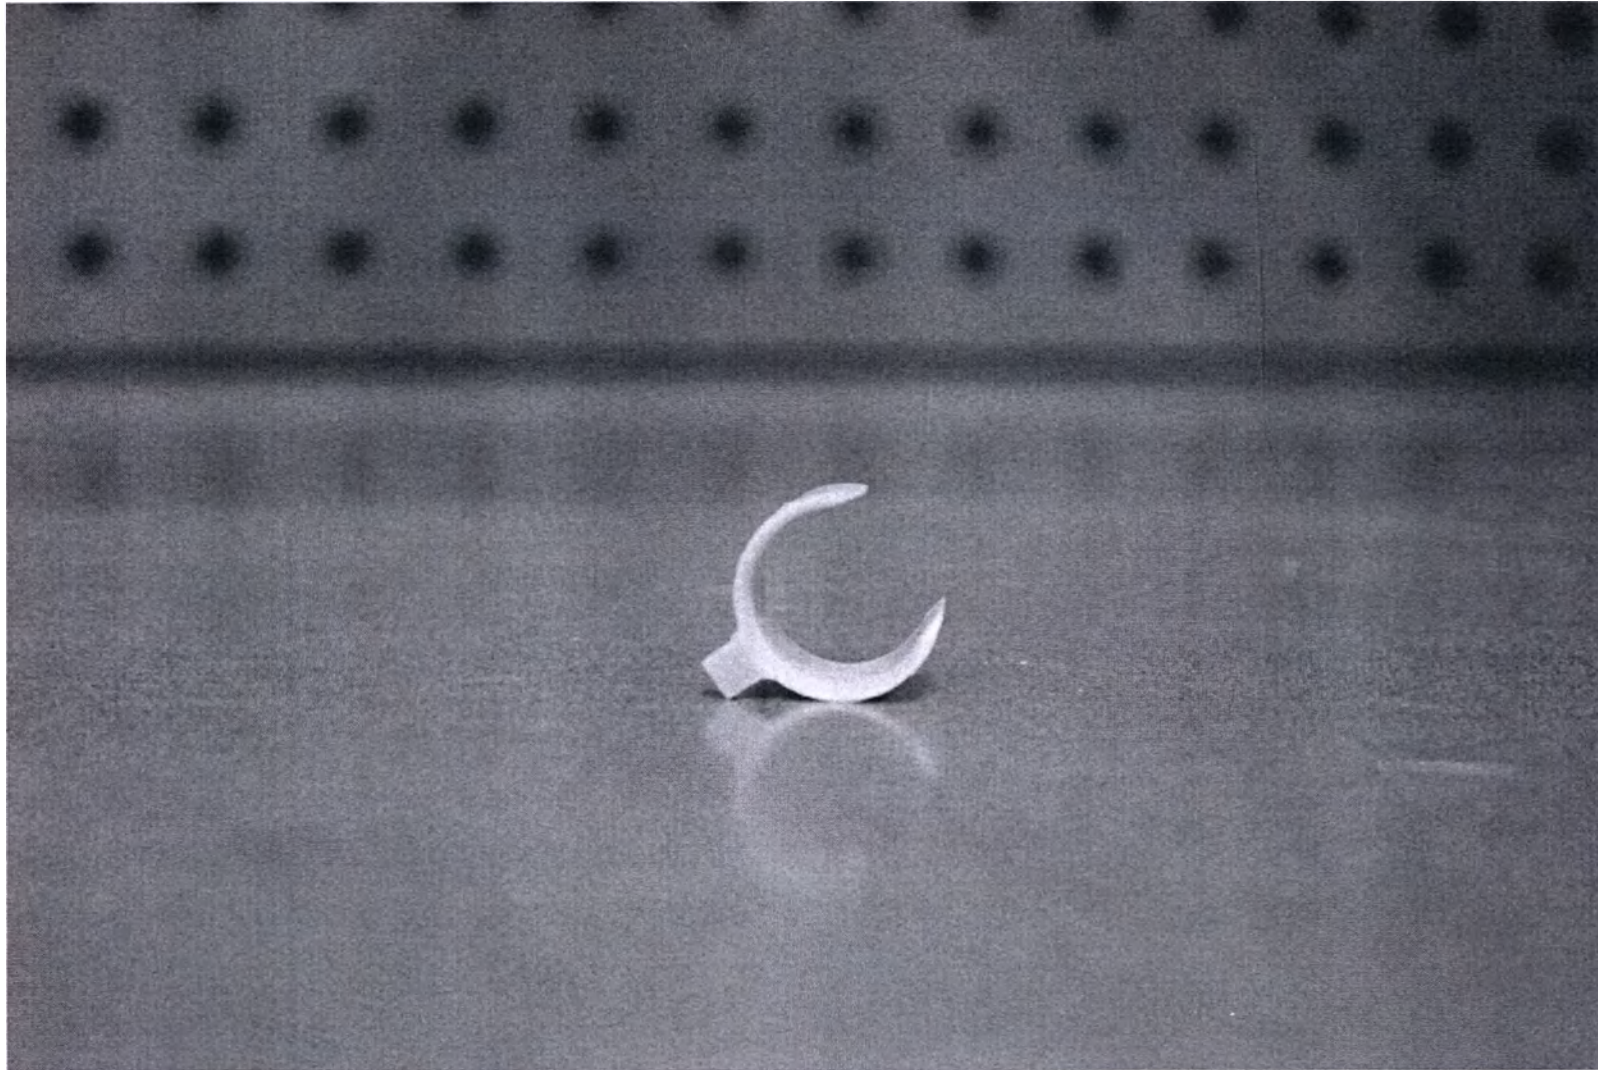

Клапан обратный

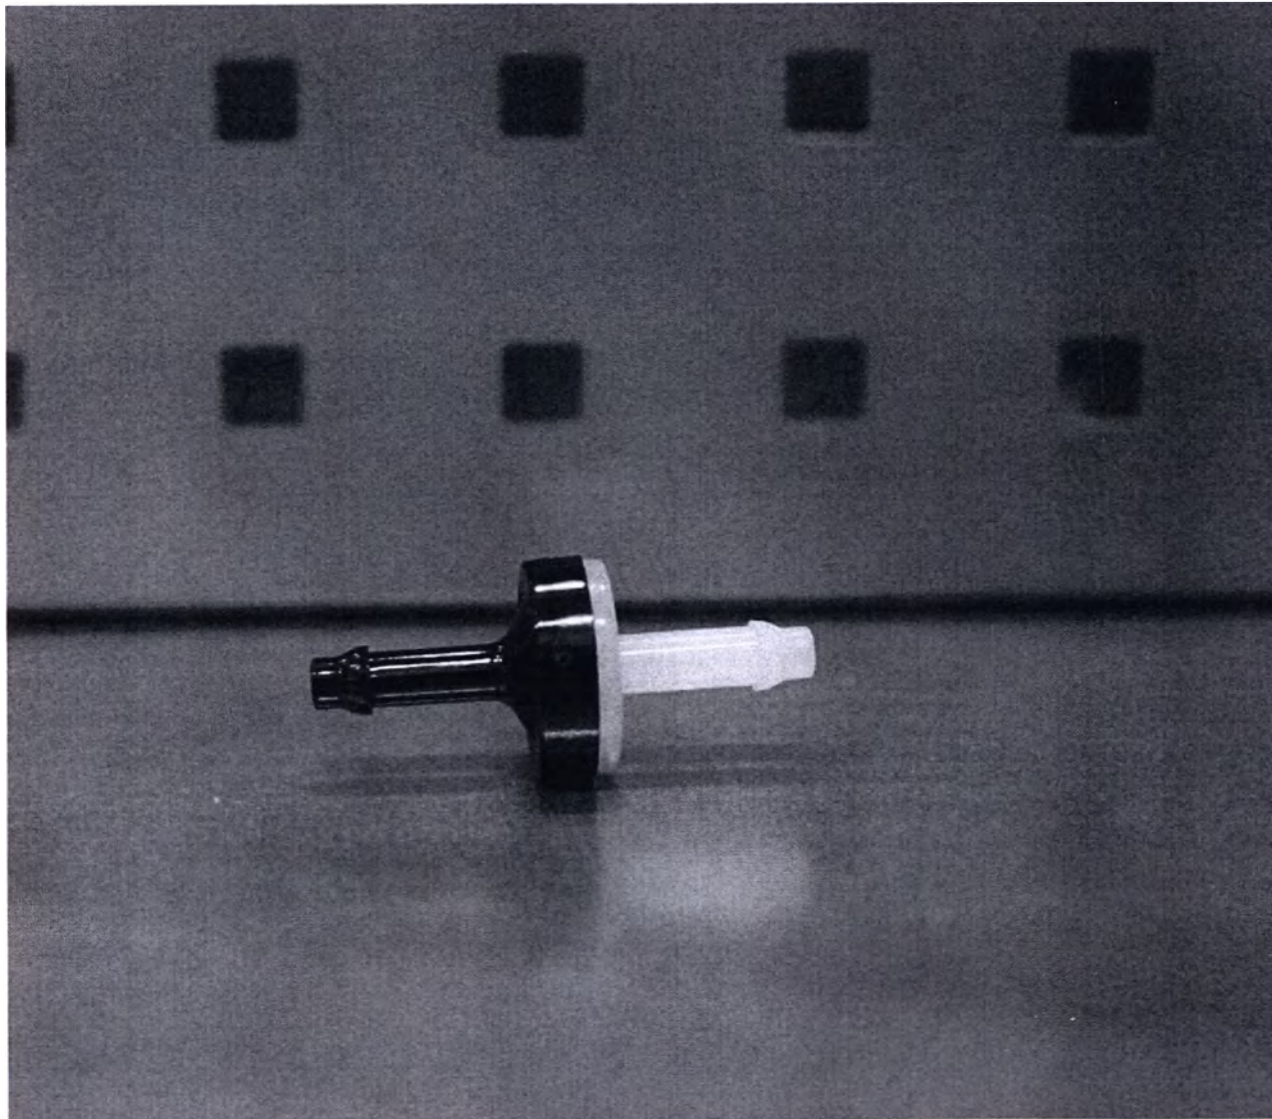


Фильтр воздушный

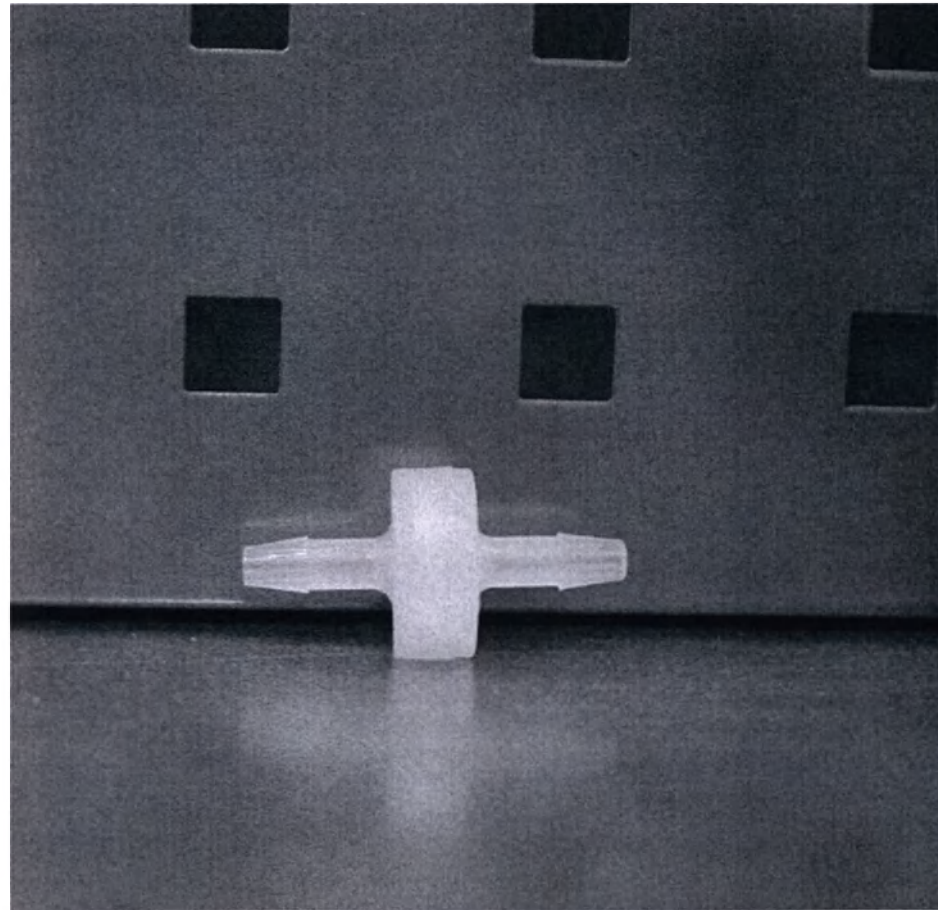

Шнур питания, 1,5 м




Термобумага для печати

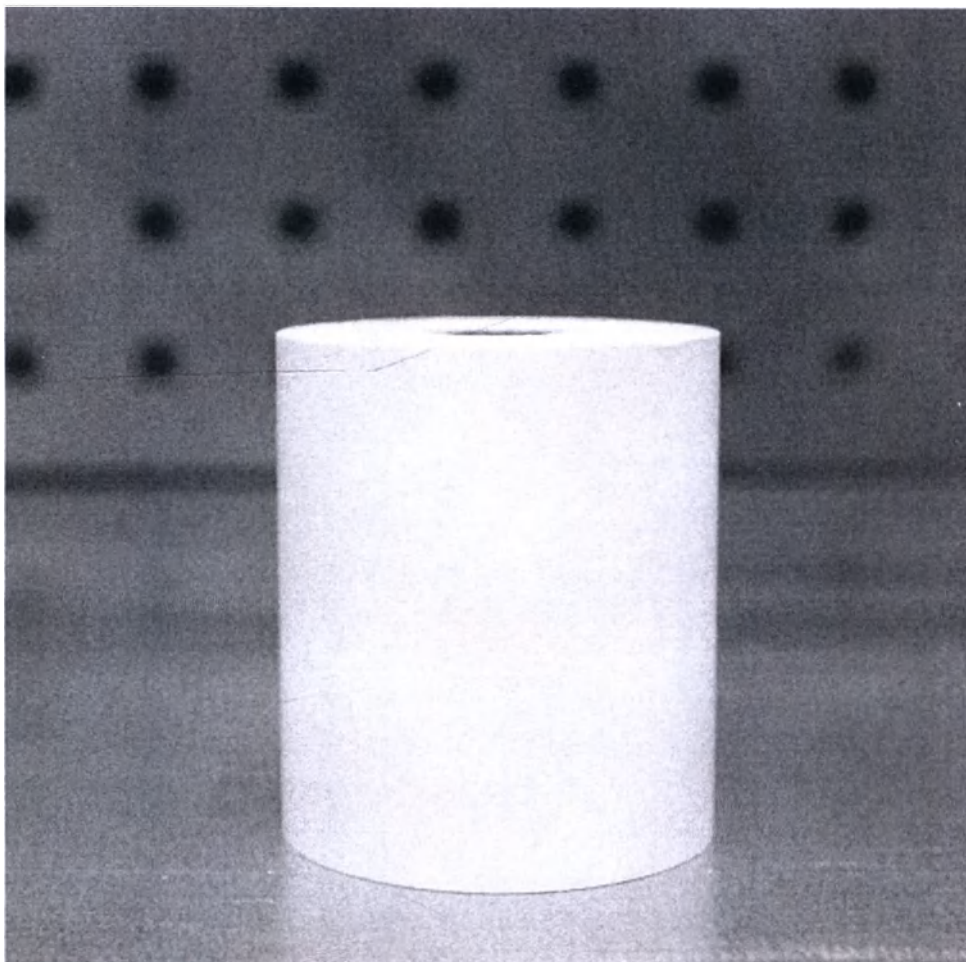


Спринцовка для промывки




Тест-полоски проверочные

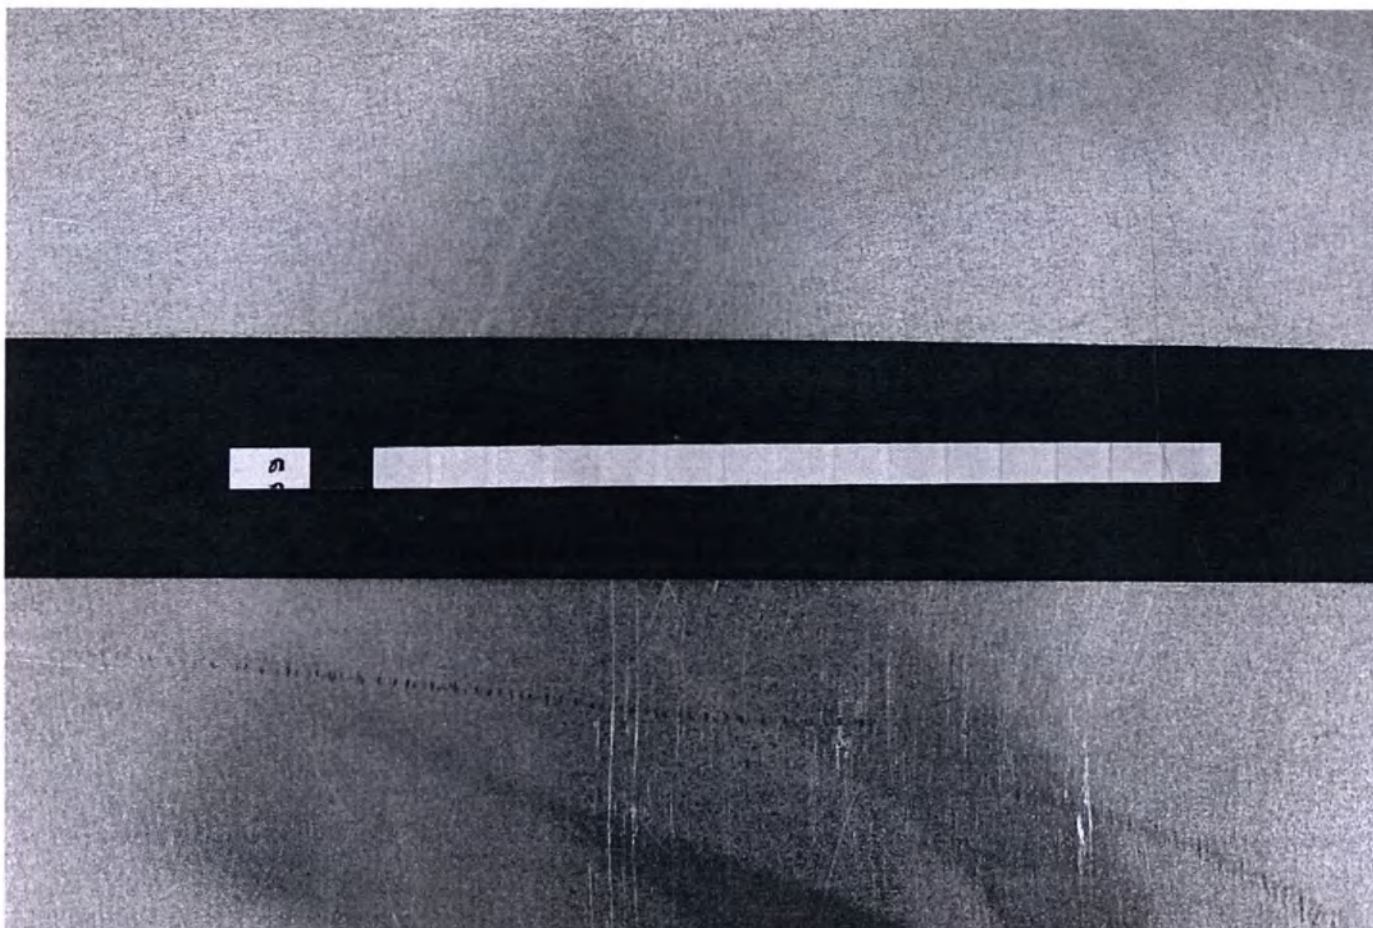


Мандрен стальной для разблокировки

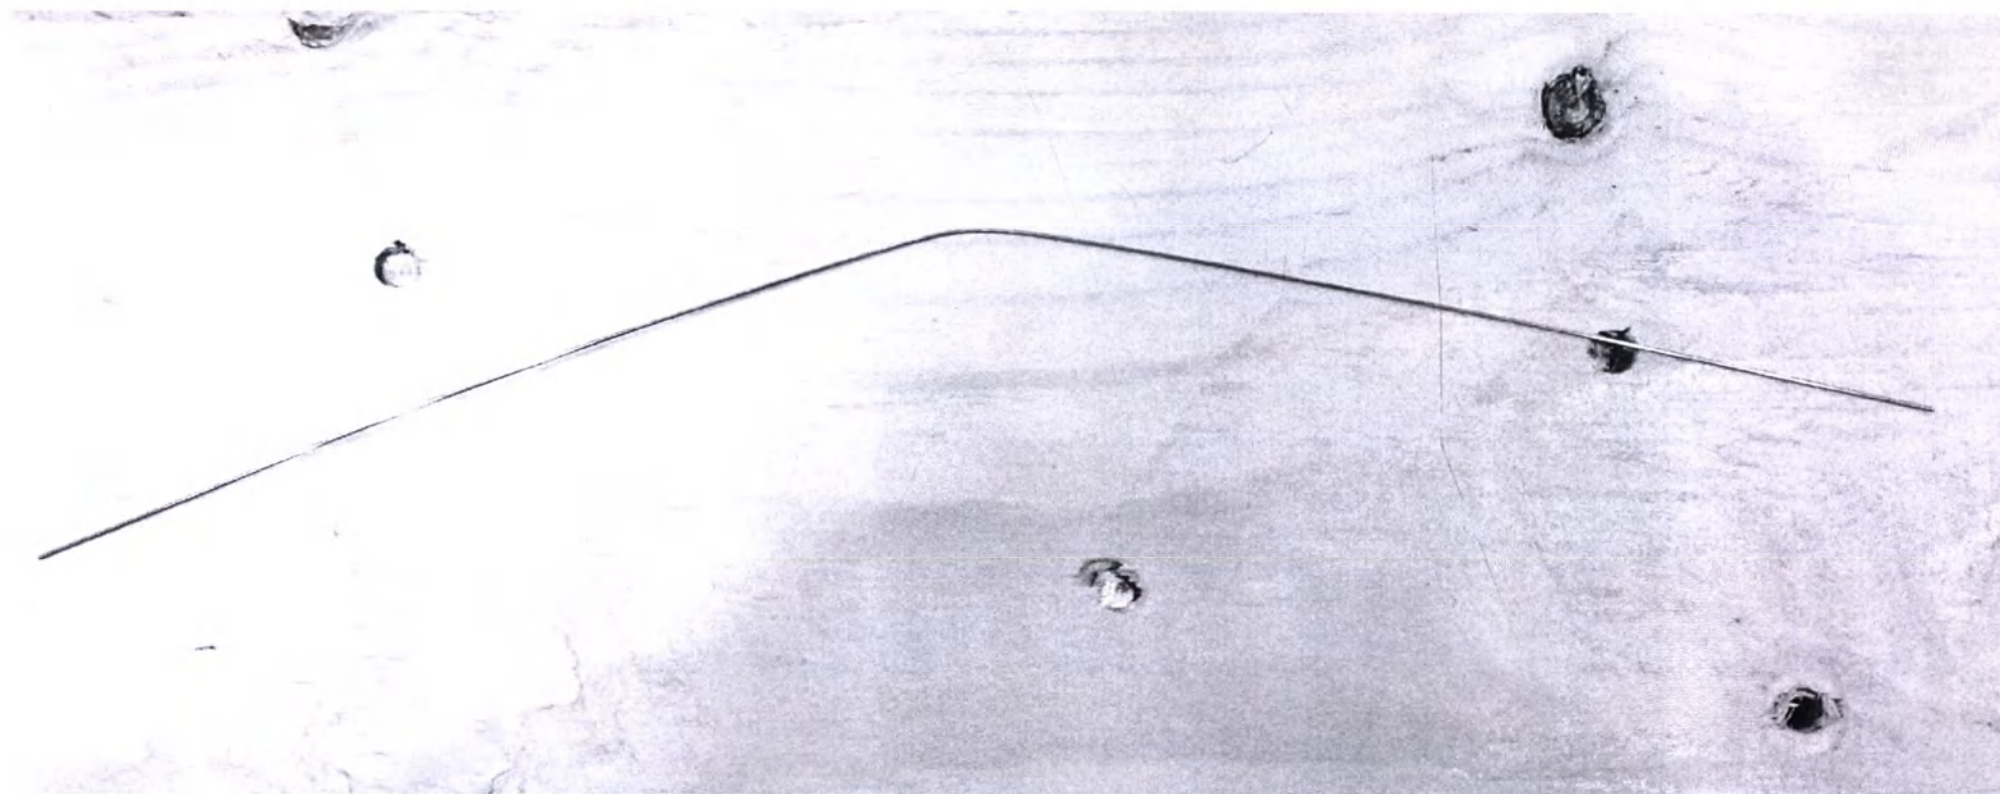


Мандрен мягкий для разблокировки

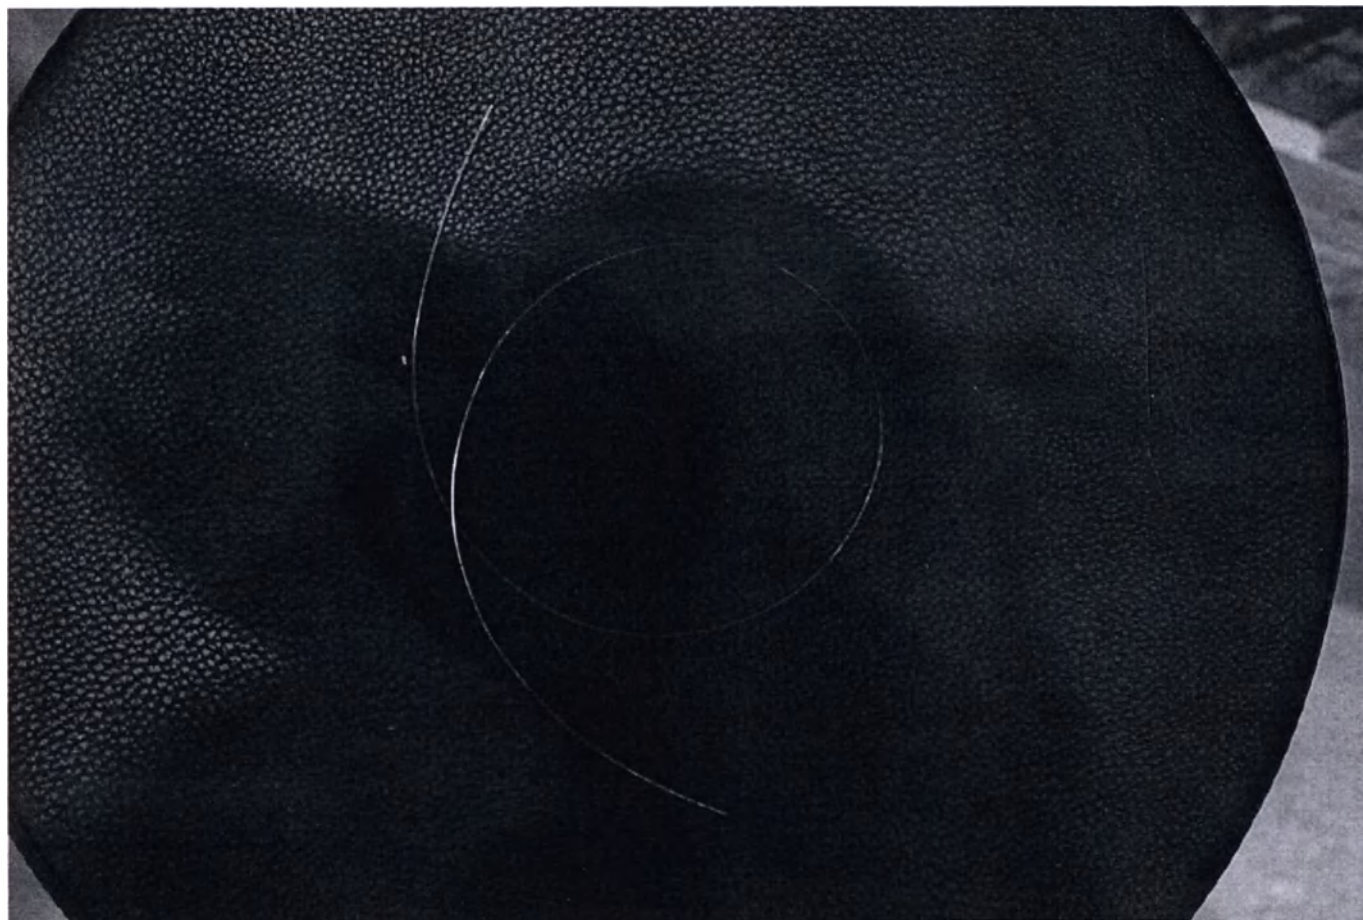


Ключ для замка боковой дверцы

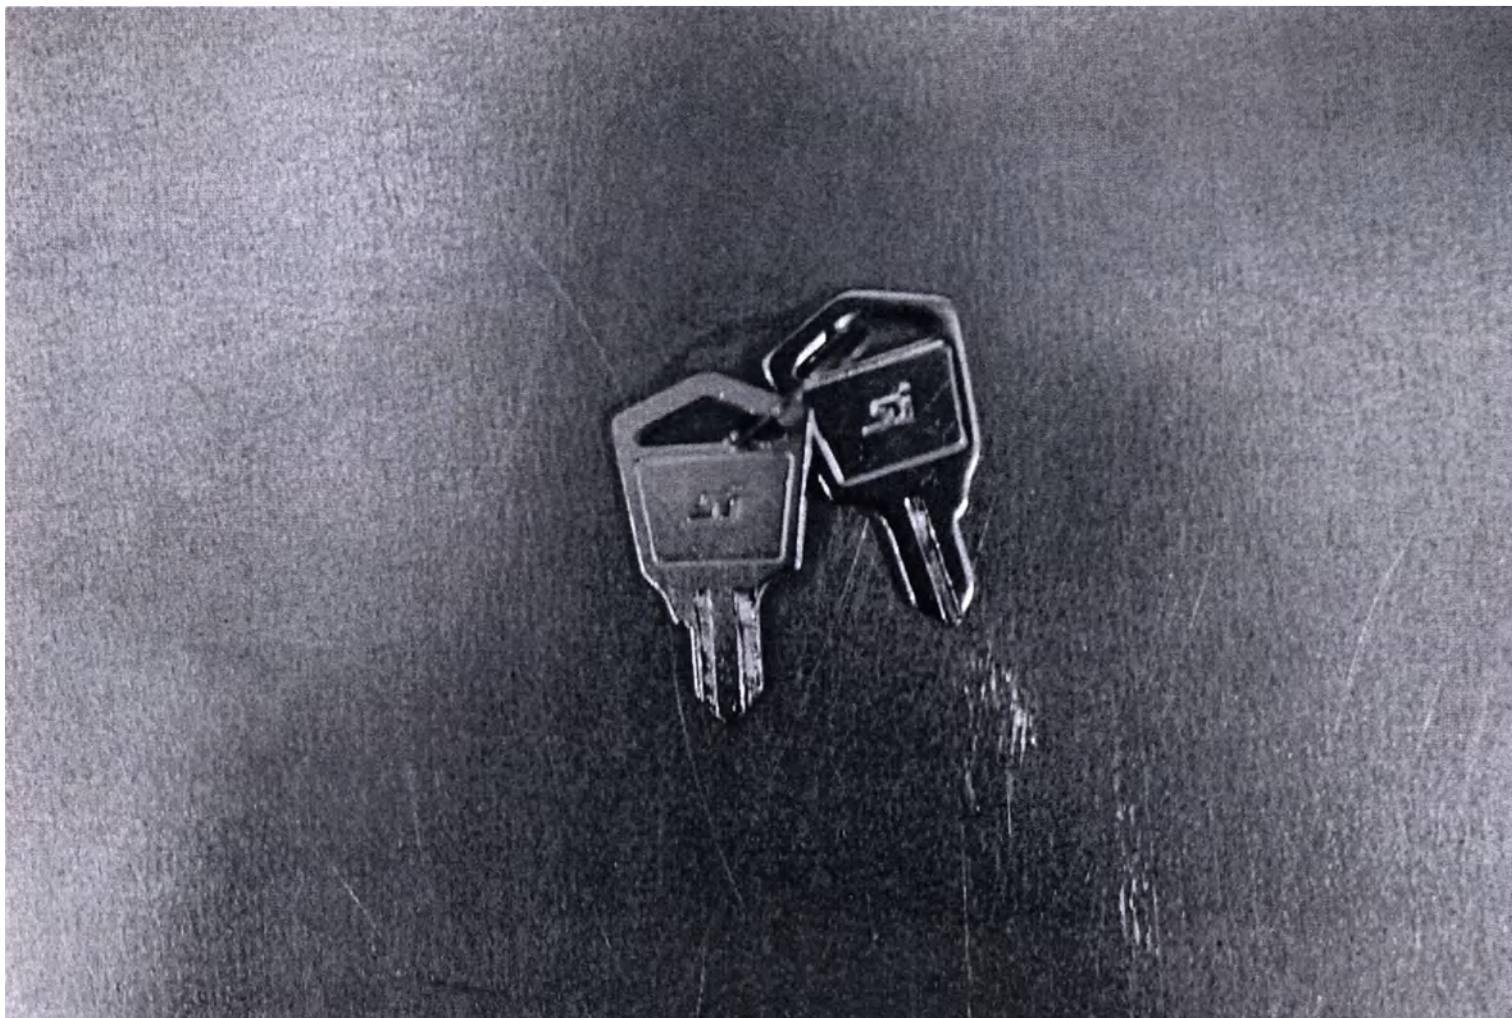


Мост соединительный для пробоподатчика

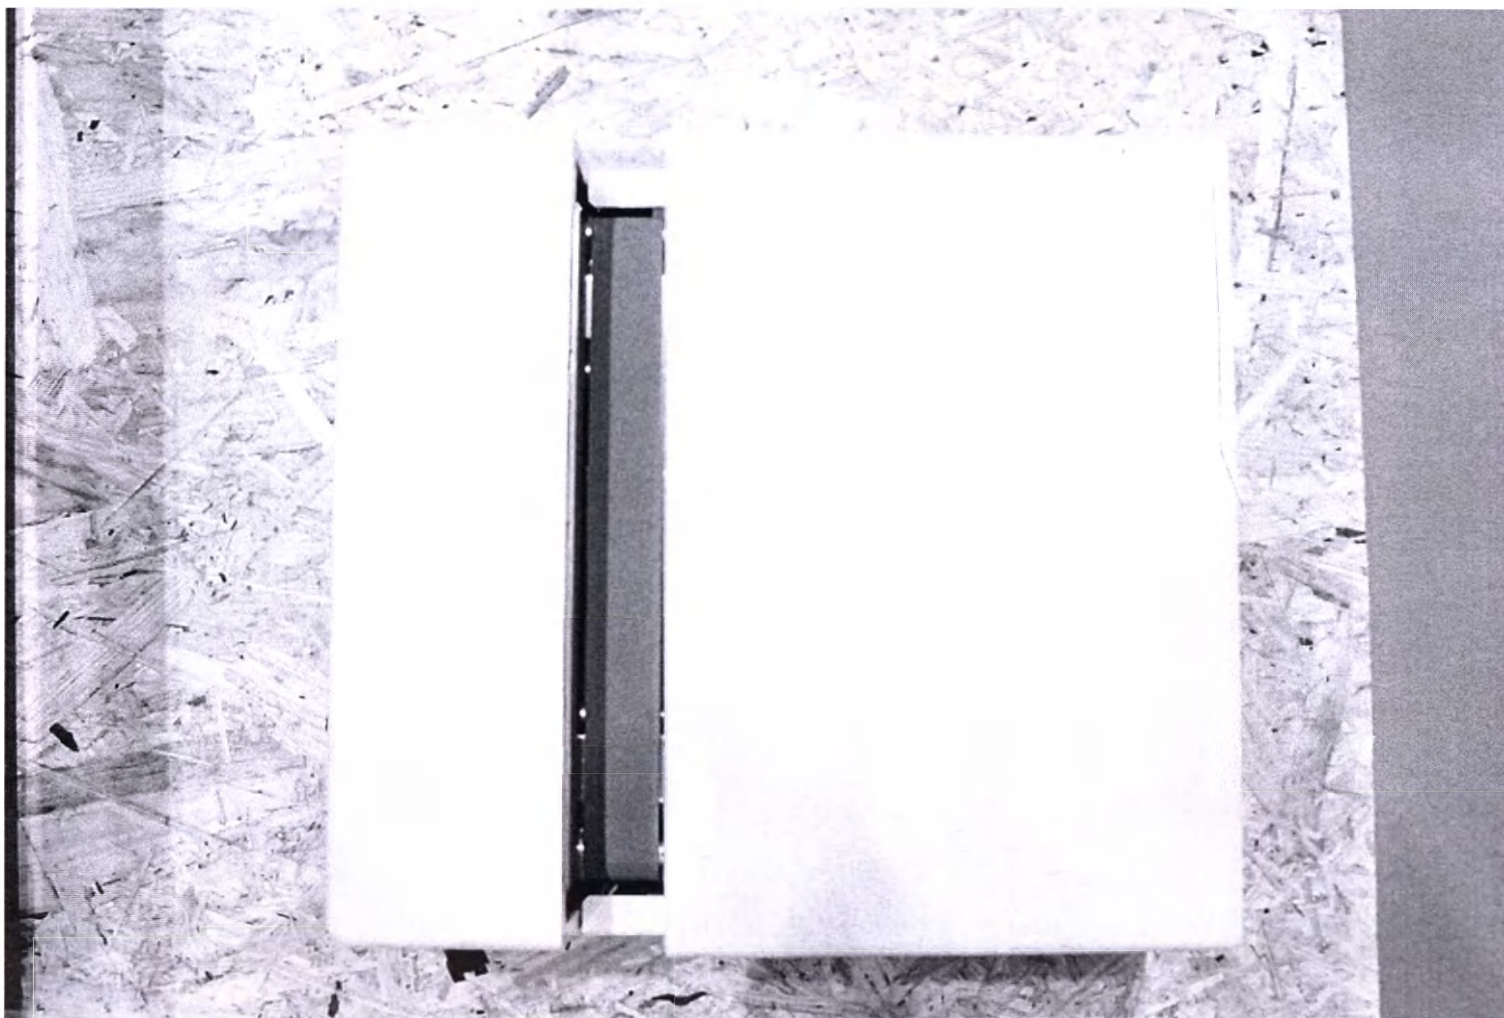


Загрузчик образцов (SS модуль)

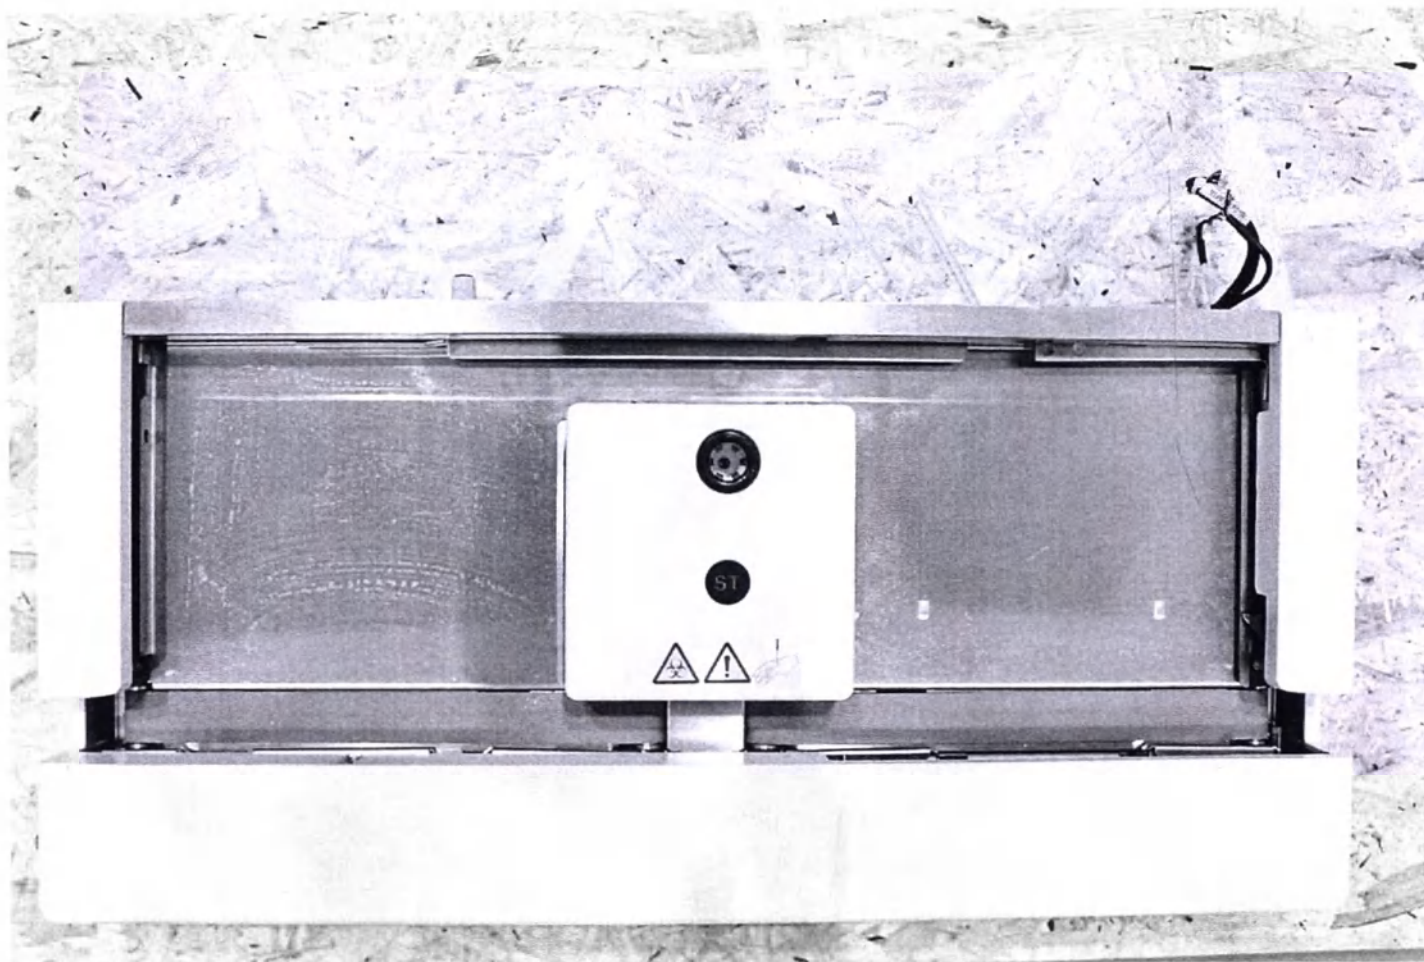


Пластина соединительная нижняя

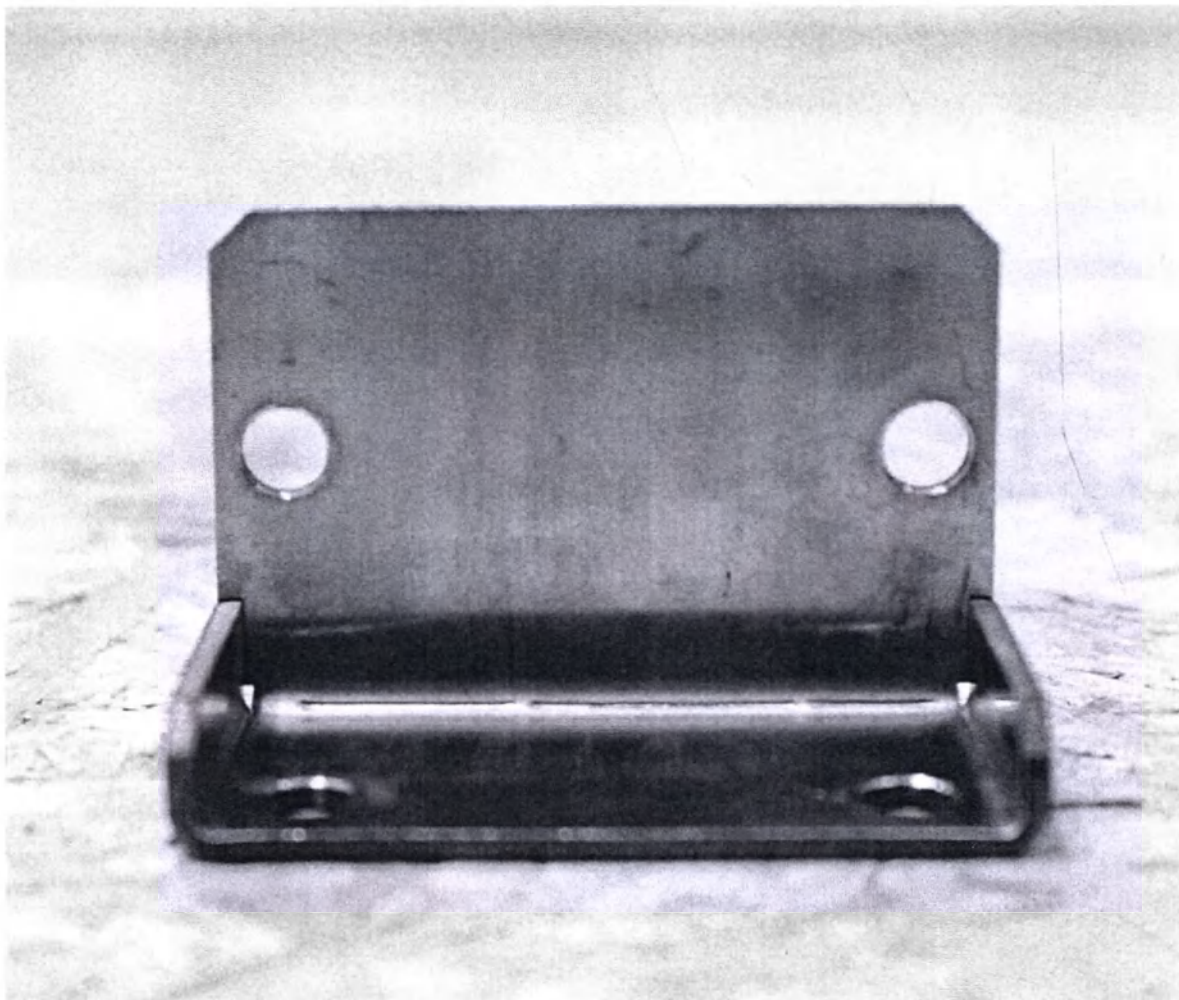


Пластина соединительная верхняя

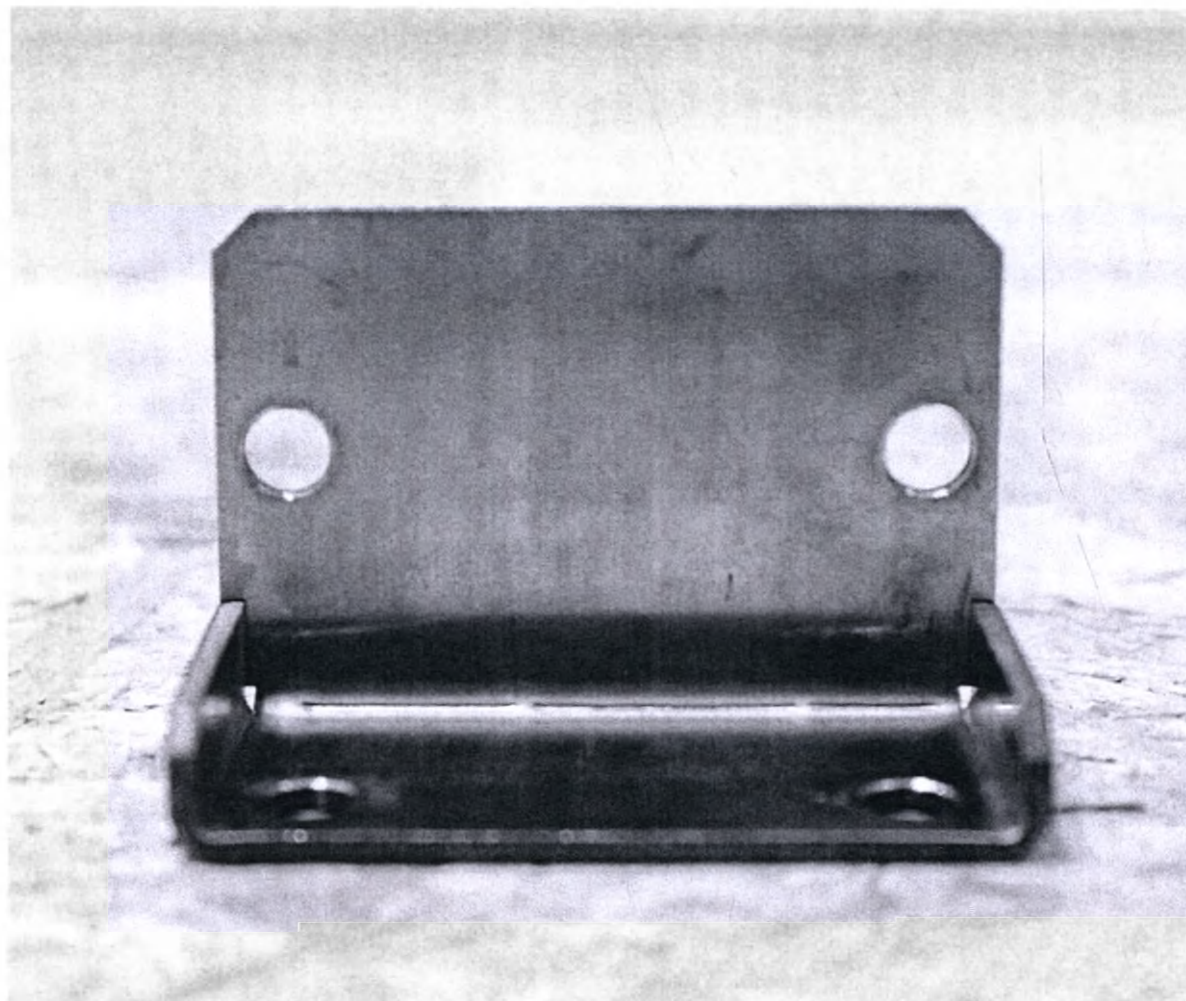


Трубка для промывающего раствора D 21N

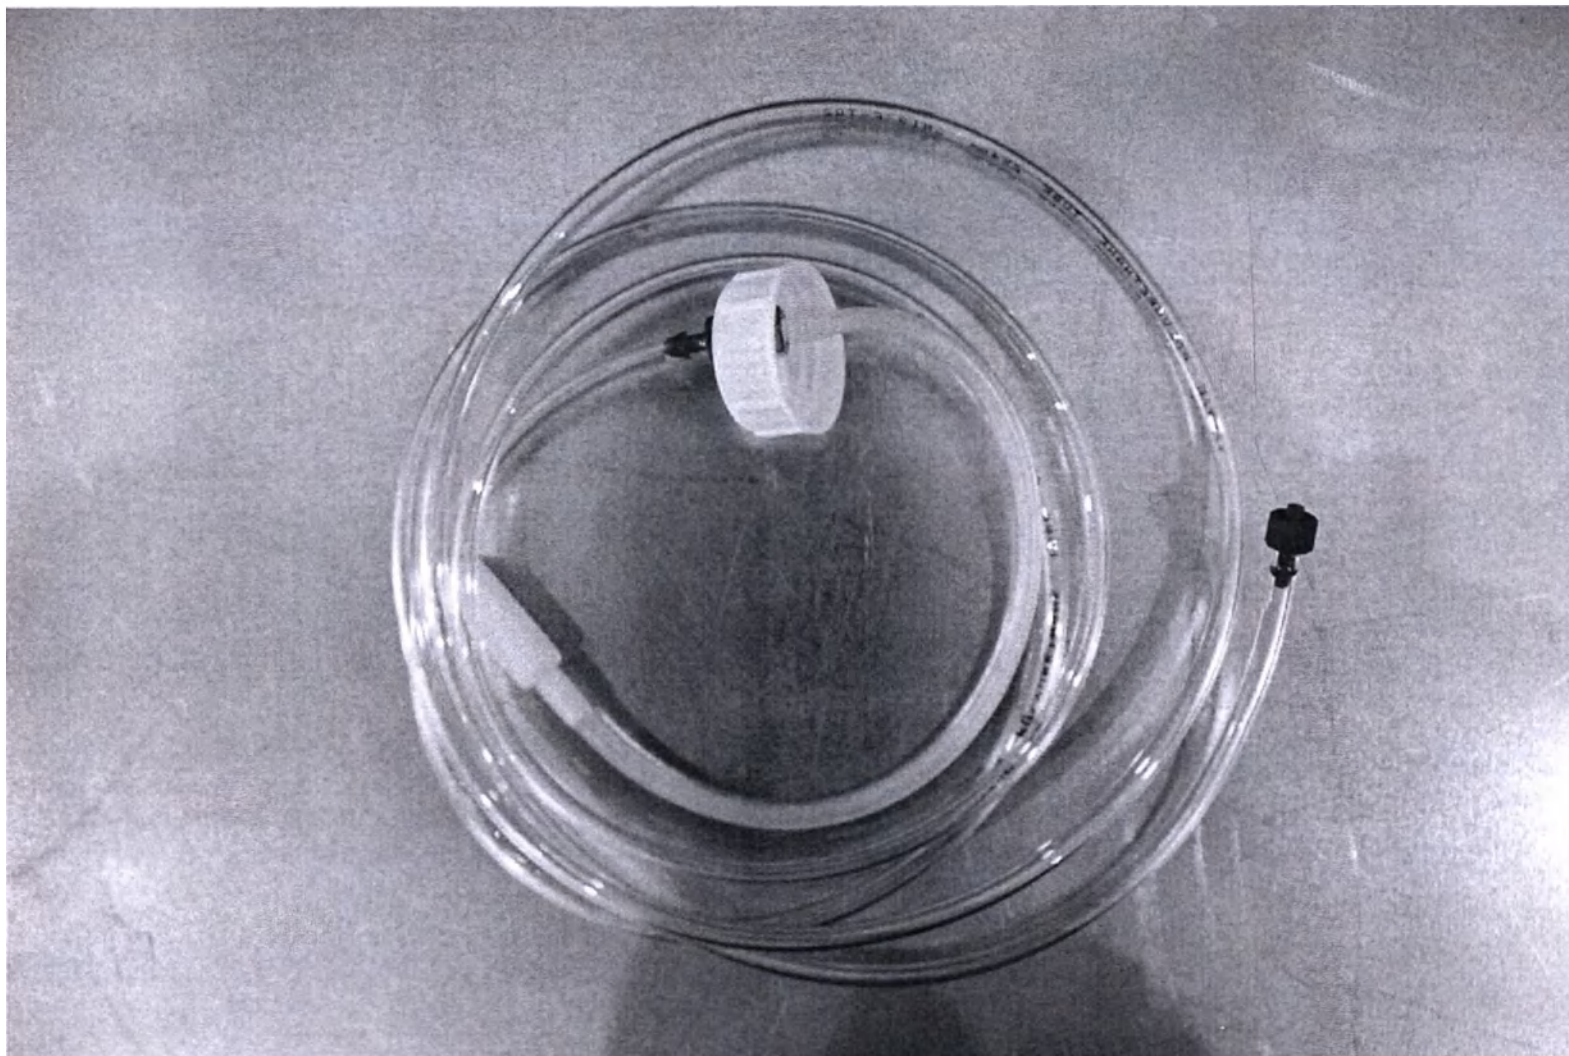

Трубка для раствора D 22 для обслуживания

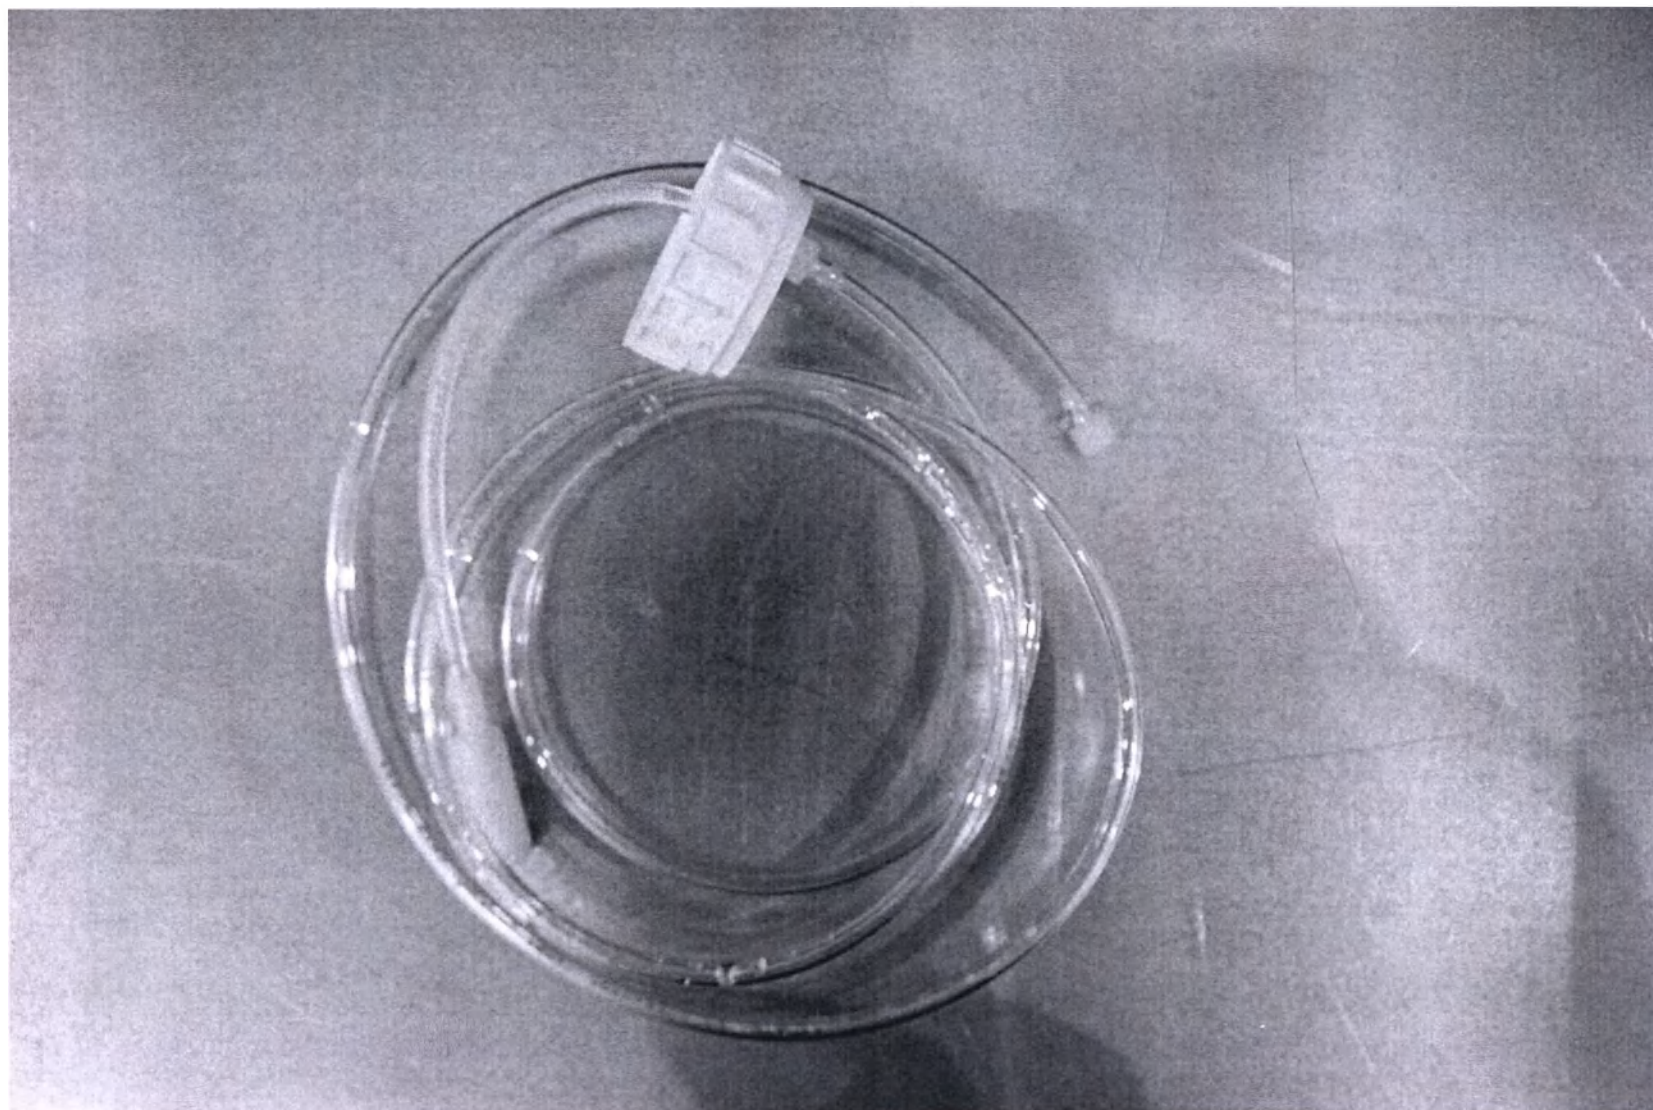


Трубка сливная

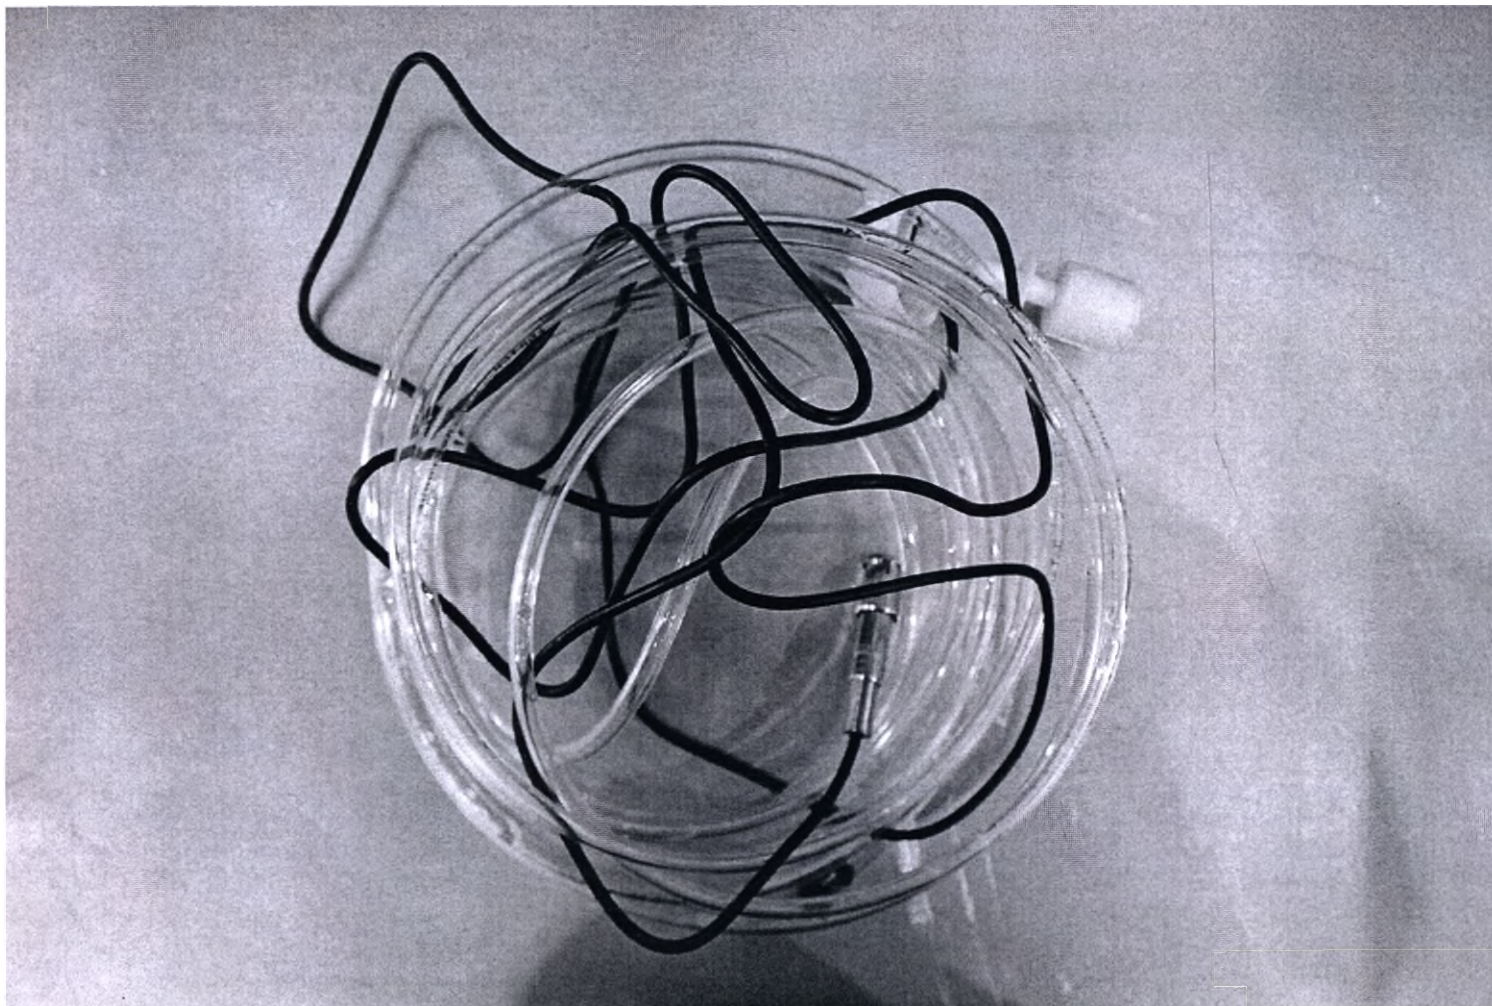




Пластина крепежная

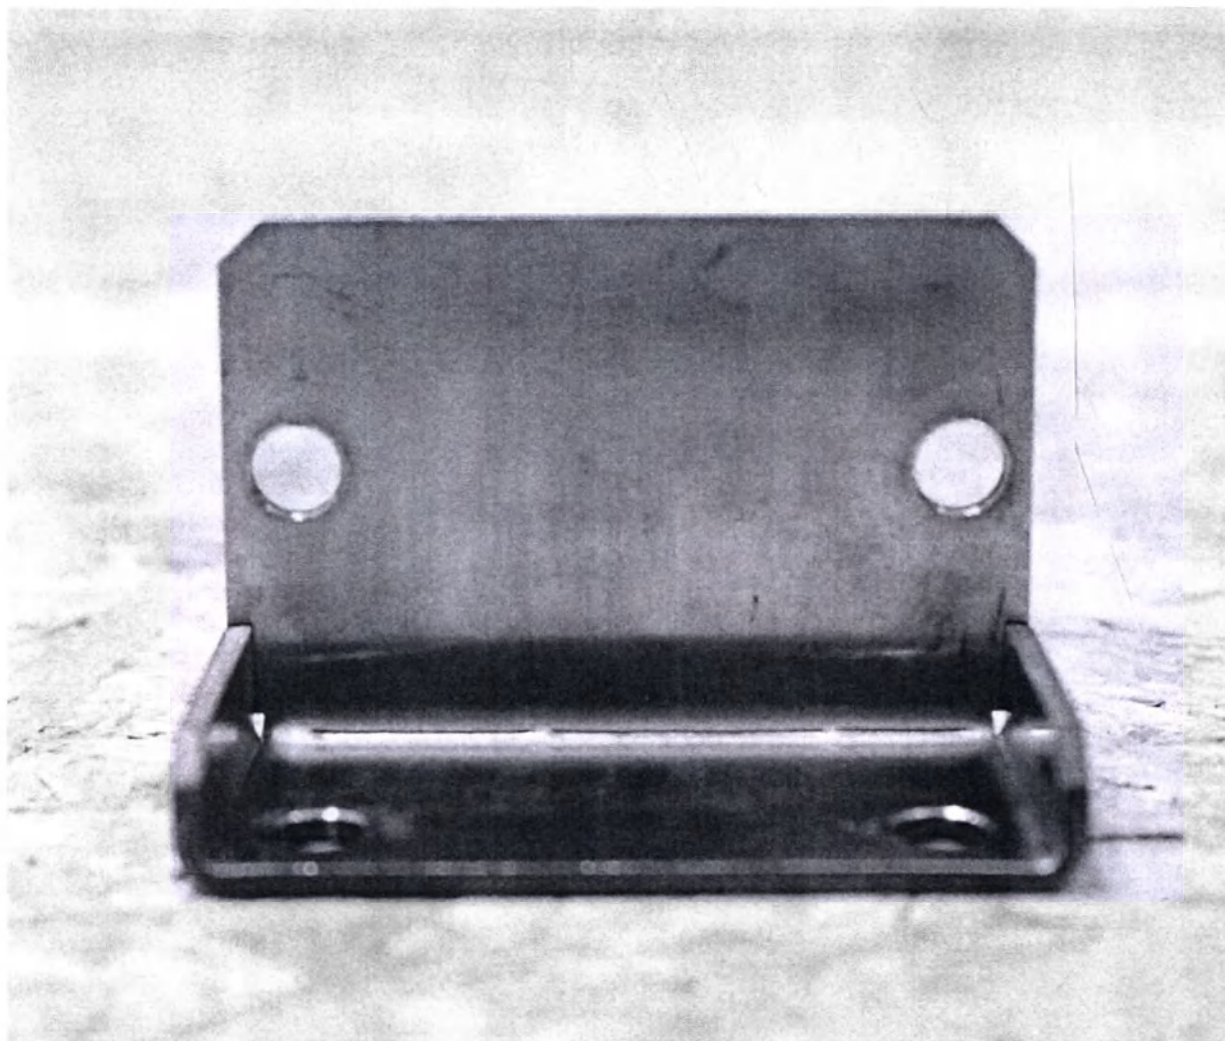

Тумба с креплением для автоматического мочевого анализатора сухой химии UC-1800

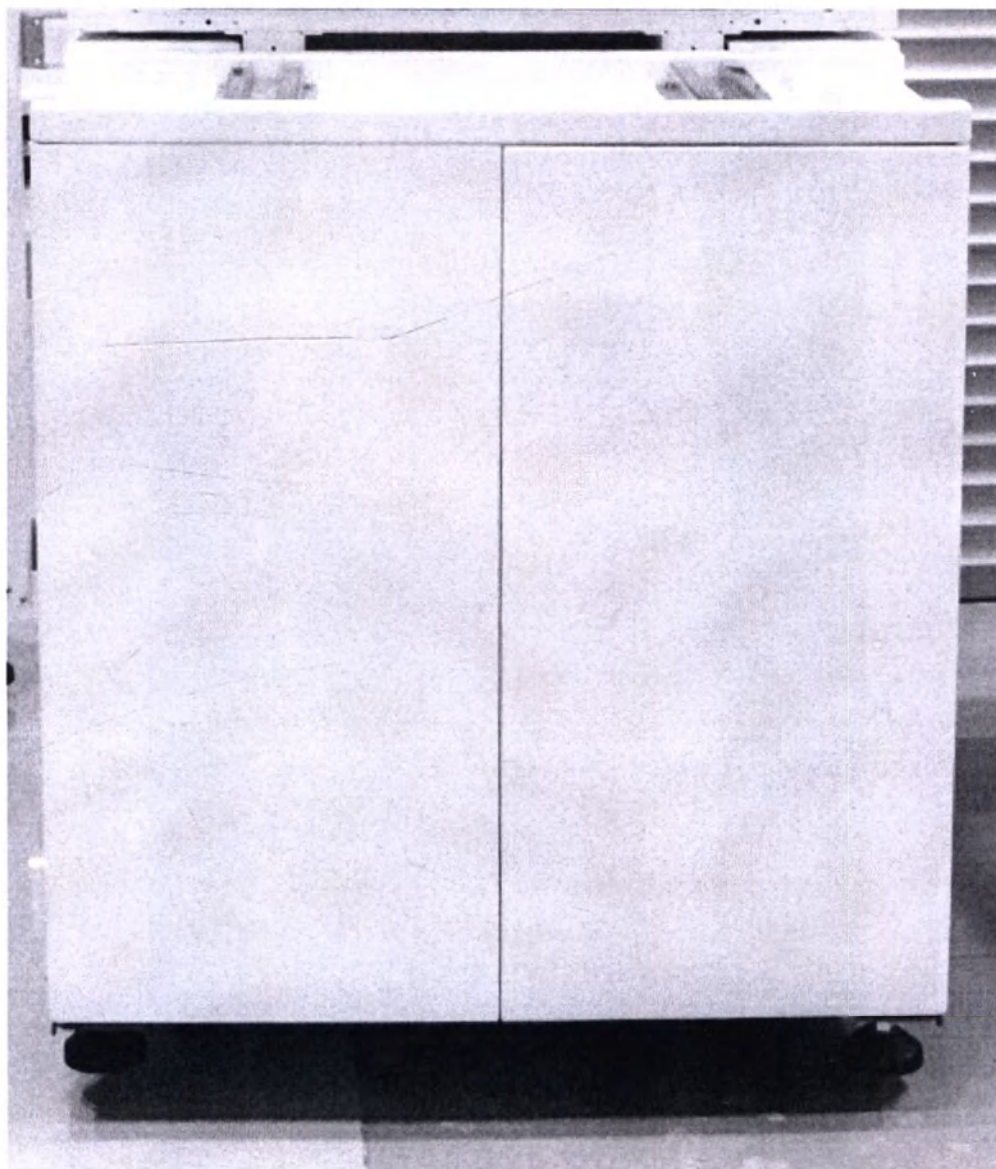

Тумба для моста



Раствор промывающий D21N (500 мл)




Раствор для обслуживания D22 (1 л)




Индикаторные полоски для анализа мочи URIT 11FA, 1 флакон/100 полосок




Индикаторные полоски для анализа мочи URIT 12FA, 1 флакон/100 полосок

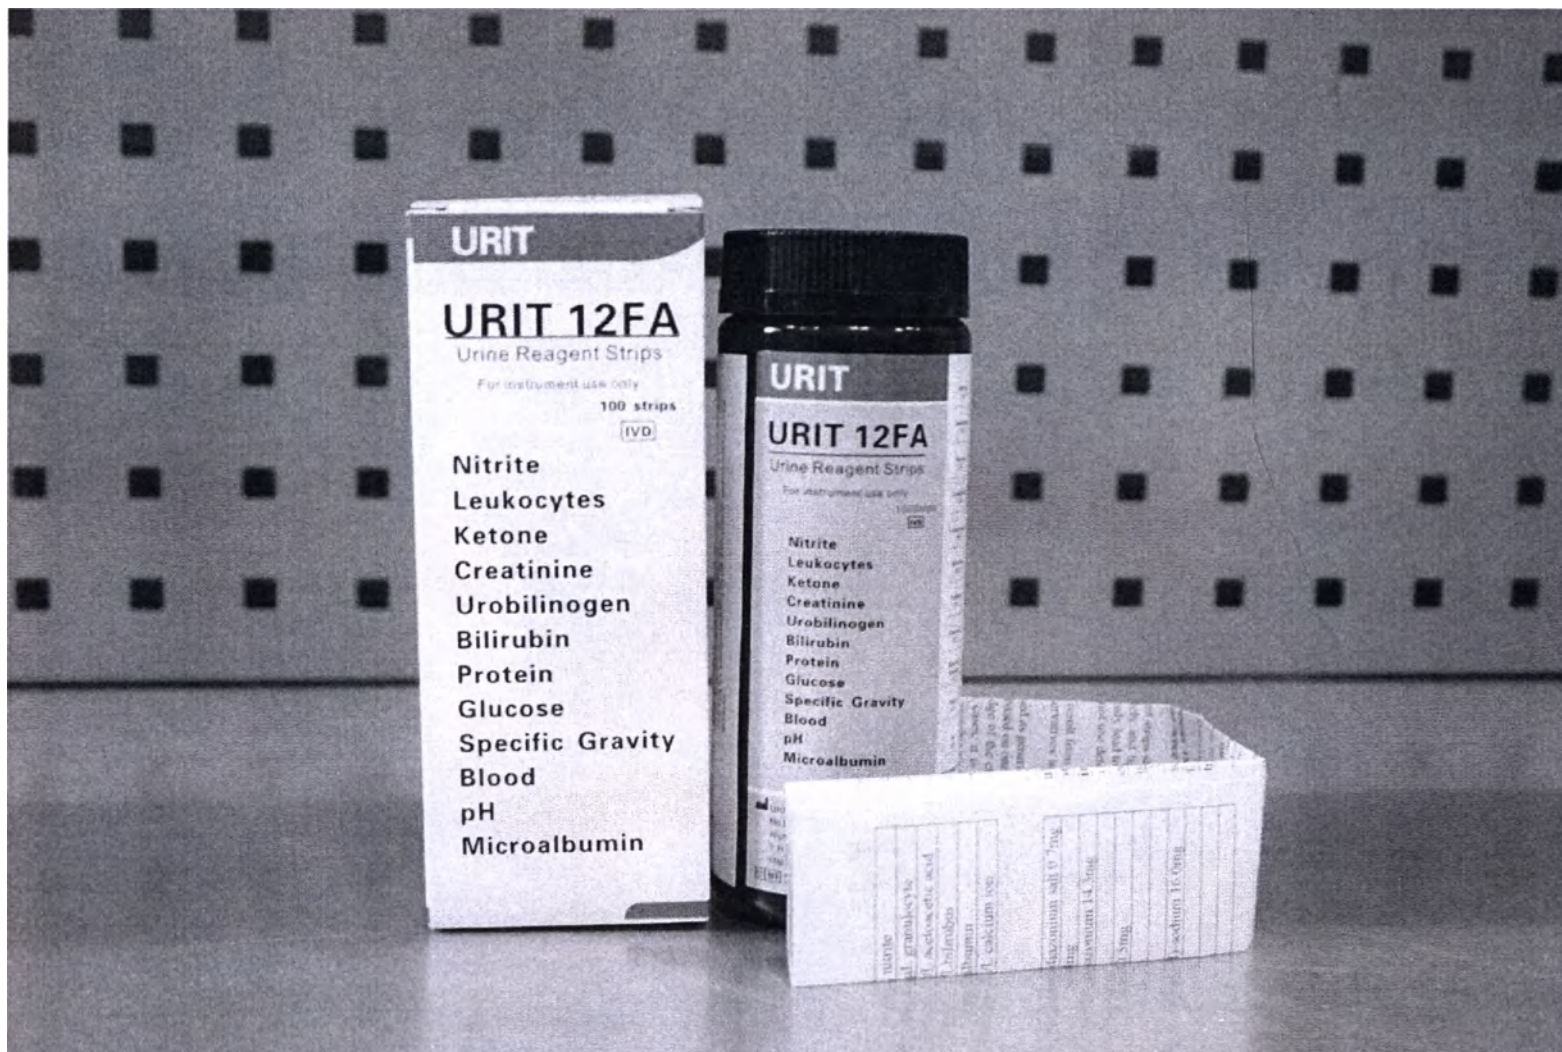

Индикаторные полоски для анализа мочи URIT 14FA, 1 флакон/100 полосок

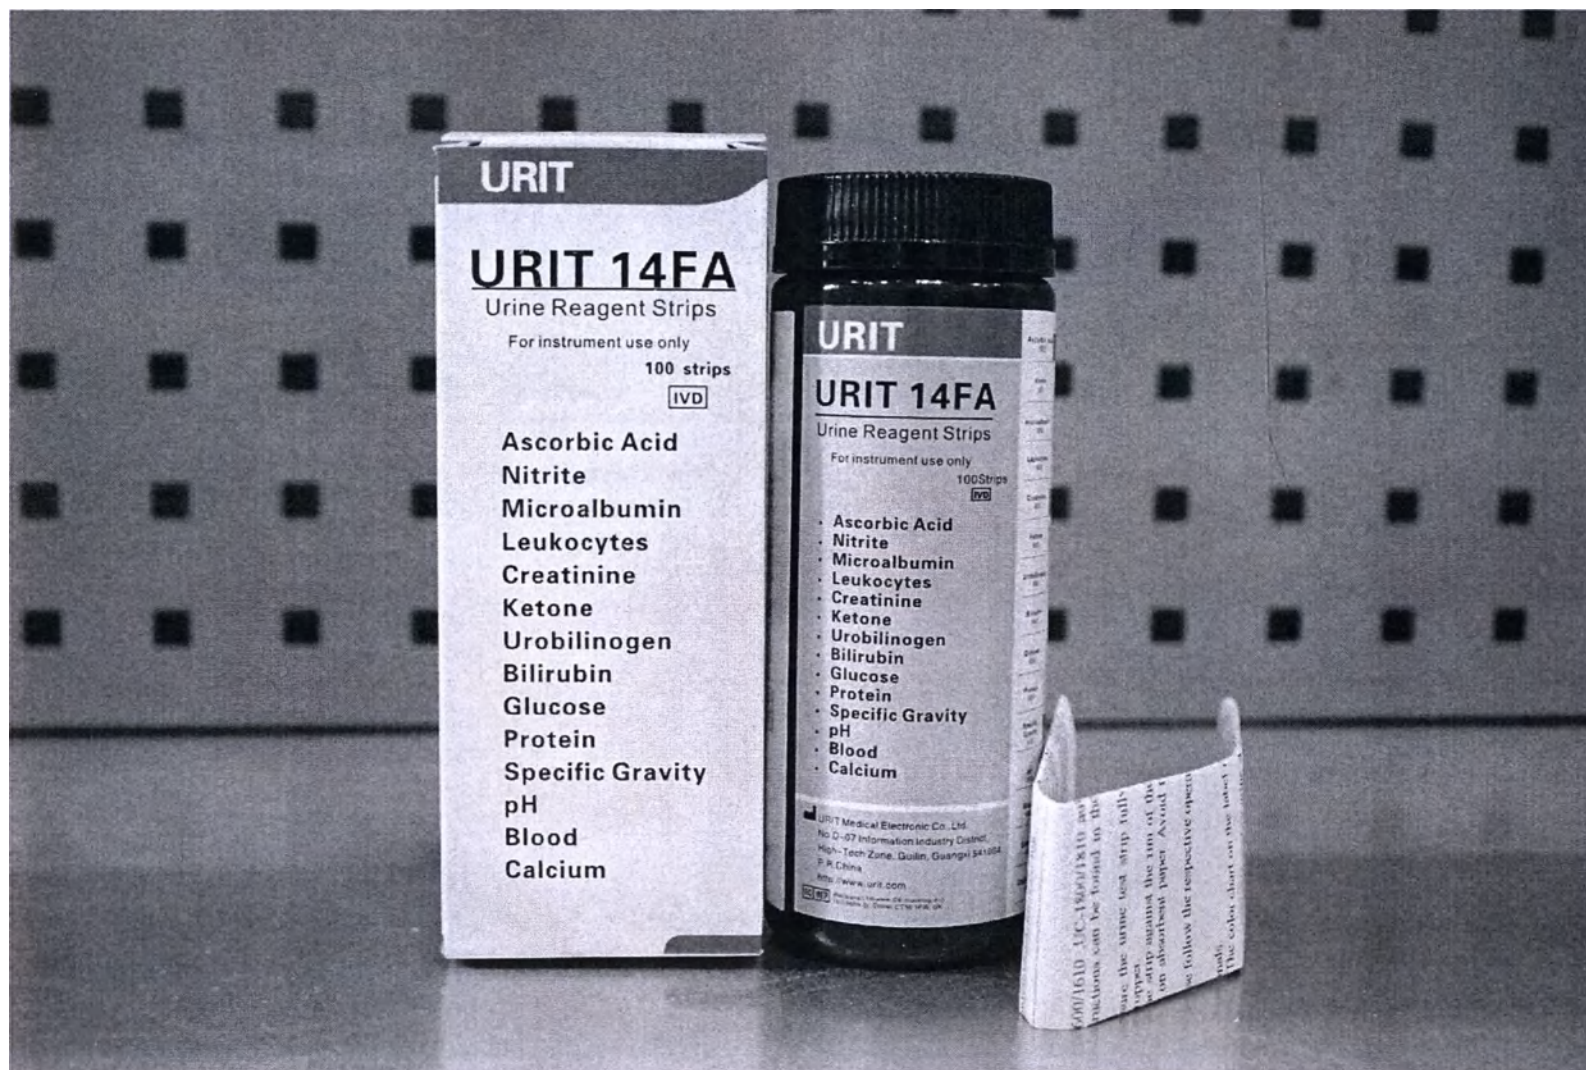


Контроль URIT UQ-14 (3 фл. по 8 мл)

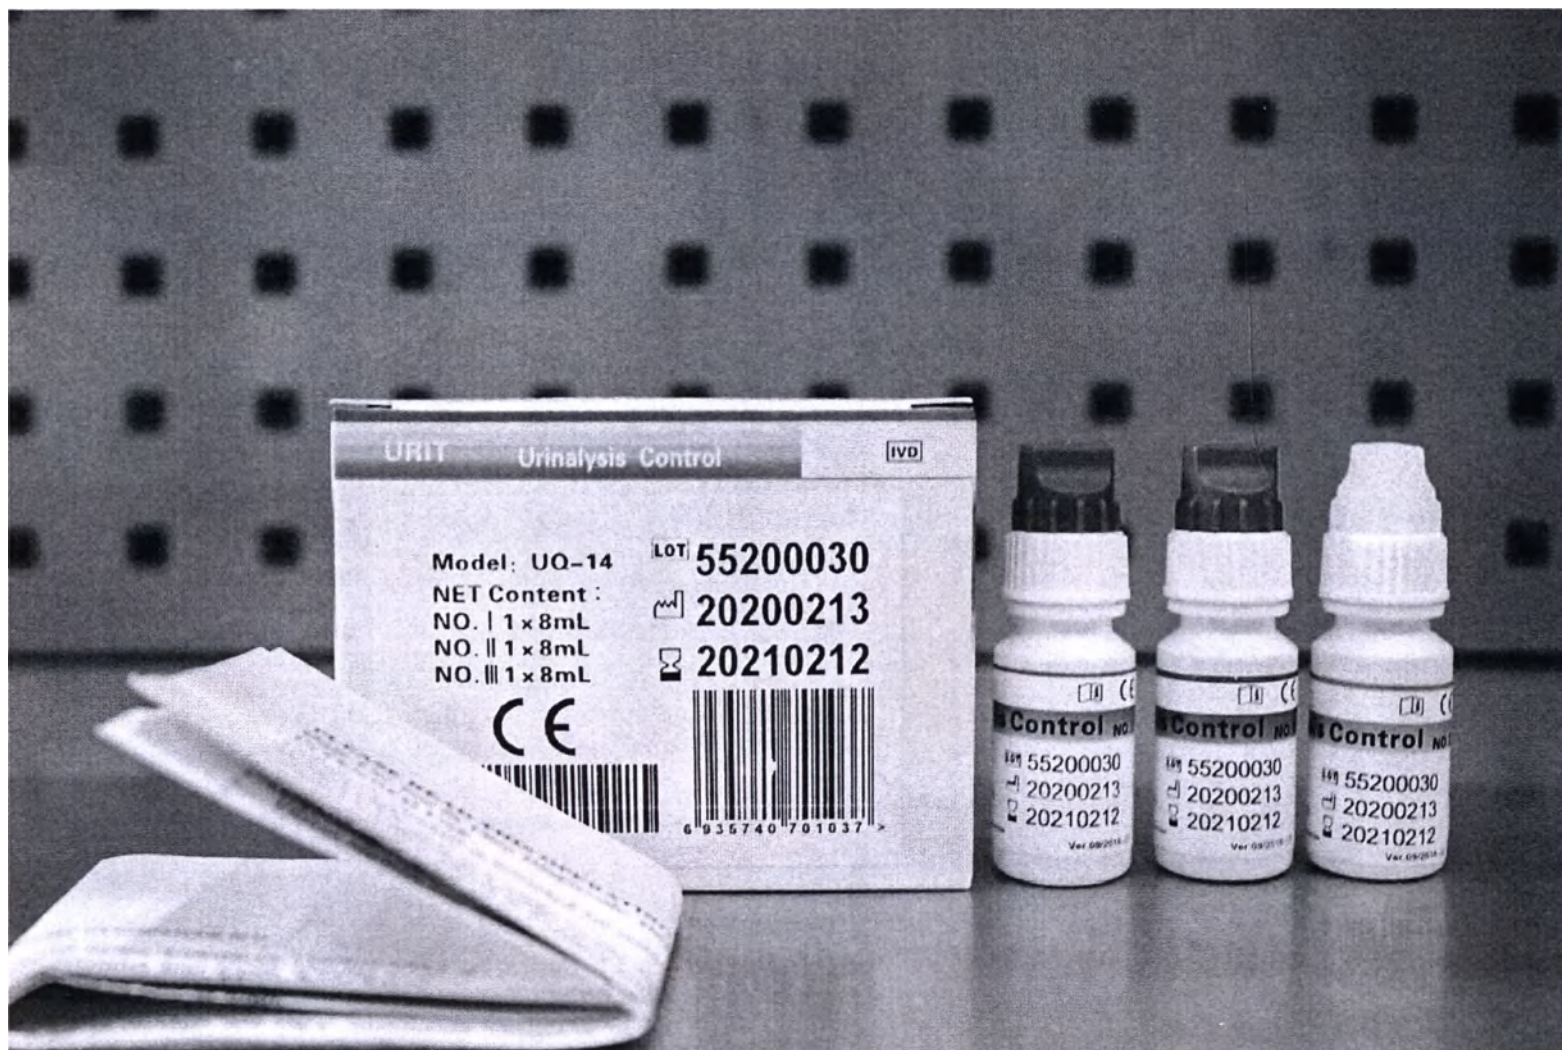

Контроль модуля SG Уровень 1,2,3, (3 фл. по 8 мл)




Калибратор модуля SG (1 фл. по 8 мл)

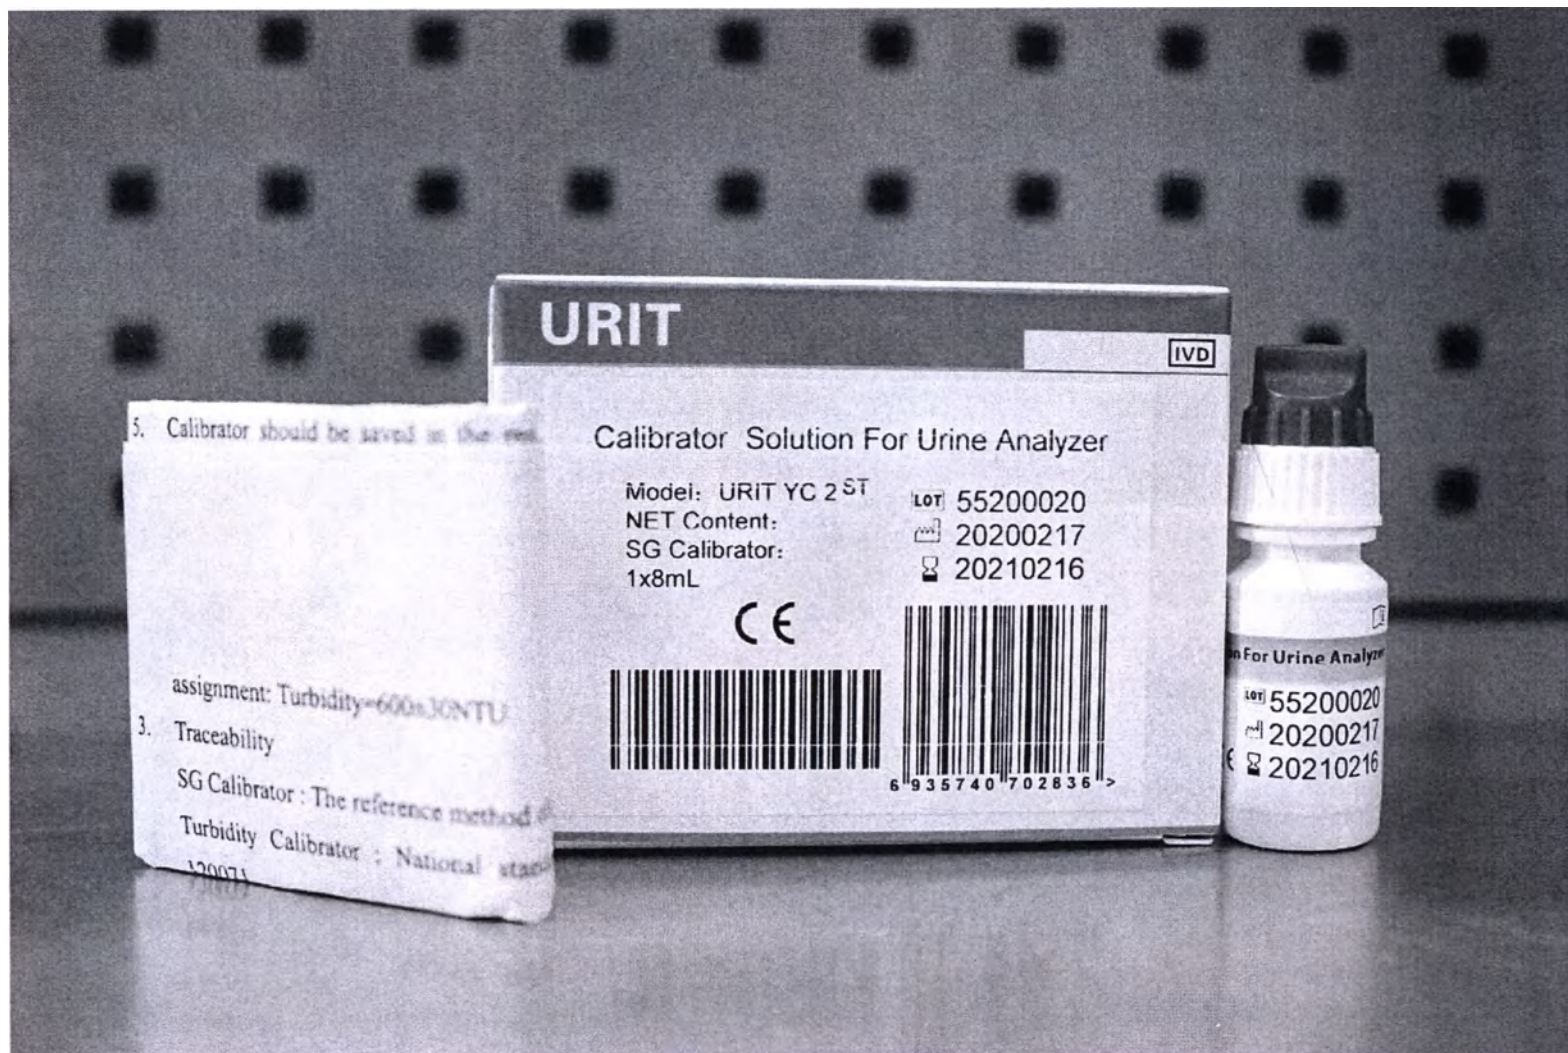


Контроль мутности Уровень 1, Уровень 2 (2 фл. по 8 мл)




Калибратор мутности (1 фл. по 8 мл)

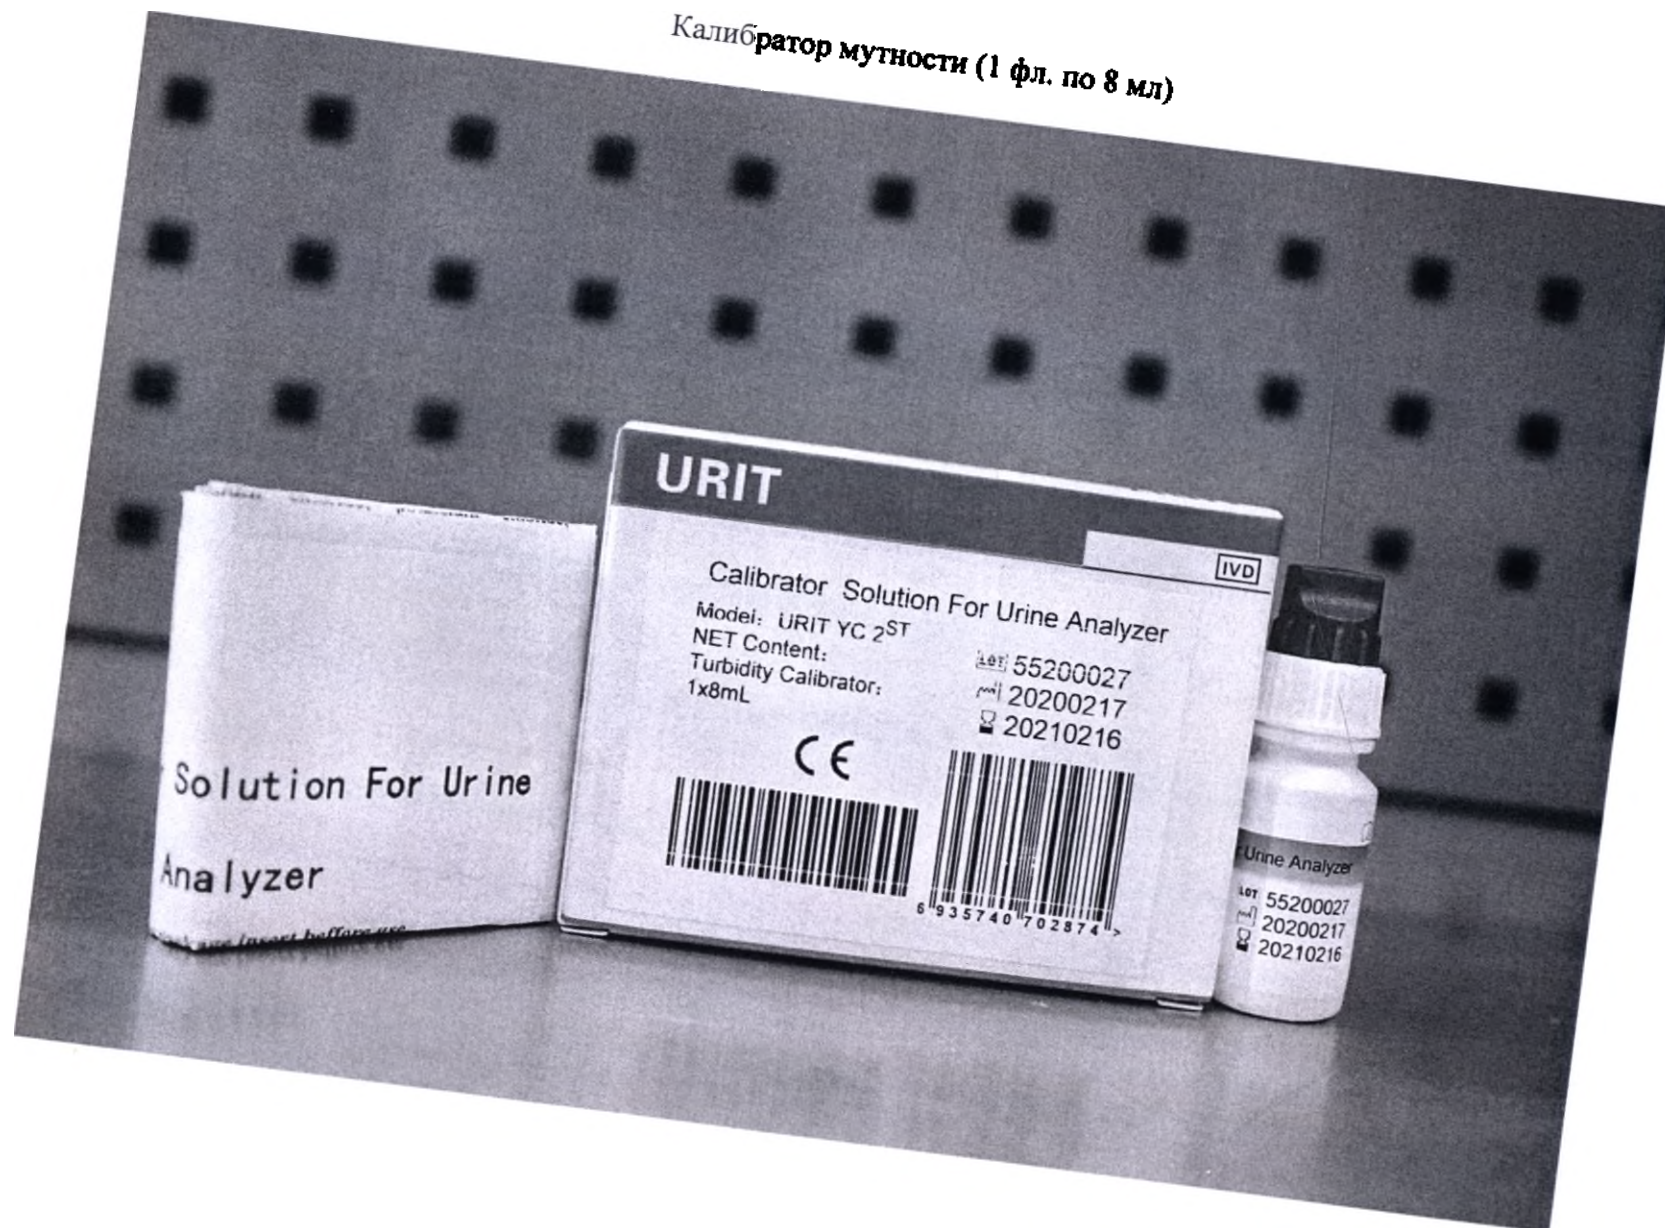

Контроль цвета (красный, желтый, зеленый) (3 фл. по 8 мл)

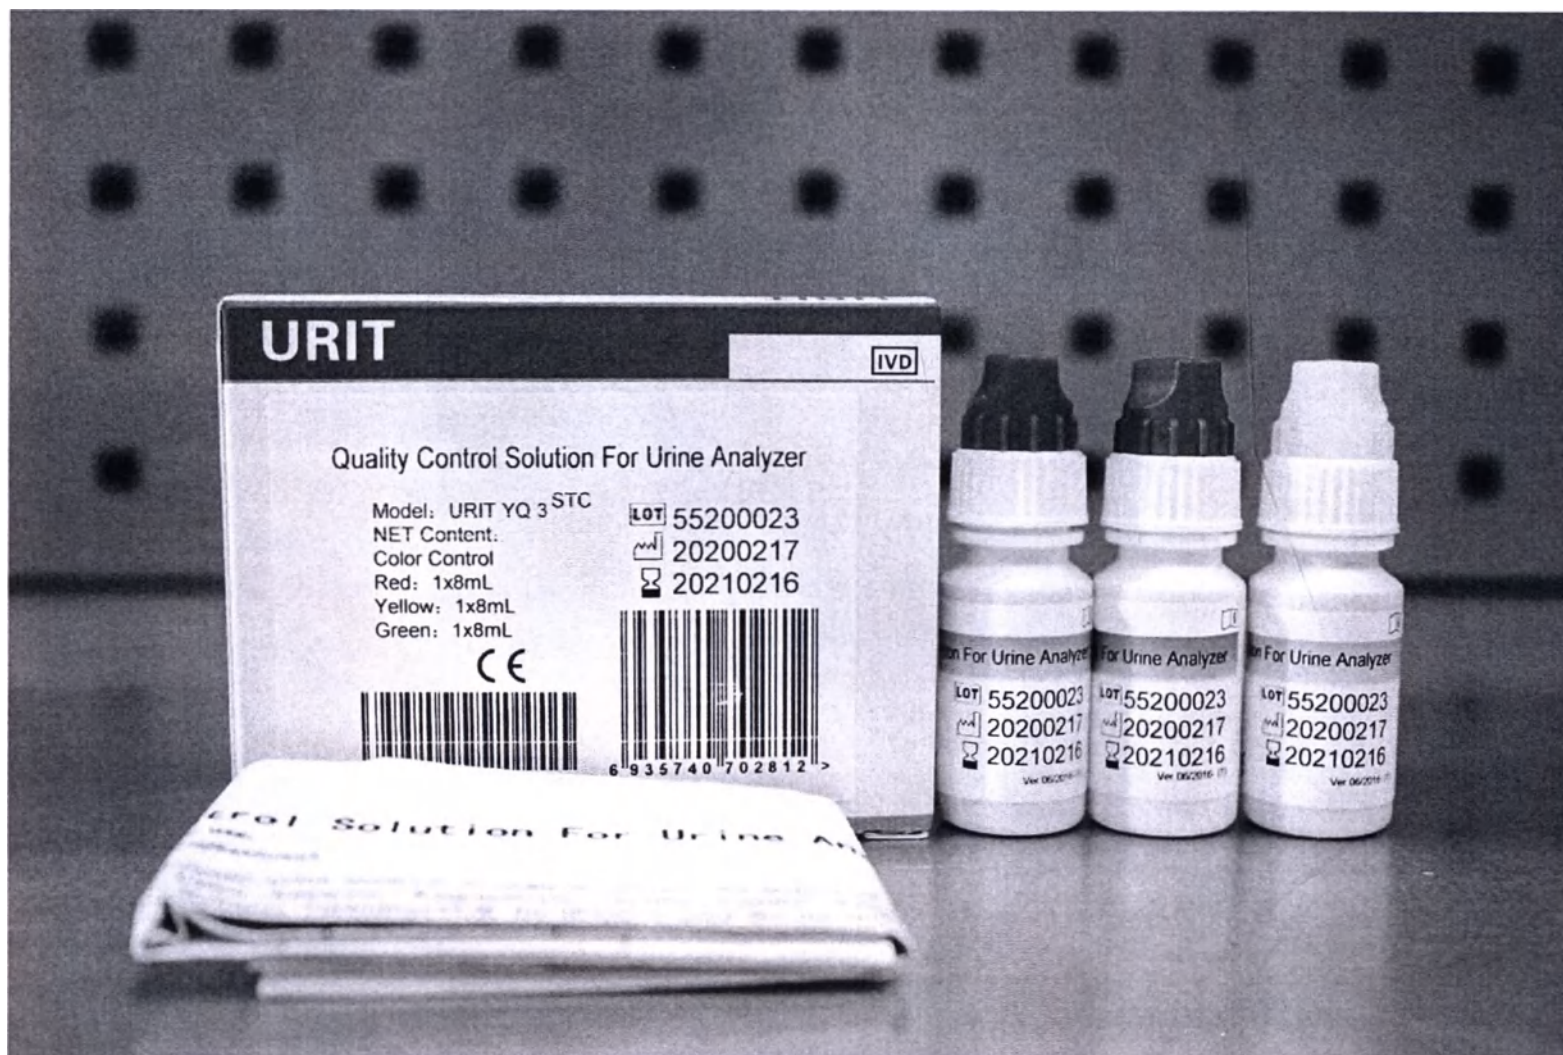


Принадлежности:
Кабель соединительный, 3 м

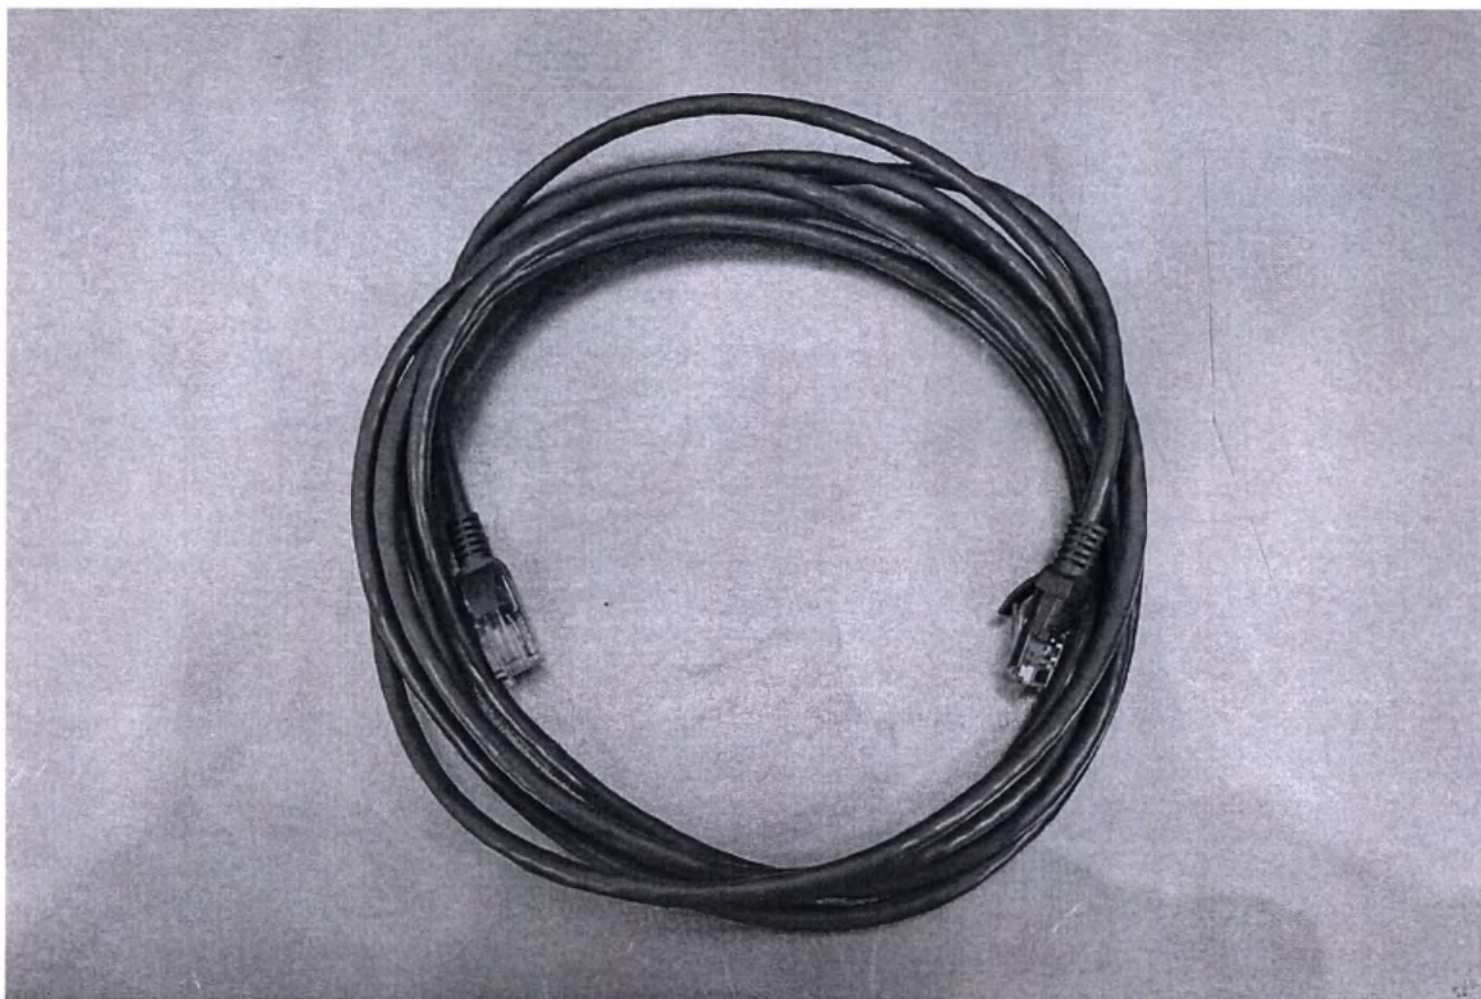


Принадлежность: Смазка для технического обслуживания




Принадлежность: Щетка для технического обслуживания

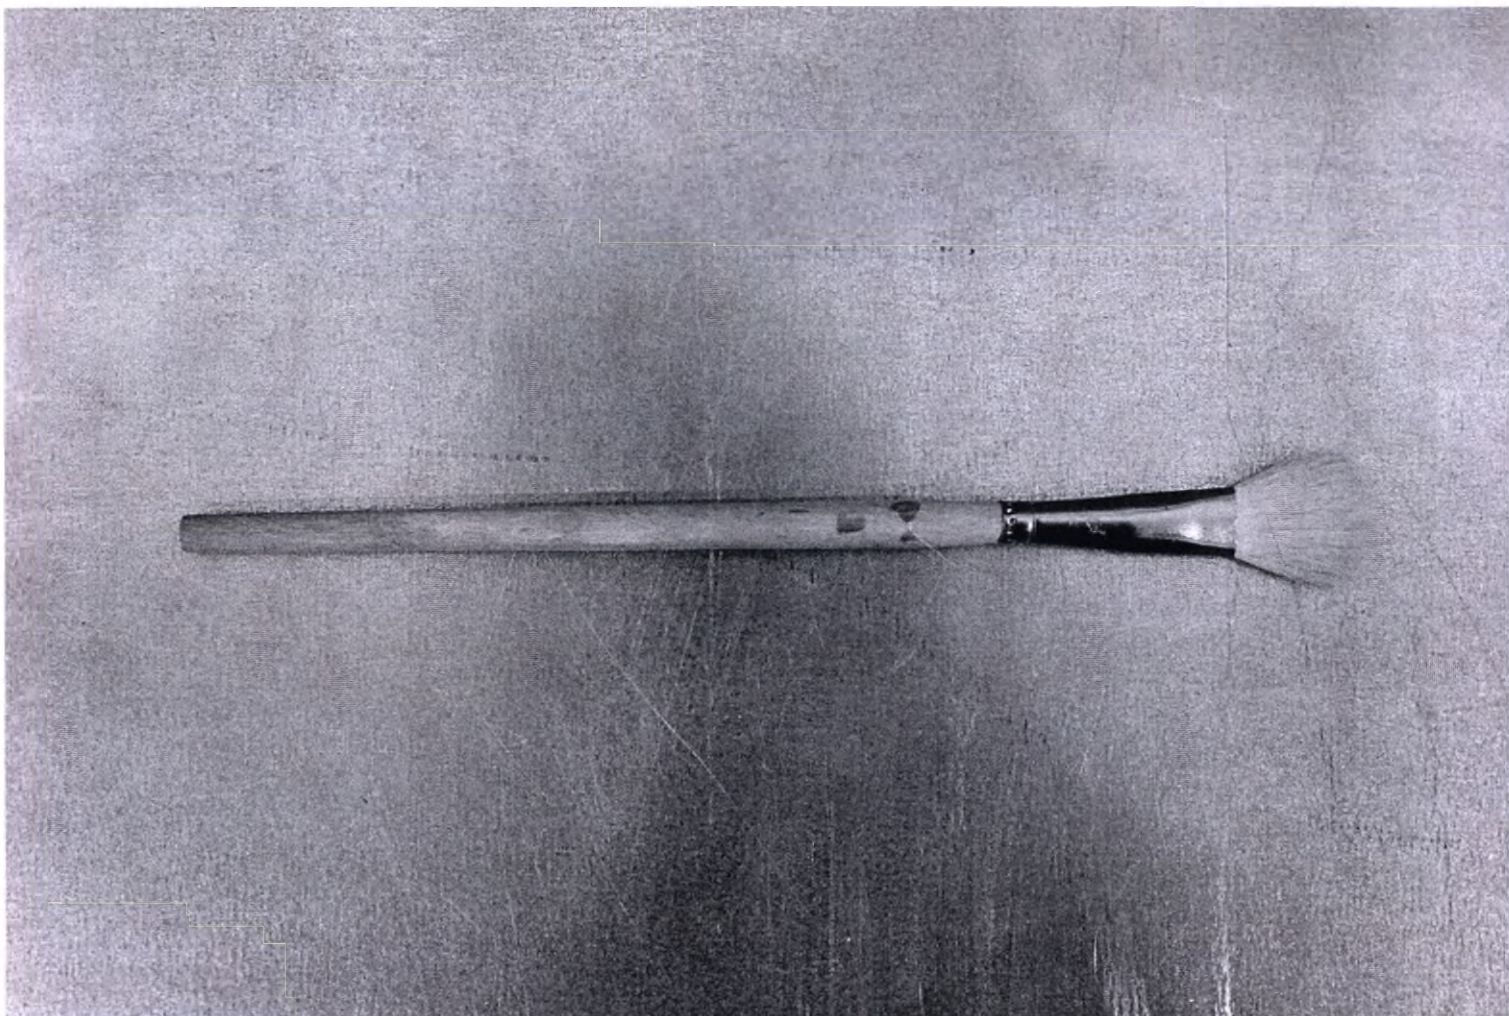


Принадлежность: Предохранитель T3.15AL250V

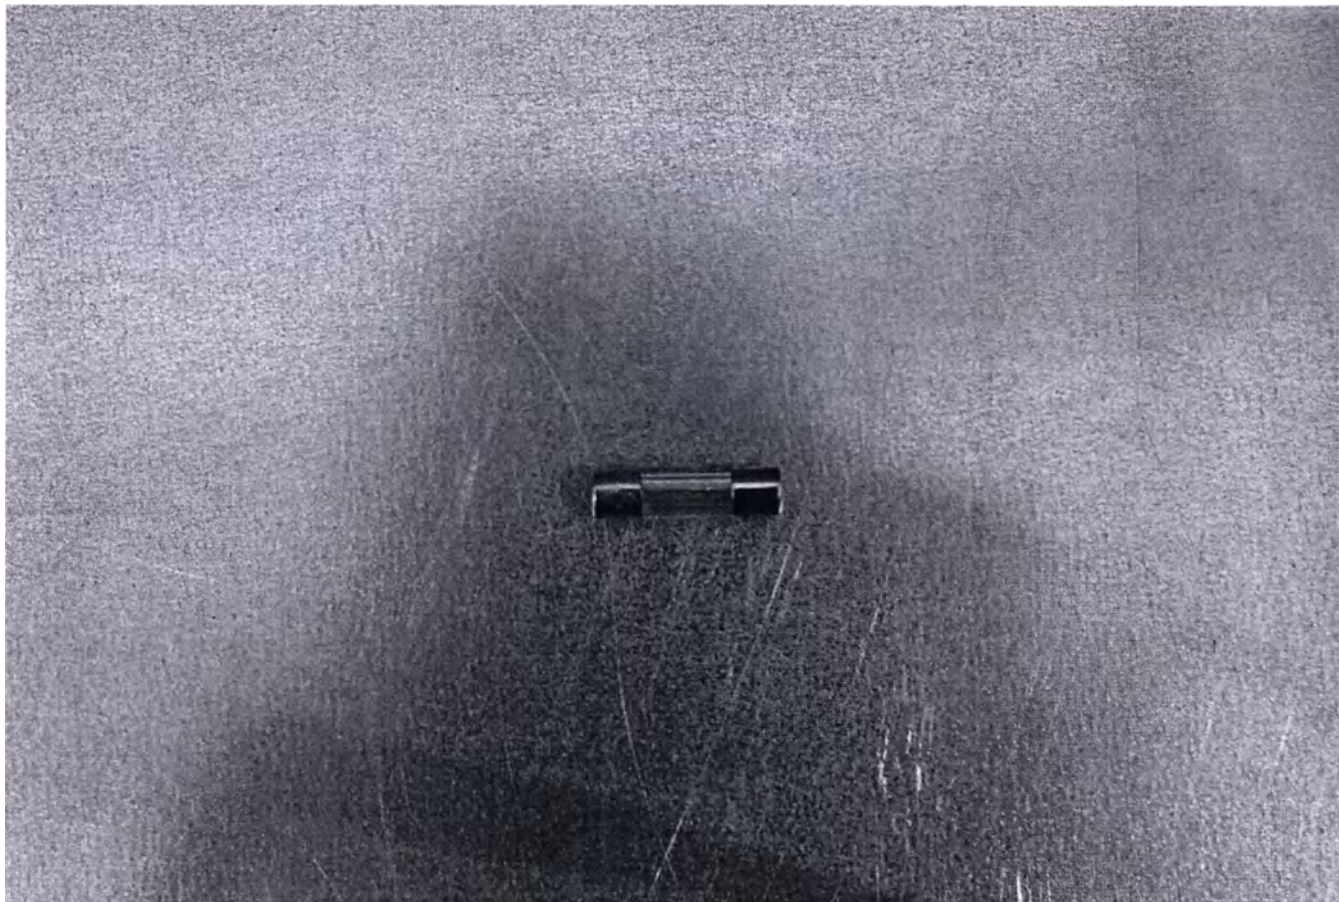

Принадлежность: Провод заземления 3-х метровый

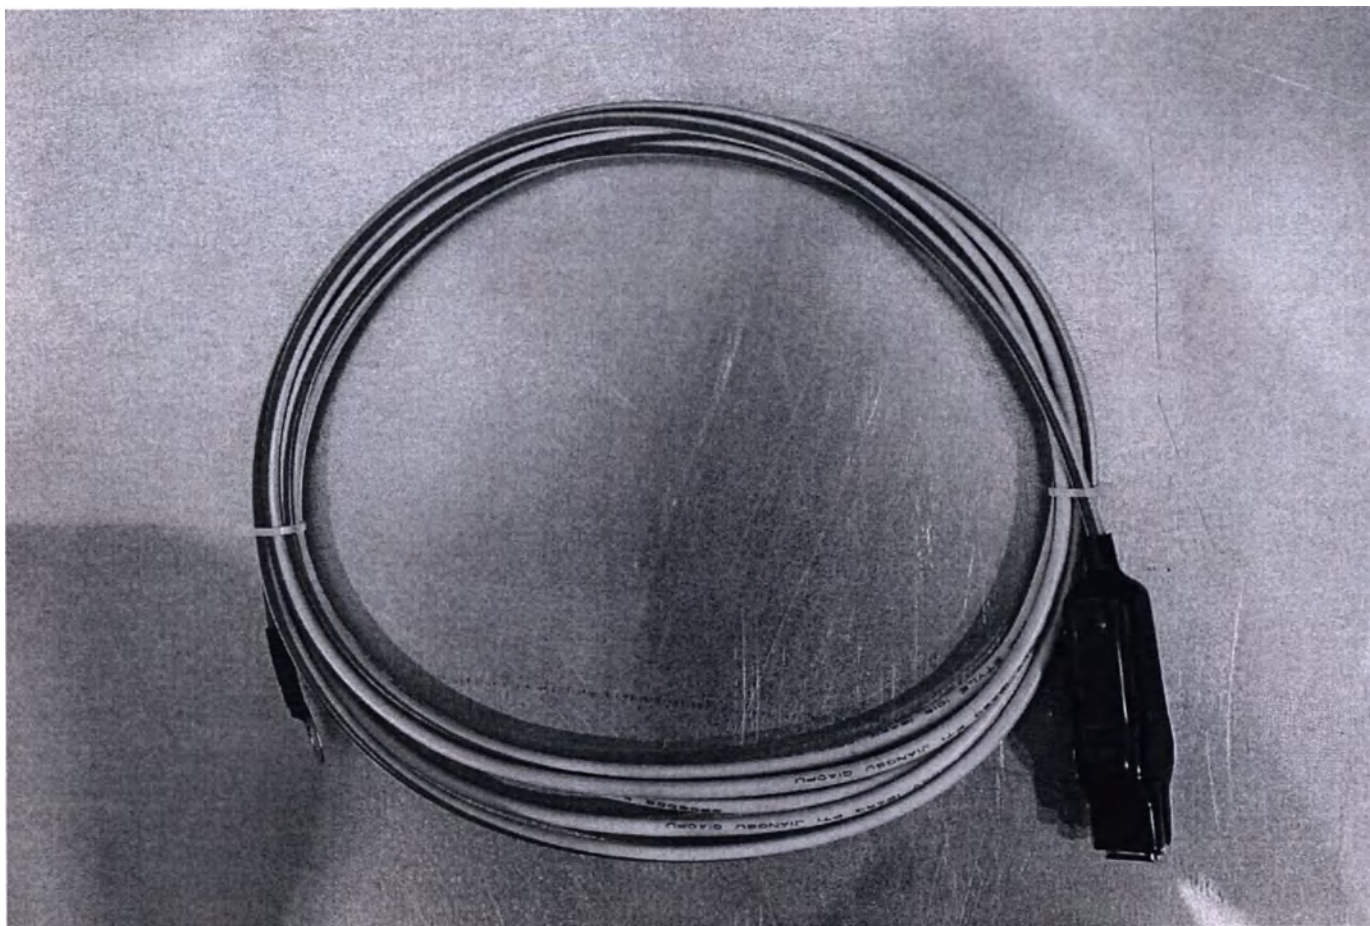

Принадлежность: Трубки для обслуживания, 1 наб х 3 шт

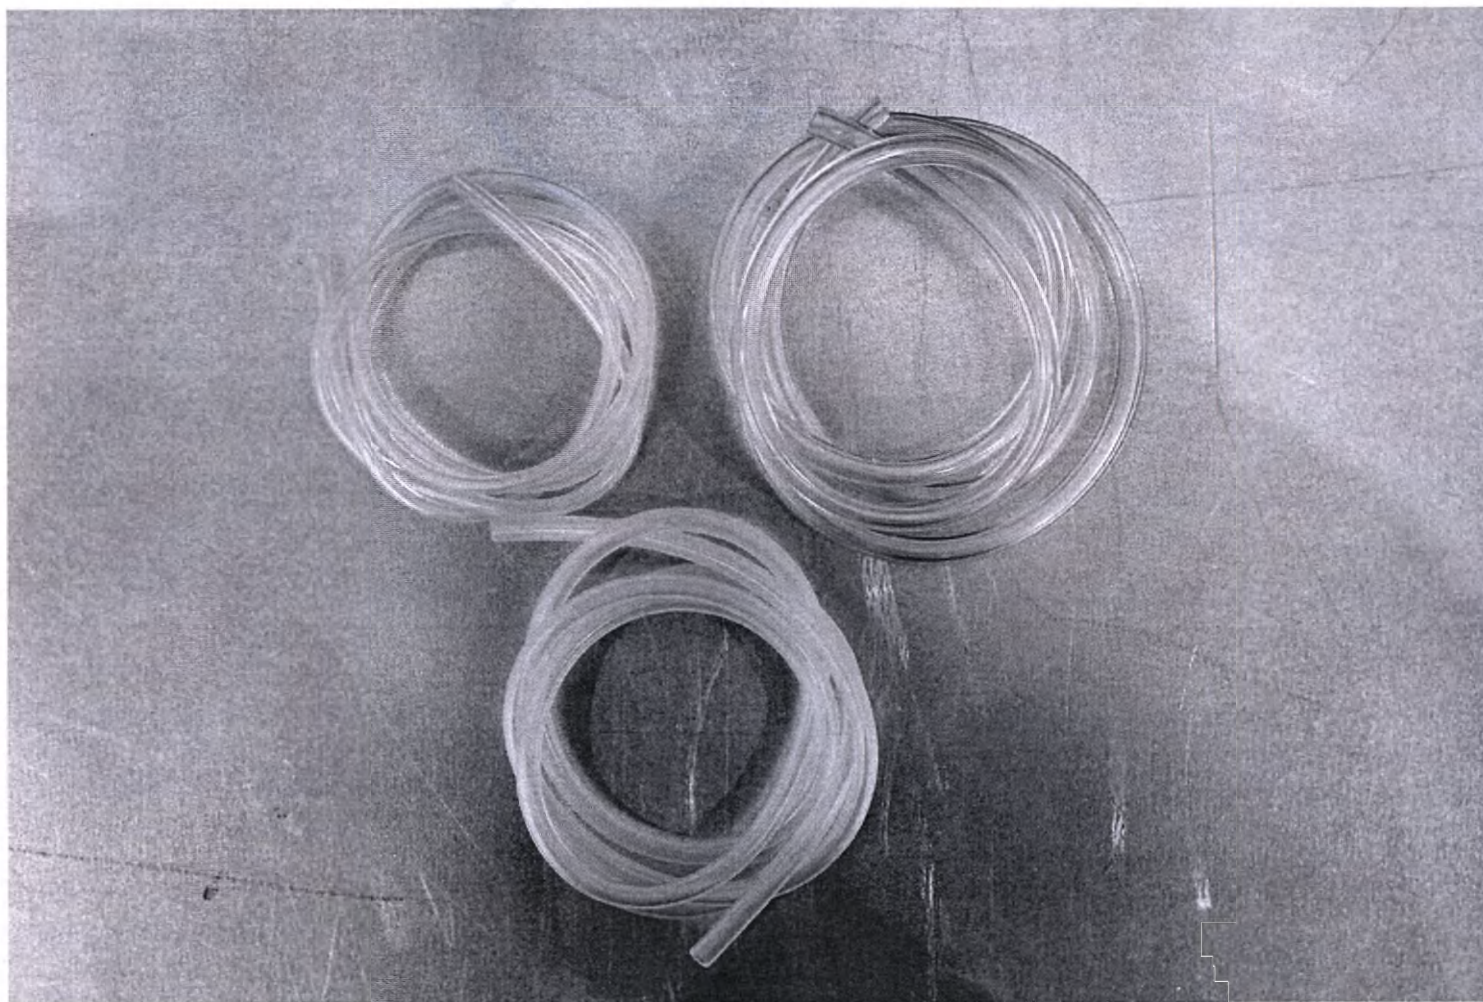

Прошито и скреплено печатью
на 47 листах

Генеральный директор
АО «СОЛТ»
Заяц В.В.

