



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 26 июля 2022 года № РЗН 2022/17843

На медицинское изделие

Анализатор автоматический мочевой сухой химии UC-1800, с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Акционерное общество "СОЛТ" (АО "СОЛТ"), Россия,
197046, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 3, литер Б, офис 308

Производитель

"УРИТ Медикал Электроник Ко., Лтд.", Китай,
URIT Medical Electronic Co., Ltd., No. D-07, Information Industry District,
High-Tech Zone, Guilin, Guangxi 541004, P.R. China

Место производства медицинского изделия

URIT Medical Electronic Co., Ltd., No. D-07 Information Industry District,
High-Tech Zone, Guilin, Guangxi 541004, P.R. China

Номер регистрационного досье № РД-48696/96001 от 24.03.2022


Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 26.60.12.119

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 26 июля 2022 года № 6836
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

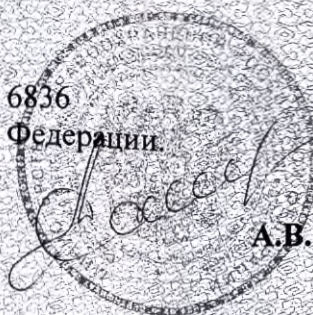

А.В. Самойлова

0064309

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2022 года

№ РЗН 2022/17843

Лист 1

На медицинское изделие

Анализатор автоматический мочевой сухой химии UC-1800 с принадлежностями, в составе:

I. Анализатор автоматический мочевой сухой химии UC-1800 в составе:

1. Анализатор автоматический мочевой сухой химии UC-1800 - 1 шт.;

- основной блок анализатора - 1 шт.;

- руководство пользователя - 1 шт.;

- бутыль для промывающего раствора, 5 л - 1 шт.;

- бак сливной, 5 л - 1 шт.;

- кабель сетевой, 3 м - 1 шт.;

- штатив для образцов (№ 1-10) - 10 шт.;

- пробирка центрифужная с завинчивающейся крышкой объемом 10 мл - 1 уп. по 100 шт.;

- адаптер для пробирок диаметром 13 мм и высотой 100 мм - 100 шт.;

- клапан обратный - 1 шт.;

- фильтр воздушный - 1 шт.;

- шнур питания, 1,5 м - 1 шт.;

- термобумага для печати - 2 шт.;

- спринцовка для промывки - 1 шт.;

- тест-полоски проверочные - 2 шт.;

- мандрен стальной для разблокировки - 1 шт.;

- мандрен мягкий для разблокировки - 1 шт.;

- ключ для замка боковой дверцы - 2 шт.;

- мост соединительный для пробоподатчика - 1 шт.;

- загрузчик образцов (SS модуль) - 1 шт.;

- пластина соединительная нижняя - 1 шт.;

- пластина соединительная верхняя - 1 шт.;

- трубка для промывающего раствора D 21N - 1 шт.;

- трубка для раствора D 22 для обслуживания - 1 шт.;

- трубка сливная - 1 шт.;

- сертификат качества - 1 шт.;

- пластина крепежная - 6 шт.


2. Тумба с креплением для автоматического мочевого анализатора сухой химии UC-1800 - не более 2 шт.

3. Тумба для моста - не более 2 шт.

4. Раствор промывающий D21N (500 мл) - не более 5 шт.

5. Раствор для обслуживания D22 (1 л) - не более 5 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

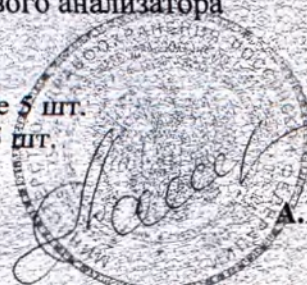

А.В. Самойлова

0105731

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2022 года

№ РЗН 2022/17843

Лист 2

6. Индикаторные полоски для анализа мочи URIT 11FA,
1 флакон/100 полосок - не более 10 уп. (при необходимости).
7. Индикаторные полоски для анализа мочи URIT 12FA,
1 флакон/100 полосок - не более 10 уп. (при необходимости).
8. Индикаторные полоски для анализа мочи URIT 14FA,
1 флакон/100 полосок - не более 10 уп.
9. Контроль URIT UQ-14 (3 фл. по 8 мл) - не более 2 шт.
10. Контроль модуля SG Уровень 1,2,3, (3 фл. по 8 мл) - не более 2 шт.
11. Калибратор модуля SG (1 фл. по 8 мл) - не более 2 шт.
12. Контроль мутности Уровень 1, Уровень 2 (2 фл. по 8 мл) - не более 2 шт.
13. Калибратор мутности (1 фл. по 8 мл) - не более 2 шт.
14. Контроль цвета (красный, желтый, зеленый) (3 фл. по 8 мл) - не более 2 шт.

II. Принадлежности:

- кабель соединительный, 3 м - 1 шт.;
- смазка для технического обслуживания - 1 шт.;
- щетка для технического обслуживания - 1 шт.;
- предохранитель T3.15AL250V - 2 шт.;
- провод заземления 3-х метровый - 1 шт.;
- трубки для обслуживания, 1 наб. - 3 шт.

2

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0105732