

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Компания «БиВи»

Т.А. Носова

«10» июля 2022 г.




ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 5987789
КУСАЙЛО Р.В.

Фотографические изображения изделия:


**Набор реагентов для количественного определения
фолликулостимулирующего гормона электрохемилюминесцентным методом
на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Follicle-stimulating Hormone
(Electrochemiluminescence Immunoassay) / FSH)**

«Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.»
(«Шэньчжэнь Лайфотроник Технолоджи Ко., Лтд.»), Китай




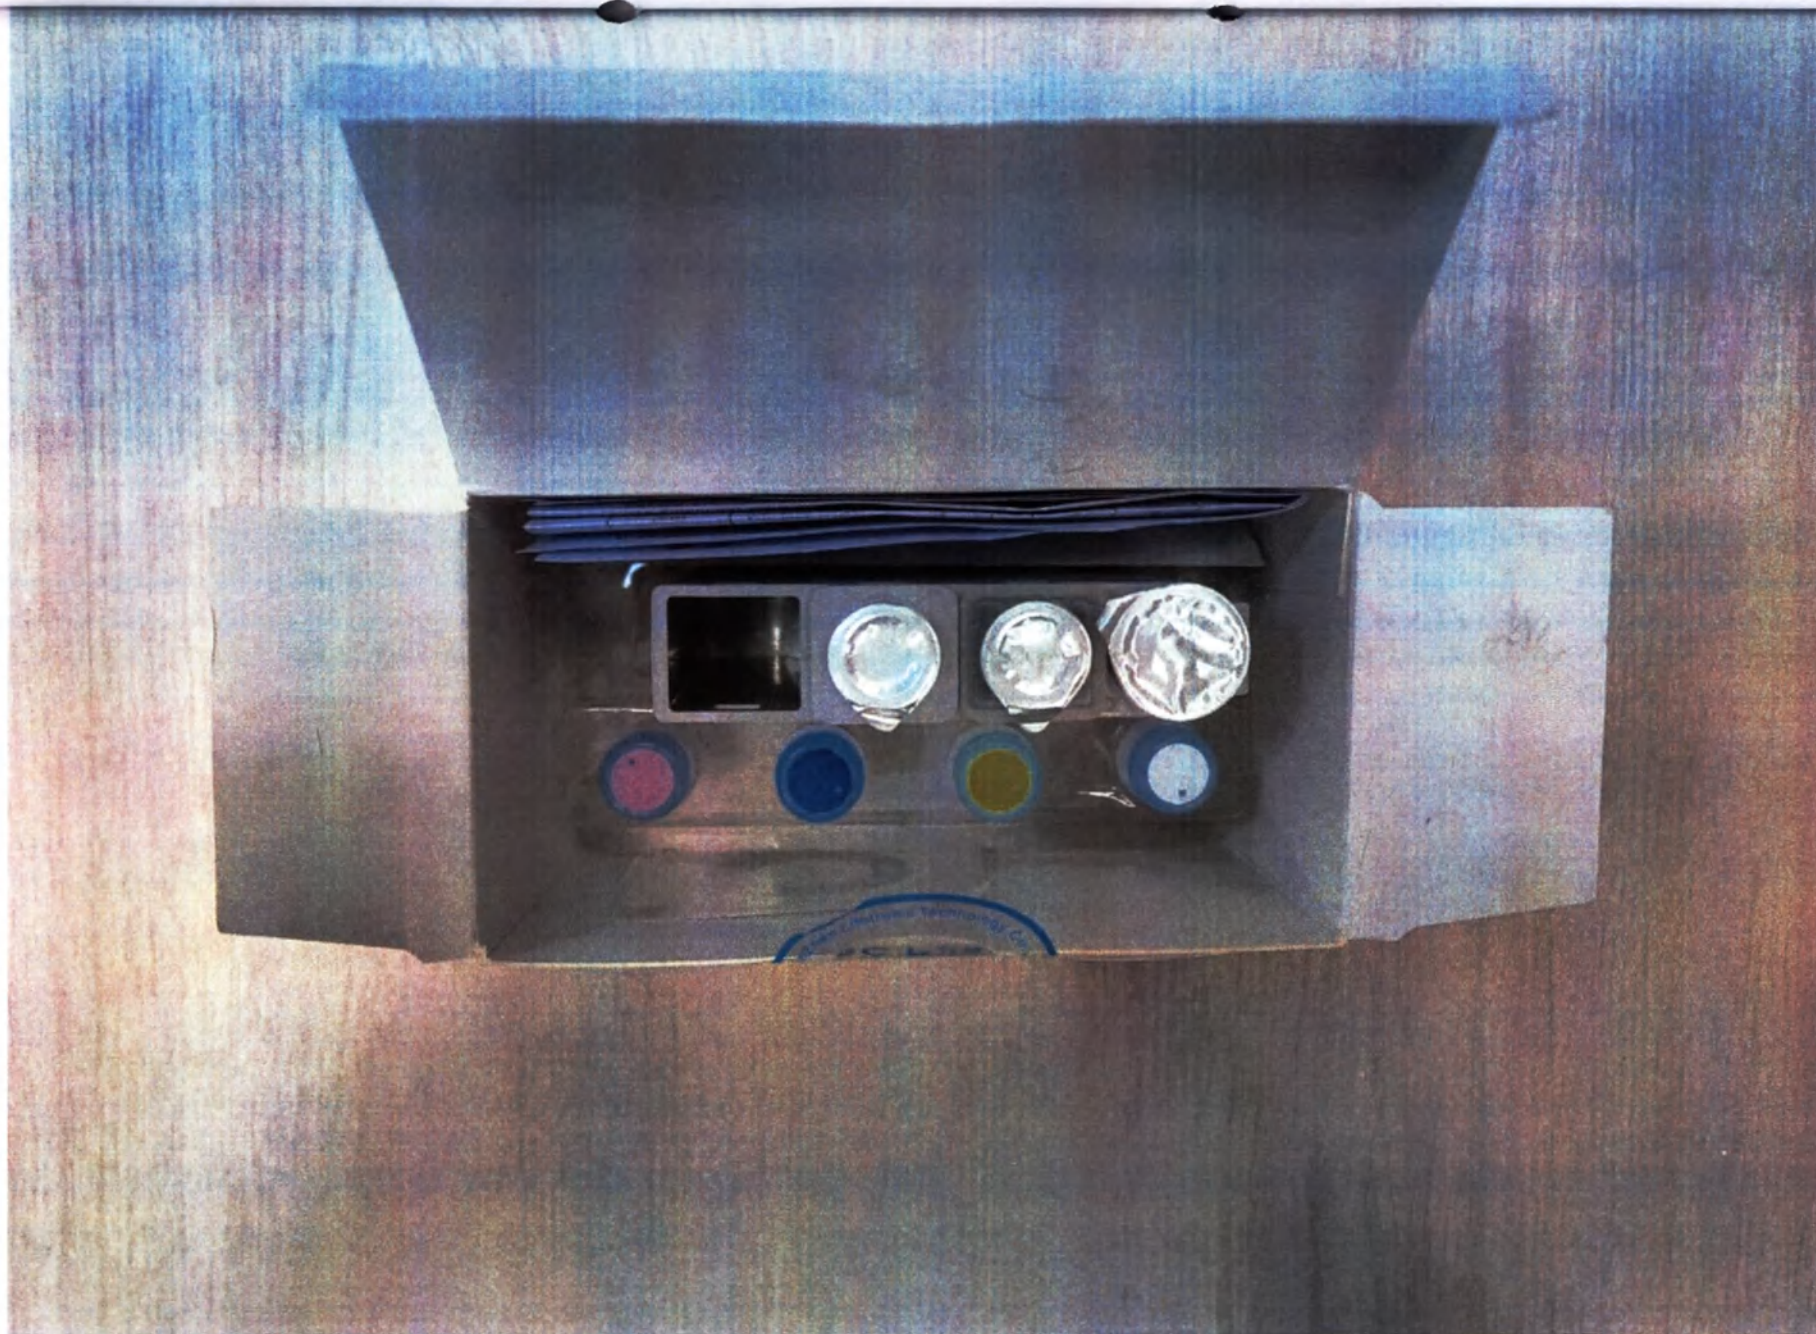


Общий вид медицинского изделия (Набор реагентов для количественного определения фолликулостимулирующего гормона электрохемилюминесцентным методом на титры in vitro (Follicle-stimulating Hormone (Electrochemiluminescence Immunoassay) / FSH), в варианте исполнения 100 тестов)

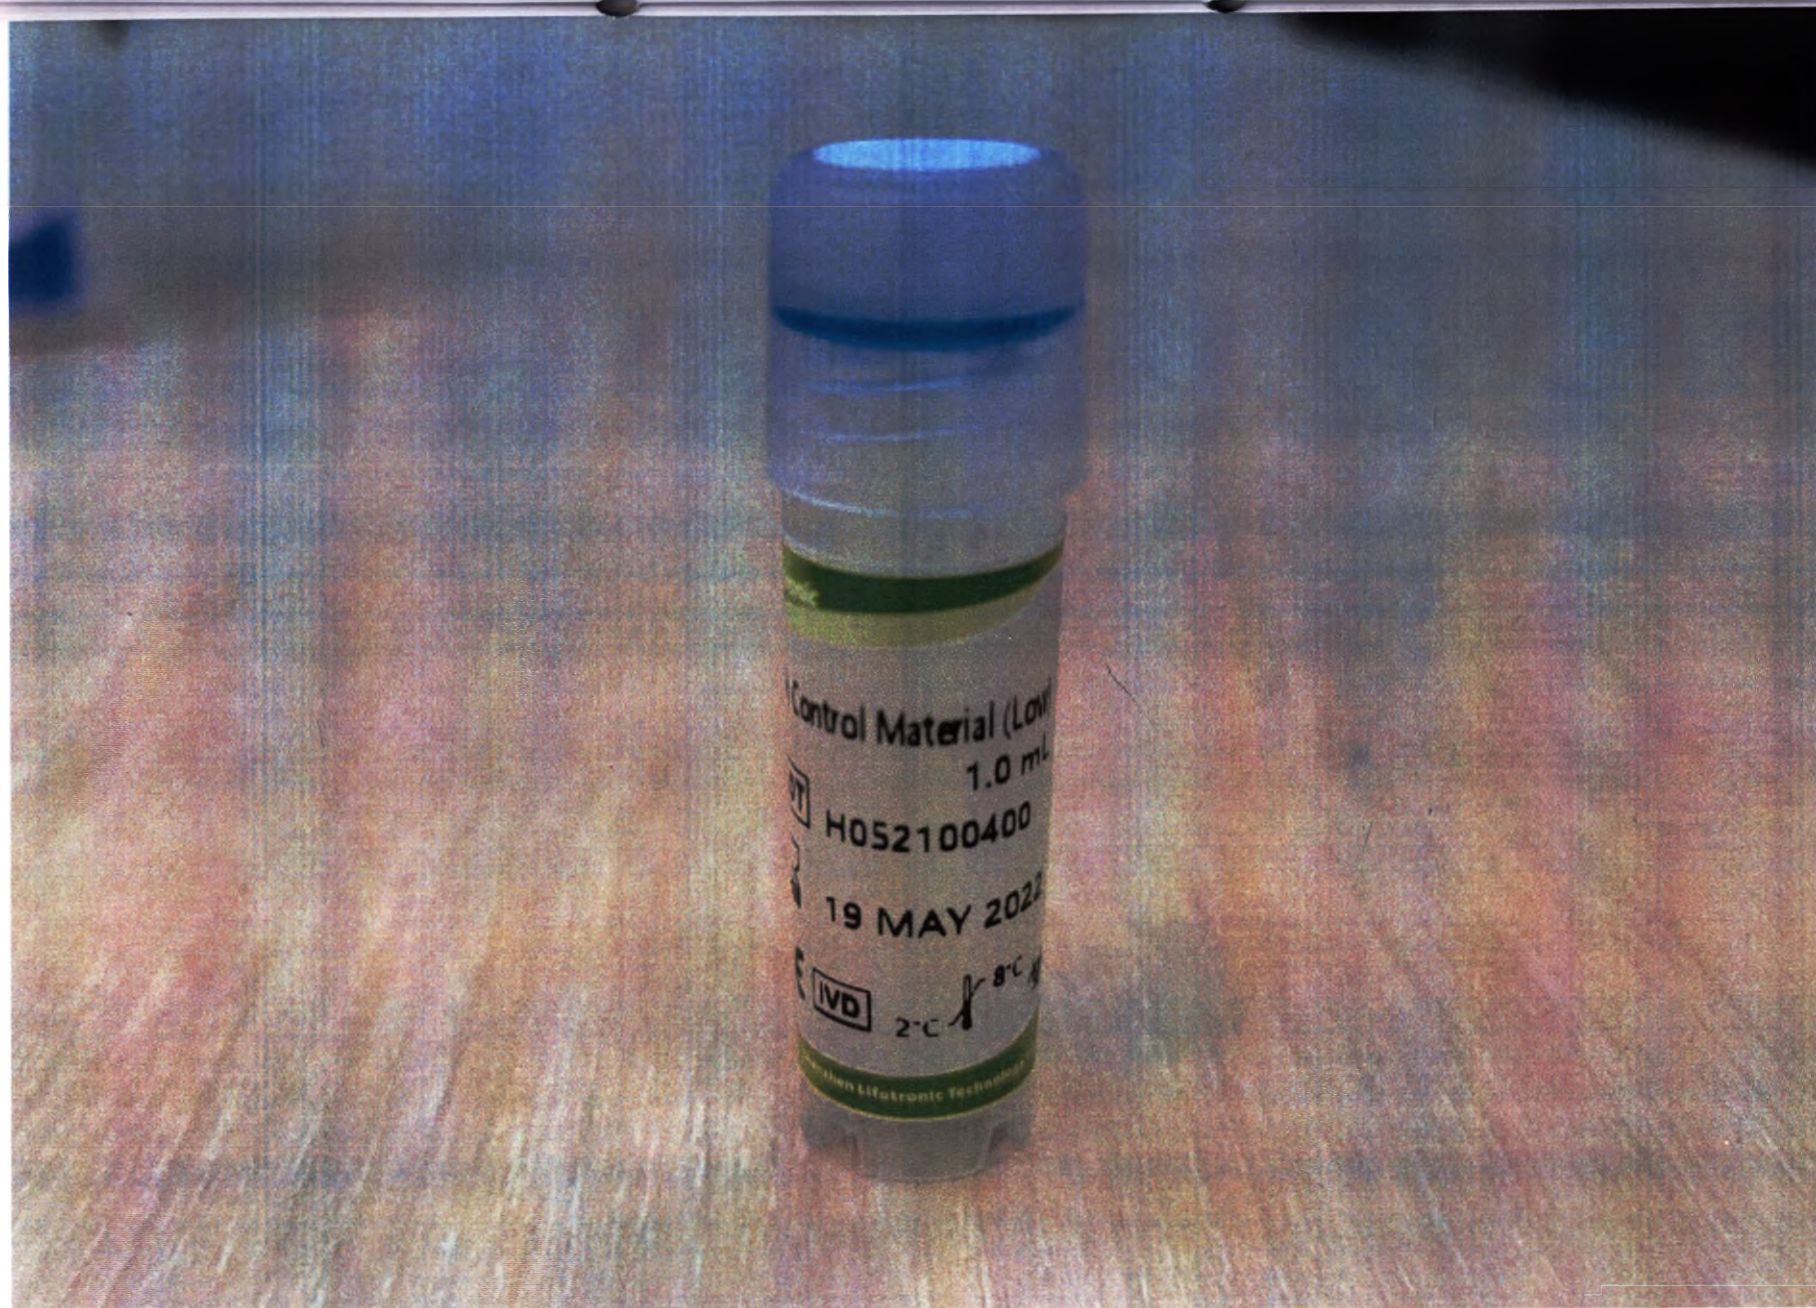





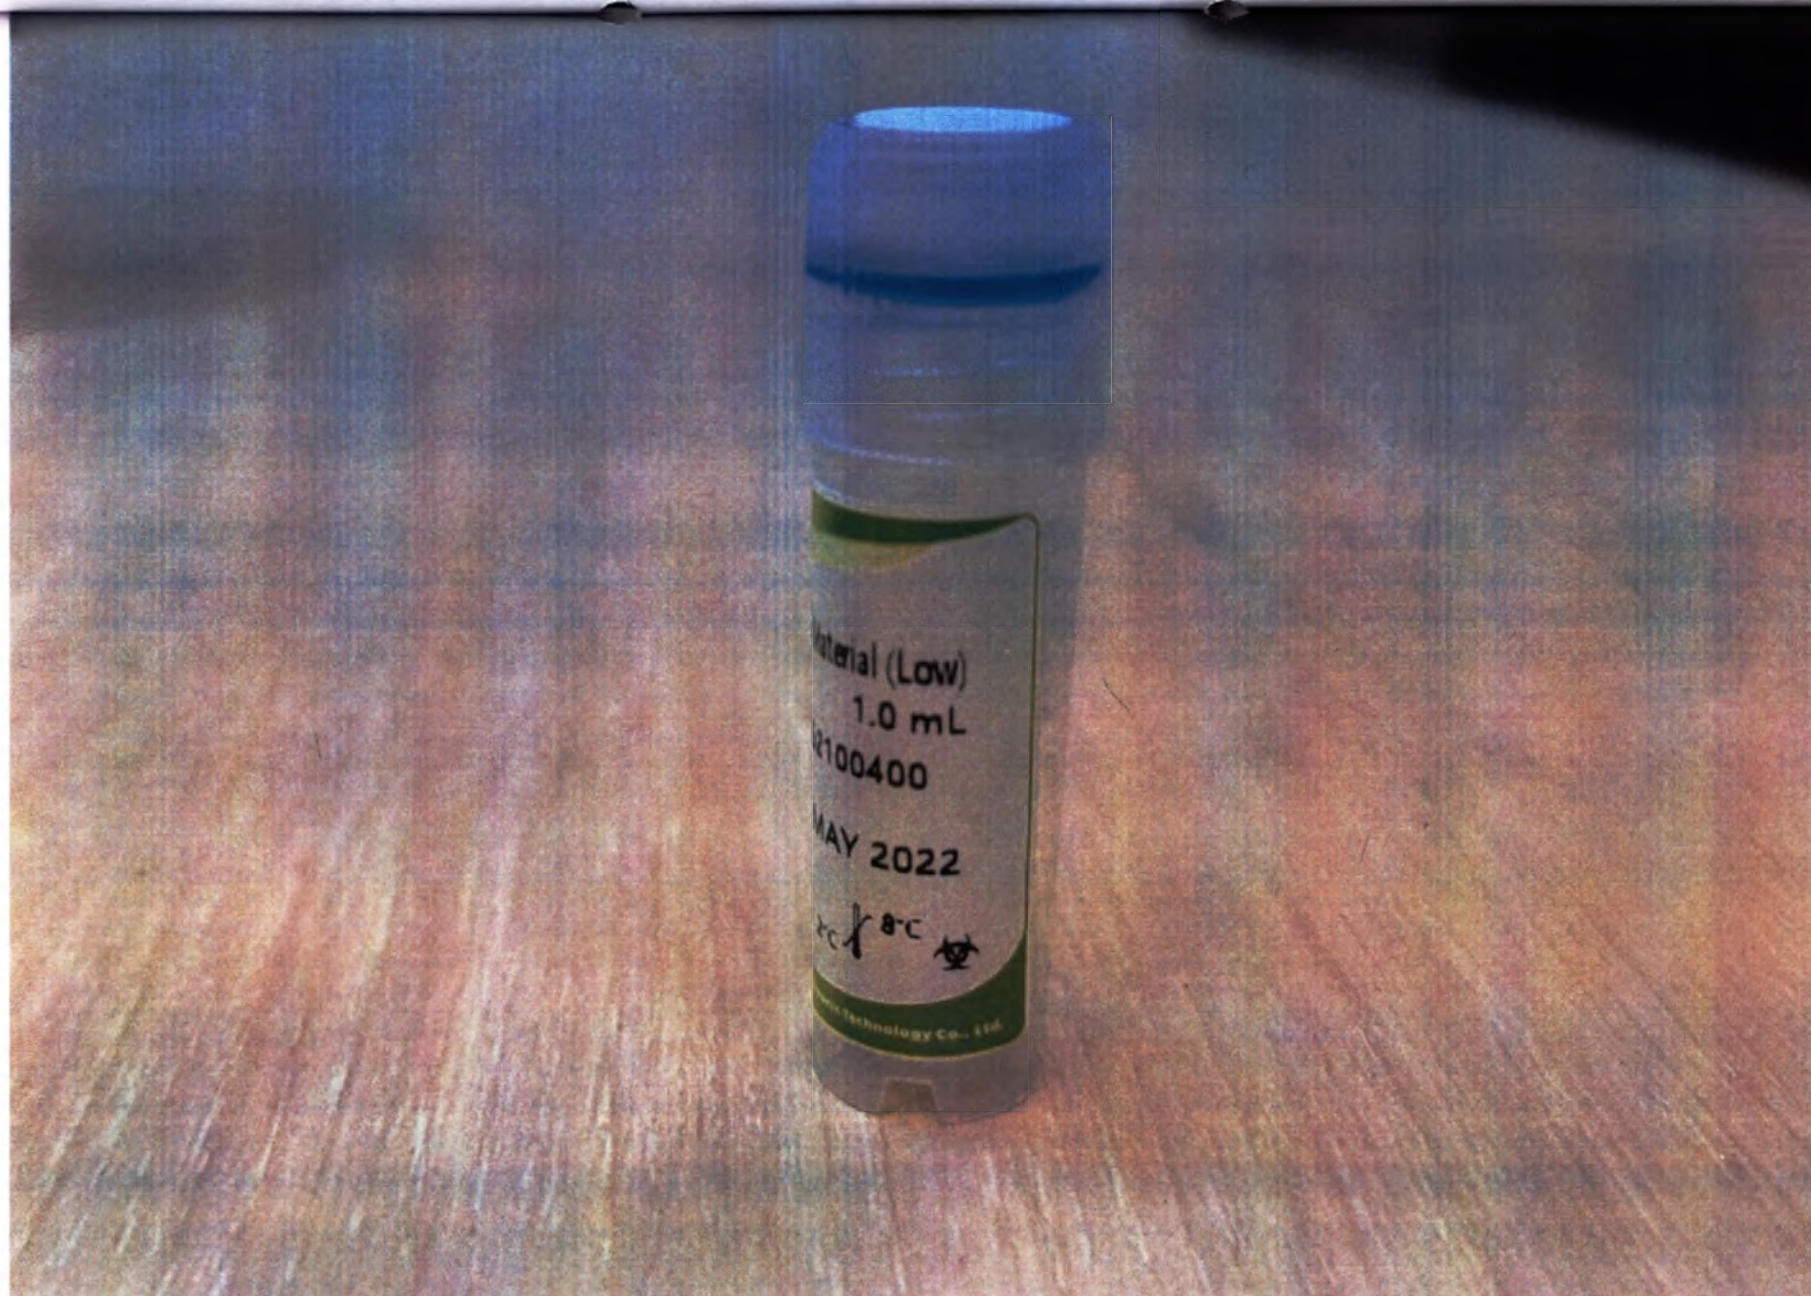


Материал контрольный (низкий уровень) (Набор реагентов для количественного определения фолликулостимулирующего гормона электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Follicle-stimulating Hormone (Electrochemiluminescence Immunoassay) / FSH), в варианте исполнения 100 тестов)

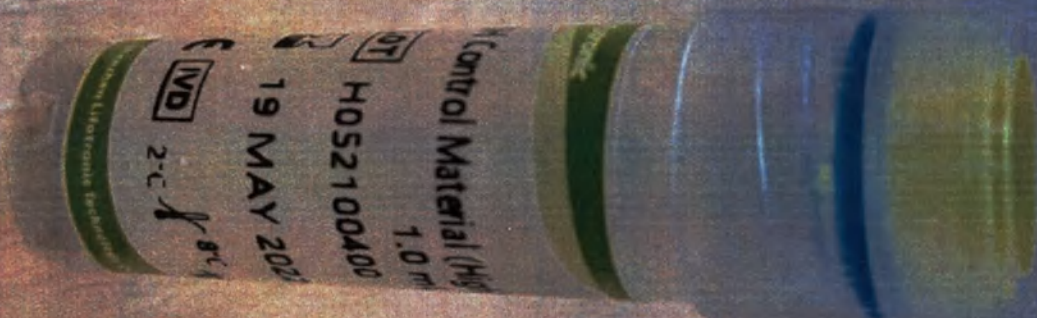


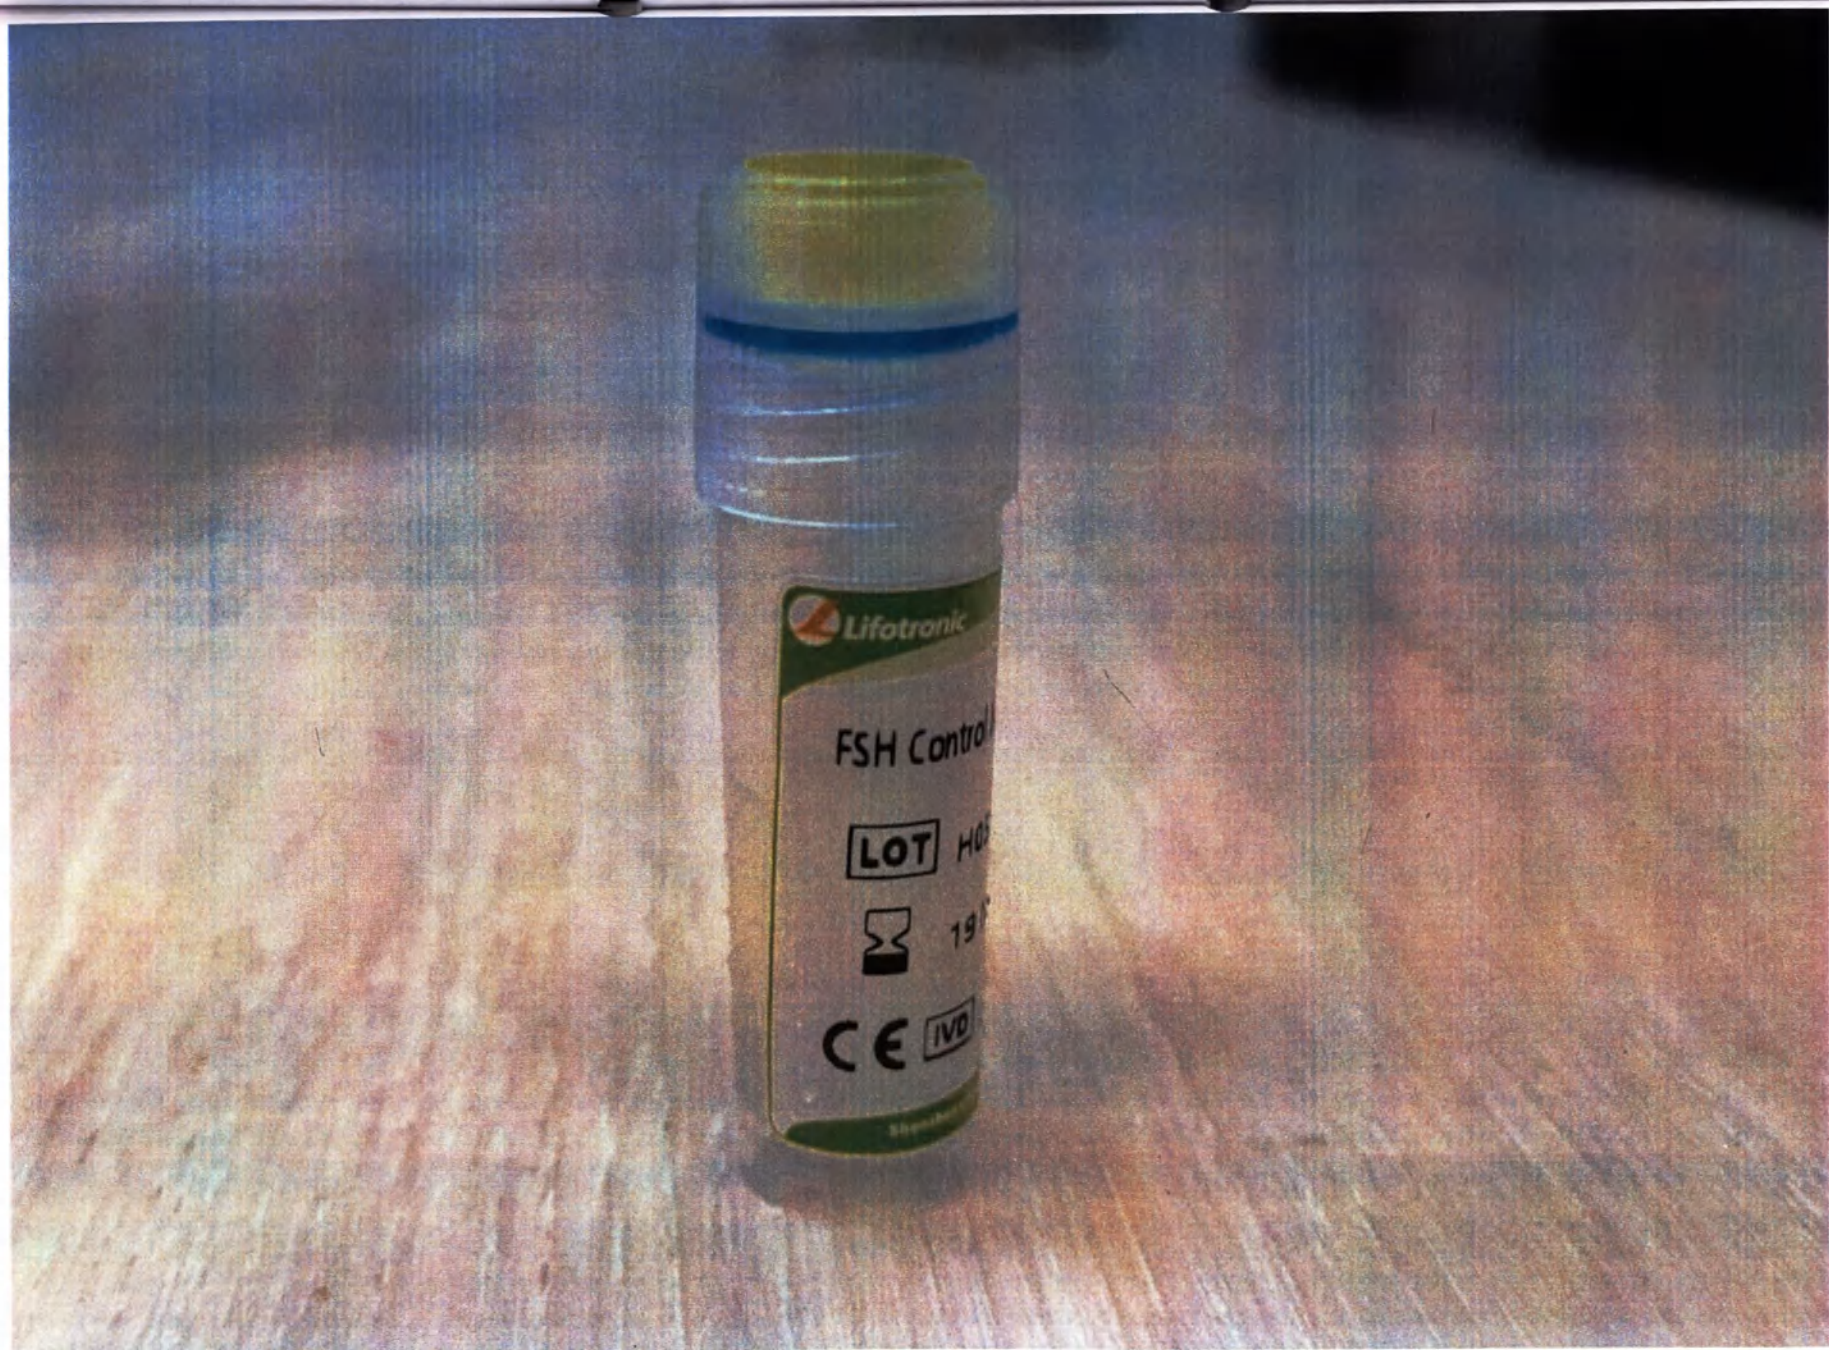


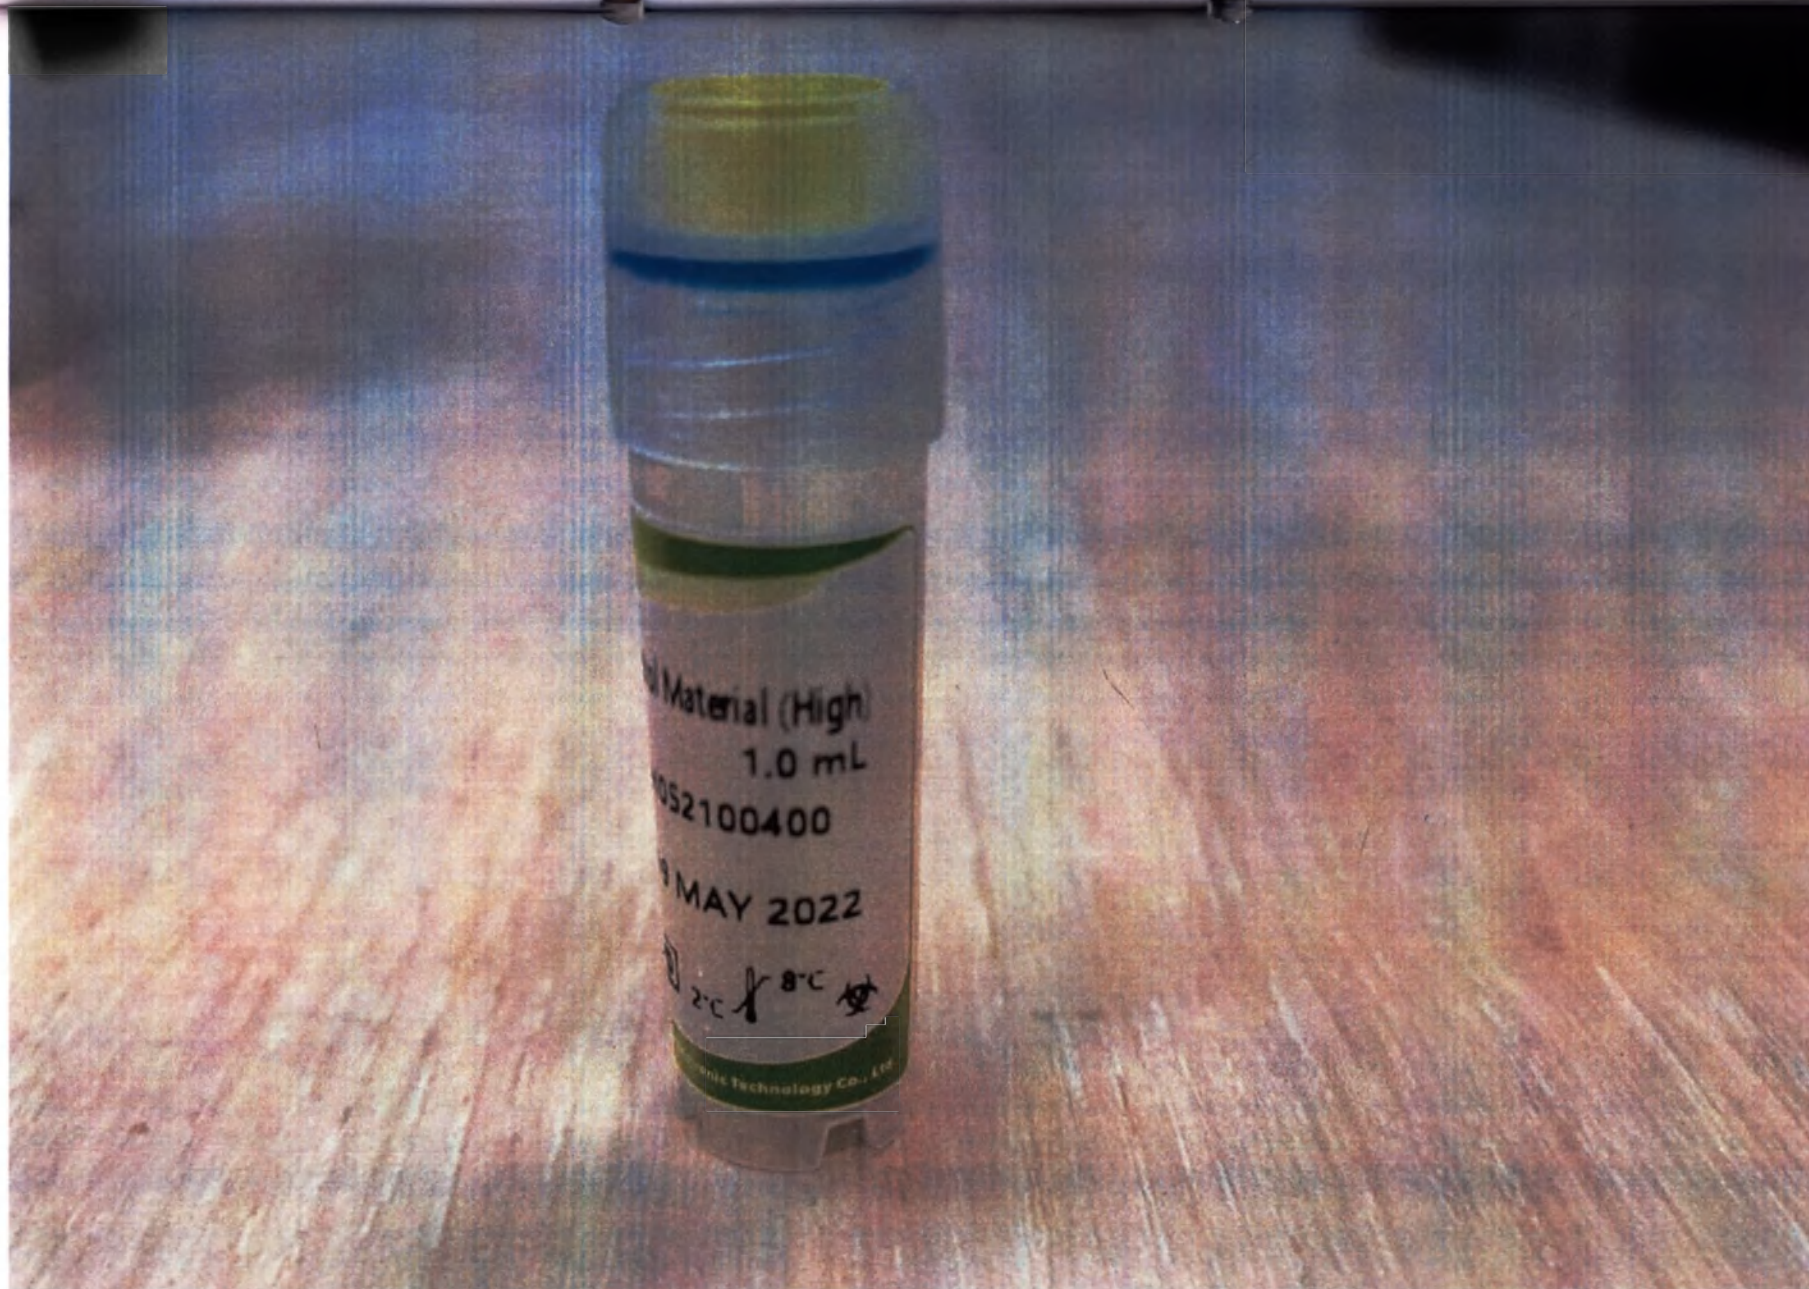


Материал контрольный (высокий уровень) (Набор реагентов для количественного определения фолликулостимулирующего гормона электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Follicle-stimulating Hormone (Electrochemiluminescence Immunoassay) / FSH), в варианте исполнения 100 тестов)

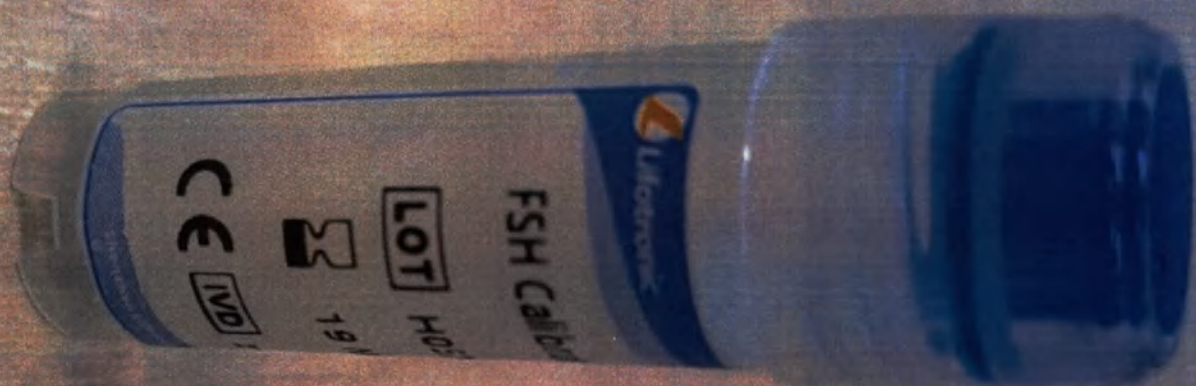


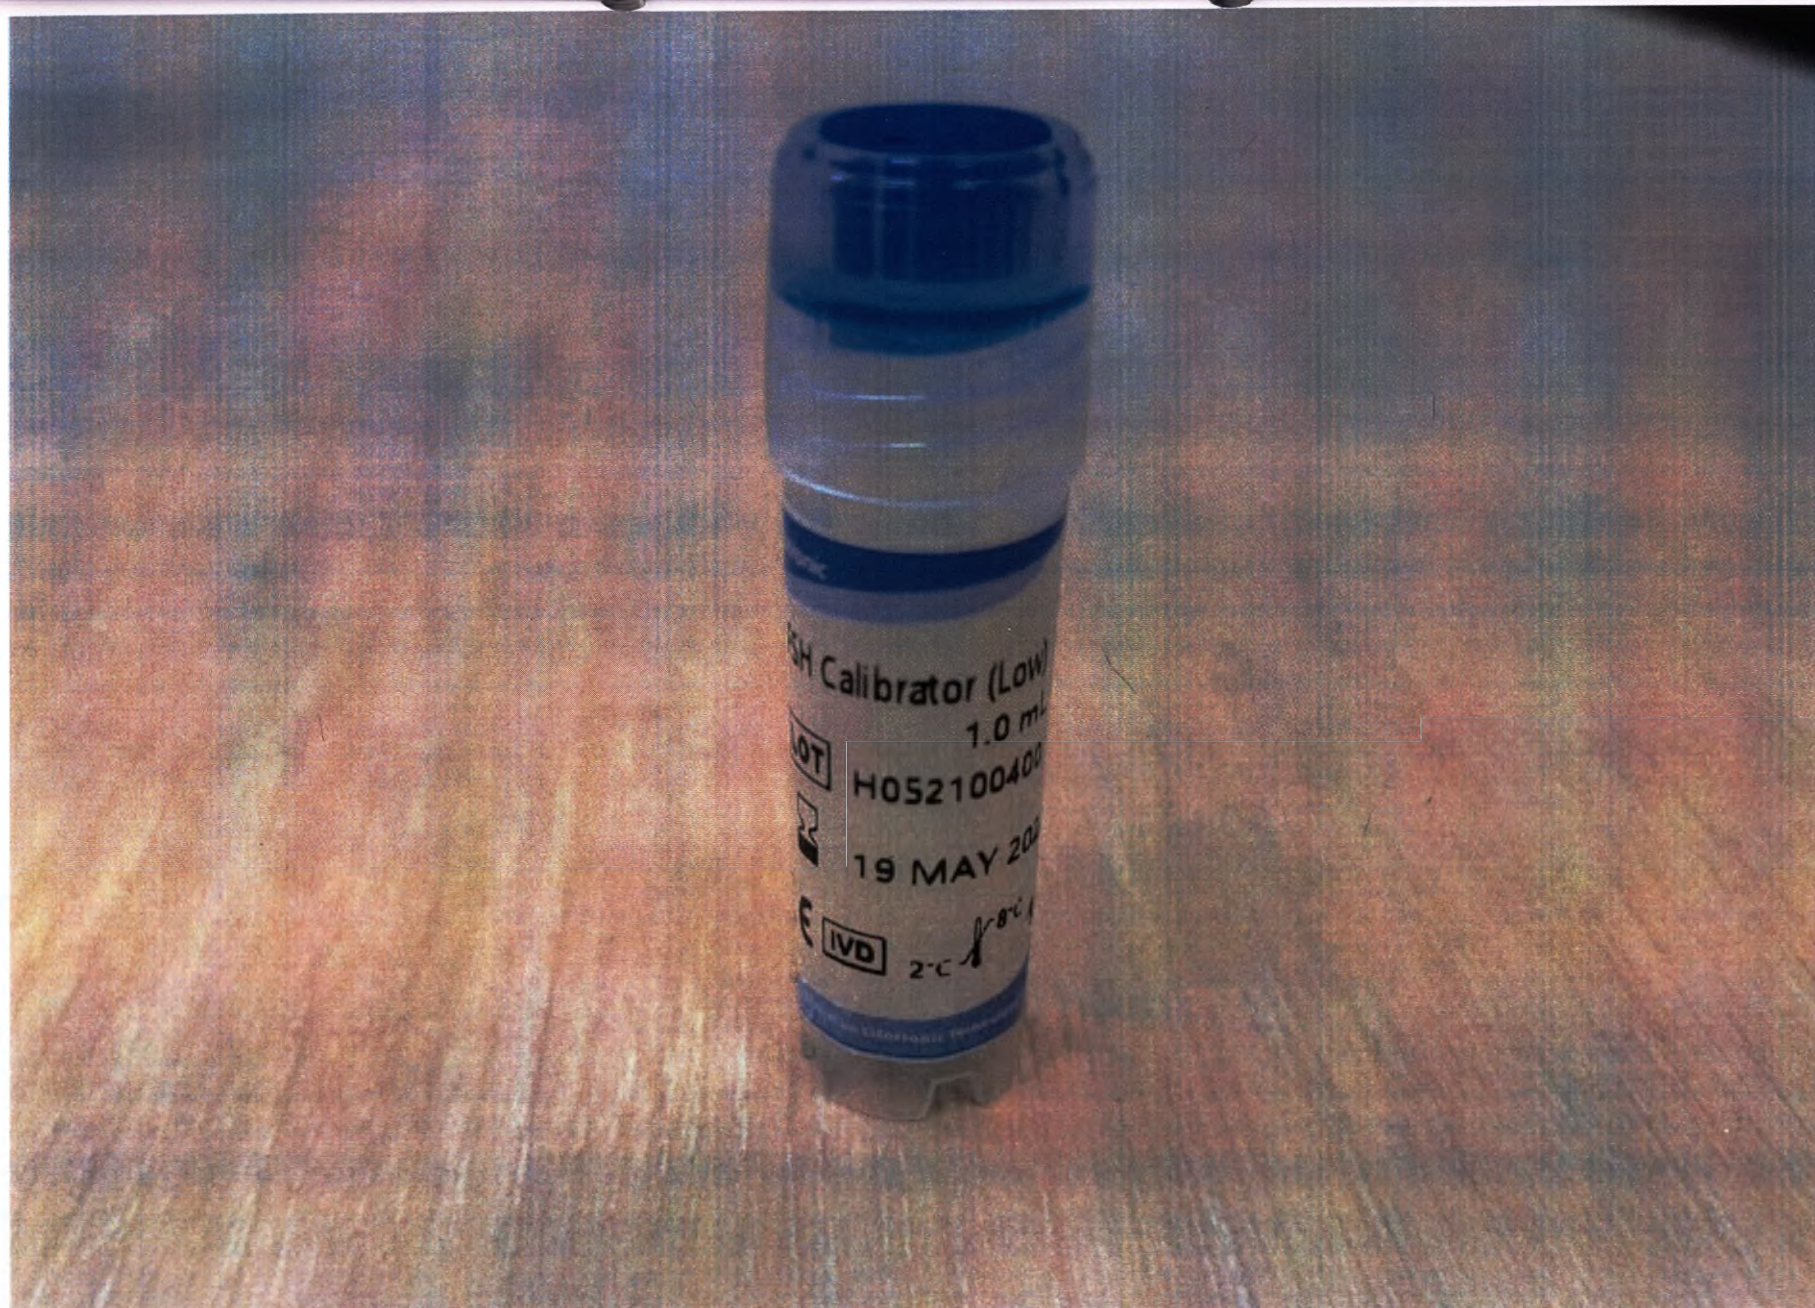

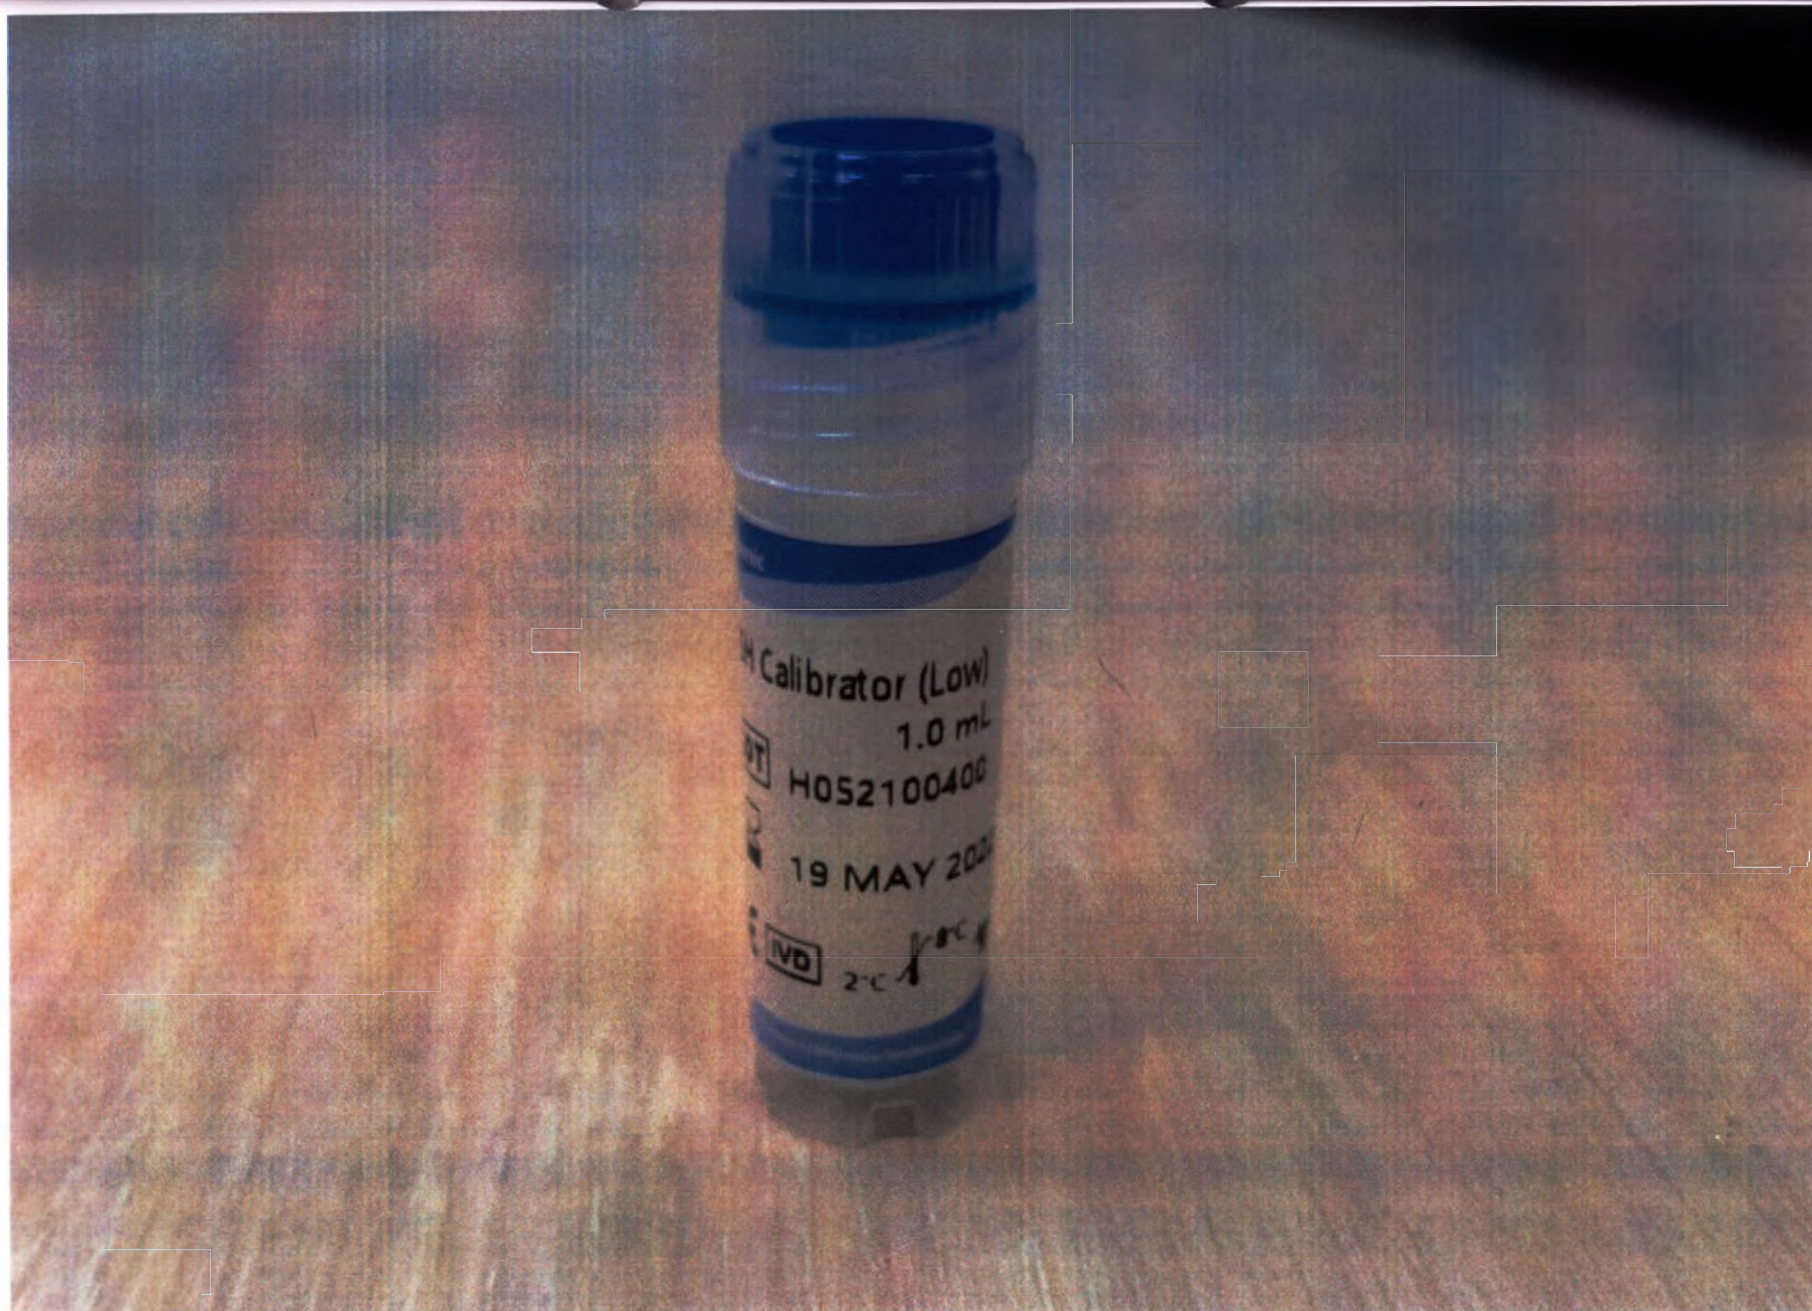

Калибратор (низкий уровень) (Набор реагентов для количественного определения фолликулостимулирующего гормона электрохемилюминесцентным методом на анализаторах FCI для диагностики in vitro (Follicle-stimulating Hormone (Electrochemiluminescence Immunoassay) / FSH), в варианте исполнения 100 тестов)

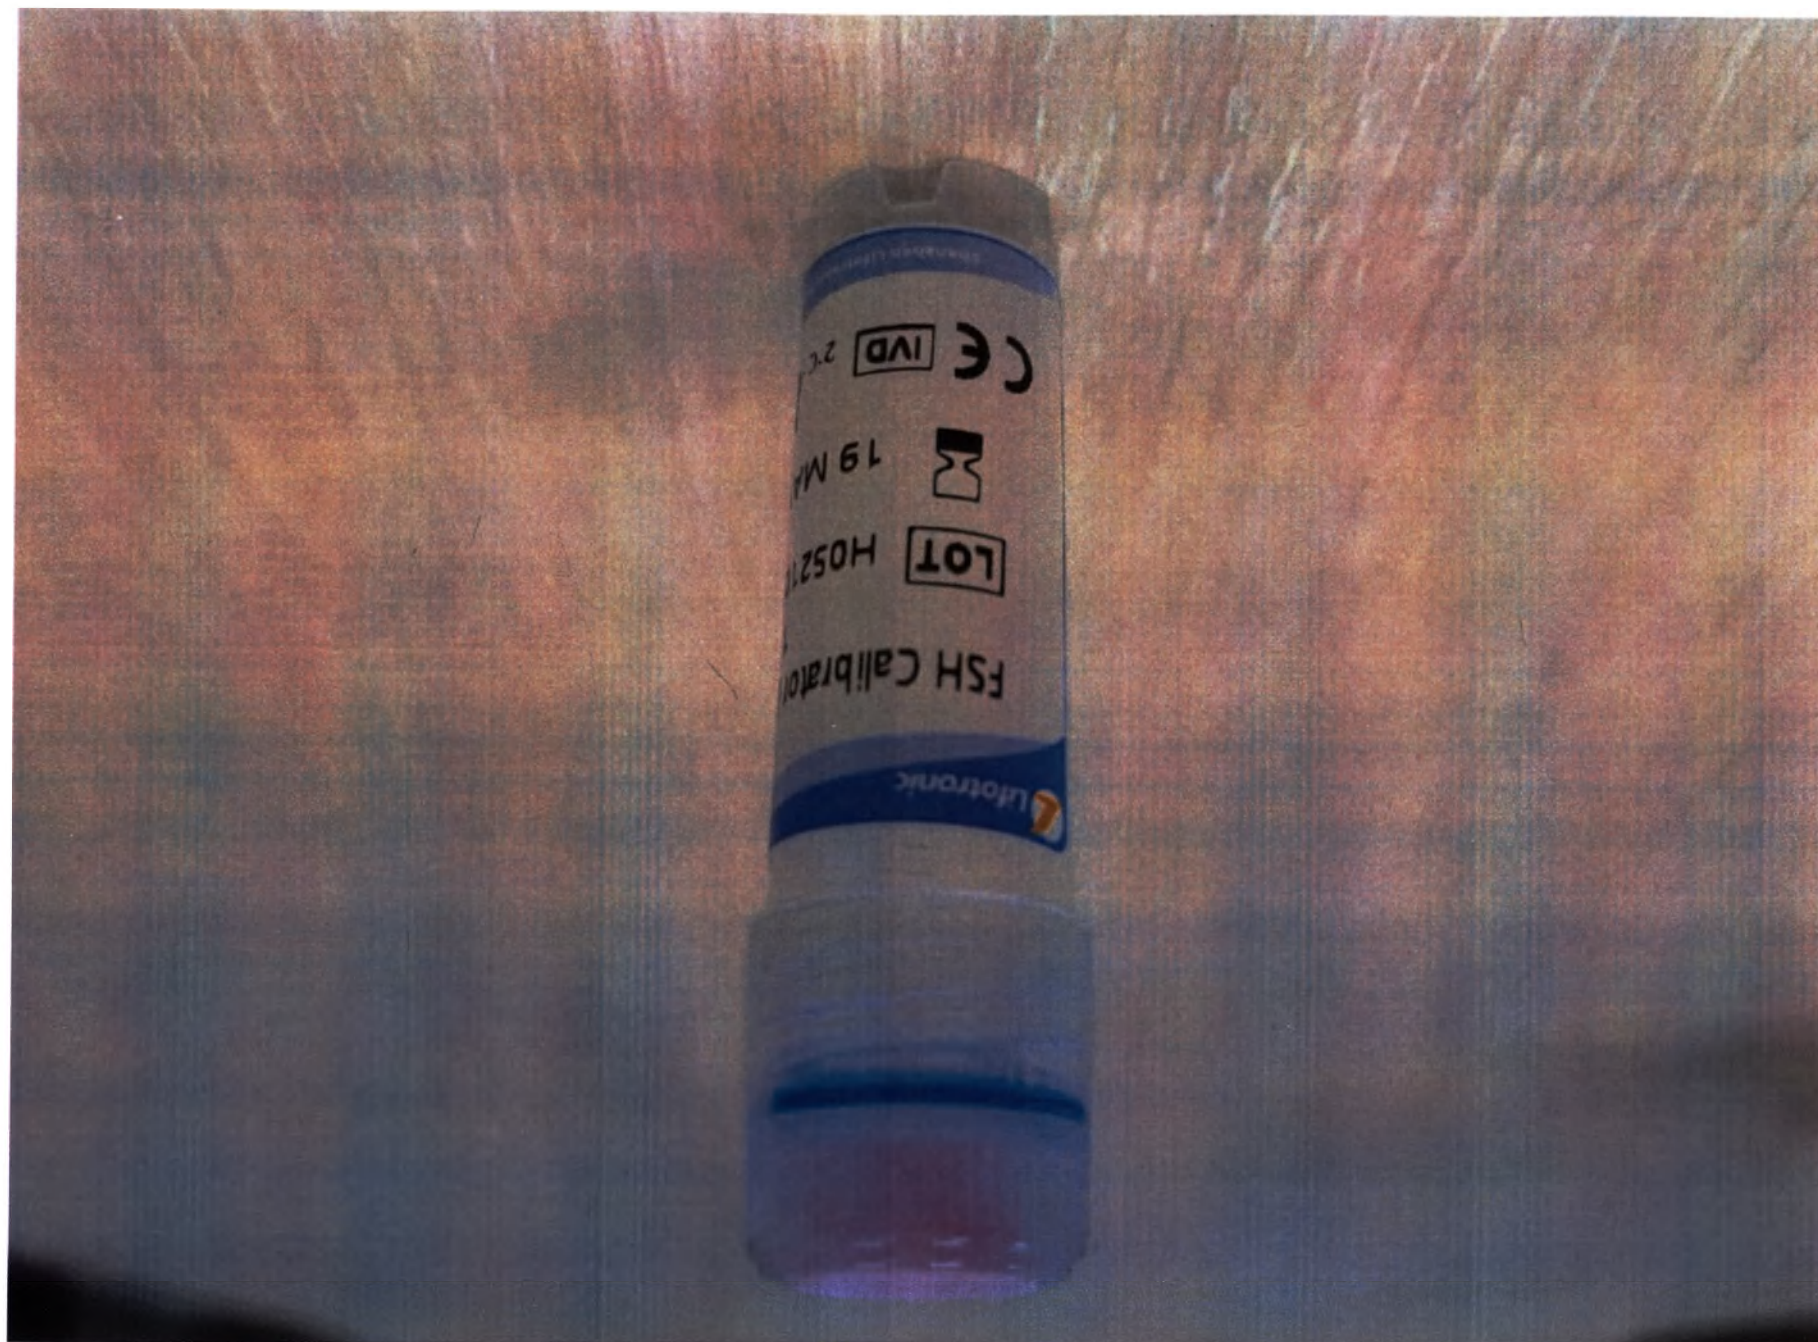


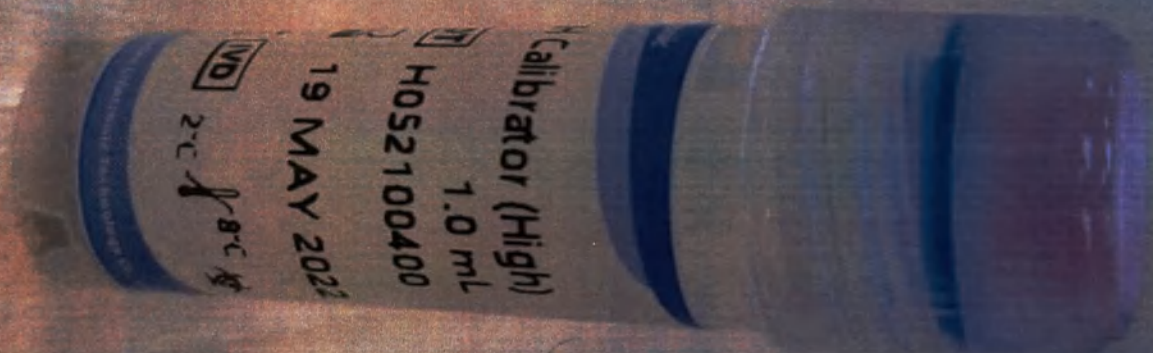



Калибратор (высокий уровень) (Набор реагентов для количественного определения фолликулостимулирующего гормона электрохемилюминесцентным методом на анализаторах

FSH, в варианте исполнения 100 тестов) (Follicle-stimulating Hormone (Electrochemiluminescence Immunoassay) / FSH), в варианте исполнения 100 тестов)

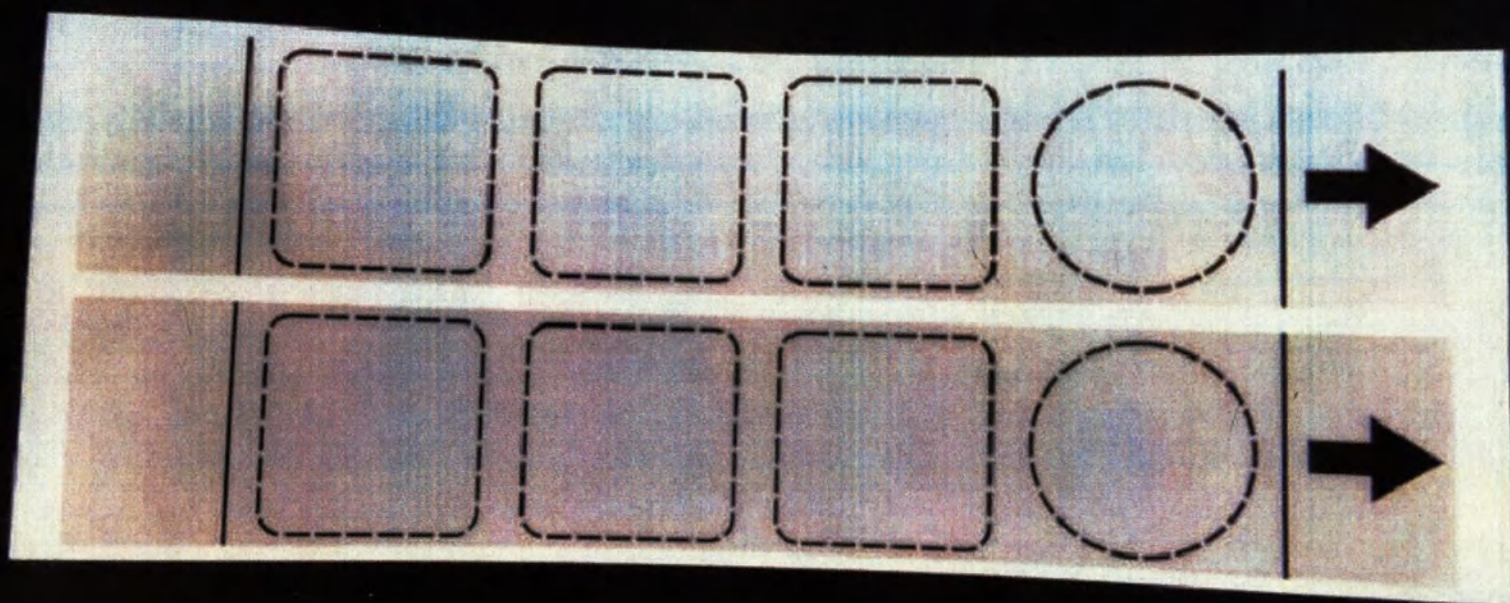

FSH Quality Control Card

LOT


H052100400




19 MAY 2022

QC Range(Low) : 9.944-26.216 mIU/mL

QC Range(High) : 30.041-79.199 mIU/mL



Этикетка результатов значений материалов контрольных (Набор реагентов для количественного определения фолликулостимулирующего гормона электрохемилюминесцентным



Follicle-stimulating Hormone
(Electrochemiluminescence Immunoassay)

Components

MB 5.0 mL

LOT

H052100400

FSH



RB 9.5 mL

SN

00195

RA 7.0 mL




19 MAY 2022




IVD

2°C




Кассета с реагентами (Набор реагентов для количественного определения фолликулостимулирующего гормона электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для




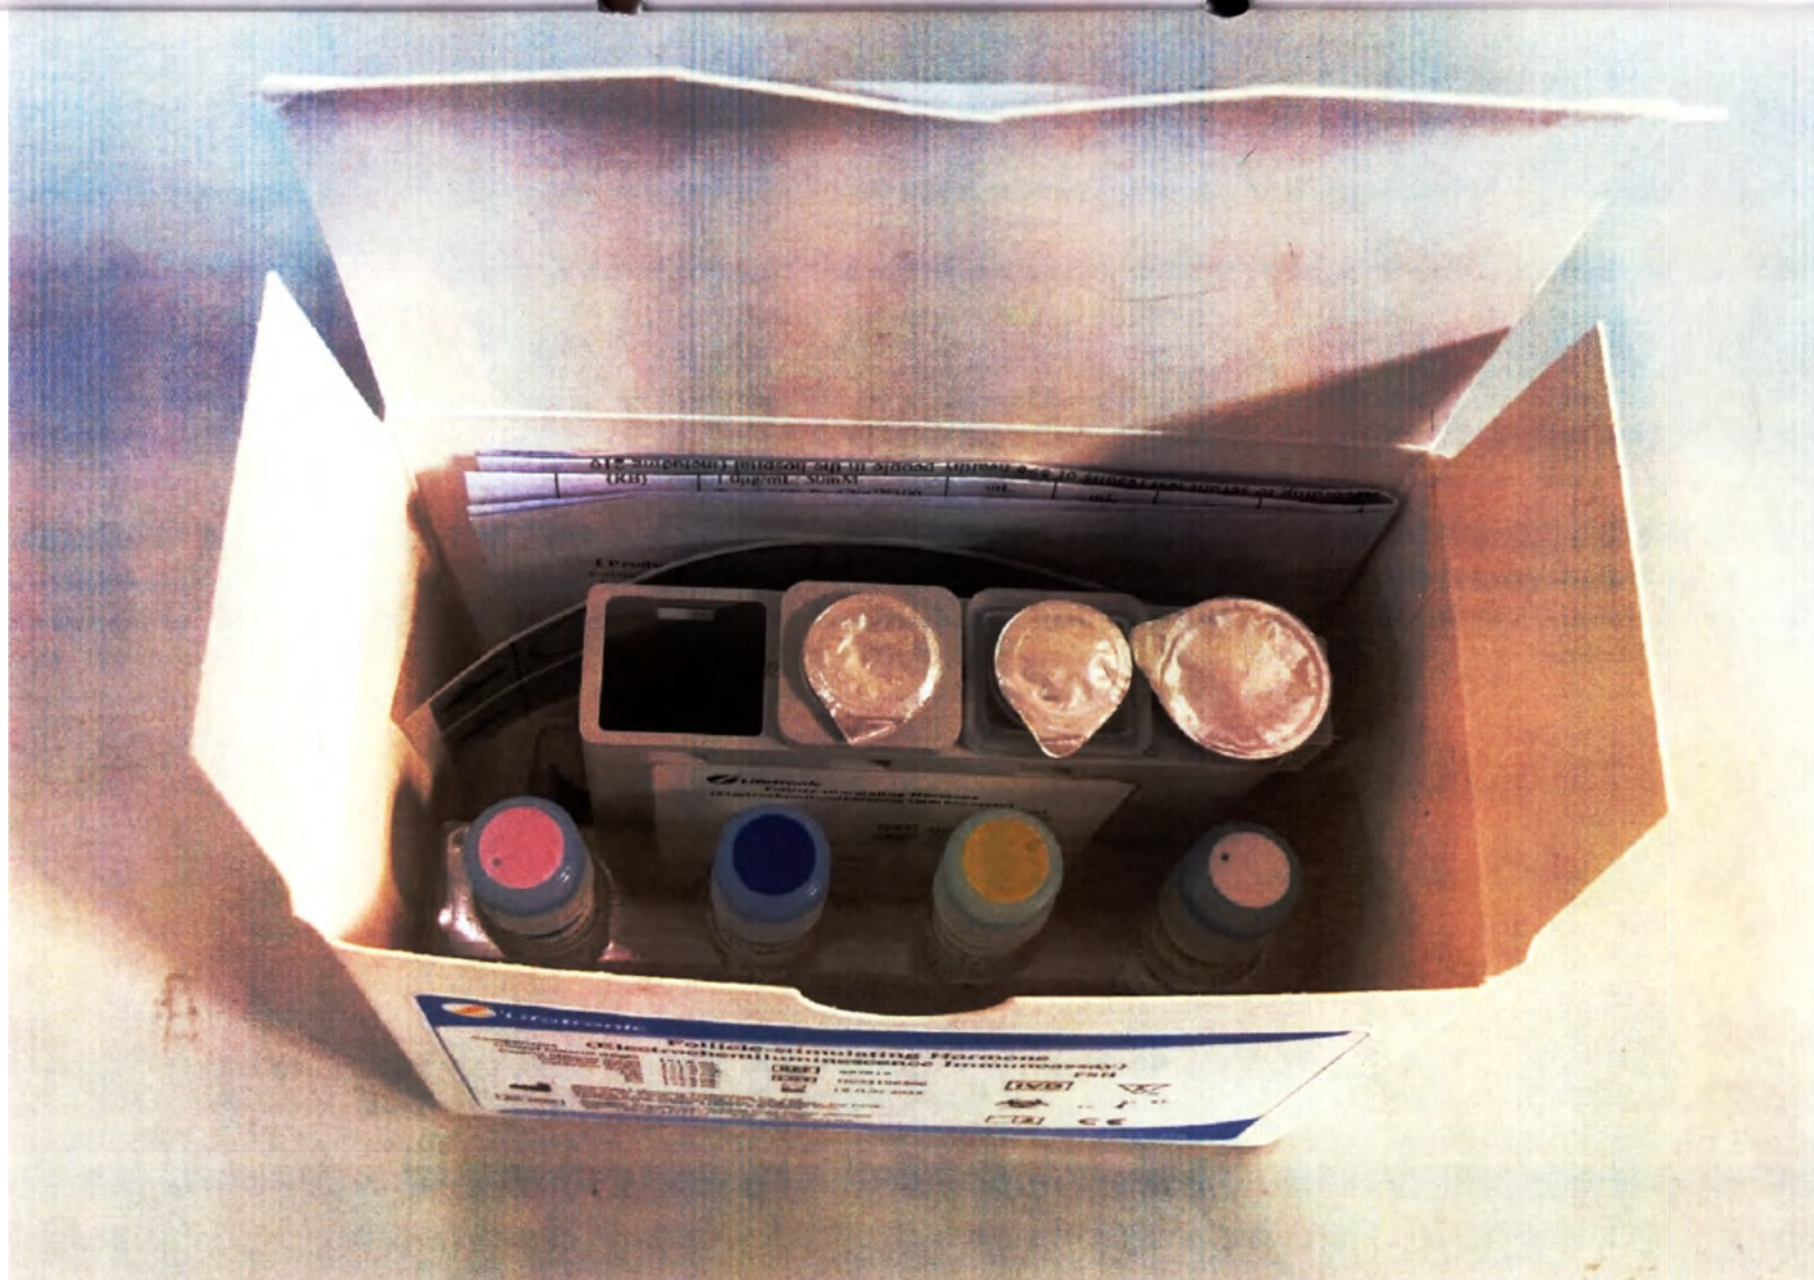


Общий вид медицинского изделия (Набор реагентов для количественного определения фолликулостимулирующего гормона электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Follicle-stimulating Hormone (Electrochemiluminescence Immunoassay) / FSH), в варианте исполнения 50 тестов)



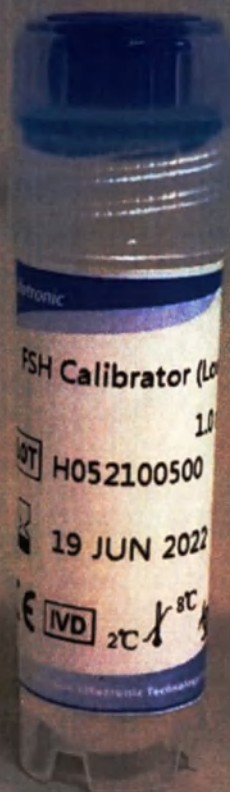

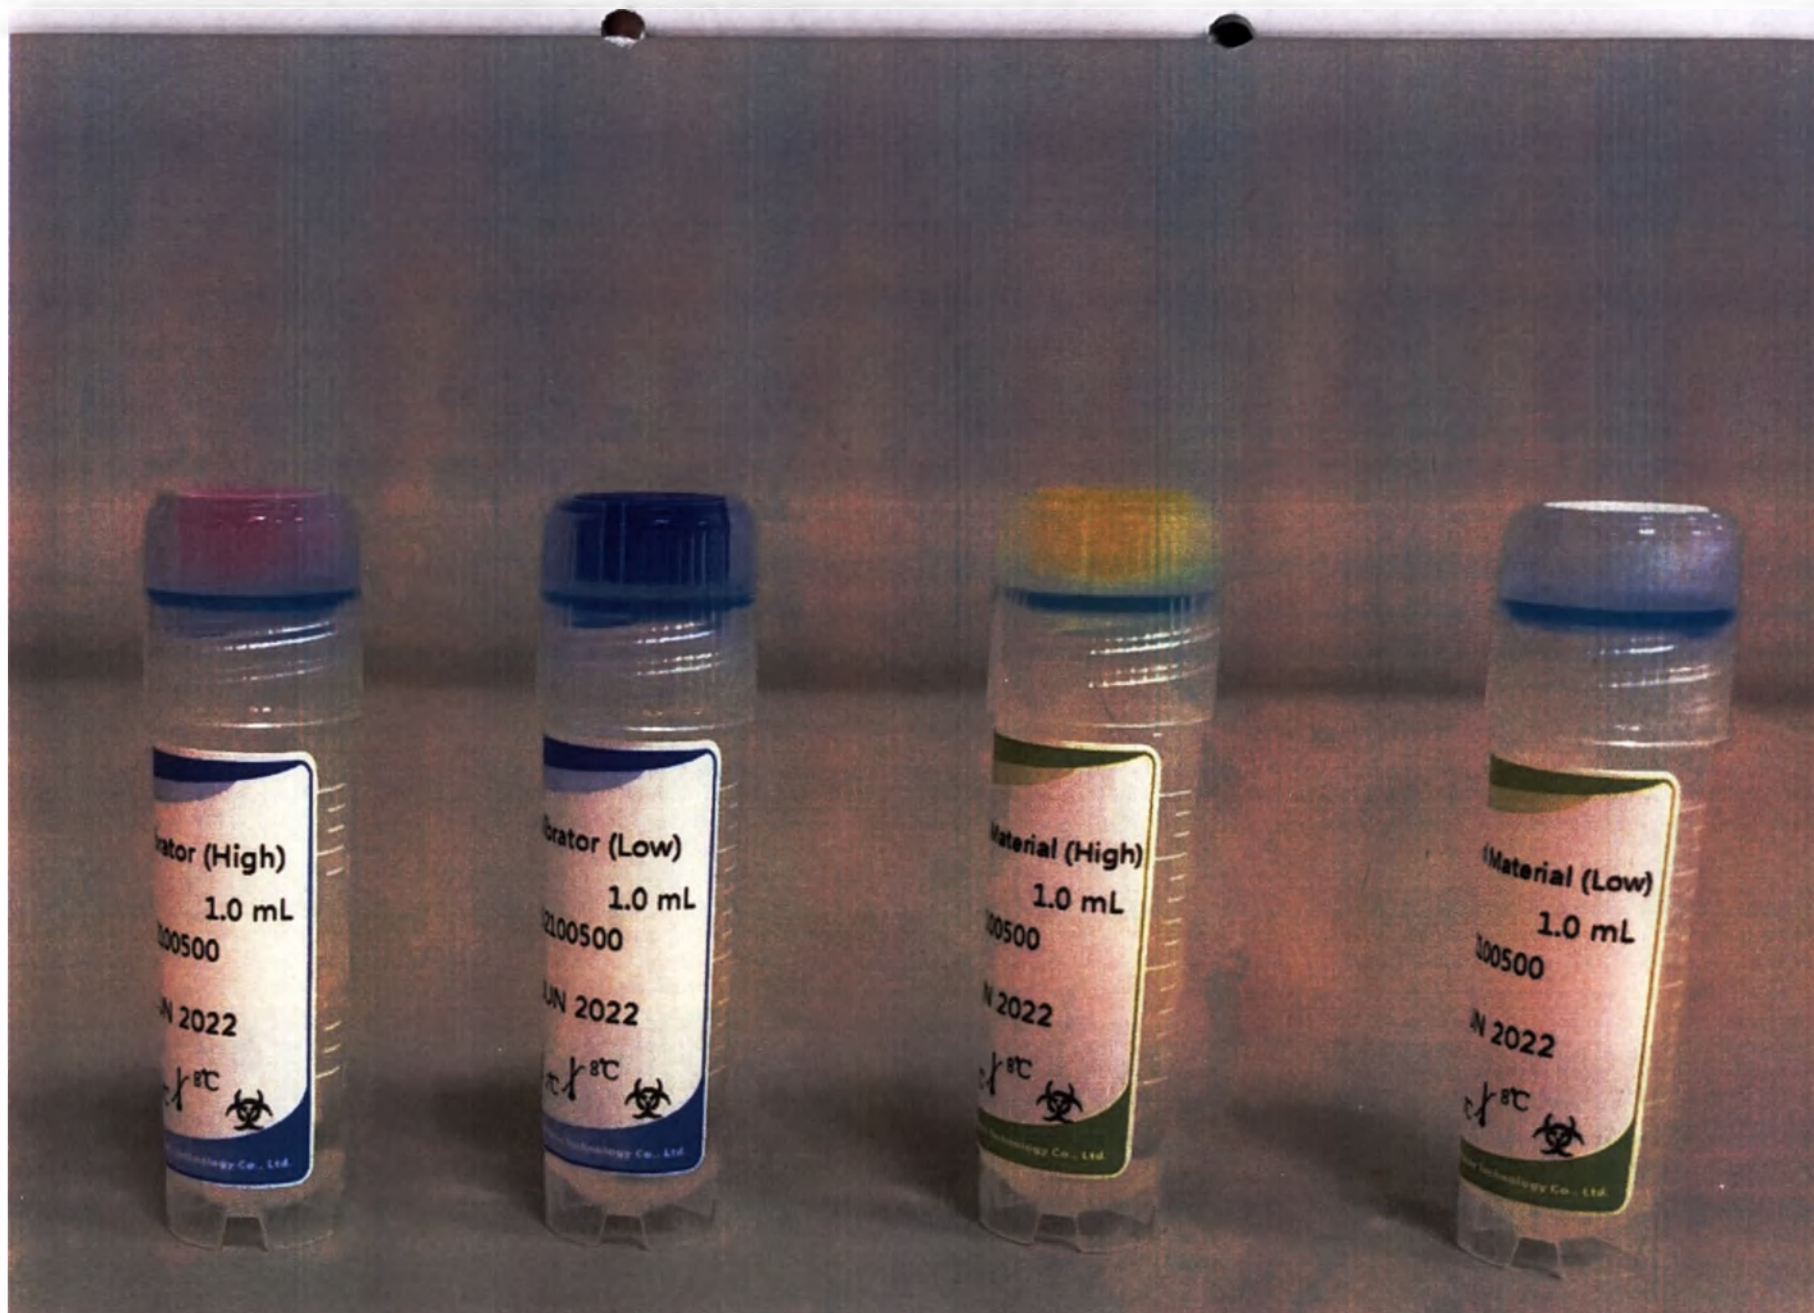

Калибратор (низкий и высокий уровень), Материал контрольный (низкий и высокий уровень) (Набор реагентов для количественного определения фолликулостимулирующего гормона электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики *in vitro* (Follicle-stimulating Hormone (Electrochemiluminescence Immunoassay) / FSH), в варианте исполнения 50 тестов)

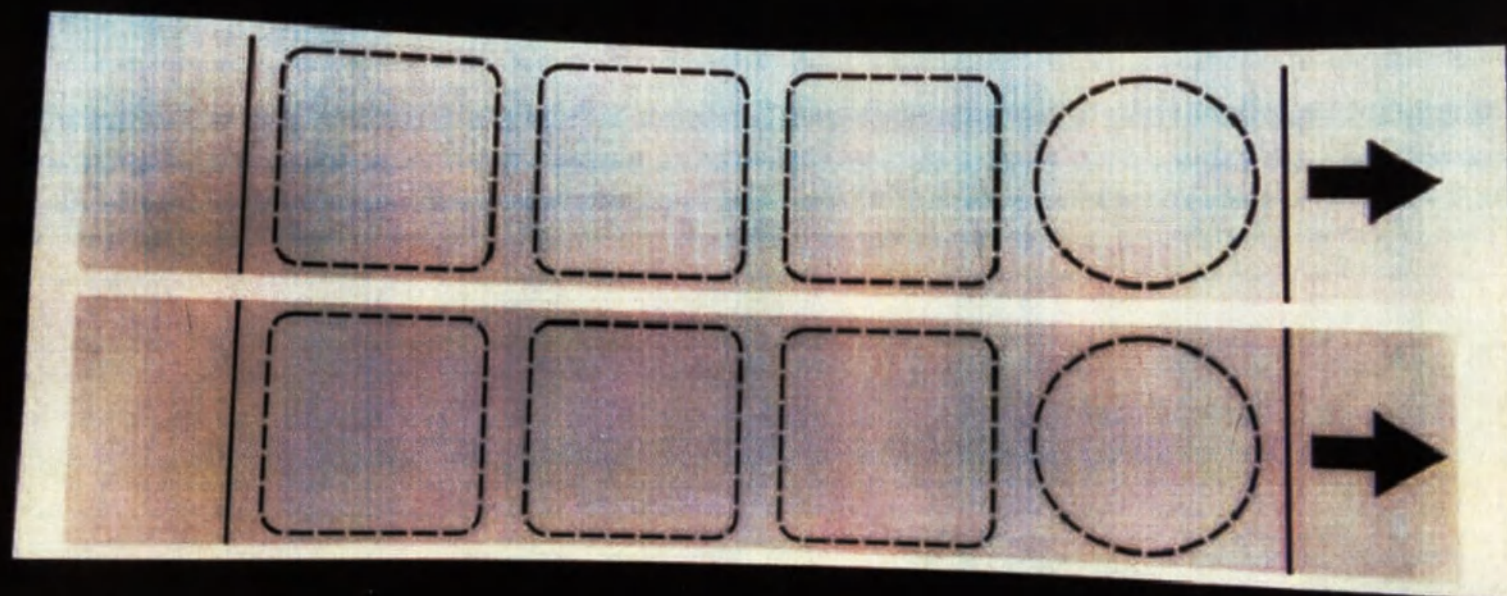

Этикетки для запечатывания флаконов (Набор реагентов для количественного определения фолликулостимулирующего гормона электрохемилюминесцентным методом на автоматизированном ЕСИ для тестов in vitro (Follicle-stimulating Hormone (Electrochemiluminescence Immunoassay) / FSH), в варианте исполнения 50 тестов)

FSH Quality Control Card

LOT


H052100500




19 JUN 2022

QC Range(Low): 10.04-26.48 mIU/mL

QC Range(High): 30.34-79.98 mIU/mL



Этикетка результатов значений материалов контрольных (Набор реагентов для количественного определения фолликулостимулирующего гормона электрохемилюминесцентным методом на анализаторах FCI, для диагностики in vitro (Follicle-stimulating Hormone (Electrochemiluminescence Immunoassay) / FSH), в варианте исполнения 50 тестов)

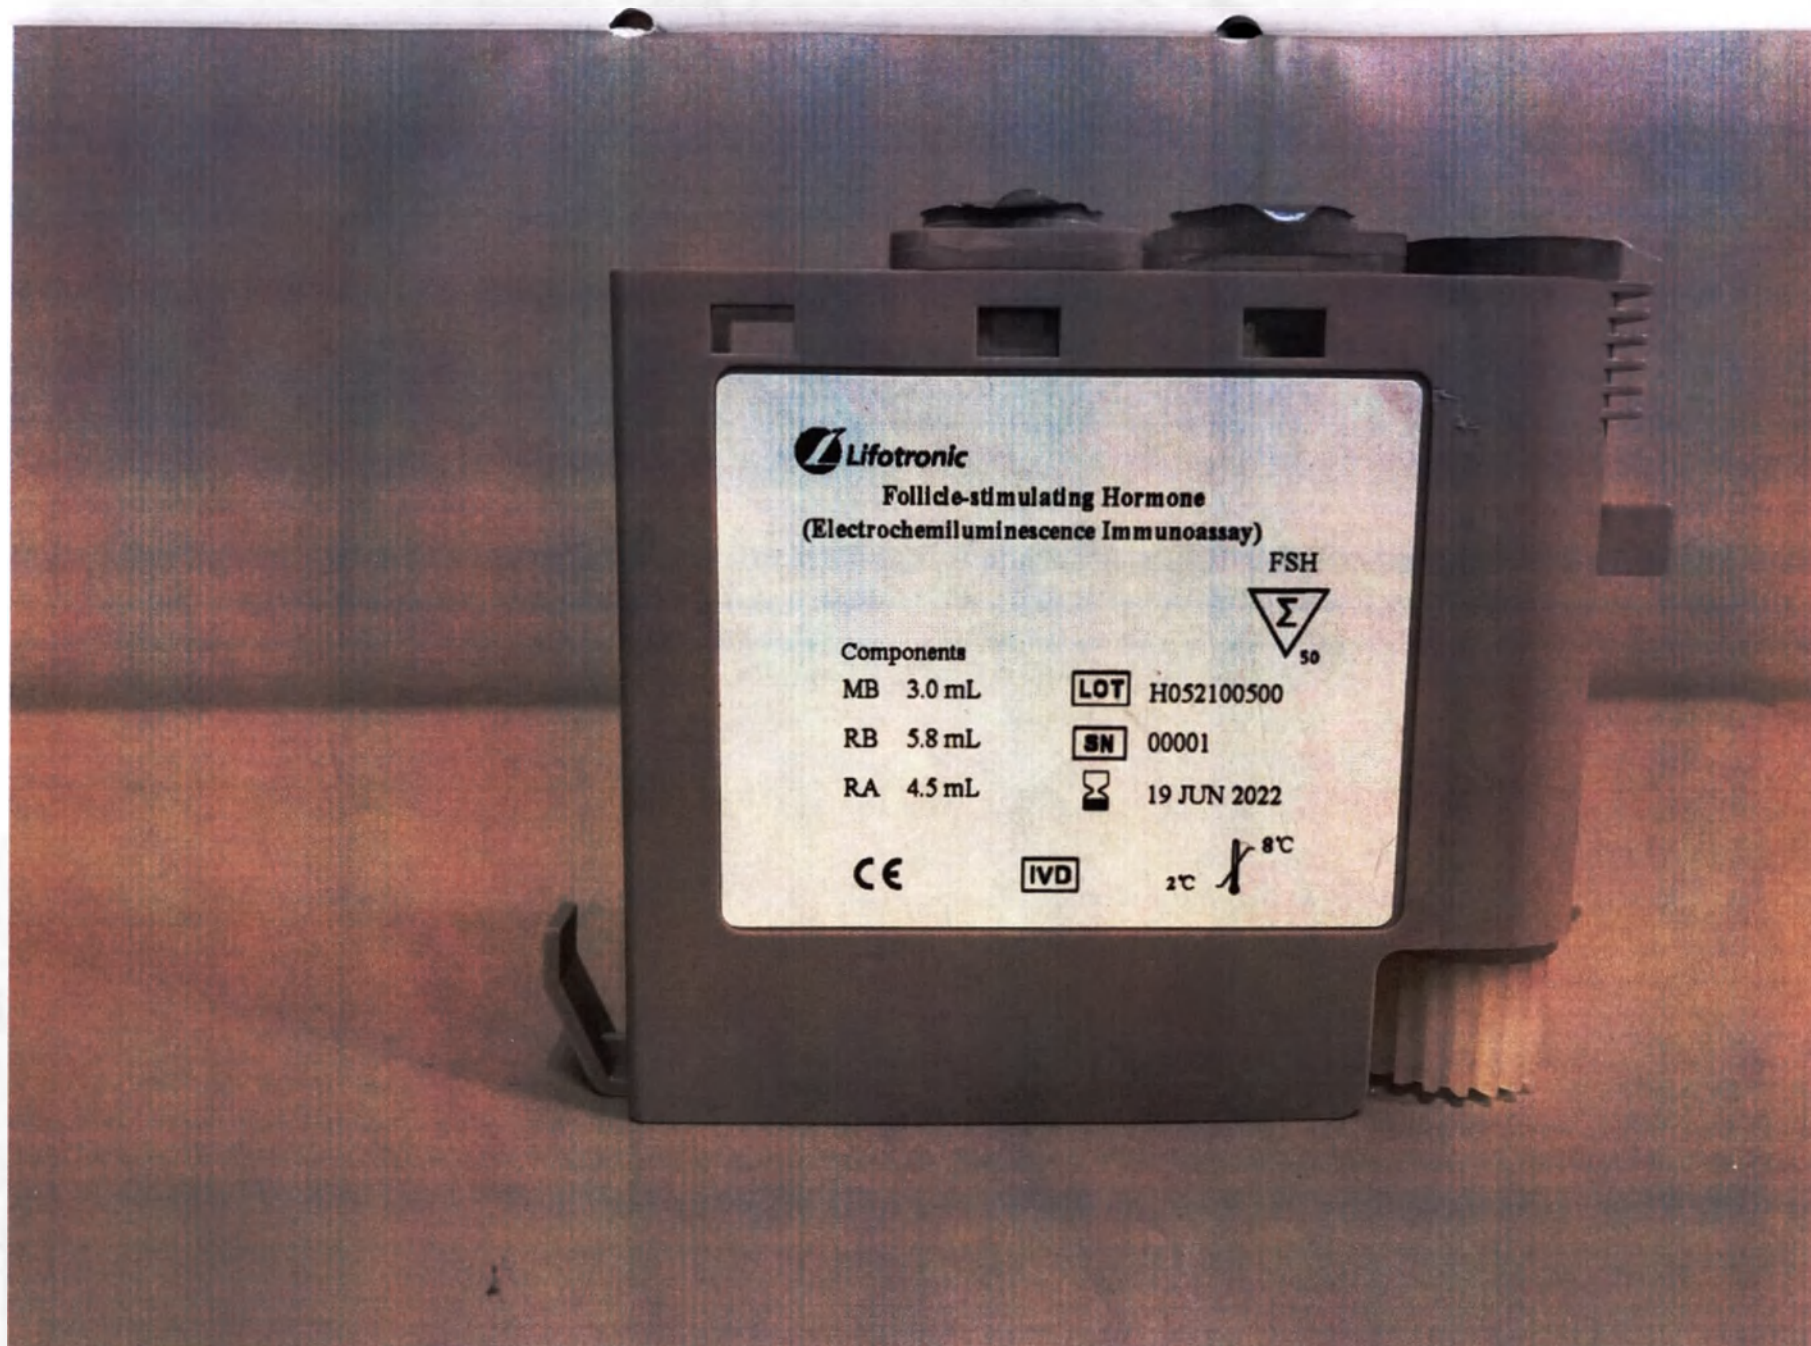

Кассета с реагентами (Набор реагентов для количественного определения фолликулостимулирующего гормона электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Follicle-stimulating Hormone (Electrochemiluminescence Immunoassay) / FSH), в варианте исполнения 50 тестов)

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 26 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А
М.П.



ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 5987789
КУСАНДЖО Р.В.