


УТВЕРЖДАЮ

**Генеральный директор
ООО «Компания «БиВи»**

Т.А. Носова

2021 г.

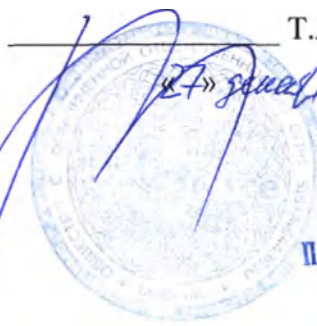


ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 5987789

КУСАЙЛО Р.В.

Фотографические изображения изделия:

**Набор реагентов для количественного определения пролактина
электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для
диагностики in vitro (Prolactin (Electrochemiluminescence Immunoassay) / PRL)**

**«Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.»
(«Шэньчжэнь Лайфотроник Технолоджи Ко., Лтд.»), Китай**

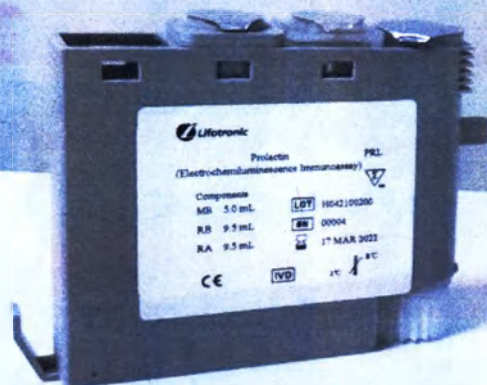



1. 1042100300
 2. 1042100300
 3. 1042100300
 4. 1042100300
 5. 1042100300
 6. 1042100300
 7. 1042100300
 8. 1042100300
 9. 1042100300
 10. 1042100300

Instruction For Use
 Product: (Electrochemiluminescence Immunoassay)
 Prolactin (PRL)
 Order Information:

REF NO.	Package Size
1042100300	100
1042100300	100
1042100300	100
1042100300	100

 Intended Use:
 Intended for the quantitative determination of Prolactin (PRL) in human serum and plasma. It is widely used to evaluate the pituitary function of women in clinical and research settings for the diagnosis of hyperprolactinemia. Prolactin is a member of the prolactin family of hormones and is secreted by the anterior pituitary gland. It is a single-chain polypeptide with a molecular weight of approximately 23 kDa. The hormone has two active sites and molecular weight is 23 kDa.

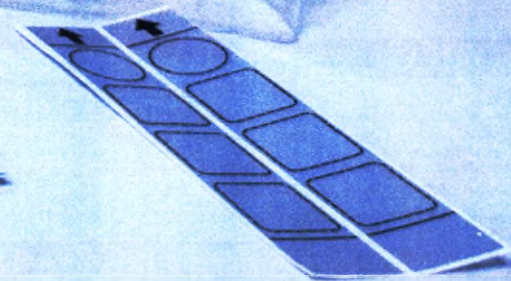


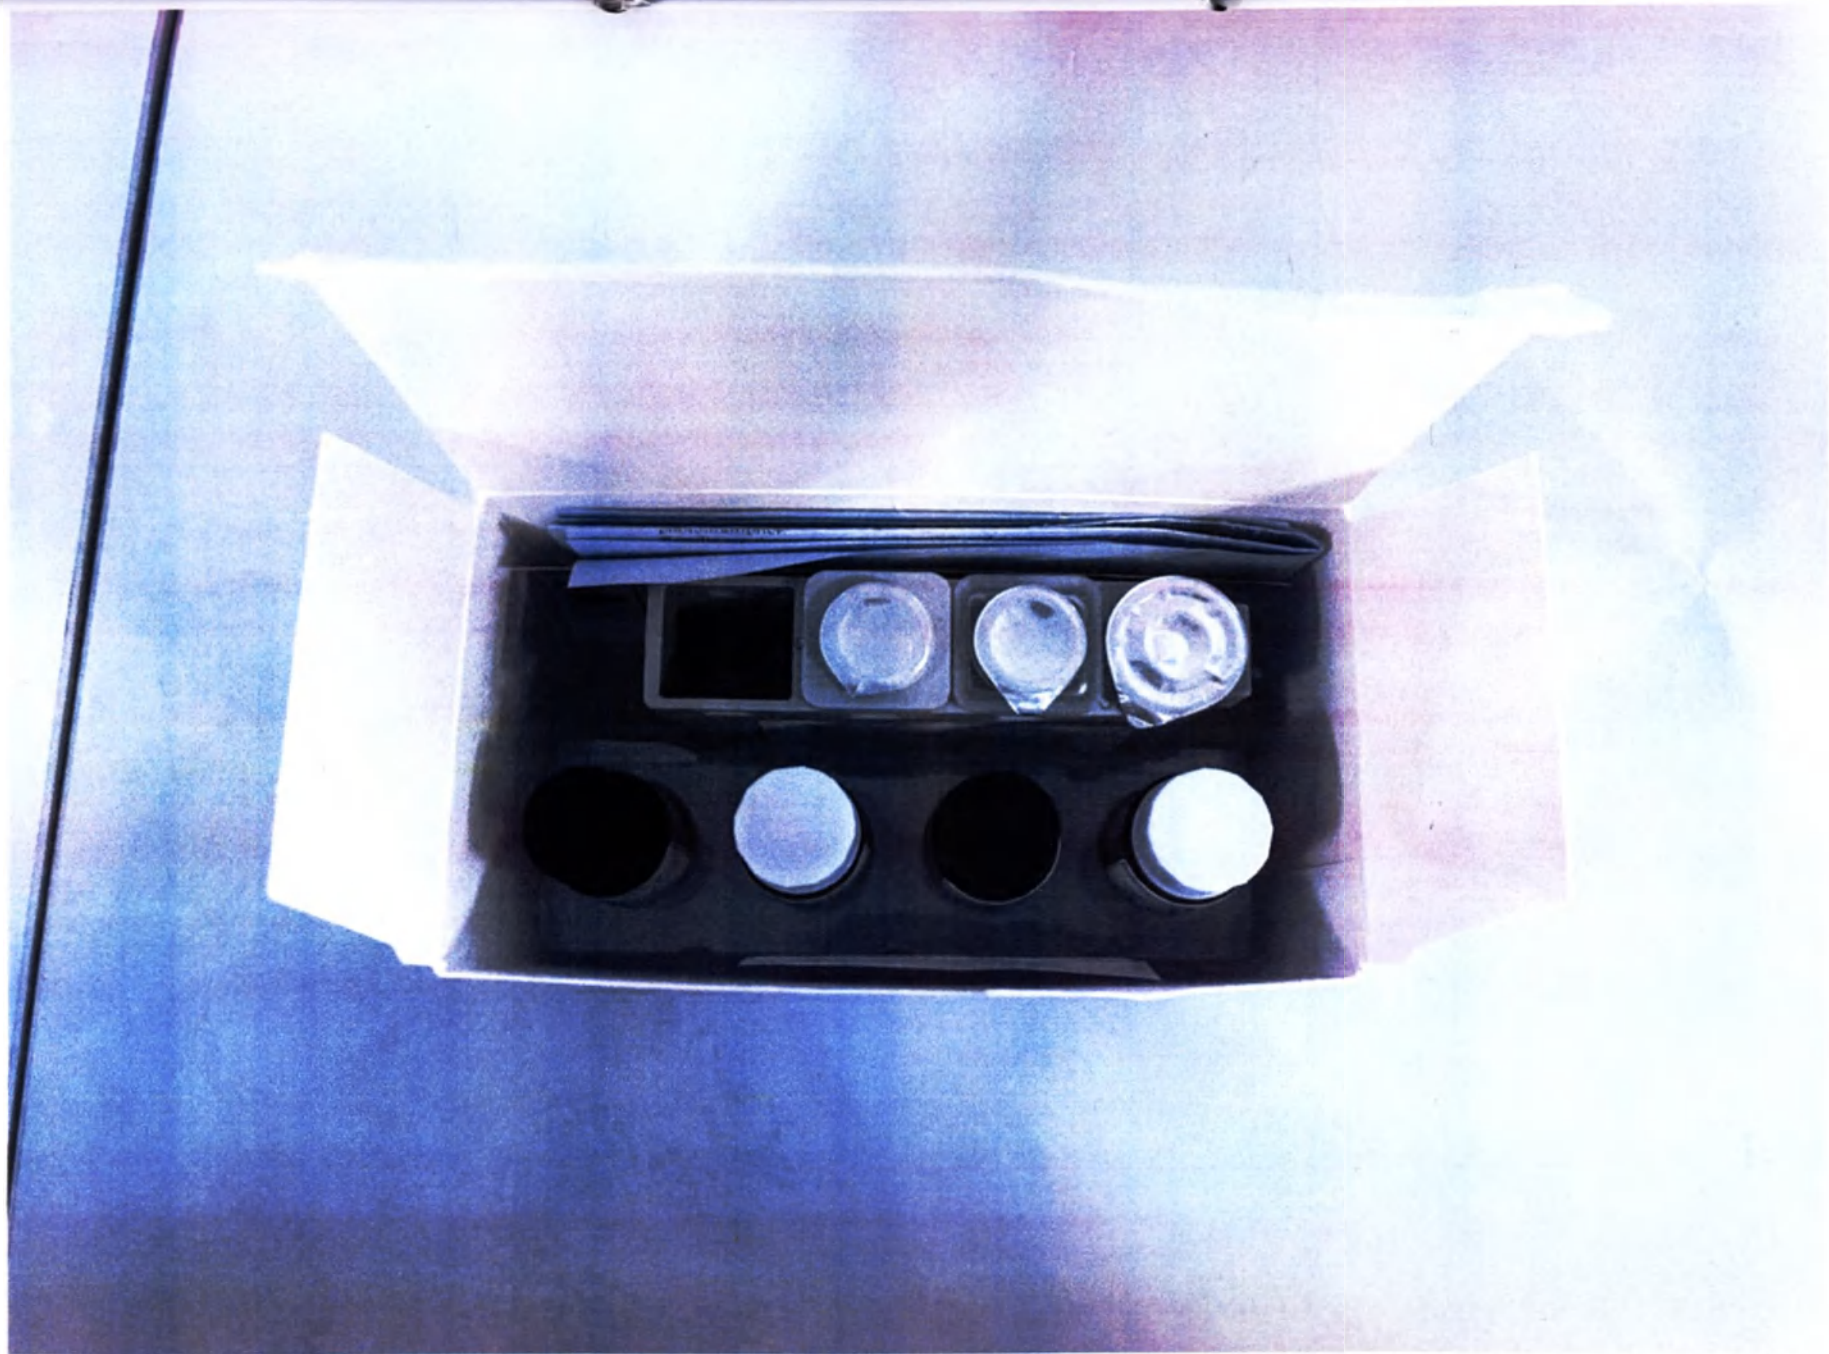


Общий вид медицинского изделия (Набор реагентов для количественного определения пролактина электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики

ООО ЦИРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru о (Prolactin (Electrochemiluminescence Immunoassay) / PRL), в варианте исполнения 100 тестов)



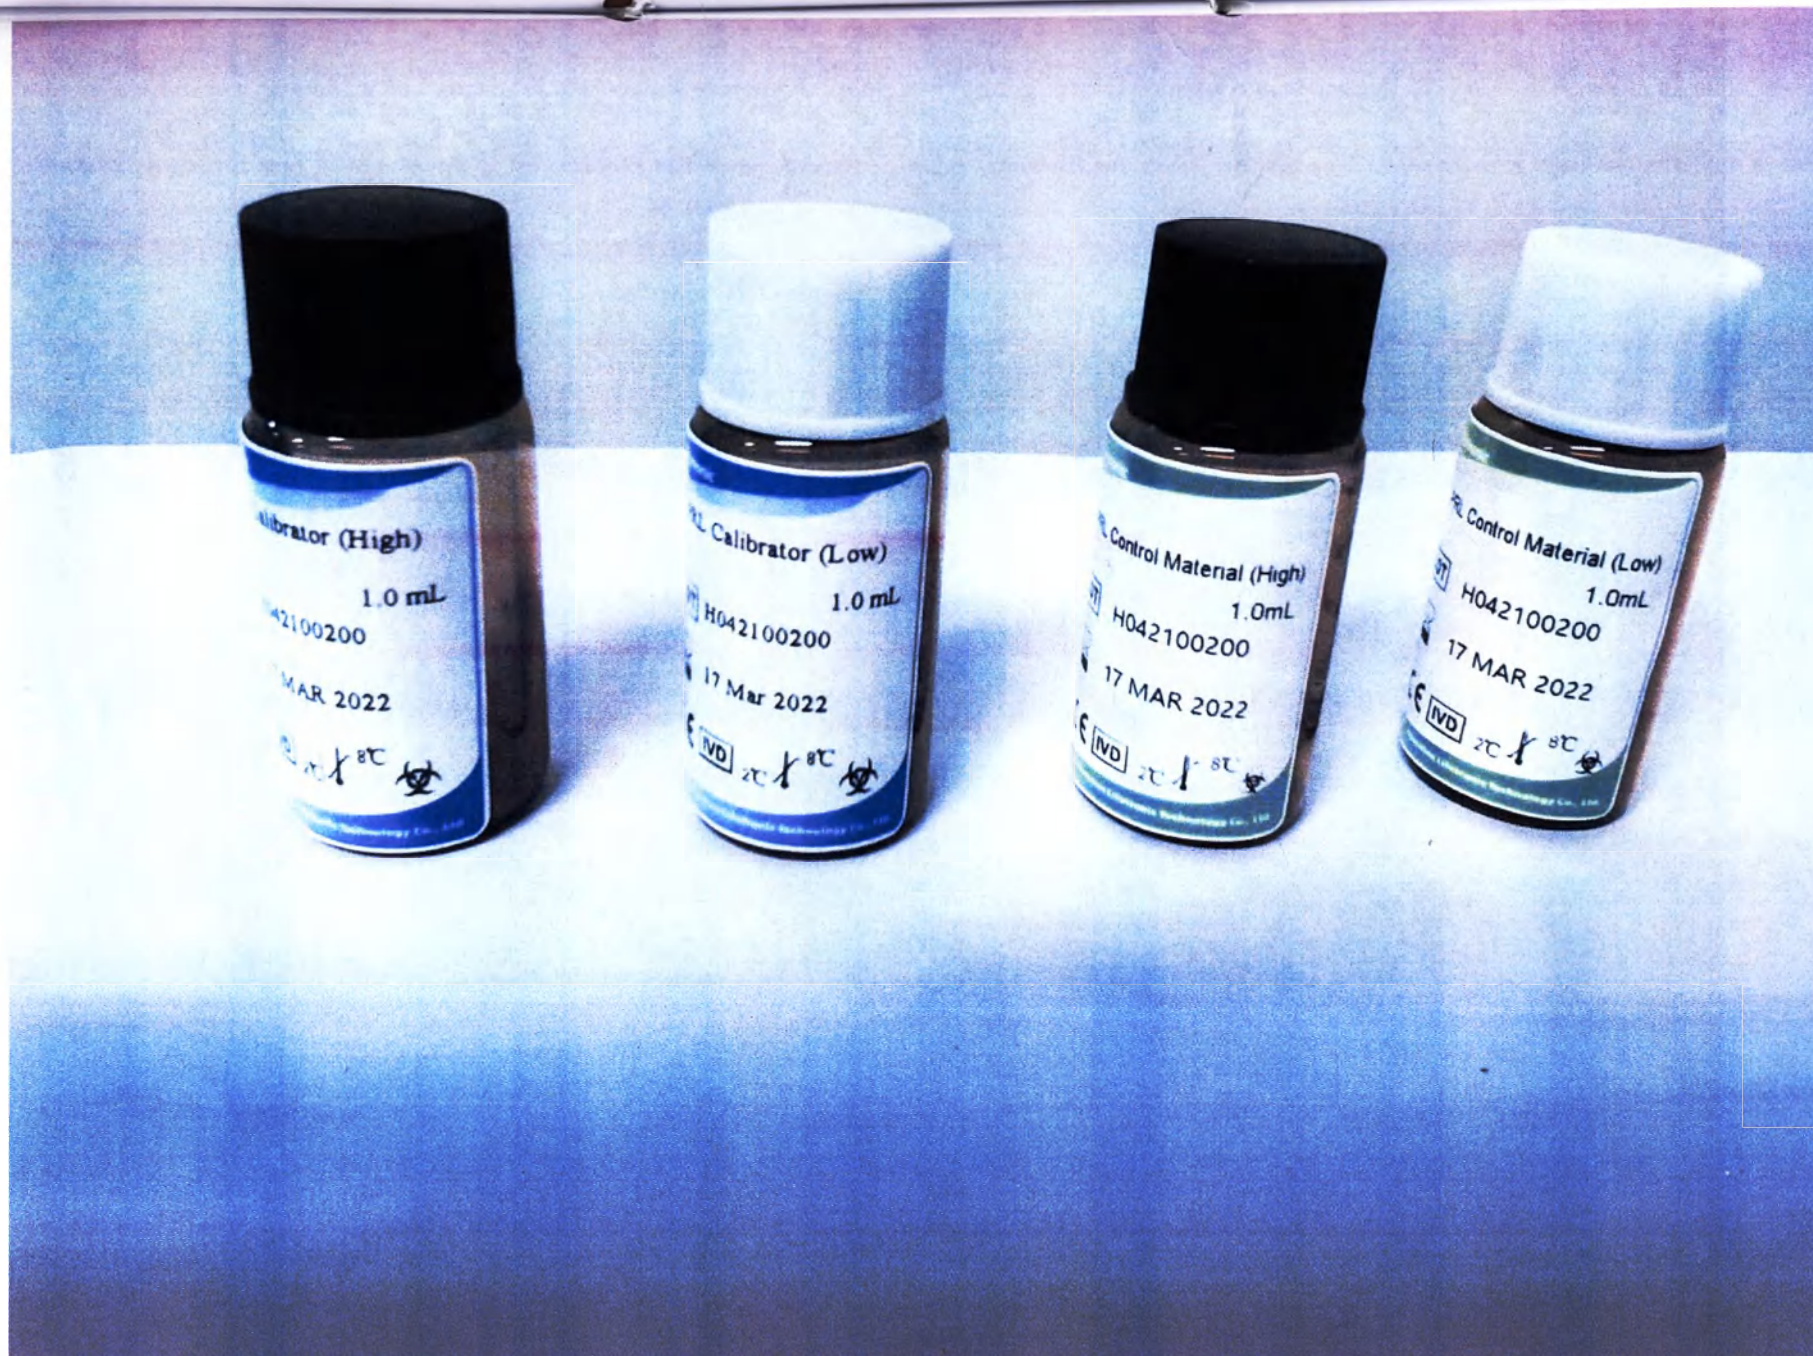

Калибратор (низкий и высокий уровень), Материал контрольный (низкий и высокий уровень) (Набор реагентов для количественного определения пролактина

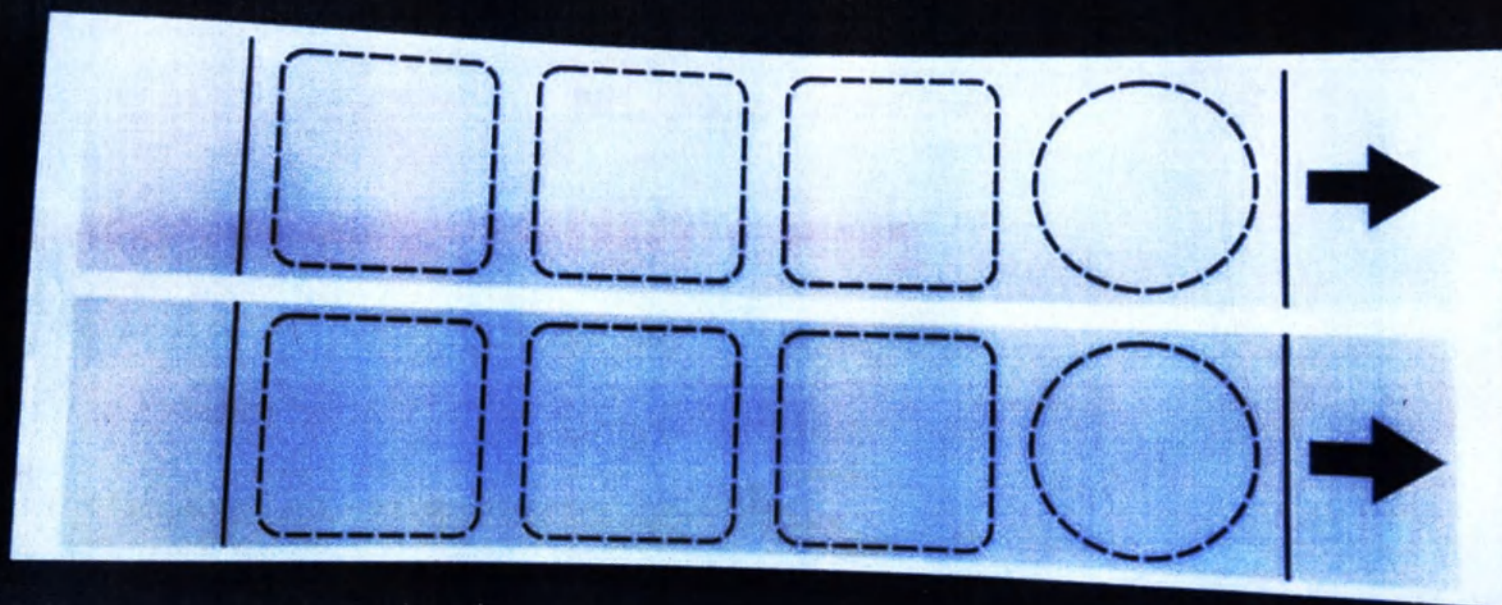

Этикетки для запечатывания флаконов (Набор реагентов для количественного определения пролактина электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для


и in vitro (Prolactin (Electrochemiluminescence Immunoassay) / PRL), в варианте исполнения 100 тестов)


PRL Quality Control Card

LOT H042100200  17 MAR 2022




QC Range(Low): 85.88-224.72 $\mu\text{IU/mL}$

QC Range(High): 877.5-2285.5 $\mu\text{IU/mL}$



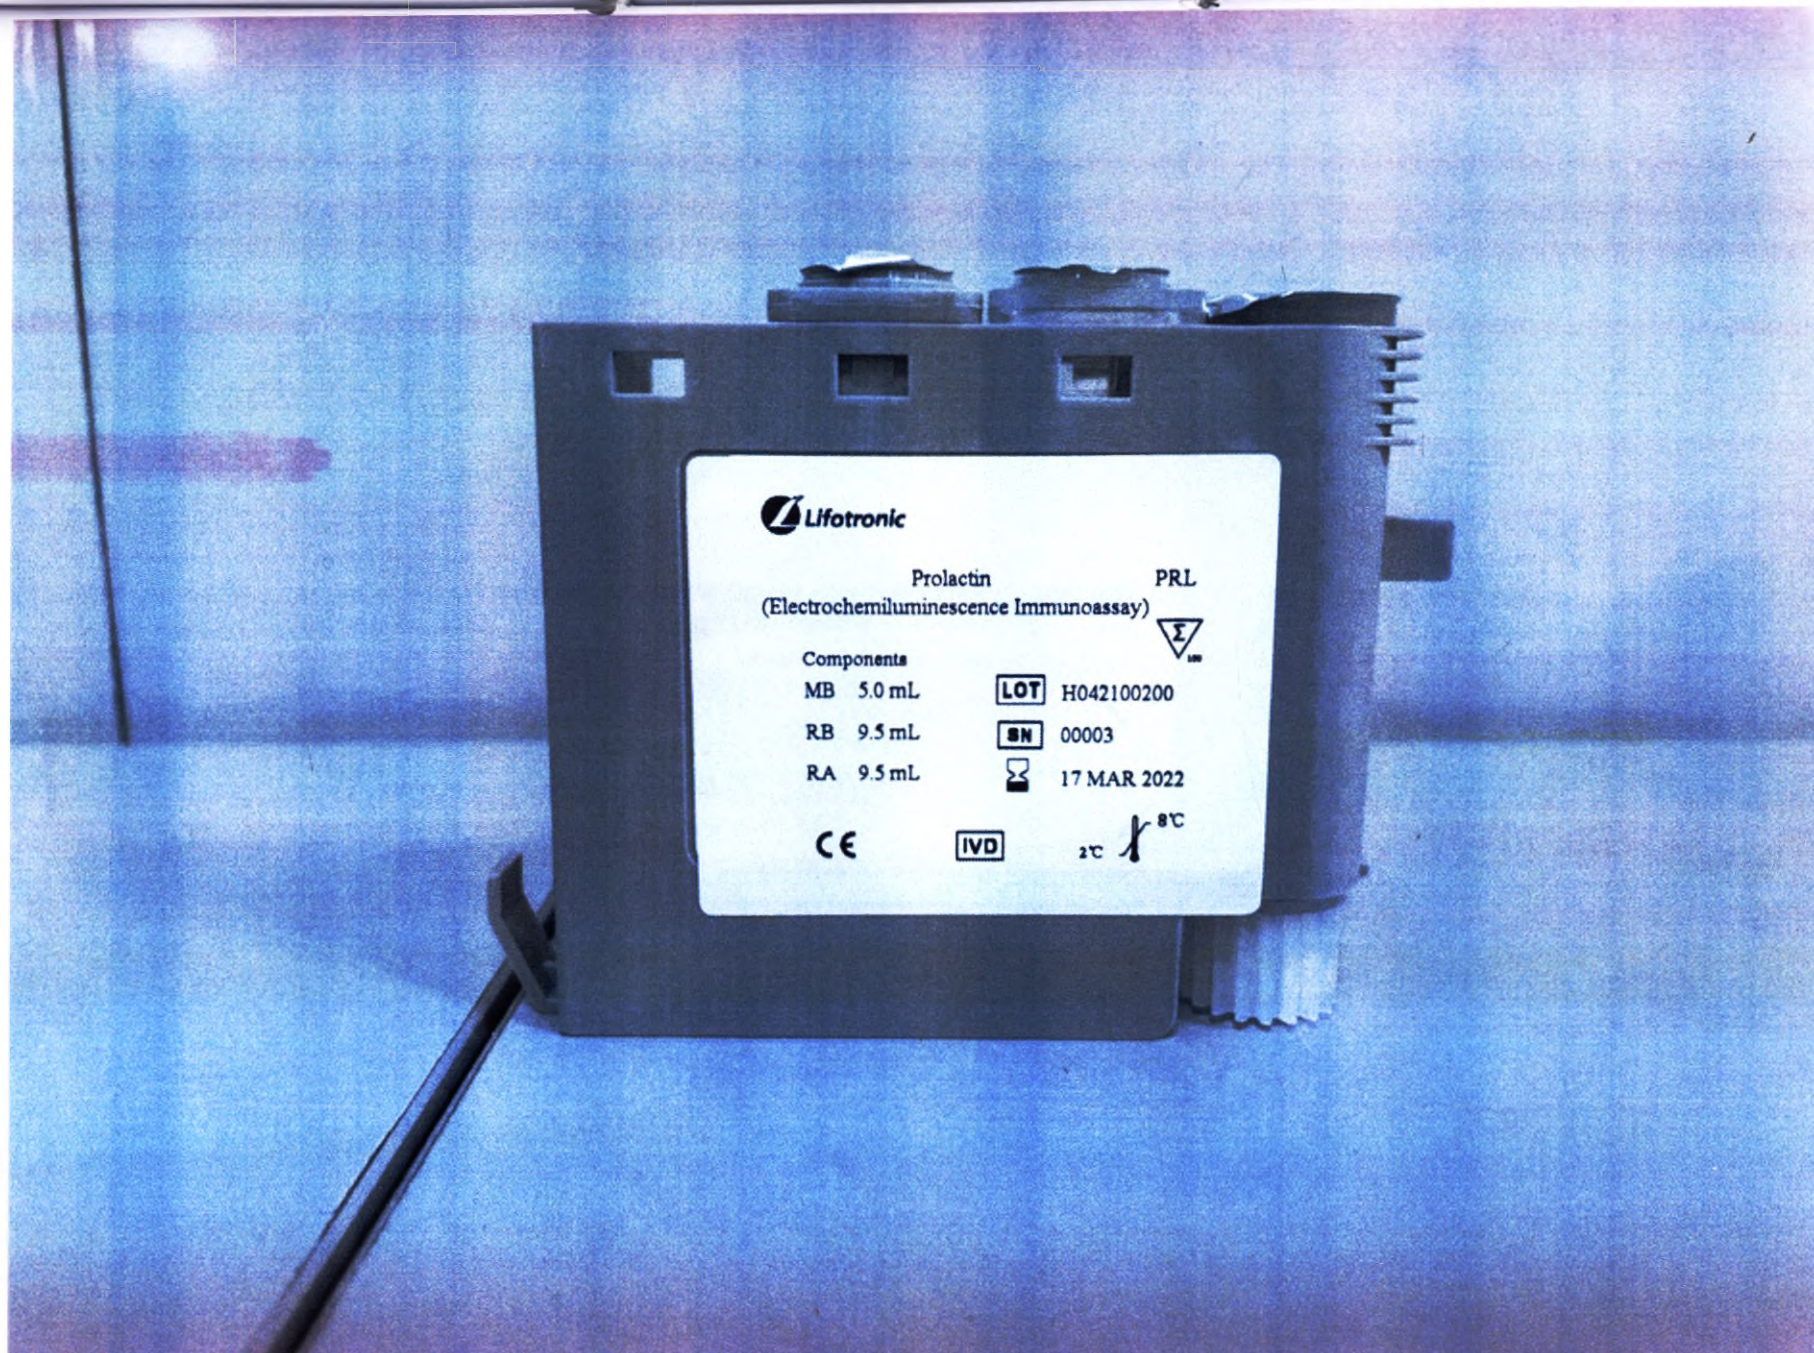


Кассета с реагентами (Набор реагентов для количественного определения пролактина электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro

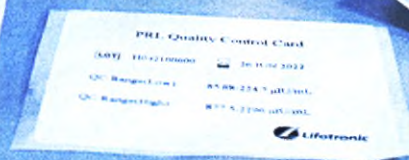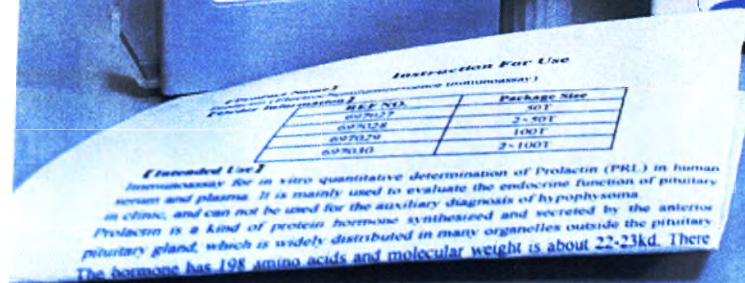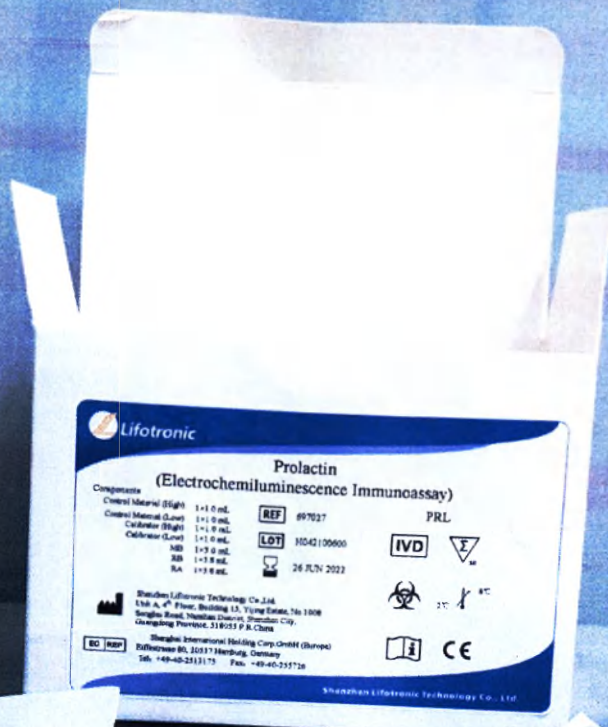




Общий вид медицинского изделия (Набор реагентов для количественного определения пролактина электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Prolactin (Electrochemiluminescence Immunoassay) / PRL), в варианте исполнения 50 тестов)

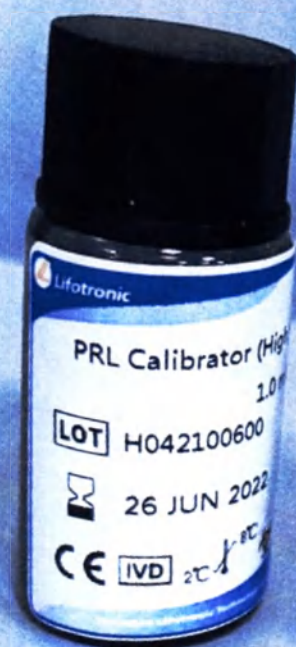



Калибратор (низкий и высокий уровень), Материал контрольный (низкий и высокий уровень) (Набор реагентов для количественного определения пролактина

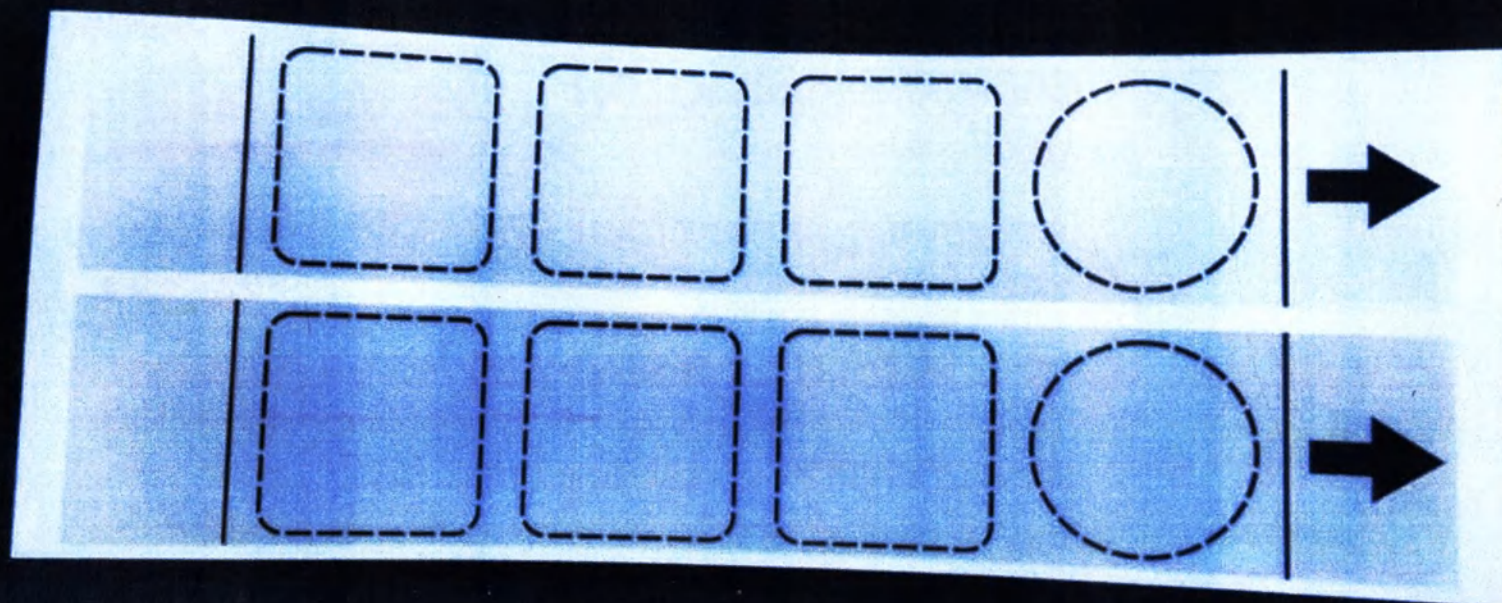

PRL Quality Control Card



H042100600



26 JUN 2022

QC Range(Low): 85.88-224.7 μ IU/mL

QC Range(High): 877.5-2296 μ IU/mL





Кассета с реагентами (Набор реагентов для количественного определения пролактина электрохемилуминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro
 ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU Prolactin (Electrochemiluminescence Immunoassay) / PRL), в варианте исполнения 50 тестов)

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 16 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А
М.П.



ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 5987789
КУСАЙЛО Р.В.