

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Компания «БиВи»»

Носова Т.А.

«*11*» *декабря* 2021 г.



ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 5987789
КУСАЙЛО Р.В.

Фотографические изображения изделия:

Набор реагентов для количественного определения общего 25-гидроксивитамина D электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro (25-OH Vitamin D Total (Electrochemiluminescence Immunoassay))

Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.
(«Шэньчжэнь Лайфотроник Технолоджи Ко., Лтд.»), Китай



Общий вид медицинского изделия (Набор реагентов для количественного определения общего 25-гидроксивитамина D электрохемилюминесцентным методом в анализаторах ECL для диагностики in vitro (25-OH Vitamin D Total (Electrochemiluminescence Immunoassay), в варианте исполнения 100 тестов)




ООО ЦИРМИ



INFO@CIRMI.RU



WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

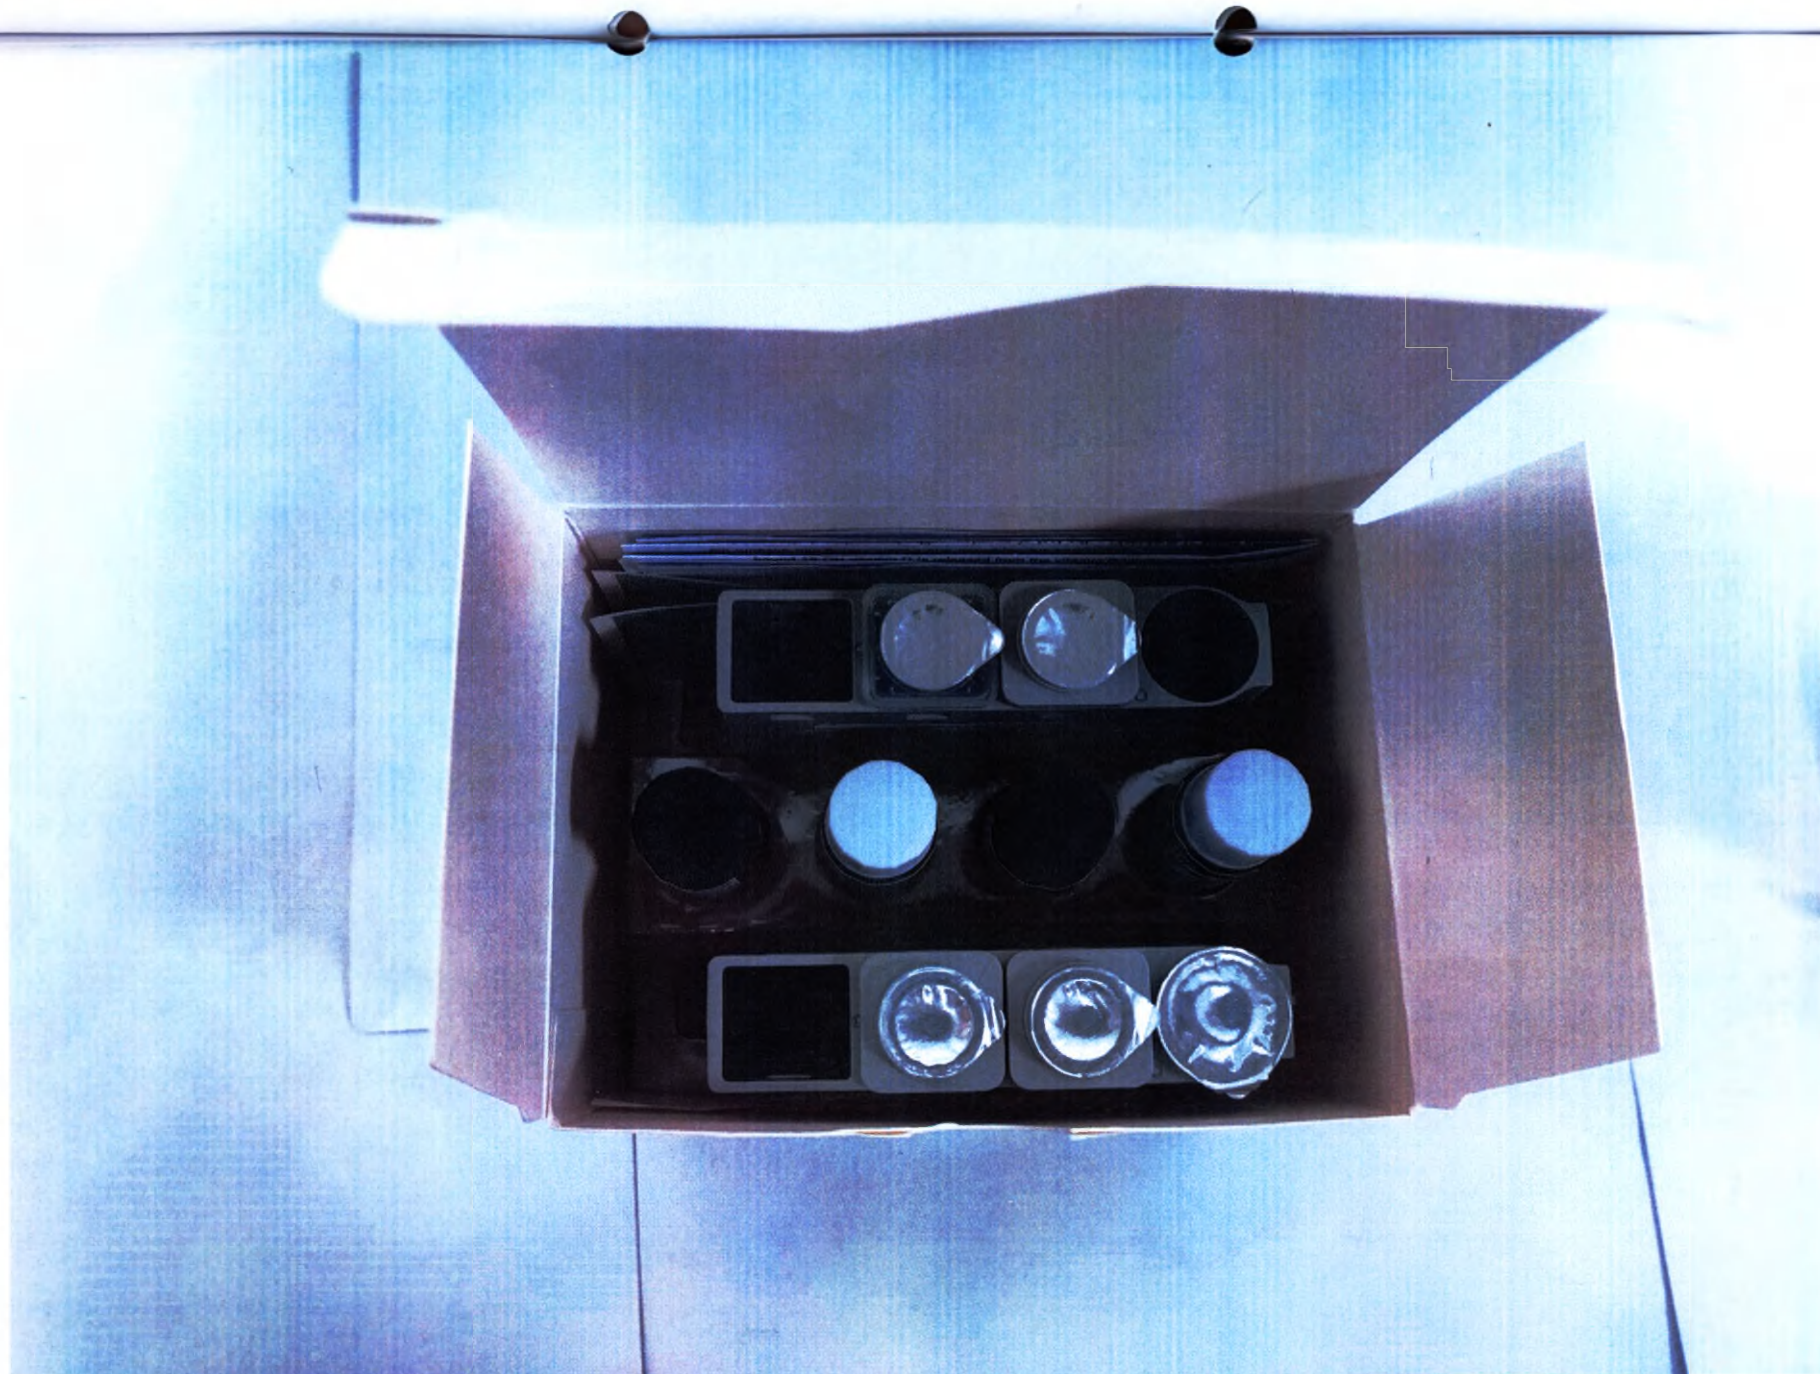

Общий вид медицинского изделия (Набор реагентов для количественного определения общего 25-гидроксивитамина D электрохемилюминесцентным методом в ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU на анализаторах ECL для диагностики in vitro (25-OH Vitamin D Total (Electrochemiluminescence Immunoassay)), в варианте исполнения 100 тестов)



Кассеты с реагентами (Набор реагентов для количественного определения общего 25-гидроксивитамина D электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или
ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU ECL для диагностики in vitro (25-OH Vitamin D Total (Electrochemiluminescence Immunoassay)), в варианте исполнения 100
тестов)




Калибратор (высокий уровень), Калибратор (низкий уровень), Материал контрольный (высокий уровень), Материал контрольный (низкий уровень) (Набор реагентов ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU 25-гидроксивитамина D электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro (25-OH Vitamin D Total (Electrochemiluminescence Immunoassay), в варианте исполнения 100 тестов)



Калибратор (высокий уровень), Калибратор (низкий уровень), Материал контрольный (высокий уровень), Материал контрольный (низкий уровень) (Набор реагентов для количественного определения содержания 25-гидроксивитамина D электрохемилуминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro (25-OH Vitamin D Total (Electrochemiluminescence Immunoassay), в варианте исполнения 100 тестов)



Калибратор (высокий уровень), Калибратор (низкий уровень), Материал контрольный (высокий уровень), Материал контрольный (низкий уровень) (Набор реагентов для количественного определения общего 25-гидроксивитамина D электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro (25-OH Vitamin D Total (Electrochemiluminescence Immunoassay), в варианте исполнения 100 тестов)

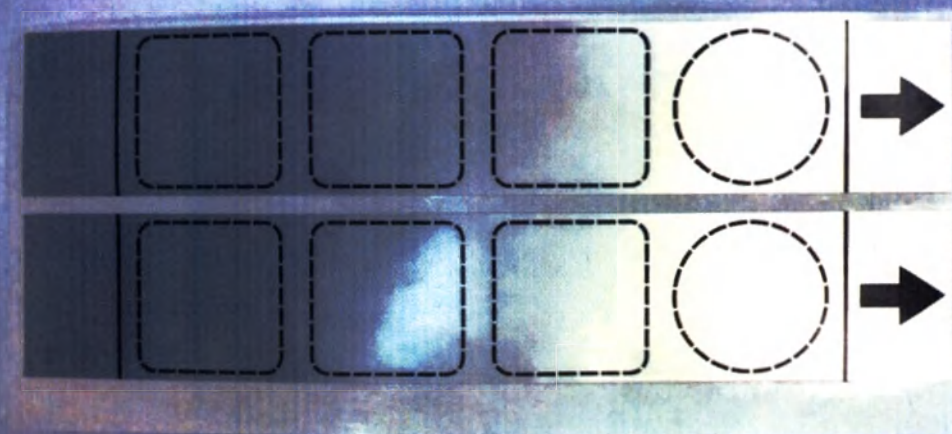

Этикетки для запечатывания флаконов (Набор реагентов для количественного определения общего 25-гидроксивитамина D электрохемилюминесцентным методом в на анализаторах ECL для диагностики in vitro (25-OH Vitamin D Total (Electrochemiluminescence Immunoassay)), в варианте исполнения 100 тестов)

25-OH VD Control Material RFID

LOT B012100300  2022-05-14

QC Range (Low): 12.06-22.44 ng/mL

QC Range (High): 27.31-50.73 ng/mL

Lifotronic

Всего прочито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 9 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А
М.П.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 5987789
КУСАНЛО Р.В.

