

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Компания «БиВи»

Т.А. Носова

«24» 12 2021 г.



ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 5987789


КУСАЙЛО Р.В.

Фотографические изображения изделия:

**Набор реагентов для количественного определения лютеинизирующего гормона
электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro
(Luteinizing Hormone (Electrochemiluminescence Immunoassay) / LH)**

**Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.
(«Шэньчжэнь Лайфотроник Технолоджи Ко., Лтд.»), Китай**



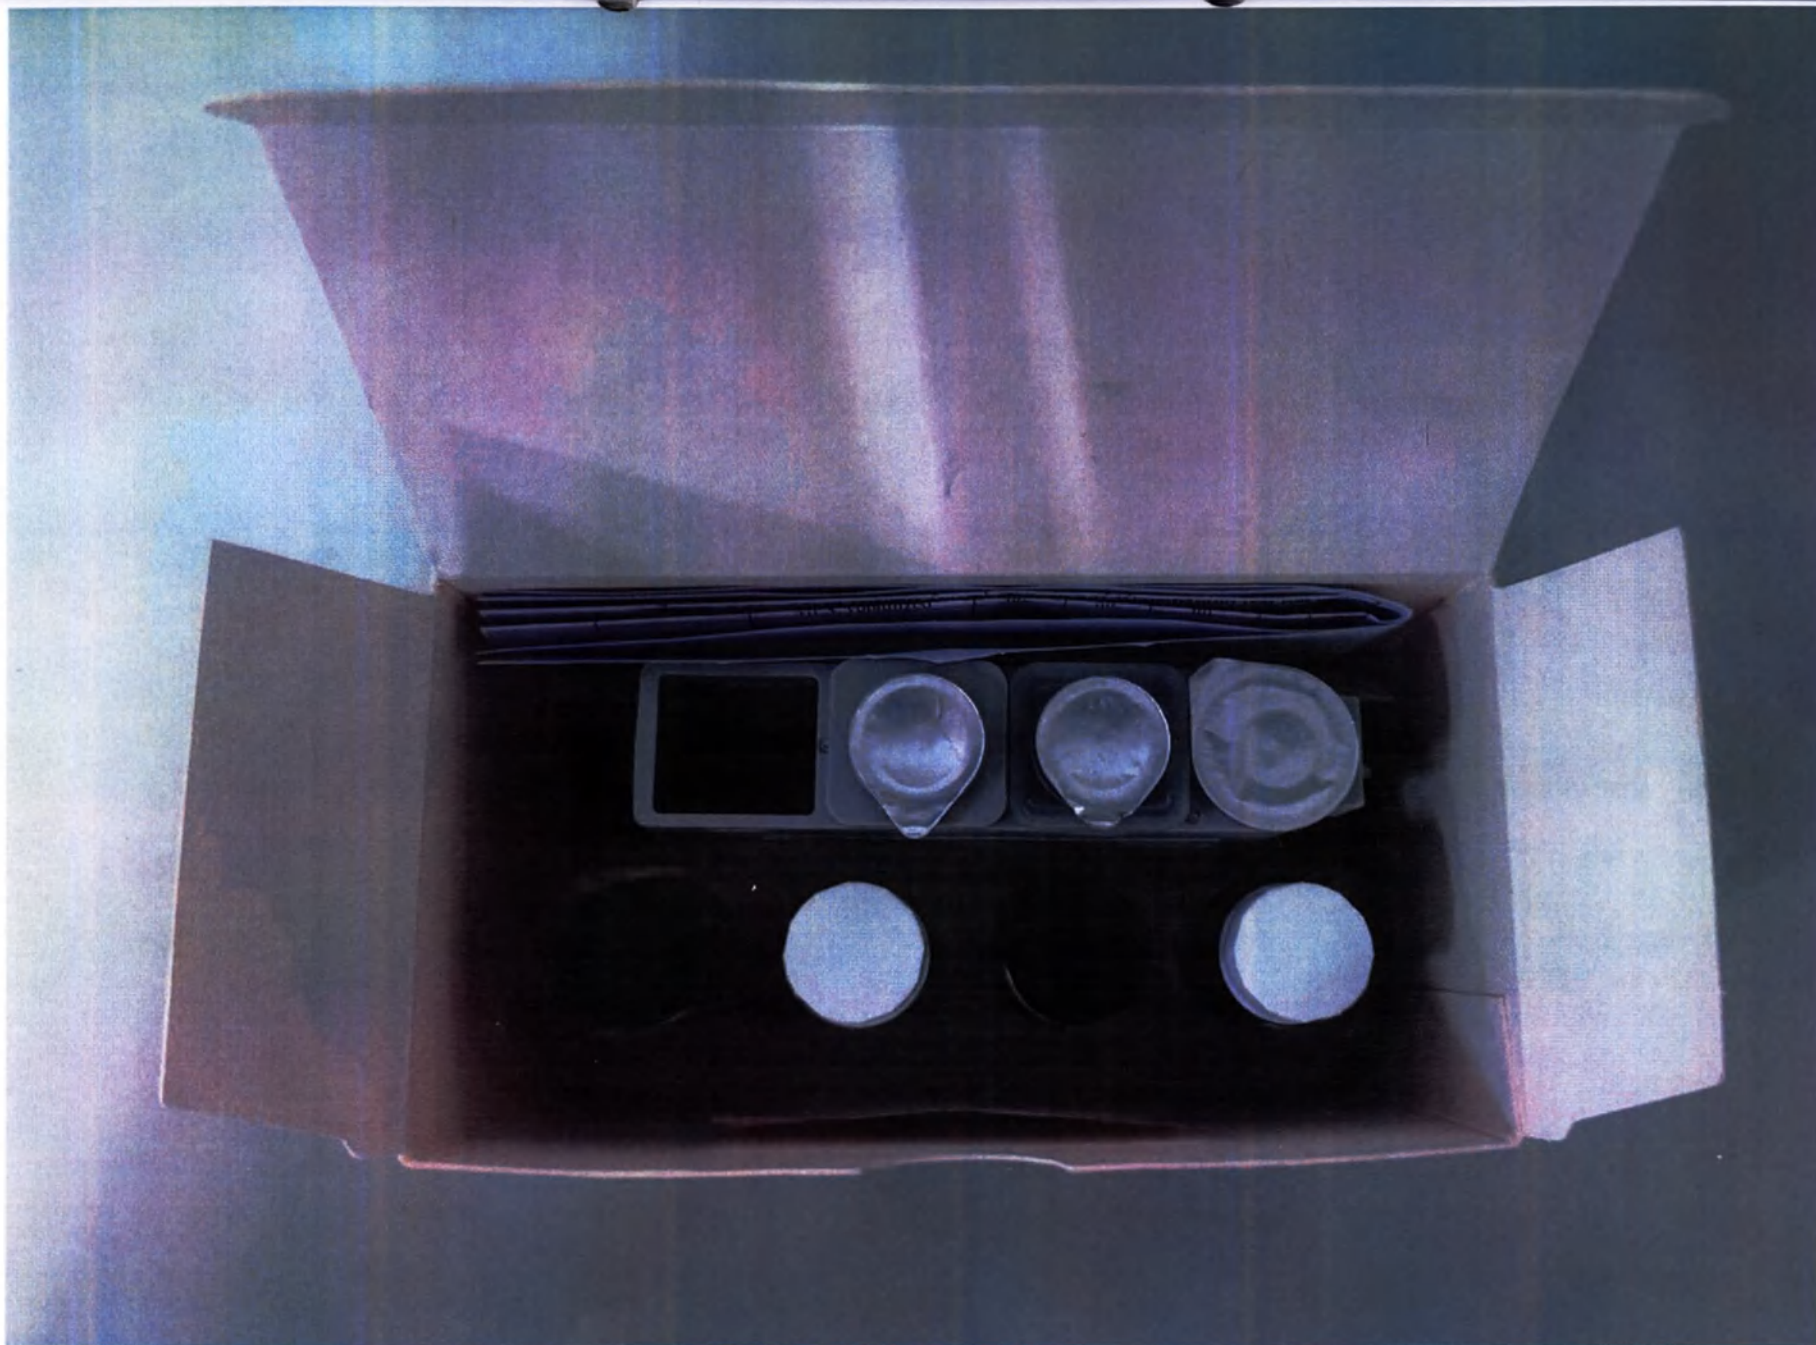

Общий вид медицинского изделия (Набор реагентов для количественного определения лютеинизирующего гормона электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для
ООО ЦРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru vitro (Luteinizing Hormone (Electrochemiluminescence Immunoassay) / LH), в варианте исполнения 100 тестов)






Калибратор (низкий и высокий уровень), Материал контрольный (низкий и высокий уровень) (Набор реагентов для количественного определения лютеинизирующего гормона


LH Quality Control Card

LOT H062100100  24 MAR 2022

QC Range(Low): 8.491-15.769 pg/mL

QC Range(High): 65.604-121.836 pg/mL





Luteinizing Hormone
(Electrochemiluminescence Immunoassay)

LH



Components

MB 5.0 mL

LOT

H062100100

RB 9.0 mL

SN

00001

RA 9.5 mL



24 MAR 2022





IVD


2°C



Кассета с реагентами (Набор реагентов для количественного определения лютеинизирующего гормона электрохемилуминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU inizing Hormone (Electrochemiluminescence Immunoassay) / LH), в варианте исполнения 100 тестов)

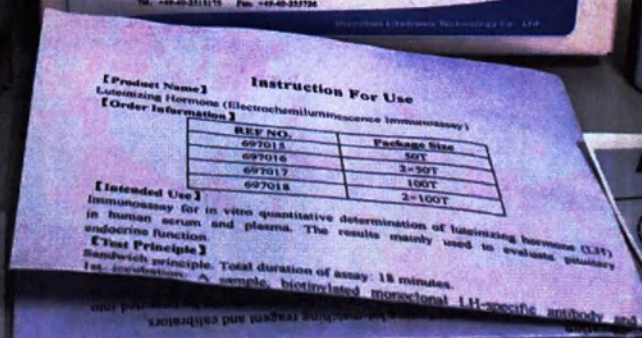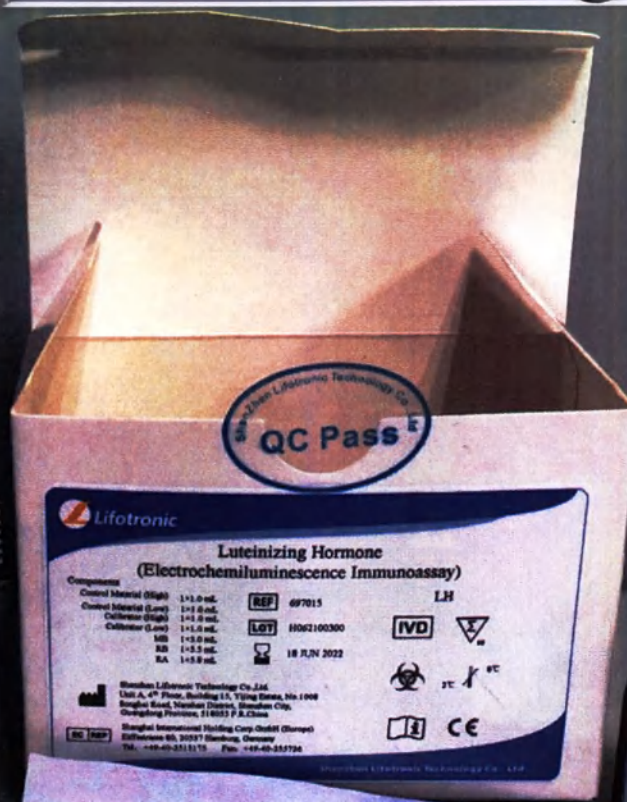

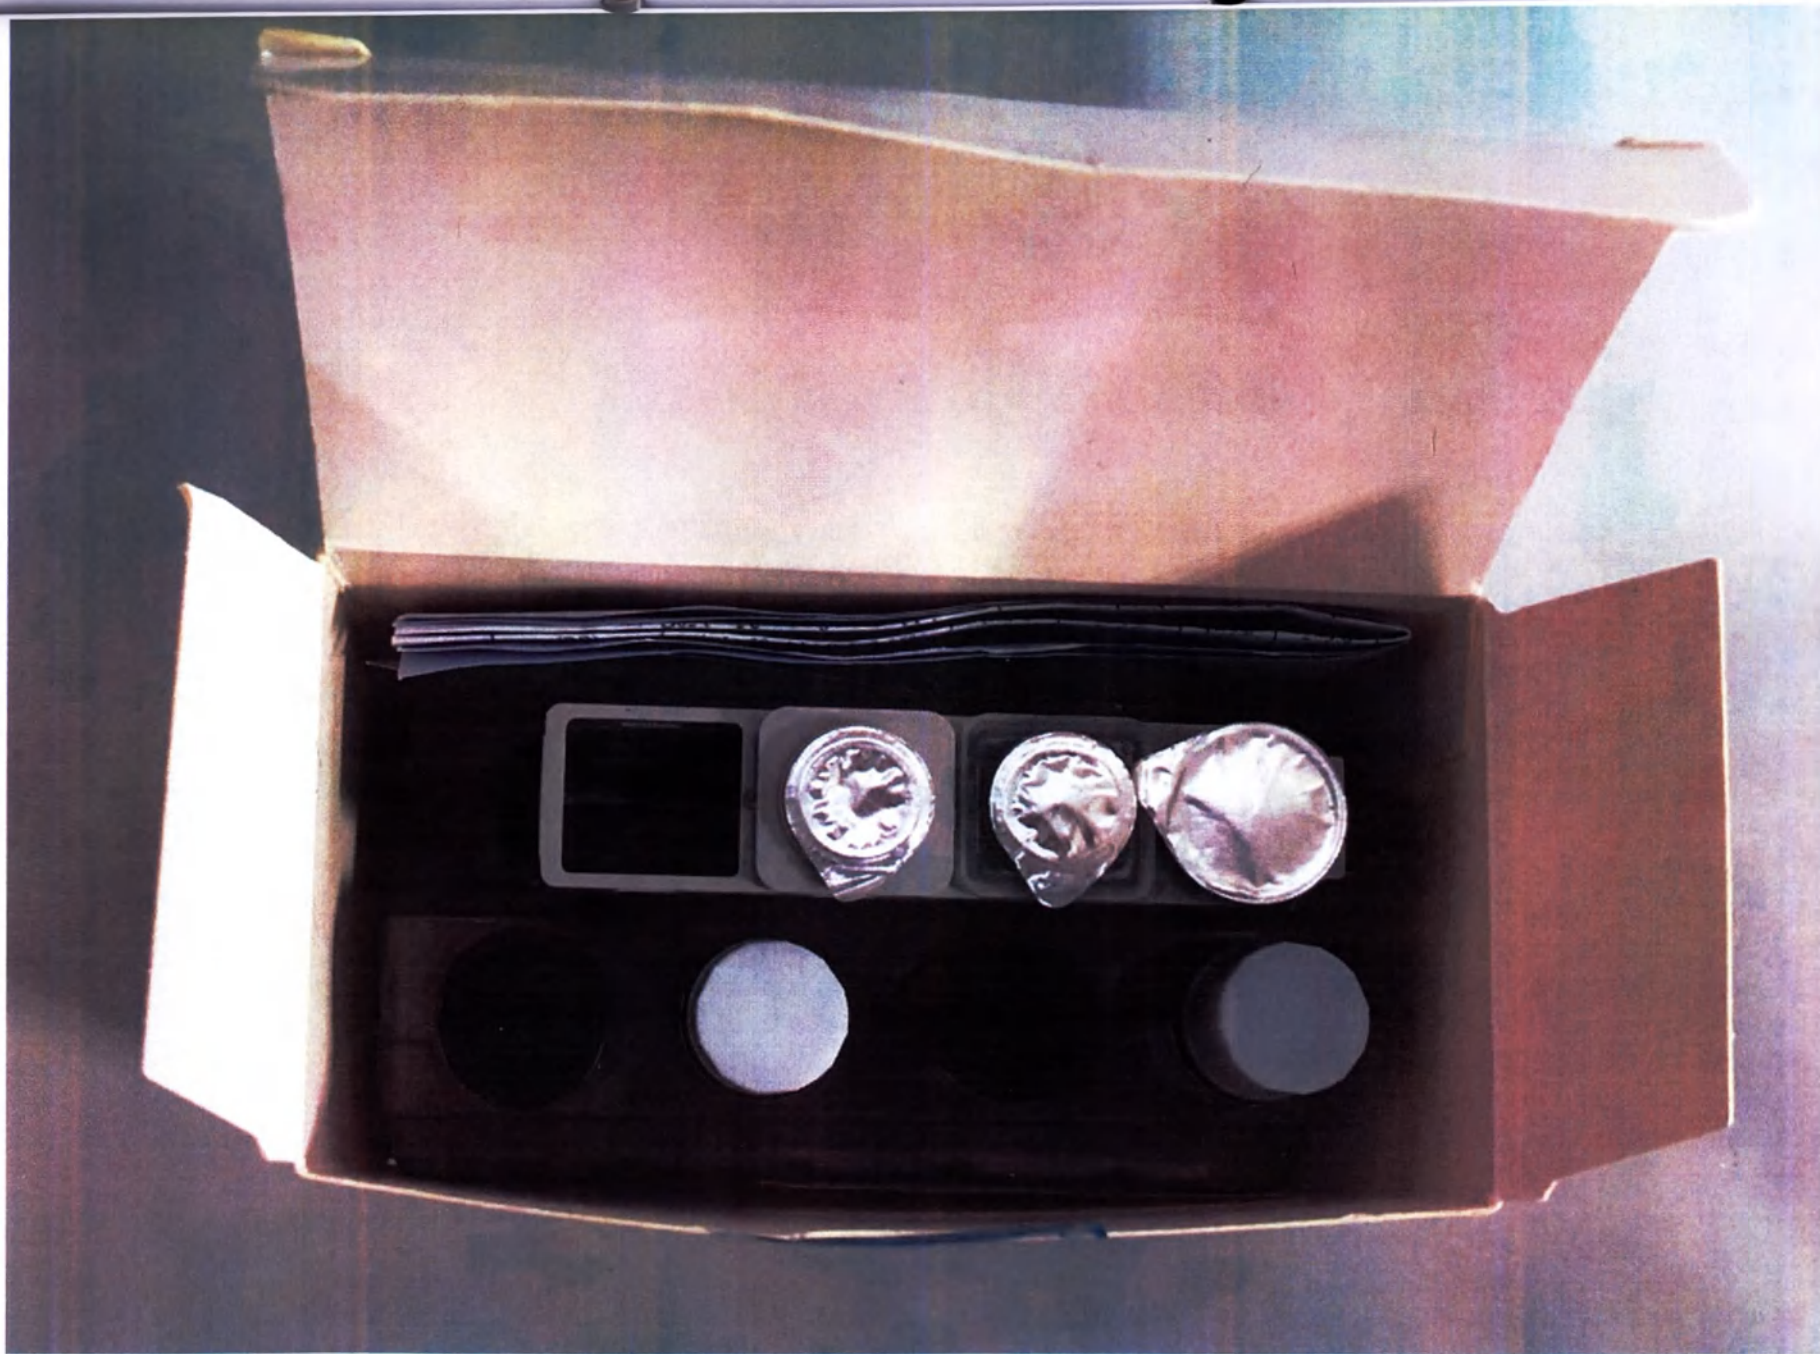


Общий вид медицинского изделия (Набор реагентов для количественного определения лютеинизирующего гормона электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU vitro (Luteinizing Hormone (Electrochemiluminescence Immunoassay) / LH), в варианте исполнения 50 тестов)





Калибратор (низкий и высокий уровень), Материал контрольный (низкий и высокий уровень) (Набор реагентов для количественного определения лютеинизирующего гормона
000 ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU изаторах ECL для диагностики in vitro (Luteinizing Hormone (Electrochemiluminescence Immunoassay) / LH), в варианте исполнения 50 тестов)

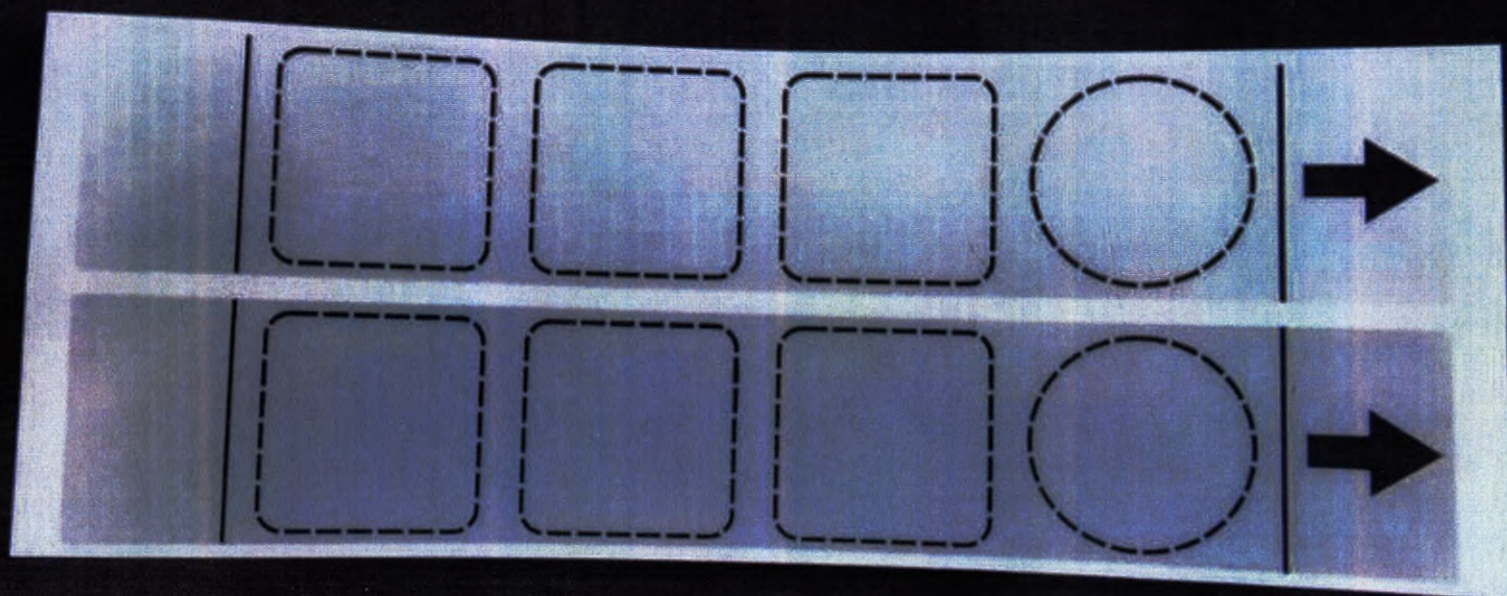

LH Quality Control Card

LOT

H062100300




18 JUN 2022

QC Range(Low): 8.491-15.77 mIU/mL

QC Range(High): 65.60-121.8 mIU/mL





Luteinizing Hormone
(Electrochemiluminescence Immunoassay)



Components

MB 3.0 mL

RB 5.5 mL

RA 5.8 mL

LOT H062100300

SN 00001

18 JUN 2022



2°C 8°C

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 15 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А.
М.П.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 5987789
КУСАЙЛО Р.В.

