

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Компания «БиВи»

Т.А. Носова

«27» сентября 2021 г.




ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 5987789

КУСАЙЛО Р.В.

Фотографические изображения изделия:

**Набор реагентов для количественного определения прогестерона
электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro
(Progesterone (Electrochemiluminescence Immunoassay) / PROG)**

«Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.»
(«Шэньчжэнь Лайфотроник Технолоджи Ко., Лтд.»), Китай

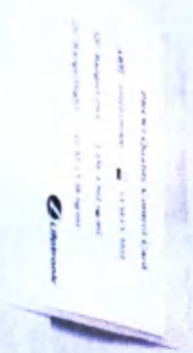


Instructions for Use

Standard Curve

Concentration (ng/mL)	Optical Density (OD)
1000	0.850
500	0.750
250	0.650
125	0.550
62.5	0.450
31.25	0.350
15.625	0.250
7.8125	0.150
3.90625	0.050

Notes:

- The standard curve should be used to determine the concentration of progesterone in the sample.
- The optical density (OD) values should be read within 10 minutes of the test.
- The sample concentration should be calculated using the standard curve.

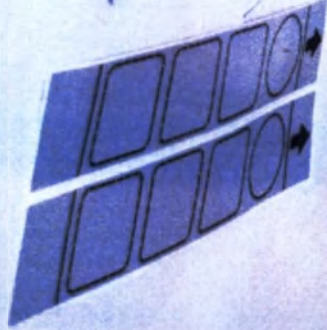





Общий вид медицинского изделия (Набор реагентов для количественного определения прогестерона электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU **in vitro (Progesterone (Electrochemiluminescence Immunoassay) / PROG), в варианте исполнения 100 тестов)**



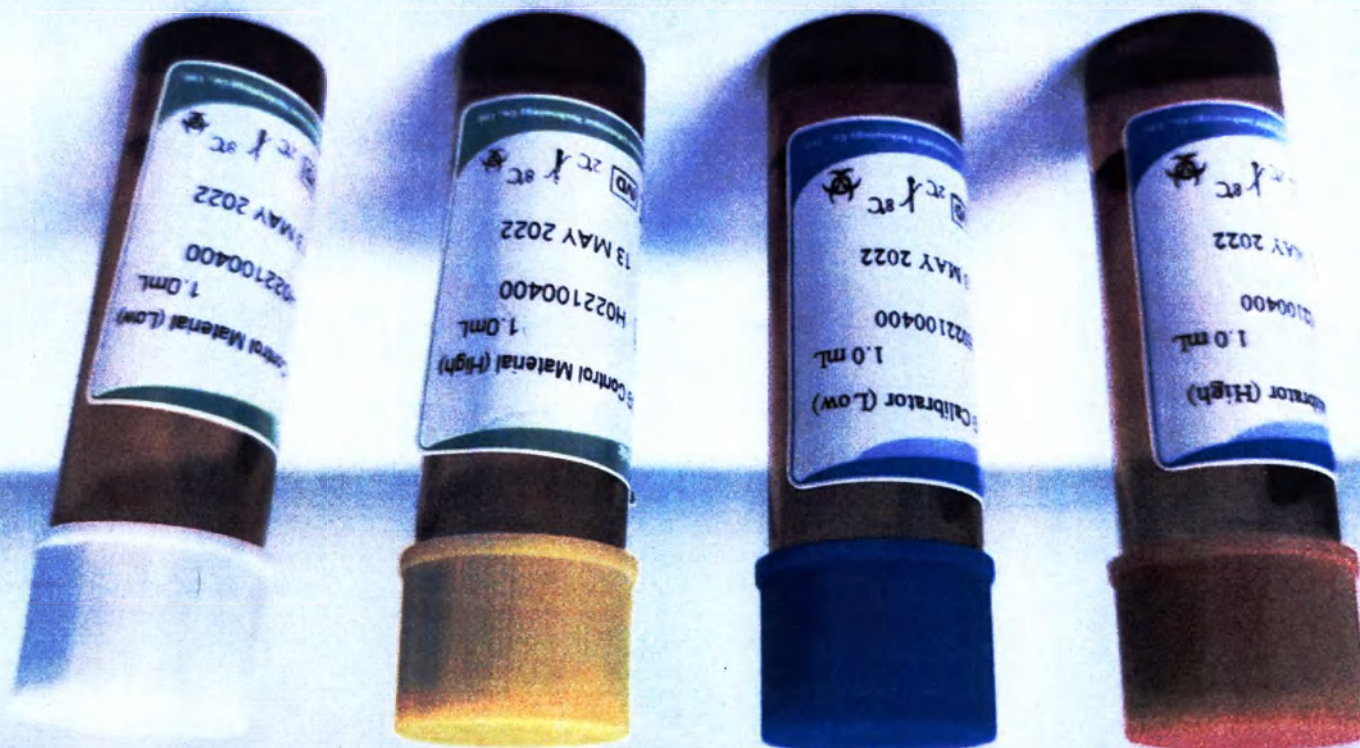

Калибратор (низкий и высокий уровень), Материал контрольный (низкий и высокий уровень) (Набор реагентов для количественного определения прогестерона электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Progesterone (Electrochemiluminescence Immunoassay) / PROG), в варианте исполнения 100 тестов)

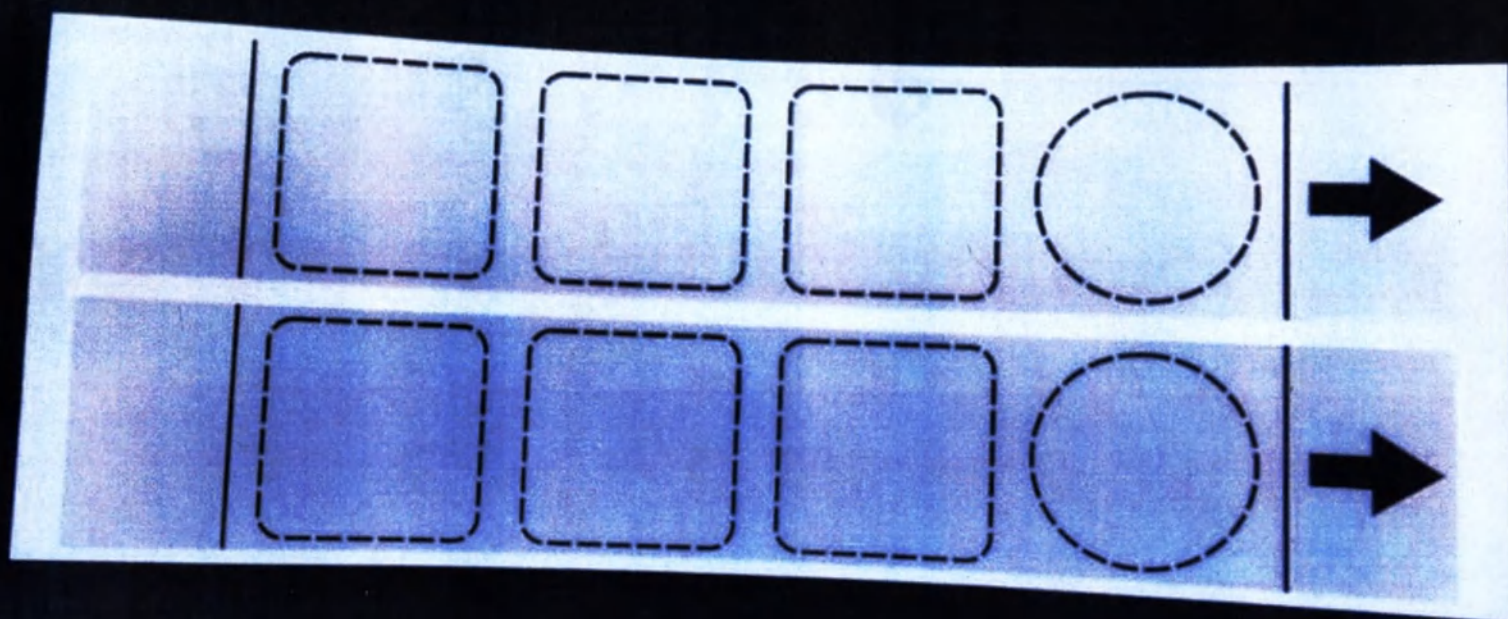

Этикетки для запечатывания флаконов (Набор реагентов для количественного определения прогестерона электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для

PROG Quality Control Card

LOT


H022100400




13 MAY 2022

QC Range(Low): 2.456-4.562 ng/mL

QC Range(High): 10.32-15.48 ng/mL



Этикетка результатов значений материалов контрольных (Набор реагентов для количественного определения прогестерона электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Progesterone (Electrochemiluminescence Immunoassay) / PROG), в варианте исполнения 100 тестов)



Progesterone
(Electrochemiluminescence Immunoassay)

PROG



Components

MB 5.0 mL

RB 9.0 mL

RA 8.0 mL

LOT H022100400





SN 00002

13 MAY 2022



20°C $\times$ 8°C



Кассета с реагентами (Набор реагентов для количественного определения прогестерона электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Progesterone (Electrochemiluminescence Immunoassay) / PROG), в варианте исполнения 100 тестов)

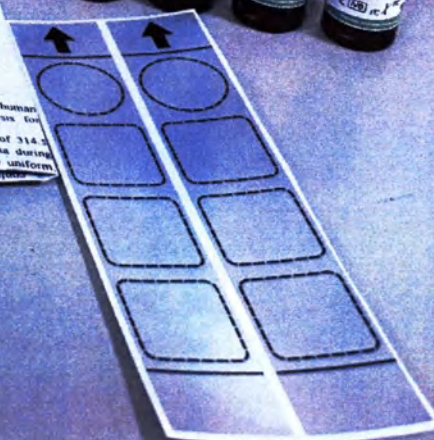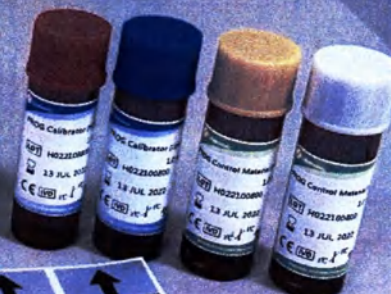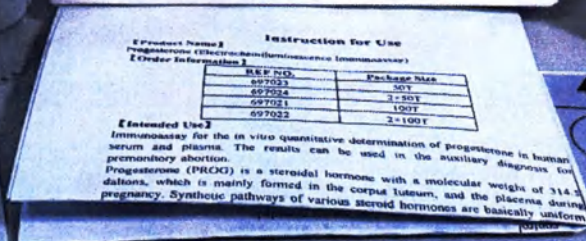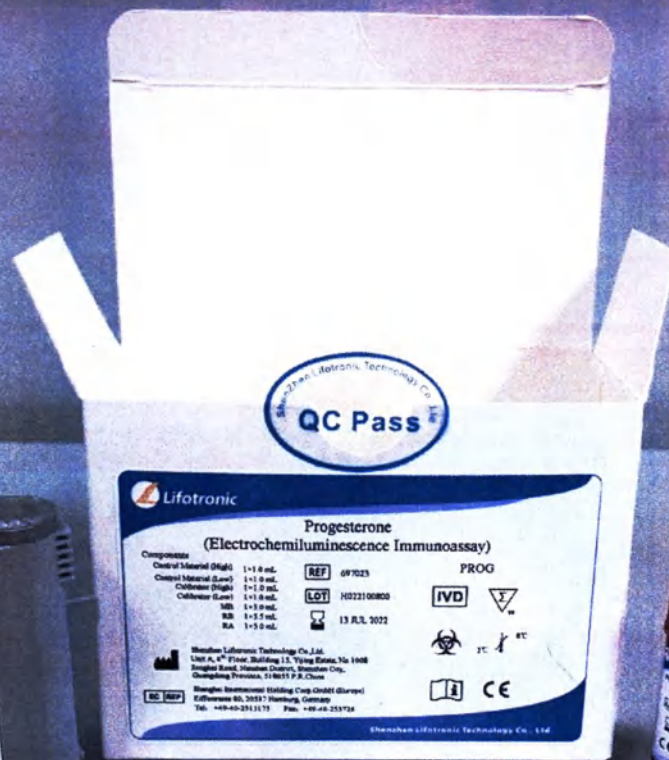




Общий вид медицинского изделия (Набор реагентов для количественного определения прогестерона электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для
ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU in vitro (Progesterone (Electrochemiluminescence Immunoassay) / PROG), в варианте исполнения 50 тестов)



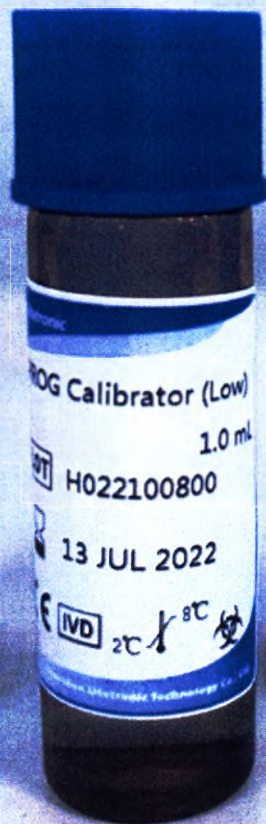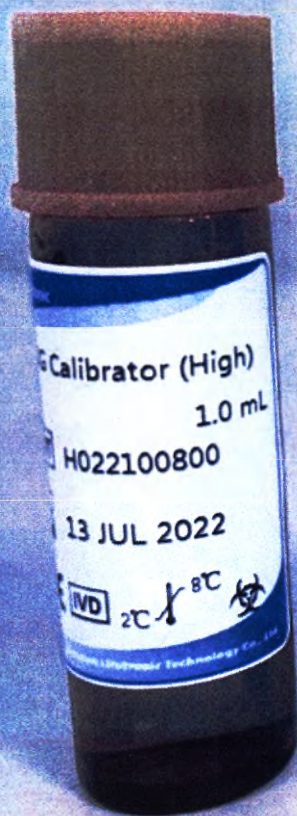

Калибратор (низкий и высокий уровень), Материал контрольный (низкий и высокий уровень) (Набор реагентов для количественного определения прогестерона электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Progesterone (Electrochemiluminescence Immunoassay) / PROG), в варианте исполнения 50 тестов)

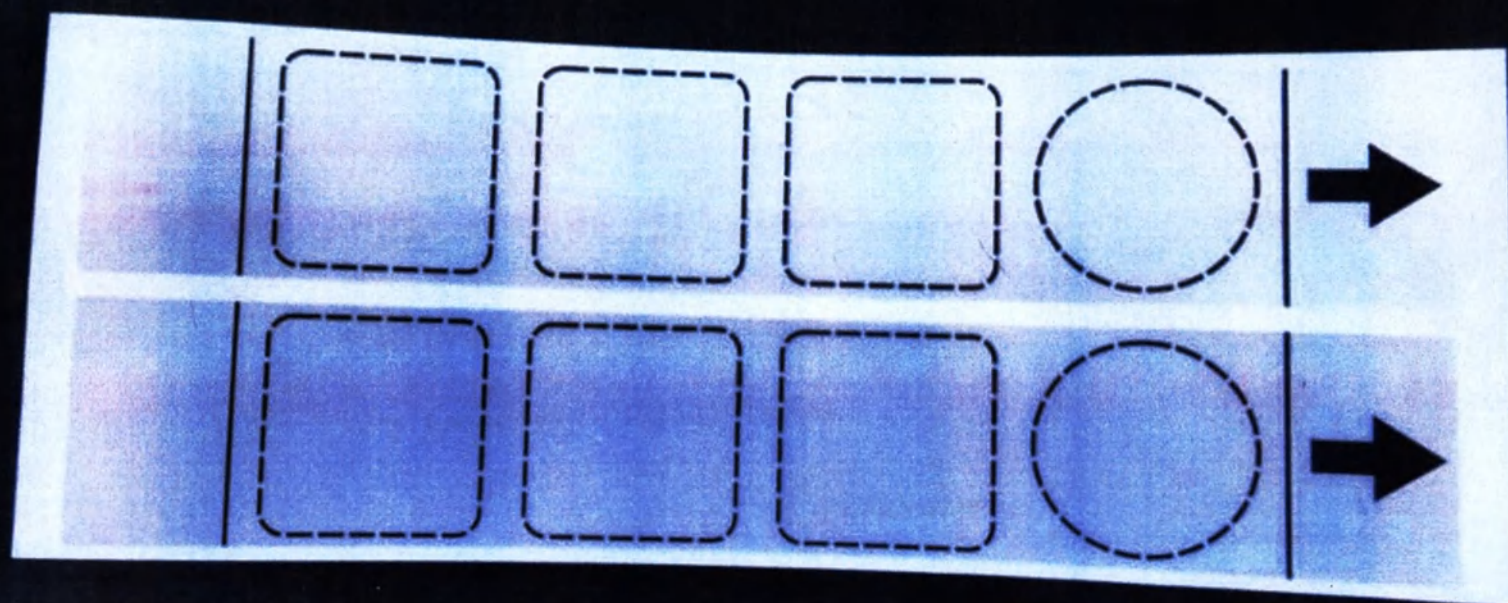

PROG Quality Control Card

LOT


H022100800



13 JUL 2022

QC Range(Low): 2.440-4.534 ng/mL

QC Range(High): 10.25-15.41 ng/mL





Кассета с реагентами (Набор реагентов для количественного определения прогестерона электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro

000 ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU Progesterone (Electrochemiluminescence Immunoassay) / PROG), в варианте исполнения 50 тестов)

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 18 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А
М.П.



ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 5987789
КУСАЙЛО Р.В.