



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 11 марта 2022 года № РЗН 2021/13614

На медицинское изделие

Система изделий протетических к имплантату стоматологическому BEGO Semados® вариантов исполнения S-Line, RI-Line, Mini-Line, RSX-Line, RS-Line, SC-Line, SCX-Line, PI-Line

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"БЕГО Имплант Системс ГмбХ энд Ко. КГ", Германия,  
BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG, Wilhelm-Herbst-Str. 1, 28359 Bremen,  
Germany

Производитель

"БЕГО Имплант Системс ГмбХ энд Ко. КГ", Германия,  
BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG, Wilhelm-Herbst-Str. 1, 28359 Bremen,  
Germany

Место производства медицинского изделия

см. приложение

Номер регистрационного досье № РД-48003/12161 от 24.02.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности 32.50.22.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 18 листах

приказом Росздравнадзора от 11 марта 2022 года № 1792  
допущено к обращению на территории Российской Федерации  
Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0060045

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 11 марта 2022 года

№ РЗН 2021/13614

Лист 1

На медицинское изделие

**Система изделий протетических к имплантату стоматологическому BEGO Semados® вариантов исполнения S-Line, RI-Line, Mini-Line, RSX-Line, RS-Line, SC-Line, SCX-Line, PI-Line:**

1. Формирователь десны Ø6.0 S 3.25-5.5/RI 3.75-5.5 L3.
2. Формирователь десны Ø6.0 S 3.25-5.5/RI 3.75-5.5 L5.
3. Формирователь десны Ø6.0 S 3.25-5.5/RI 3.75-5.5 L7.
4. Формирователь десны конический (грибовидная форма) S 3.25-3.75/RI 3.75 L5.
5. Формирователь десны конический (грибовидная форма) S/RI 4.1 L5.
6. Формирователь десны PS HP Ø3.0 L 3.
7. Формирователь десны PS HP Ø3.0 L 5.
8. Формирователь десны PS HP Ø3.0 L 7.
9. Формирователь десны PS HP Ø4.0 L 3.
10. Формирователь десны PS HP Ø4.0 L 5.
11. Формирователь десны PS HP Ø4.0 L 7.
12. Формирователь десны PS HP Ø4.5 L 3.
13. Формирователь десны PS HP Ø4.5 L 5.
14. Формирователь десны PS HP Ø5.0 L 3.
15. Формирователь десны PS HP Ø5.0 L 5.
16. Формирователь десны PS HP Ø5.5 L 3.
17. Формирователь десны PS HP Ø5.5 L 5.
18. Формирователь десны PS HP Ø6.5 L 3.
19. Формирователь десны PS HP Ø6.5 L 5.
20. Формирователь десны PS HP Ø4.5 L 7.
21. Формирователь десны PS HP Ø5.0 L 7.
22. Формирователь десны PS HP Ø5.5 L 7.
23. Формирователь десны PS HP Ø6.5 L 7.
24. Формирователь десны широкий PS HPW Ø5.5 L 3.
25. Формирователь десны широкий PS HPW Ø6.0 L 3.
26. Формирователь десны широкий PS HPW Ø6.5 L 3.
27. Формирователь десны широкий PS HPW Ø6.5 L 5.
28. Формирователь десны широкий PS HPW Ø5.5 L 5.
29. Формирователь десны широкий PS HPW Ø5.5 L 7.
30. Формирователь десны широкий PS HPW Ø6.0 L 7.
31. Формирователь десны широкий PS HPW Ø6.5 L 7.
32. Формирователь десны широкий PS HPW Ø6.5 L 5.

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**



0098611

## ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ


от 11 марта 2022 года

№ РЗН 2021/13614

Лист 2

33. Формирователь десны широкий PS HPW Ø6.5 L 7.
34. Формирователь десны широкий PS HPW Ø7.0 L 5.
35. Формирователь десны широкий PS HPW Ø7.0 L 7.
36. Винт-заглушка имплантата 3.0.
37. Винт-заглушка имплантата 3.25.
38. Винт-заглушка имплантата 3.75.
39. Винт-заглушка имплантата 4.1.
40. Винт-заглушка имплантата 4.5.
41. Винт-заглушка имплантата 5.5.
42. Колпачок заживляющий Multi<sup>Plus</sup> L5.
43. Колпачок заживляющий Mushroom Multi<sup>Plus</sup> L5.
44. Колпачок многофункциональный PI.
45. Колпачок многофункциональный PI - 5 шт./уп.
46. Колпачок защитный PI - 5 шт./уп.
47. Абатмент временный Sub-Tec S 3.25-3.75/RI 3.75 в комплекте с винтом техническим L9 и винтом клиническим шестигранным 1.25 мм.
48. Абатмент временный Sub-Tec S/RI 4.1-4.5 в комплекте с винтом техническим L9 и винтом клиническим шестигранным 1.25 мм.
49. Абатмент временный PS PPA 3.25-3.75 в комплекте с винтом техническим L9 и винтом клиническим шестигранным 1.25 мм.
50. Абатмент временный PS PPA 4.1 в комплекте с винтом техническим L9 и винтом клиническим шестигранным 1.25 мм.
51. Абатмент временный PS PPA 4.5 в комплекте с винтом техническим L9 и винтом клиническим шестигранным 1.25 мм.
52. Абатмент временный PS PPA 5.5 в комплекте с винтом техническим L9 и винтом клиническим шестигранным 1.25 мм.
53. Абатмент временный PS TPA 3.25-3.75 в комплекте с винтом техническим L9 и винтом клиническим шестигранным 1.25 мм.
54. Абатмент временный PS TPA 4.1 в комплекте с винтом техническим L9 и винтом клиническим шестигранным 1.25 мм.
55. Абатмент временный PS TPA 4.5 в комплекте с винтом техническим L9 и винтом клиническим шестигранным 1.25 мм.
56. Абатмент временный титановый без шестигранника Sub-Tec S 3.25-3.75/RI 3.75 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
57. Абатмент временный титановый без шестигранника Sub-Tec S/RI 4.1 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

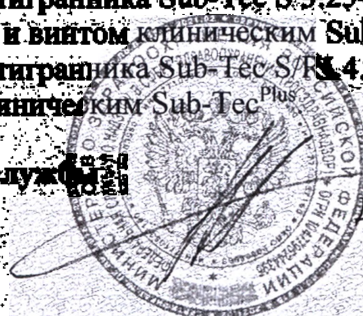

Д.Ю. Павлюков

0098612

**„ ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 11 марта 2022 года

№ РЗН 2021/13614

Лист 3

58. Абатмент временный титановый без шестигранника Sub-Tec S/RI 4.5 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
59. Абатмент временный титановый без шестигранника Sub-Tec S/RI 5.5 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
60. Абатмент временный титановый Sub-Tec S 3.25-3.75/RI 3.75 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
61. Абатмент временный титановый Sub-Tec S/RI 4.1 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
62. Абатмент временный титановый Sub-Tec S/RI 4.5 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
63. Абатмент временный титановый Sub-Tec S/RI 5.5 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
64. Абатмент временный титановый для немедленной нагрузки Sub-Tec S 3.25-3.75/RI 3.75.
65. Абатмент временный титановый для немедленной нагрузки Sub-Tec S/RI 4.1.
66. Абатмент временный титановый для немедленной нагрузки Sub-Tec S/RI 4.5.
67. Абатмент временный титановый для немедленной нагрузки PS ITA 3.0.
68. Абатмент временный титановый для немедленной нагрузки PS ITA 3.25-3.75.
69. Абатмент временный титановый для немедленной нагрузки PS ITA 4.1.
70. Абатмент временный титановый для немедленной нагрузки PS ITA 4.5.
71. Абатмент временный титановый PS TTiA 3.25-3.75 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
72. Абатмент временный титановый PS TTiA 4.1 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
73. Абатмент временный титановый PS TTiA 4.5 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
74. Абатмент временный титановый PS TTiA 5.5 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
75. Абатмент временный титановый без шестигранника PS TTiA NH 3.25-3.75 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
76. Абатмент временный титановый без шестигранника PS TTiA NH 4.1 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
77. Абатмент временный титановый без шестигранника PS TTiA NH 4.5 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
78. Абатмент временный титановый без шестигранника PS TTiA NH 5.5 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0098613

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 11 марта 2022 года


№ РЗН 2021/13614

Лист 4

79. Абатмент керамический BeCe Sub-Tec<sup>Plus</sup> S 3.25-3.75/RI 3.75 с основой для склеивания в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
80. Абатмент керамический BeCe Sub-Tec<sup>Plus</sup> S/RI 4.1 с основой для склеивания в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
81. Абатмент керамический BeCe Sub-Tec<sup>Plus</sup> S/RI 4.5 с основой для склеивания в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
82. Абатмент керамический BeCe Sub-Tec<sup>Plus</sup> S/RI 5.5 с основой для склеивания в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
83. Абатмент керамический PS CA 3.25-3.75 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим для керамического абатмента.
84. Абатмент керамический PS CA 4.1 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим для керамического абатмента.
85. Абатмент керамический PS CA 4.5 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим для керамического абатмента.
86. Абатмент керамический PS CA 5.5 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим для керамического абатмента.
87. Абатмент керамический PS CATi 3.25-3.75 с основой для склеивания в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
88. Абатмент керамический PS CATi 4.1 с основой для склеивания в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
89. Абатмент керамический PS CATi 4.5 с основой для склеивания в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
90. Абатмент керамический PS CATi 5.5 с основой для склеивания в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
91. Абатмент цельный титановый PS TiA 3.25-3.75 GH 1-2 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
92. Абатмент цельный титановый PS TiA 3.25-3.75 GH 2.5-4 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
93. Абатмент цельный титановый PS TiA 4.1 GH 1-2 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
94. Абатмент цельный титановый PS TiA 4.1 GH 2.5-4 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
95. Абатмент цельный титановый PS TiA 4.5 GH 1-2 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
96. Абатмент цельный титановый PS TiA 4.5 GH 2.5-4 в комплекте с винтом

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

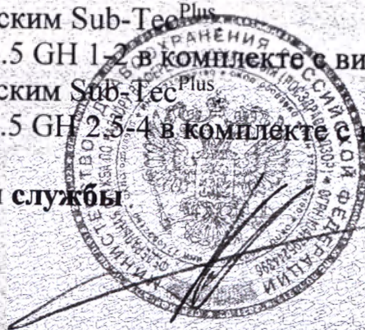

0098614

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 11 марта 2022 года


№ РЗН 2021/13614

Лист 5

- техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
97. Абатмент цельный титановый PS TiA 5.5 GH 1-2 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
98. Абатмент цельный титановый PS TiA 5.5 GH 2.5-4 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
99. Абатмент цельный титановый PS TiAA 3.25-3.75 15° P GH 1-2 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
100. Абатмент цельный титановый PS TiAA 3.25-3.75 15° P GH 2.5-4 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
101. Абатмент цельный титановый PS TiAA 3.25-3.75 15° E GH 1-2 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
102. Абатмент цельный титановый PS TiAA 3.25-3.75 15° E GH 2.5-4 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
103. Абатмент цельный титановый PS TiAA 4.1 15° P GH 1-2 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
104. Абатмент цельный титановый PS TiAA 4.1 15° P GH 2.5-4 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
105. Абатмент цельный титановый PS TiAA 4.1 15° E GH 1-2 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
106. Абатмент цельный титановый PS TiAA 4.1 15° E GH 2.5-4 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
107. Абатмент цельный титановый PS TiAA 4.5 15° P GH 1-2 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
108. Абатмент цельный титановый PS TiAA 4.5 15° P GH 2.5-4 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
109. Абатмент цельный титановый PS TiAA 4.5 15° E GH 1-2 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
110. Абатмент цельный титановый PS TiAA 4.5 15° E GH 2.5-4 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
111. Абатмент цельный титановый PS TiAA 5.5 15° P GH 1-2 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
112. Абатмент цельный титановый PS TiAA 5.5 15° P GH 2.5-4 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
113. Абатмент цельный титановый PS TiAA 5.5 15° E GH 1-2 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
114. Абатмент цельный титановый PS TiAA 5.5 15° E GH 2.5-4 в комплекте с винтом

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

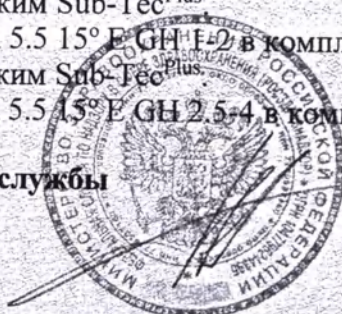

0098615

## ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ


от 11 марта 2022 года

№ РЗН 2021/13614

Лист 6

- техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
115. Абатмент цельный титановый PS TiAA 3.25-3.75 20° P GH 1-2 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
116. Абатмент цельный титановый PS TiAA 3.25-3.75 20° P GH 2.5-4 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
117. Абатмент цельный титановый PS TiAA 3.25-3.75 20° E GH 1-2 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
118. Абатмент цельный титановый PS TiAA 3.25-3.75 20° E GH 2.5-4 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
119. Абатмент цельный титановый PS TiAA 4.1 20° P GH 1-2 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
120. Абатмент цельный титановый PS TiAA 4.1 20° P GH 2.5-4 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
121. Абатмент цельный титановый PS TiAA 4.1 20° E GH 1-2 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
122. Абатмент цельный титановый PS TiAA 4.1 20° E GH 2.5-4 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
123. Абатмент цельный титановый PS TiAA 4.5 20° P GH 1-2 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
124. Абатмент цельный титановый PS TiAA 4.5 20° P GH 2.5-4 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
125. Абатмент цельный титановый PS TiAA 4.5 20° E GH 1-2 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
126. Абатмент цельный титановый PS TiAA 4.5 20° E GH 2.5-4 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
127. Абатмент цельный титановый PS TiAA 5.5 20° P GH 1-2 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
128. Абатмент цельный титановый PS TiAA 5.5 20° P GH 2.5-4 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
129. Абатмент цельный титановый PS TiAA 5.5 20° E GH 1-2 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
130. Абатмент цельный титановый PS TiAA 5.5 20° E GH 2.5-4 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
131. Абатмент цельный титановый PS TiA 3.25-3.75 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
132. Абатмент цельный титановый PS TiA 4.1 в комплекте с винтом техническим Sub-

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

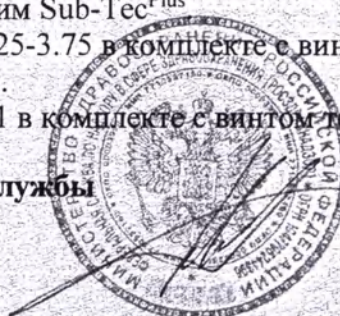

Д.Ю. Павлюков

0098616

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 11 марта 2022 года

№ РЗН 2021/13614

Лист 7

Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.

133. Абатмент цельный титановый PS TiA 4.5 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.

134. Абатмент цельный титановый PS TiA 5.5 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.

135. Абатмент цельный титановый PS TiA 3.0 в комплекте с винтом техническим TScrew и винтом клиническим PScrew.

136. Абатмент цельный титановый PS TiAA 3.0 15° P GH 2.5-4 в комплекте с винтом техническим TScrew и винтом клиническим PScrew.

137. Абатмент цельный титановый PS TiAA 3.0 15° E GH 2.5-4 в комплекте с винтом техническим TScrew и винтом клиническим PScrew.

138. Абатмент цельный титановый Mini TiA в комплекте с винтом техническим Mini и винтом клиническим Mini.

139. Абатмент Sub-Tec Easy-Con S/RI/RS/R SX 3.75-4.1 L1.

140. Абатмент Sub-Tec Easy-Con S/RI/RS/R SX 3.75-4.1 L2.

141. Абатмент Sub-Tec Easy-Con S/RI/RS/R SX 3.75-4.1 L3.

142. Абатмент Sub-Tec Easy-Con S/RI/RS/R SX 3.75-4.1 L4.

143. Абатмент Sub-Tec Easy-Con S/RI/RS/R SX 4.5 L1.

144. Абатмент Sub-Tec Easy-Con S/RI/RS/R SX 4.5 L2.

145. Абатмент Sub-Tec Easy-Con S/RI/RS/R SX 4.5 L3.

146. Абатмент Sub-Tec Easy-Con S/RI/RS/R SX 4.5 L4.

147. Абатмент PS Easy-Con 3.75 L1.

148. Абатмент PS Easy-Con 3.75 L2.

149. Абатмент PS Easy-Con 3.75 L3.

150. Абатмент PS Easy-Con 3.75 L4.

151. Абатмент PS Easy-Con 4.1 L1.

152. Абатмент PS Easy-Con 4.1 L2.

153. Абатмент PS Easy-Con 4.1 L3.

154. Абатмент PS Easy-Con 4.1 L4.

155. Абатмент PS Easy-Con 4.5 L1.

156. Абатмент PS Easy-Con 4.5 L2.

157. Абатмент PS Easy-Con 4.5 L3.

158. Абатмент PS Easy-Con 4.5 L4.

159. Абатмент PS Easy-Con 5.5 L2.

160. Абатмент PS Easy-Con 5.5 L4.

161. Абатмент Easy-Con Mini L1.5.

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0098617

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 11 марта 2022 года

№ РЗН 2021/13614

Лист 8

162. Абатмент Easy-Con Mini L2.5.  
163. Абатмент Easy-Con Mini L3.5.  
164. Абатмент Sub-Tec Multi<sup>Plus</sup> 0° GH1 S 3.25-3.75/RI 3.75 в комплекте с приспособлением для позиционирования Multi<sup>Plus</sup> 0°.  
165. Абатмент Sub-Tec Multi<sup>Plus</sup> 0° GH1 S/RI 4.1 в комплекте с приспособлением для позиционирования Multi<sup>Plus</sup> 0°.  
166. Абатмент Sub-Tec Multi<sup>Plus</sup> 0° GH1 S/RI 4.5 в комплекте с приспособлением для позиционирования Multi<sup>Plus</sup> 0°.  
167. Абатмент Sub-Tec Multi<sup>Plus</sup> 0° GH3 S 3.25-3.75/RI 3.75 в комплекте с приспособлением для позиционирования Multi<sup>Plus</sup> 0°.  
168. Абатмент Sub-Tec Multi<sup>Plus</sup> 0° GH3 S/RI 4.1 в комплекте с приспособлением для позиционирования Multi<sup>Plus</sup> 0°.  
169. Абатмент Sub-Tec Multi<sup>Plus</sup> 0° GH3 S/RI 4.5 в комплекте с приспособлением для позиционирования Multi<sup>Plus</sup> 0°.  
170. Абатмент Sub-Tec Multi<sup>Plus</sup> 20° GH2,3-0,6 S 3.25-3.75/RI 3.75 в комплекте с приспособлением для позиционирования Multi<sup>Plus</sup> 20° и винтом клиническим Multi<sup>Plus</sup>.  
171. Абатмент Sub-Tec Multi<sup>Plus</sup> 20° GH2,3-0,6 S/RI 4.1 в комплекте с приспособлением для позиционирования Multi<sup>Plus</sup> 20° и винтом клиническим Multi<sup>Plus</sup>.  
172. Абатмент Sub-Tec Multi<sup>Plus</sup> 20° GH2,3-0,6 S/RI 4.5 в комплекте с приспособлением для позиционирования Multi<sup>Plus</sup> 20° и винтом клиническим Multi<sup>Plus</sup>.  
173. Абатмент Sub-Tec Multi<sup>Plus</sup> 20° GH4,0-2,3 S 3.25-3.75/RI 3.75 в комплекте с приспособлением для позиционирования Multi<sup>Plus</sup> 20° и винтом клиническим Multi<sup>Plus</sup>.  
174. Абатмент Sub-Tec Multi<sup>Plus</sup> 20° GH4,0-2,3 S/RI 4.1 в комплекте с приспособлением для позиционирования Multi<sup>Plus</sup> 20° и винтом клиническим Multi<sup>Plus</sup>.  
175. Абатмент Sub-Tec Multi<sup>Plus</sup> 20° GH4,0-2,3 S/RI 4.5 в комплекте с приспособлением для позиционирования Multi<sup>Plus</sup> 20° и винтом клиническим Multi<sup>Plus</sup>.  
176. Абатмент Sub-Tec Multi<sup>Plus</sup> 30° GH4,0-1,5 S 3.25-3.75/RI 3.75 в комплекте с приспособлением для позиционирования Multi<sup>Plus</sup> 30° и винтом клиническим Multi<sup>Plus</sup>.  
177. Абатмент Sub-Tec Multi<sup>Plus</sup> 30° GH4,0-1,5 S/RI 4.1 в комплекте с приспособлением для позиционирования Multi<sup>Plus</sup> 30° и винтом клиническим Multi<sup>Plus</sup>.  
178. Абатмент Sub-Tec Multi<sup>Plus</sup> 30° GH4,0-1,5 S/RI 4.5 в комплекте с приспособлением для позиционирования Multi<sup>Plus</sup> 30° и винтом клиническим Multi<sup>Plus</sup>.  
179. Абатмент PS Multi<sup>Plus</sup> 3.25-3.75 0° GH 1 в комплекте с приспособлением для позиционирования Multi<sup>Plus</sup> 0°.  
180. Абатмент PS Multi<sup>Plus</sup> 3.25-3.75 0° GH 3 в комплекте с приспособлением для позиционирования Multi<sup>Plus</sup> 0°.

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков



0098618

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 11 марта 2022 года

№ РЗН 2021/13614

Лист 9

181. Абатмент PS Multi<sup>Plus</sup> 4.1 0° GH 1 в комплекте с приспособлением для позиционирования Multi<sup>Plus</sup> 0°.
182. Абатмент PS Multi<sup>Plus</sup> 4.1 0° GH 3 в комплекте с приспособлением для позиционирования Multi<sup>Plus</sup> 0°.
183. Абатмент PS Multi<sup>Plus</sup> 4.5 0° GH 1 в комплекте с приспособлением для позиционирования Multi<sup>Plus</sup> 0°.
184. Абатмент PS Multi<sup>Plus</sup> 4.5 0° GH 3 в комплекте с приспособлением для позиционирования Multi<sup>Plus</sup> 0°.
185. Абатмент PS Multi<sup>Plus</sup> 3.25-3.75 20° GH 2.3-0.6 в комплекте с приспособлением для позиционирования Multi<sup>Plus</sup> 20° и винтом клиническим Multi<sup>Plus</sup>.
186. Абатмент PS Multi<sup>Plus</sup> 3.25-3.75 20° GH 4.0-2.3 в комплекте с приспособлением для позиционирования Multi<sup>Plus</sup> 20° и винтом клиническим Multi<sup>Plus</sup>.
187. Абатмент PS Multi<sup>Plus</sup> 4.1 20° GH 2.3-0.6 в комплекте с приспособлением для позиционирования Multi<sup>Plus</sup> 20° и винтом клиническим Multi<sup>Plus</sup>.
188. Абатмент PS Multi<sup>Plus</sup> 4.1 20° GH 4.0-2.3 в комплекте с приспособлением для позиционирования Multi<sup>Plus</sup> 20° и винтом клиническим Multi<sup>Plus</sup>.
189. Абатмент PS Multi<sup>Plus</sup> 4.5 20° GH 2.3-0.6 в комплекте с приспособлением для позиционирования Multi<sup>Plus</sup> 20° и винтом клиническим Multi<sup>Plus</sup>.
190. Абатмент PS Multi<sup>Plus</sup> 4.5 20° GH 4.0-2.3 в комплекте с приспособлением для позиционирования Multi<sup>Plus</sup> 20° и винтом клиническим Multi<sup>Plus</sup>.
191. Абатмент PS Multi<sup>Plus</sup> 3.25-3.75 30° GH 4.0-1.5 в комплекте с приспособлением для позиционирования Multi<sup>Plus</sup> 30° и винтом клиническим Multi<sup>Plus</sup>.
192. Абатмент PS Multi<sup>Plus</sup> 4.1 30° GH 4.0-1.5 в комплекте с приспособлением для позиционирования Multi<sup>Plus</sup> 30° и винтом клиническим Multi<sup>Plus</sup>.
193. Абатмент PS Multi<sup>Plus</sup> 4.5 30° GH 4.0-1.5 в комплекте с приспособлением для позиционирования Multi<sup>Plus</sup> 30° и винтом клиническим Multi<sup>Plus</sup>.
194. Абатмент титановый Multi<sup>Plus</sup> в комплекте с винтом техническим Multi<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Multi<sup>Plus</sup>.
195. Абатмент Multi<sup>Plus</sup> Universal в комплекте с винтом техническим Multi<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Multi<sup>Plus</sup>.
196. Абатмент Multi<sup>Plus</sup> под литье из золотого сплава в комплекте со вставкой для воскового моделирования Multi<sup>Plus</sup> под литье из золотого сплава, винтом техническим Multi<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Multi<sup>Plus</sup>.
197. Абатмент под литье из золотого сплава PS GCO 3.25-3.75 в комплекте со вставкой для воскового моделирования под литье из золотого сплава, винтом техническим L9 и винтом клиническим шестигранным 1.25 мм.

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков



0098619

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 11 марта 2022 года

№ РЗН 2021/13614

Лист 10

198. Абатмент под литье из золотого сплава PS GCO 4.1 в комплекте со вставкой для воскового моделирования под литье из золотого сплава, винтом техническим L9 и винтом клиническим шестигранным 1.25 мм.
199. Абатмент под литье из золотого сплава PS GCO 4.5 в комплекте со вставкой для воскового моделирования под литье из золотого сплава, винтом техническим L9 и винтом клиническим шестигранным 1.25 мм.
200. Абатмент под литье из золотого сплава PS GCO 5.5 в комплекте со вставкой для воскового моделирования под литье из золотого сплава, винтом техническим L9 и винтом клиническим шестигранным 1.25 мм.
201. Абатмент под литье из золотого сплава без шестигранника PS GCO NH 3.25-3.75 в комплекте со вставкой для воскового моделирования под литье из золотого сплава, винтом техническим L9 и винтом клиническим шестигранным 1.25 мм.
202. Абатмент под литье из золотого сплава без шестигранника PS GCO NH 4.1 в комплекте со вставкой для воскового моделирования под литье из золотого сплава, винтом техническим L9 и винтом клиническим шестигранным 1.25 мм.
203. Абатмент под литье из золотого сплава без шестигранника PS GCO NH 4.5 в комплекте со вставкой для воскового моделирования под литье из золотого сплава, винтом техническим L9 и винтом клиническим шестигранным 1.25 мм.
204. Абатмент под литье из золотого сплава без шестигранника PS GCO NH 5.5 в комплекте со вставкой для воскового моделирования под литье из золотого сплава, винтом техническим L9 и винтом клиническим шестигранным 1.25 мм.
205. Абатмент универсальный PS UNI 3.25-3.75 в комплекте с Sub-вставкой для воскового моделирования Universal, винтом техническим PS UNI TScrew и винтом клиническим PS UNI PScrew.
206. Абатмент универсальный PS UNI 4.1 в комплекте с Sub-вставкой для воскового моделирования Universal, винтом техническим PS UNI TScrew и винтом клиническим PS UNI PScrew.
207. Абатмент универсальный PS UNI 4.5 в комплекте с Sub-вставкой для воскового моделирования Universal, винтом техническим PS UNI TScrew и винтом клиническим PS UNI PScrew.
208. Абатмент универсальный PS UNI 5.5 в комплекте с Sub-вставкой для воскового моделирования Universal, винтом техническим PS UNI TScrew и винтом клиническим PS UNI PScrew.
209. Абатмент универсальный без шестигранника PS UNI NH 3.25-3.75 в комплекте с Sub-вставкой для воскового моделирования Universal, винтом техническим PS UNI TScrew и винтом клиническим PS UNI PScrew.

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**Д.Ю. Павлюков**

0098620

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 11 марта 2022 года


№ РЗН 2021/13614

Лист 11

210. Абатмент универсальный без шестигранника PS UNI NH 4.1 в комплекте с Sub-вставкой для воскового моделирования Universal, винтом техническим PS UNI TScrew и винтом клиническим PS UNI PScrew.
211. Абатмент универсальный без шестигранника PS UNI NH 4.5 в комплекте с Sub-вставкой для воскового моделирования Universal, винтом техническим PS UNI TScrew и винтом клиническим PS UNI PScrew.
212. Абатмент универсальный без шестигранника PS UNI NH 5.5 в комплекте с Sub-вставкой для воскового моделирования Universal, винтом техническим PS UNI TScrew и винтом клиническим PS UNI PScrew.
213. Абатмент Mini под литье из золотого сплава в комплекте с Sub-вставкой для воскового моделирования под литье из золотого сплава, винтом техническим Mini, коническим и винтом клиническим Mini, коническим.
214. Основа для склеивания PS TiB 3.25-3.75 GH0 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
215. Основа для склеивания PS TiB 4.1 GH0 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
216. Основа для склеивания PS TiB 4.5 GH0 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
217. Основа для склеивания PS TiB 5.5 GH0 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
218. Основа для склеивания без шестигранника PS TiB NH 3.25-3.75 GH0 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
219. Основа для склеивания без шестигранника PS TiB NH 4.1 GH0 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
220. Основа для склеивания без шестигранника PS TiB NH 4.5 GH0 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
221. Основа для склеивания без шестигранника PS TiB NH 5.5 GH0 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
222. Аттачмент шаровидный Sub-Tec GH 0 S/RI 3.25-3.75, в составе:
- шаровидный аттачмент Sub GH 0 S/RI 3.25-3.75 без матрицы;
  - дистанционная шайба.
223. Аттачмент шаровидный Sub-Tec GH 3 S/RI 3.25-3.75, в составе:
- шаровидный аттачмент Sub GH 3 S/RI 3.25-3.75 без матрицы;
  - дистанционная шайба.
224. Аттачмент шаровидный Sub-Tec GH 5 S/RI 3.25-3.75, в составе:
- шаровидный аттачмент Sub GH 5 S/RI 3.25-3.75 без матрицы.

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

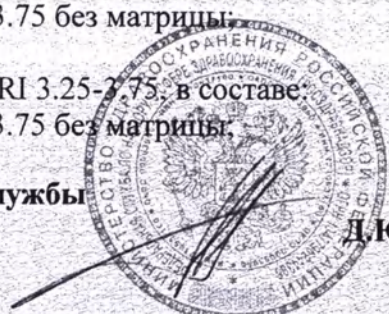

0098621

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 11 марта 2022 года


№ РЗН 2021/13614

Лист 12

- дистанционная шайба.
- 225. Аттачмент шаровидный Sub-Tec GH 0 S/RI 4.1-4.5, в составе:
  - шаровидный аттачмент Sub GH 0 S/RI 4.1-4.5 без матрицы;
  - дистанционная шайба.
- 226. Аттачмент шаровидный Sub-Tec GH 3 S/RI 4.1-4.5, в составе:
  - шаровидный аттачмент Sub GH 3 S/RI 4.1-4.5 без матрицы;
  - дистанционная шайба.
- 227. Аттачмент шаровидный Sub-Tec GH 5 S/RI 4.1-4.5, в составе:
  - шаровидный аттачмент Sub GH 5 S/RI 4.1-4.5 без матрицы;
  - дистанционная шайба.
- 228. Аттачмент шаровидный PS BA 3.75 GH0, в составе:
  - шаровидный аттачмент PS GH 0 RS/RSX 3.75 без матрицы;
  - дистанционная шайба.
- 229. Аттачмент шаровидный PS BA 3.75 GH3, в составе:
  - шаровидный аттачмент PS GH 3 RS/RSX 3.75 без матрицы;
  - дистанционная шайба.
- 230. Аттачмент шаровидный PS BA 3.75 GH5, в составе:
  - шаровидный аттачмент PS GH 5 RS/RSX 3.75 без матрицы;
  - дистанционная шайба.
- 231. Аттачмент шаровидный PS BA 4.1 GH0, в составе:
  - шаровидный аттачмент PS GH 0 RS/RSX 4.1 без матрицы;
  - дистанционная шайба.
- 232. Аттачмент шаровидный PS BA 4.1 GH3, в составе:
  - шаровидный аттачмент PS GH 3 RS/RSX 4.1 без матрицы;
  - дистанционная шайба.
- 233. Аттачмент шаровидный PS BA 4.1 GH5, в составе:
  - шаровидный аттачмент PS GH 5 RS/RSX 4.1 без матрицы;
  - дистанционная шайба.
- 234. Аттачмент шаровидный PS BA 4.5 GH0, в составе:
  - шаровидный аттачмент PS GH 0 RS/RSX 4.5 без матрицы;
  - дистанционная шайба.
- 235. Аттачмент шаровидный PS BA 4.5 GH3, в составе:
  - шаровидный аттачмент PS GH 3 RS/RSX 4.5 без матрицы;
  - дистанционная шайба.
- 236. Аттачмент шаровидный PS BA 4.5 GH5, в составе:
  - шаровидный аттачмент PS GH 5 RS/RSX 4.5 без матрицы;

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**

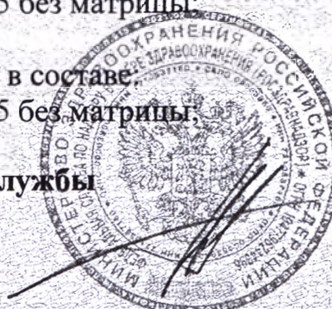

0098622

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 11 марта 2022 года


№ РЗН 2021/13614

Лист 13

- дистанционная шайба.
- 237. Аттачмент шаровидный Mini 2,9-3,1 GH 1,5.
- 238. Аттачмент шаровидный Mini 2,9-3,1 GH 4.
- 239. Аттачмент шаровидный Mini, лабораторный комплект - 2 шт./уп., в составе:
  - корпус PRECI-CLIX;
  - элемент для дублирования PRECI-CLIX;
  - матрица PRECI-CLIX, желтая;
  - вставка PRECI-CLIX.
- 240. Аналог имплантата Mini.
- 241. Аналог имплантата PI.
- 242. Аналог имплантата PI - 5 шт./уп.
- 243. Аналог Multi<sup>Plus</sup>.
- 244. Аналог Multi<sup>Plus</sup> - 4 шт./уп.
- 245. Аналог защитный Multi<sup>Plus</sup> - 4 шт./уп.
- 246. Аналог Easy-Con - 4 шт./уп.
- 247. Аналог матрицы PRECI-CLIX.
- 248. Аналог PS IMPA 3.0.
- 249. Аналог PS IMPA 3.75.
- 250. Аналог PS IMPA 4.1.
- 251. Аналог PS IMPA 4.5.
- 252. Аналог PS IMPA 5.5.
- 253. Основа титановая для склеивания Sub-Tec CAD/CAM S 3.25-3.75/RI 3.75 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
- 254. Основа титановая для склеивания Sub-Tec CAD/CAM S/RI 4.1 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
- 255. Основа титановая для склеивания Sub-Tec CAD/CAM S/RI 4.5 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
- 256. Основа титановая для склеивания Sub-Tec CAD/CAM S/RI 5.5 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
- 257. Основа титановая для склеивания Sub-Tec CAD/CAM без шестигранника S 3.25-3.75/RI 3.75 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
- 258. Основа титановая для склеивания Sub-Tec CAD/CAM без шестигранника S/RI 4.1 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
- 259. Основа титановая для склеивания Sub-Tec CAD/CAM без шестигранника S/RI 4.5 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

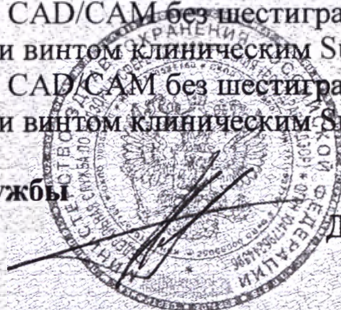

0098623

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 11 марта 2022 года

№ РЗН 2021/13614

Лист 14

260. Основа титановая для склеивания Sub-Tec CAD/CAM без шестигранника S/RI 5.5 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
261. Основа титановая Sub-Tec CAD/CAM TiBase L S 3.25-3.75/RI 3.75 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
262. Основа титановая Sub-Tec CAD/CAM TiBase L S/RI 4.1 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
263. Основа титановая Sub-Tec CAD/CAM TiBase L S/RI 4.5 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
264. Основа титановая Sub-Tec CAD/CAM TiBase L S/RI 5.5 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
265. Основа балочная титановая Mini TiBA в комплекте с винтом техническим Mini и винтом клиническим Mini.
266. Основа балочная титановая PS TiBA 3.75 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
267. Основа балочная титановая PS TiBA 4.1 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
268. Основа балочная титановая PS TiBA 4.5 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
269. Основа для склеивания PS TiB в комплекте с винтом техническим TScrew и винтом клиническим PScrew.
270. Винт Osseo<sup>Plus</sup> Transfer Ø1.5 L10.
271. Винт Osseo<sup>Plus</sup> Transfer Ø1.5 L12.
272. Винт Osseo<sup>Plus</sup> Transfer Ø1.5 L14.
273. Винт Osseo<sup>Plus</sup> Transfer Ø1.5 L6.
274. Винт Osseo<sup>Plus</sup> Transfer Ø1.5 L8.
275. Винт технический L9.
276. Винт технический Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
277. Винт технический TScrew.
278. Винт технический для универсального абатмента Sub-Tec S 3.25-4.5/RI 3.75-4.5.
279. Винт технический для универсального абатмента Sub-Tec S/RI 5.5.
280. Винт технический Multi<sup>Plus</sup> (M1.4).
281. Винт технический Mini.
282. Винт технический Mini, конический.
283. Винт технический BEGO CADSCREW T Mini.
284. Винт технический BEGO CADSCREW T Multi<sup>Plus</sup>.
285. Винт технический BEGO CADSCREW T - 50 шт./уп.

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков



0098624

## « ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 11 марта 2022 года


№ РЗН 2021/13614

Лист 15

- 286. Винт технический PS UNI TScrew.
- 287. Винт клинический шестигранный 1.25 мм.
- 288. Винт клинический для керамического абатмента.
- 289. Винт клинический Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
- 290. Винт клинический для универсального абатмента Sub-Tec S 3.25-4.5/RI 3.75-4.5.
- 291. Винт клинический для универсального абатмента Sub-Tec S/RI 5.5.
- 292. Винт клинический Multi<sup>Plus</sup> (M1.4).
- 293. Винт клинический Multi<sup>Plus</sup> (M1.8).
- 294. Винт клинический Mini.
- 295. Винт клинический Mini, конический.
- 296. Винт клинический BEGO CADSCREW P.
- 297. Винт клинический BEGO CADSCREW P Mini.
- 298. Винт клинический BEGO CADSCREW S Multi<sup>Plus</sup>.
- 299. Винт клинический PScrew 3.0.
- 300. Винт клинический PScrew CADP 3.0.
- 301. Винт клинический PS UNI PScrew.
- 302. Комплект винтов для металлического абатмента:
  - винт клинический BEGO CADSCREW P;
  - винт технический BEGO CADSCREW T.
- 303. Комплект винтов для керамического абатмента:
  - винт клинический для керамического абатмента;
  - винт технический BEGO CADSCREW T.
- 304. Комплект для снятия слепка методом закрытой ложки Multi<sup>Plus</sup> L8:
  - слепочный трансфер Multi<sup>Plus</sup> для снятия слепка методом закрытой ложки L8;
  - аналог Multi<sup>Plus</sup>.
- 305. Комплект для снятия слепка методом закрытой ложки Multi<sup>Plus</sup> L12:
  - слепочный трансфер Multi<sup>Plus</sup> для снятия слепка методом закрытой ложки L12;
  - аналог Multi<sup>Plus</sup>.
- 306. Комплект для снятия слепка методом открытой ложки Multi<sup>Plus</sup>:
  - слепочный трансфер Multi<sup>Plus</sup> для снятия слепка методом открытой ложки;
  - титановый винт L11 и L16;
  - аналог Multi<sup>Plus</sup>.
- 307. Комплект для снятия слепка методом открытой ложки Mini:
  - слепочный трансфер Mini для снятия слепка методом открытой ложки;
  - титановый винт L15 и L19;
  - аналог имплантата Mini.

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

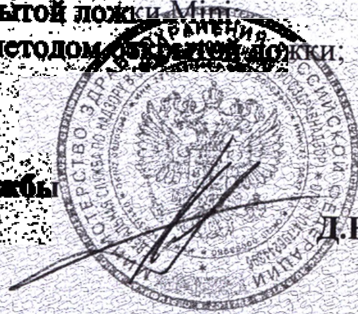

0098625

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**


от 11 марта 2022 года

№ РЗН 2021/13614

Лист 16

308. Комплект для снятия слепка методом закрытой ложки PS CTI 3.0:
- колпачок слепочного трансфера;
  - слепочный трансфер PS 3.0 для снятия слепка методом закрытой ложки;
  - титановый винт L11;
  - аналог PS IMPA.
309. Комплект для снятия слепка методом закрытой ложки PS CTI 3.75:
- колпачок слепочного трансфера;
  - слепочный трансфер PS 3.75 для снятия слепка методом закрытой ложки;
  - титановый винт L11;
  - аналог PS IMPA.
310. Комплект для снятия слепка методом закрытой ложки PS CTI 4.1:
- колпачок слепочного трансфера;
  - слепочный трансфер PS 4.1 для снятия слепка методом закрытой ложки;
  - титановый винт L11;
  - аналог PS IMPA.
311. Комплект для снятия слепка методом закрытой ложки PS CTI 4.5:
- колпачок слепочного трансфера;
  - слепочный трансфер PS 4.5 для снятия слепка методом закрытой ложки;
  - титановый винт L11;
  - аналог PS IMPA.
312. Комплект для снятия слепка методом закрытой ложки PS CTI 5.5:
- колпачок слепочного трансфера;
  - слепочный трансфер PS 5.5 для снятия слепка методом закрытой ложки;
  - титановый винт L11;
  - аналог PS IMPA.
313. Комплект для снятия слепка методом закрытой ложки PS OTI 3.0:
- слепочный трансфер PS 3.0 для снятия слепка методом открытой ложки;
  - титановый винт L16 и L21;
  - аналог PS IMPA.
314. Комплект для снятия слепка методом открытой ложки PS OTI 3.75:
- слепочный трансфер PS 3.75 для снятия слепка методом открытой ложки;
  - титановый винт L16 и L21;
  - аналог PS IMPA.
315. Комплект для снятия слепка методом открытой ложки PS OTI 4.1:
- слепочный трансфер PS 4.1 для снятия слепка методом открытой ложки;
  - титановый винт L16 и L21;

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

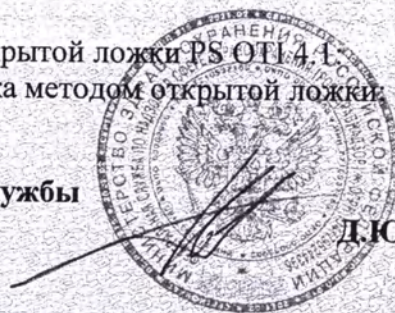

Д.Ю. Павлюков

0098626

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**


от 11 марта 2022 года

№ РЗН 2021/13614

Лист 17

- аналог PS IMPA.
- 316. Комплект для снятия слепка методом открытой ложки PS OTI 4.5:
  - слепочный трансфер PS 4.5 для снятия слепка методом открытой ложки;
  - титановый винт L16 и L21;
  - аналог PS IMPA.
- 317. Комплект для снятия слепка методом открытой ложки PS OTI 5.5:
  - слепочный трансфер PS 5.5 для снятия слепка методом открытой ложки;
  - титановый винт L16 и L21;
  - аналог PS IMPA.
- 318. Колпачок слепочный Easy-Con - 4 шт./уп.
- 319. Комплект колпачков для снятия слепка методом открытой ложки - 10 шт./уп.
- 320. Комплект примерочных абатментов Sub-Tec<sup>Plus</sup> 0° / 15° / 20°:
  - абатмент прямой титановый Sub-Tec<sup>Plus</sup> GH 1-2 S/RI 4.1 - 2 шт.;
  - абатмент прямой титановый Sub-Tec<sup>Plus</sup> GH 2.5-4 S/RI 4.1 - 2 шт.;
  - абатмент угловой титановый Sub-Tec<sup>Plus</sup> 15° P GH 1-2 S/RI 4.1 - 2 шт.;
  - абатмент угловой титановый Sub-Tec<sup>Plus</sup> 15° E GH 1-2 S/RI 4.1 - 2 шт.;
  - абатмент угловой титановый Sub-Tec<sup>Plus</sup> 15° P GH 2.5-4 S/RI 4.1 - 2 шт.;
  - абатмент угловой титановый Sub-Tec<sup>Plus</sup> 15° E GH 2.5-4 S/RI 4.1 - 2 шт.;
  - абатмент угловой титановый Sub-Tec<sup>Plus</sup> 20° P GH 1-2 S/RI 4.1 - 2 шт.;
  - абатмент угловой титановый Sub-Tec<sup>Plus</sup> 20° E GH 1-2 S/RI 4.1 - 2 шт.;
  - абатмент угловой титановый Sub-Tec<sup>Plus</sup> 20° P GH 2.5-4 S/RI 4.1 - 2 шт.;
  - абатмент угловой титановый Sub-Tec<sup>Plus</sup> 20° E GH 2.5-4 S/RI 4.1 - 2 шт.;
  - пинцет.
- 321. Комплект лабораторный Easy-Con:
  - вкладка ретенционная Easy-Con (прозрачная) - 2 шт.;
  - вкладка ретенционная Easy-Con (розовая) - 2 шт.;
  - вкладка ретенционная Easy-Con (синяя) - 2 шт.;
  - кольцо изолирующее - 2 шт.;
  - колпачок ретенционный - 2 шт.;
  - вкладка техническая Easy-Con (черная) - 2 шт.
- 322. Вкладка техническая Easy-Con (черная) - 4 шт./уп.
- 323. Вкладка ретенционная Easy-Con (синяя) - 4 шт./уп.
- 324. Вкладка ретенционная Easy-Con (розовая) - 4 шт./уп.
- 325. Вкладка ретенционная Easy-Con (прозрачная) - 4 шт./уп.
- 326. Вкладка ретенционная Easy-Con (красная) - 4 шт./уп.
- 327. Вкладка ретенционная Easy-Con (зеленая) - 4 шт./уп.

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

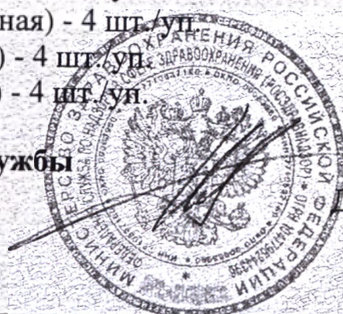

Д.Ю. Павлюков

0098627

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 11 марта 2022 года

№ РЗН 2021/13614

Лист 18

328. Позиционер CAD Sub-Tec в комплекте с винтом клиническим шестигранным 1.25 мм.
329. Позиционер CAD Multi<sup>Plus</sup>.
330. Позиционер CAD Mini в комплекте с винтом клиническим Mini.
331. Позиционер CAD PS CADP в комплекте с винтом клиническим PScrew.
332. Трансфер сканируемый CAD SP 3.0 в комплекте с винтом клиническим PScrew.
333. Трансфер сканируемый CAD SP 3.25-3.75 в комплекте с винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
334. Трансфер сканируемый CAD SP 4.1 в комплекте с винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
335. Трансфер сканируемый CAD SP 4.5 в комплекте с винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
336. Трансфер сканируемый CAD SP 5.5 в комплекте с винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
337. Матрица PRECI-CLIX, белая - 2 шт./уп.
338. Матрица PRECI-CLIX, желтая - 2 шт./уп.
339. Матрица PRECI-CLIX, красная - 2 шт./уп.
340. Шарнир балочный титановый Dolder® 3,0.
341. Заготовка фрезерная CAD/CAM ST PMB Ø16 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
342. Заготовка фрезерная CAD/CAM PS PMB Ø16 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
343. Заготовка фрезерная CAD/CAM ST PMB Ø11.5 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
344. Заготовка фрезерная CAD/CAM PS PMB Ø11.5 в комплекте с винтом техническим Sub-Tec<sup>Plus</sup> и винтом клиническим Sub-Tec<sup>Plus</sup>.
- Место производства:
1. BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG, Wilhelm-Herbst-Str. 1, 28359 Bremen, Germany.
  2. BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG, Wilhelm-Herbst-Str. 5, 28359 Bremen, Germany.
  3. Industrias Preciber, S.A, Camí del Roquís, 75, ES-43206 Reus, Spain.
  4. Cendres + Métaux SA, Rue de Boujean 122, CH-2501 Biel/Bienne, Switzerland.

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0098628