

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «ЦКТ»

Кричков Е.А

02.06.2022



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Кюветы Nemochron для определения активированного времени свертывания
крови на портативных коагулометрических анализаторах серии Nemochron
Signature, для диагностики in vitro, варианты исполнения.**

Версия 2.


Кюветы Hemochron ACT+ для определения активированного времени свертывания крови при умеренных и высоких концентрациях гепарина.

Внешняя упаковка, вид сверху.




Кюветы Hemochron АСТ+ для определения активированного времени свертывания крови при умеренных и высоких концентрациях гепарина.

Внешняя упаковка, вид сбоку.

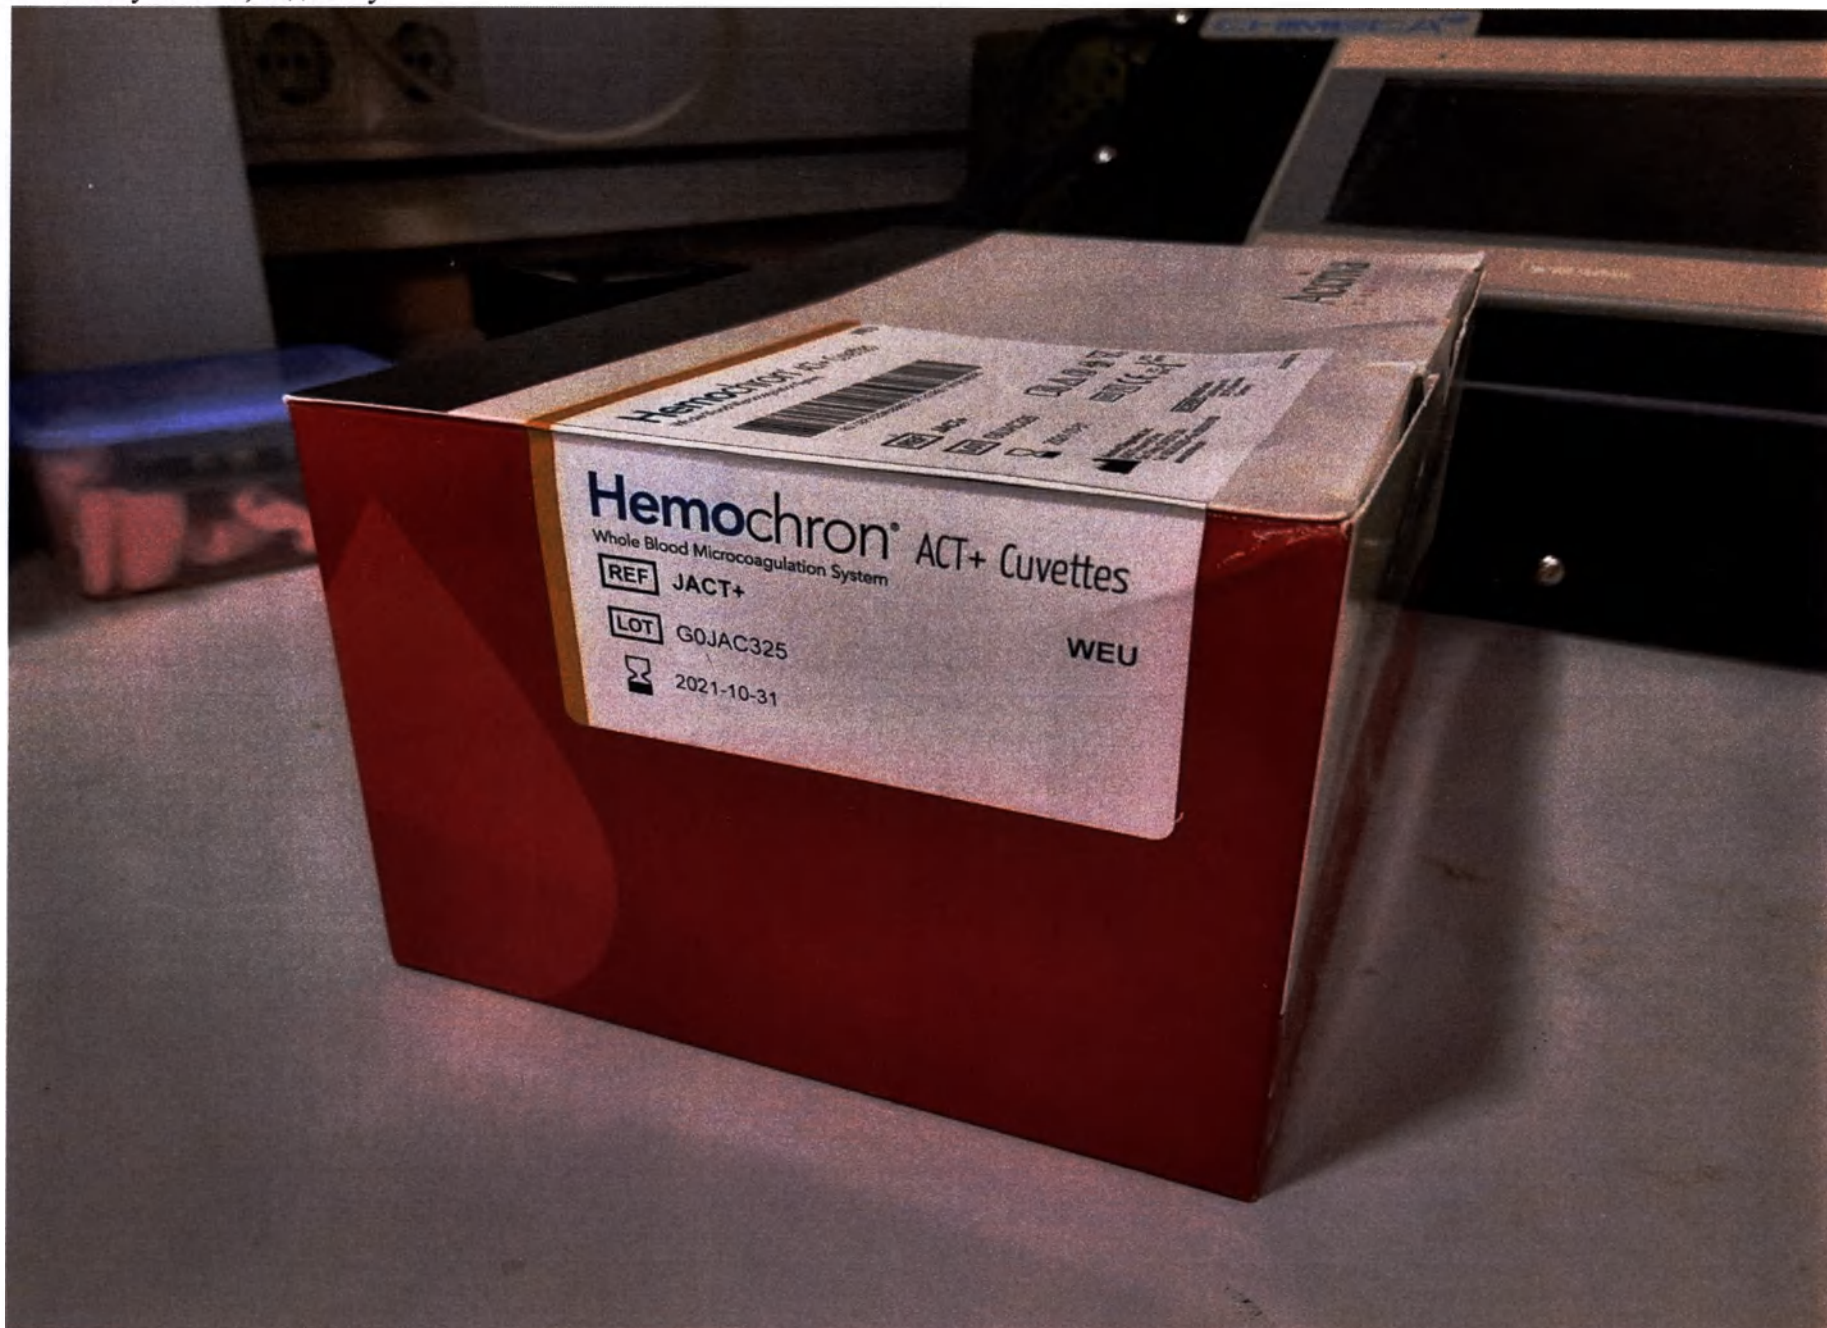

Кюветы Hemochron ACT+ для определения активированного времени свертывания крови при умеренных и высоких концентрациях гепарина.


Общий вид (кюветы, инструкция по применению, вкладыш).

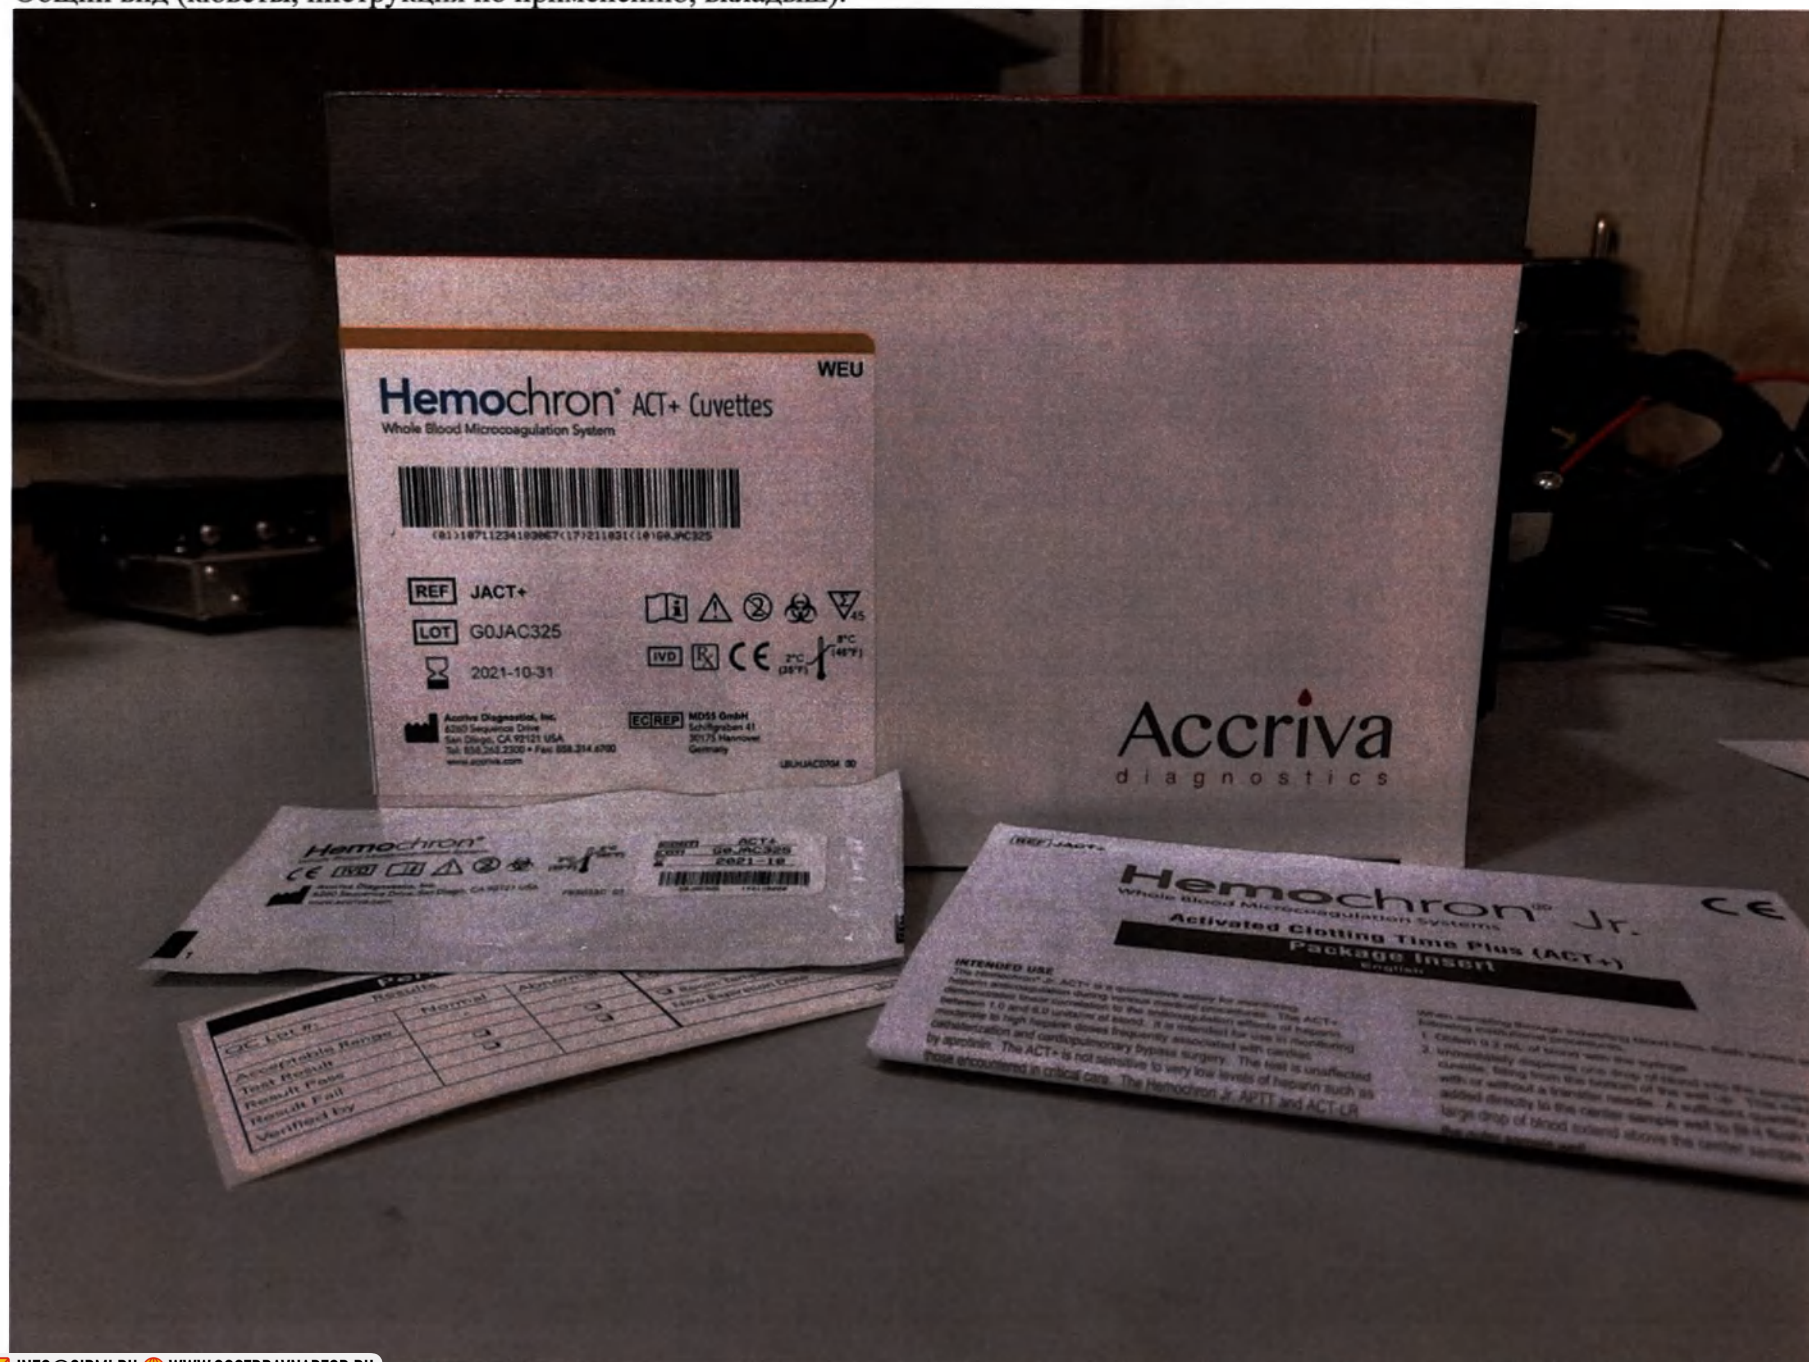


Кюветы Hemochron ACT+ для определения активированного времени свертывания крови при умеренных и высоких концентрациях гепарина. Кювета.




Кюветы Hemochron ACT-LR для определения активированного времени свертывания крови при низких и умеренных концентрациях гепарина
Внешняя упаковка, вид сверху.

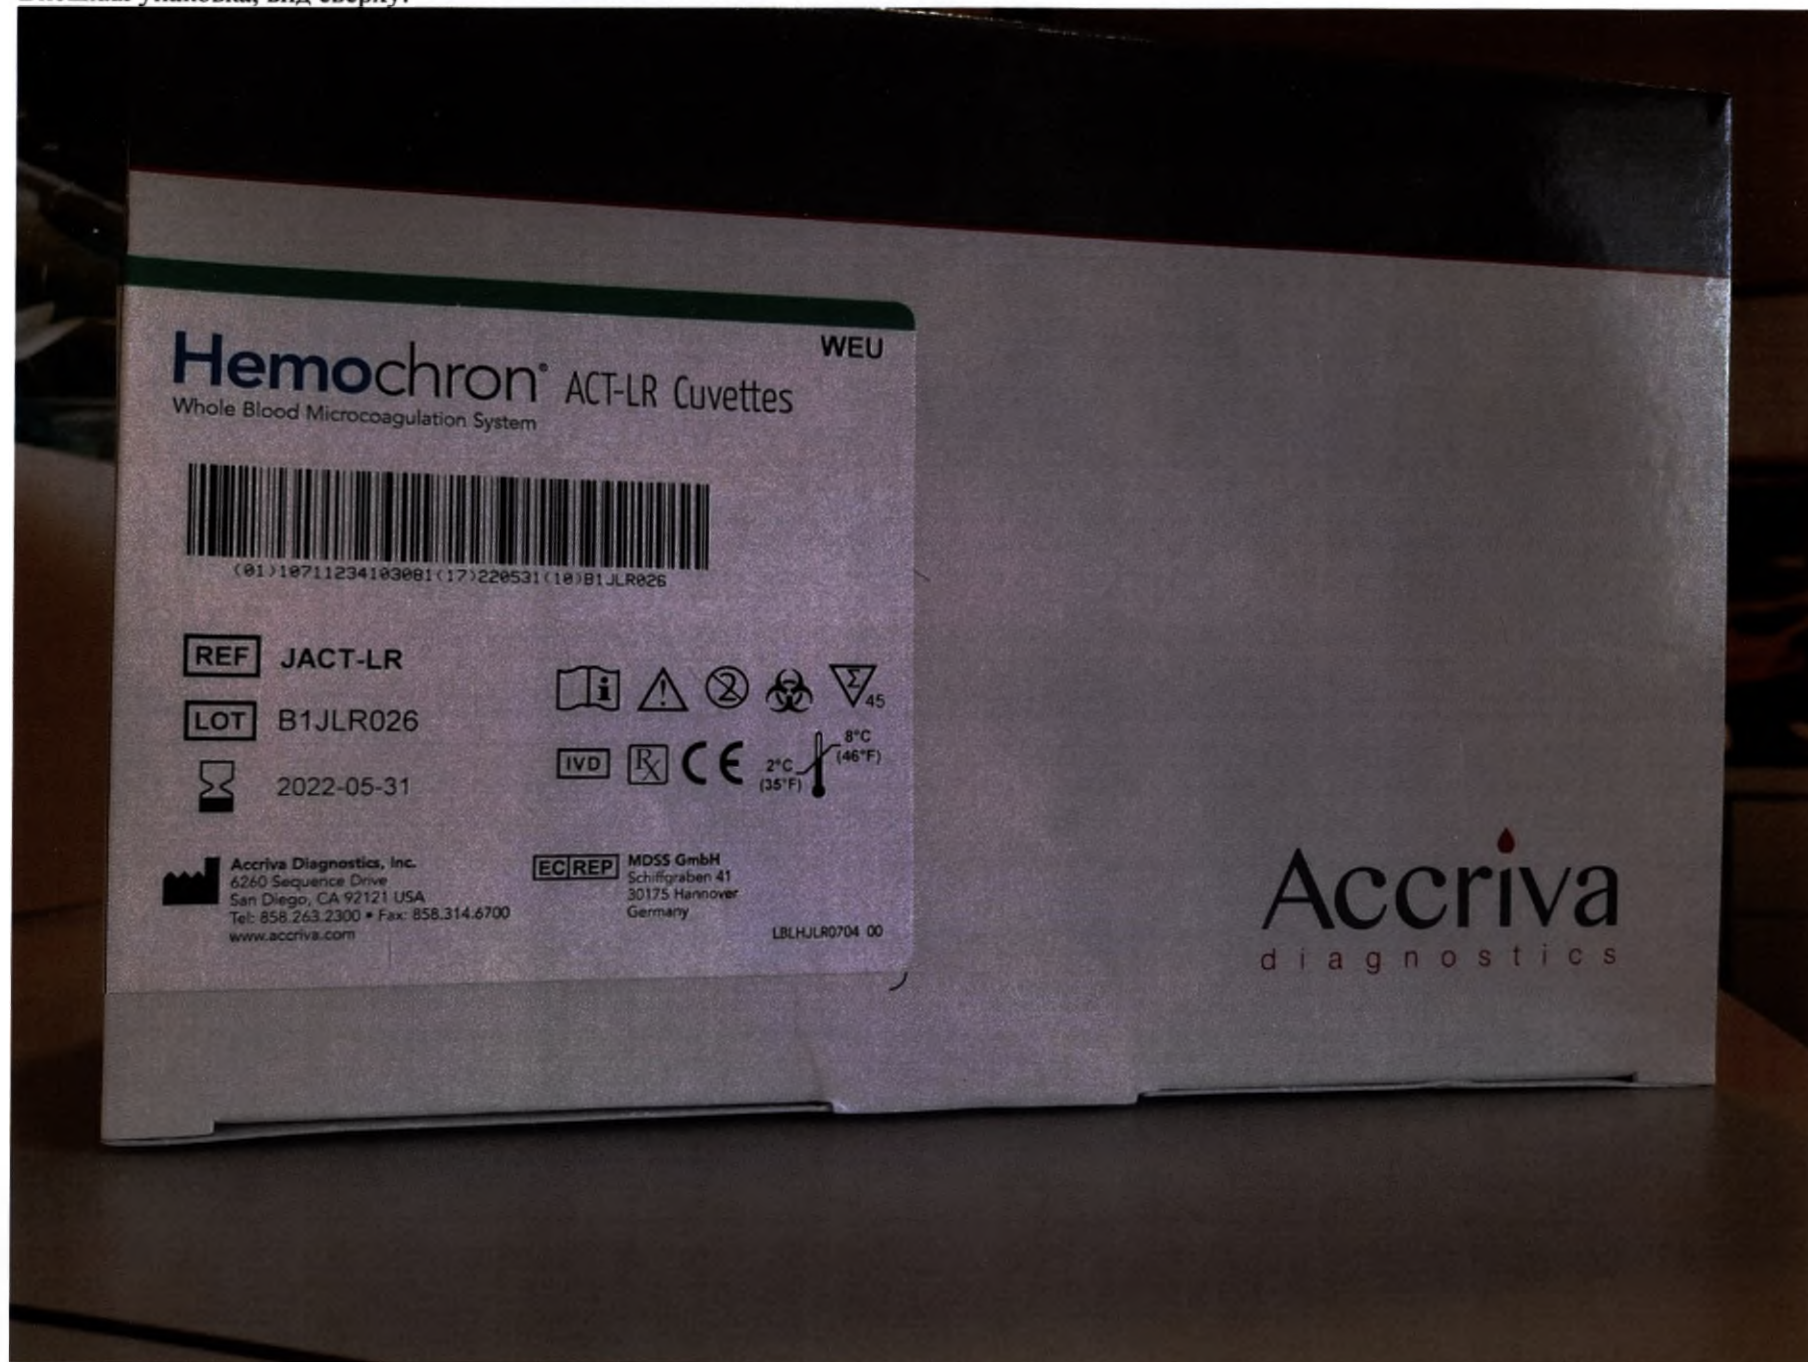

Кюветы Hemochron ACT-LR для определения активированного времени свертывания крови при низких и умеренных концентрациях гепарина
Внешняя упаковка, вид сбоку.

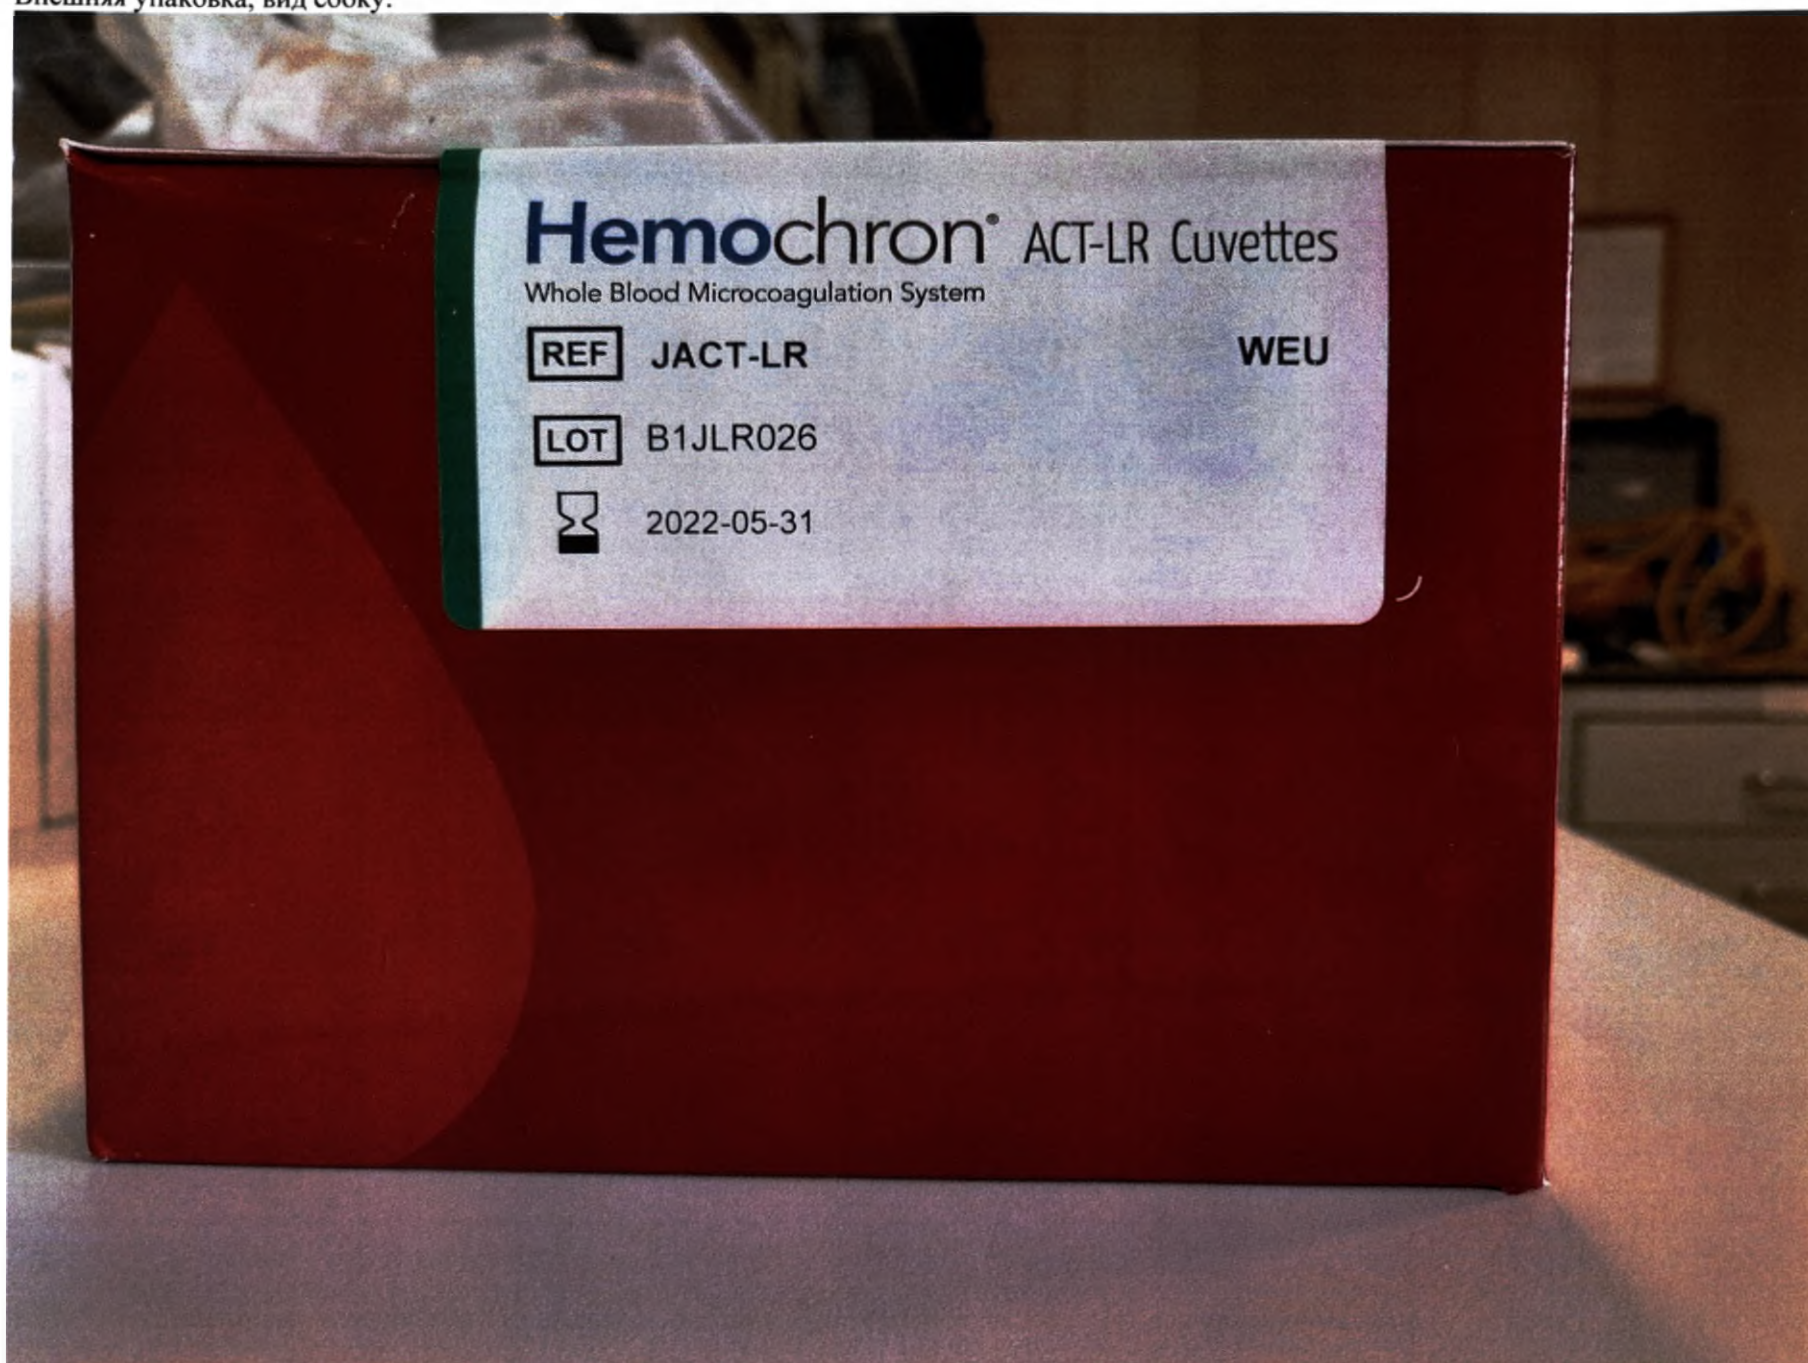

Кюветы Hemochron ACT-LR для определения активированного времени свертывания крови при низких и умеренных концентрациях гепарина. Общий вид (кюветы, инструкция по применению, вкладыш).

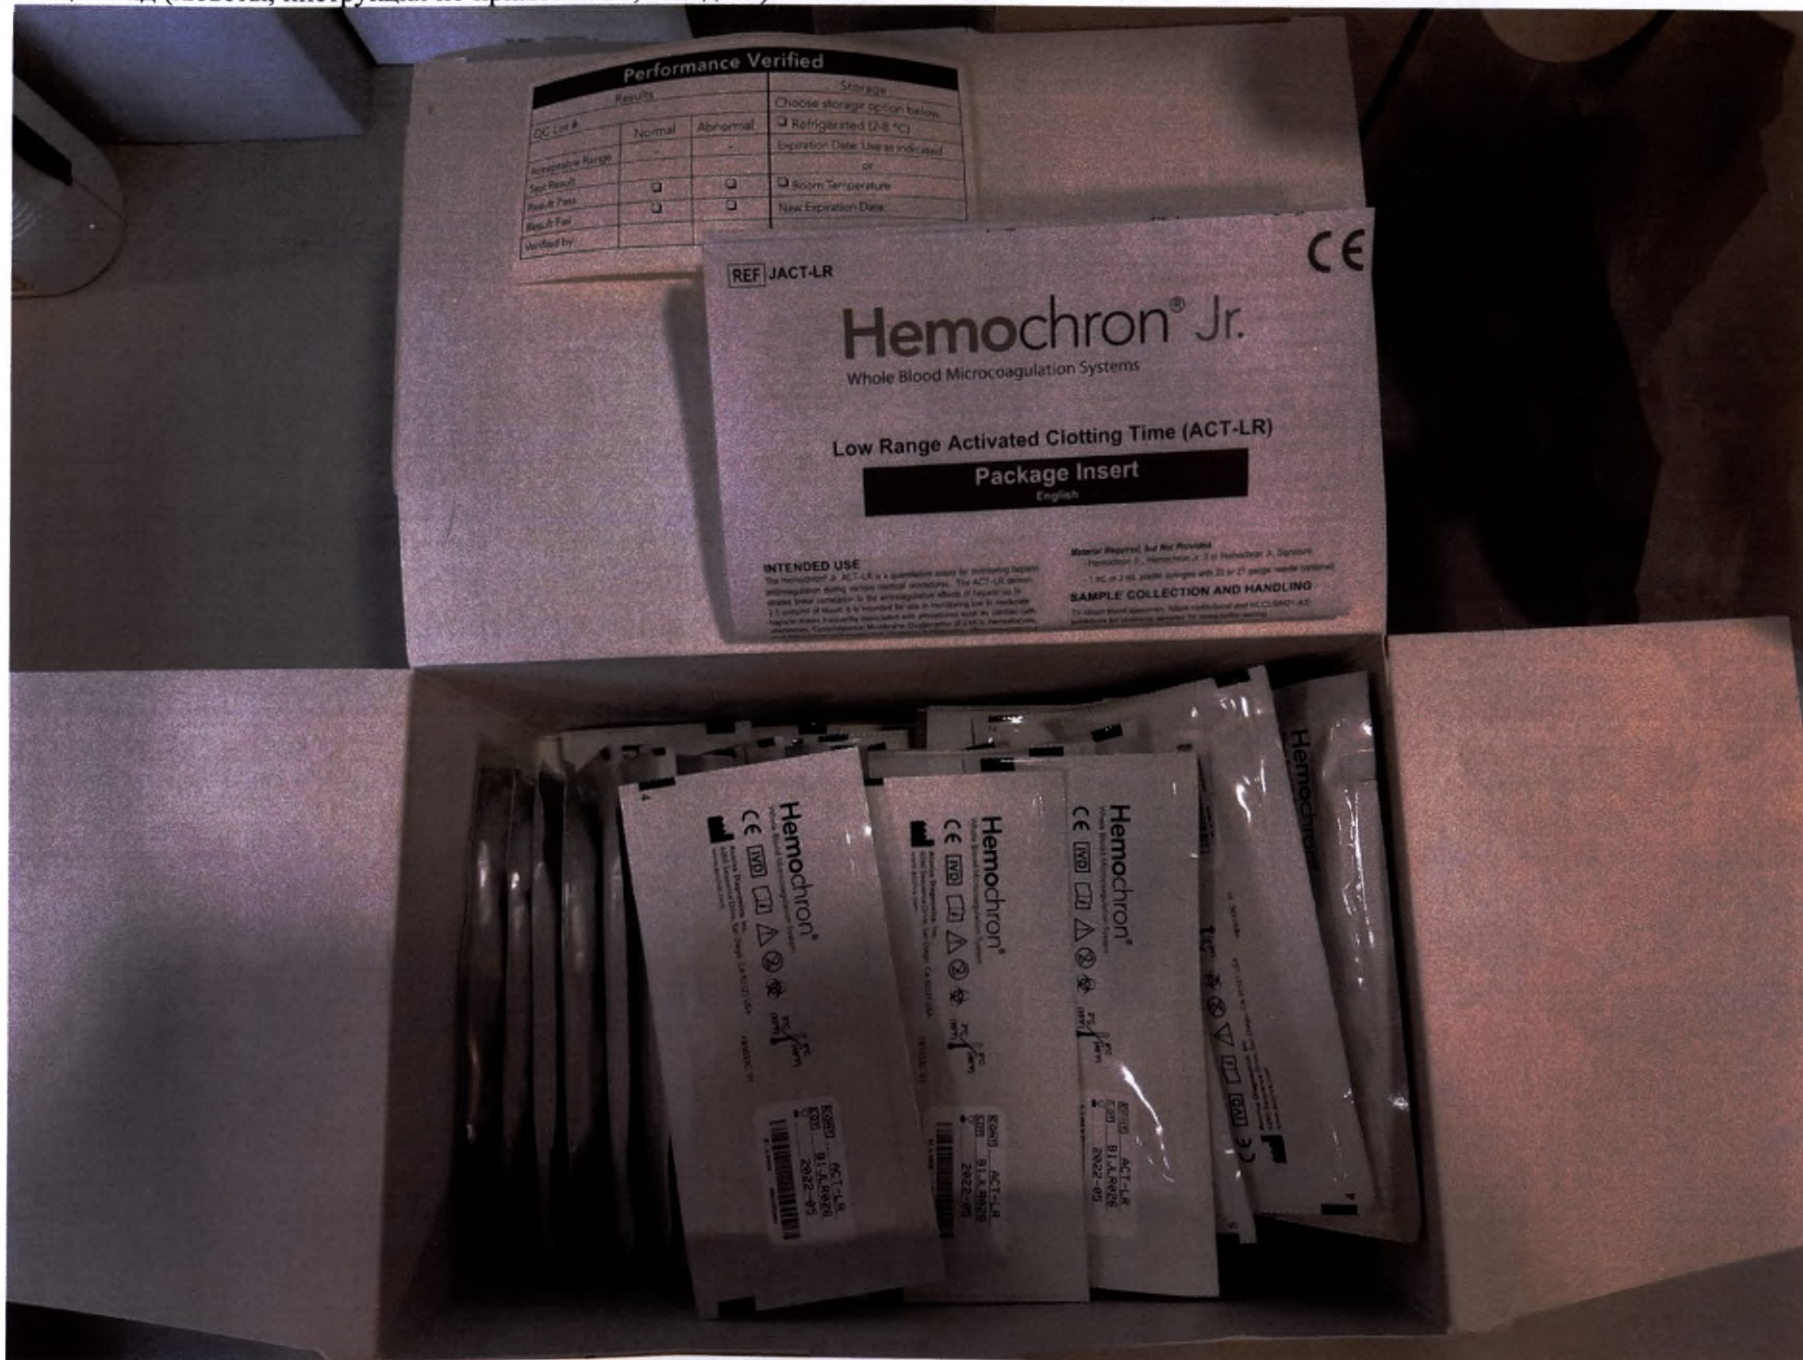

Кюветы Hemochron ACT-LR для определения активированного времени свертывания крови при низких и умеренных концентрациях гепарина. Кювета.



Всем прошить,
проинформировать и
срочно печатать
5 (девят) штук /с/

Директор ООО "Цирми"
Курочкин С.А.

