




ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ холестерина_2 для автоматических биохимических анализаторов серии ADVIA (ADVIA Chemistry Cholesterol_2 Reagent (CHOL_2)):
 нбіиий вил излпния

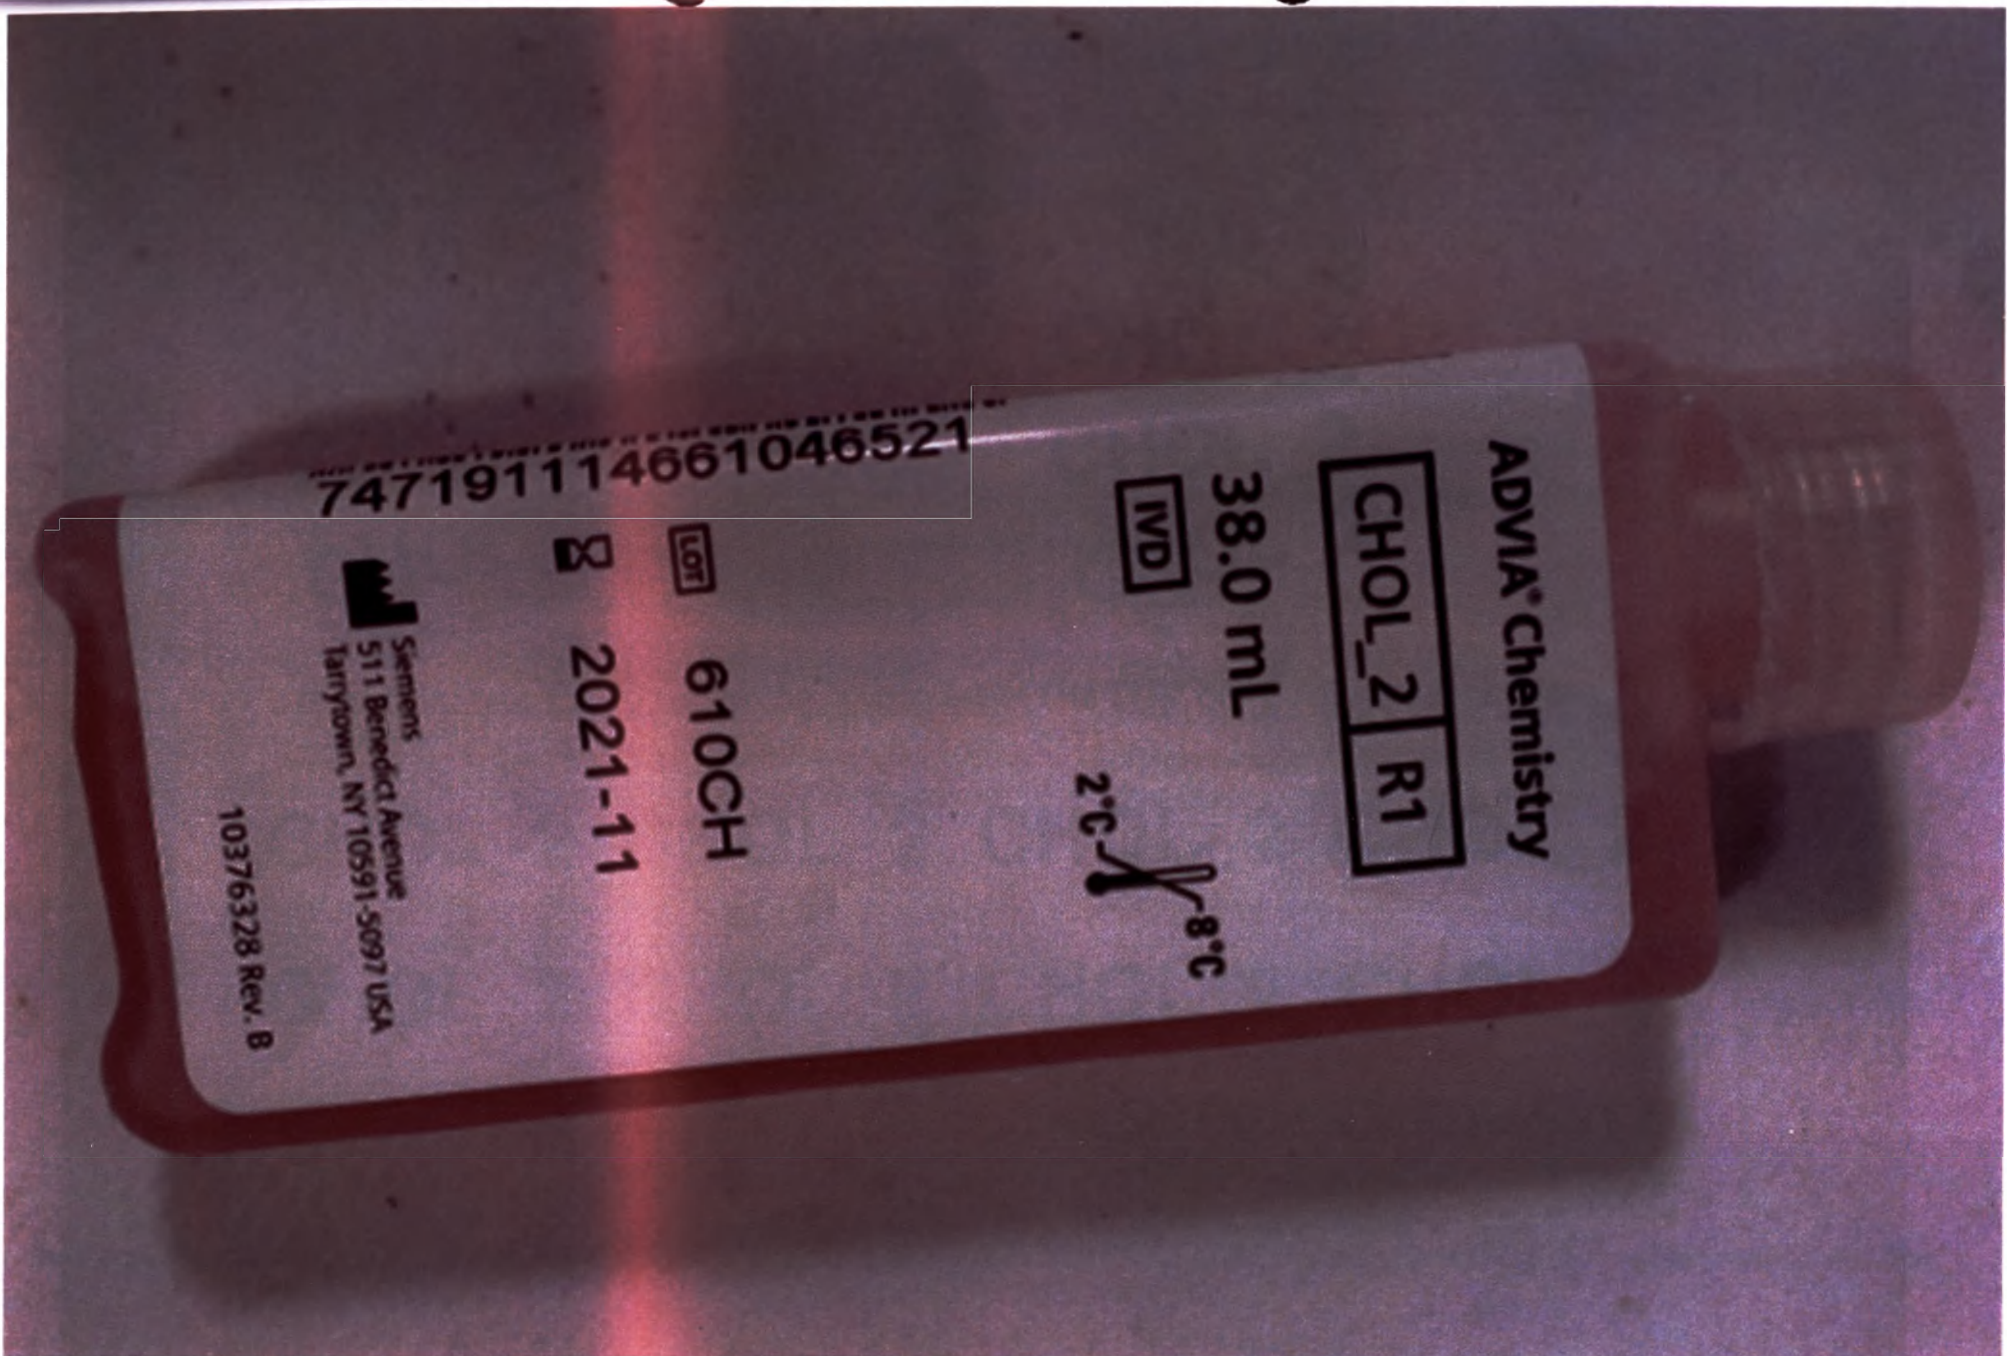

CHOL_2
CHOL_2
CHOL_2
CHOL_2

CHOL_2
CHOL_2
CHOL_2
CHOL_2

If method uses a 70 mL bottle, place label **ON TOP** of 70 mL reagent bottle.

CHOL_2	CHOL_2	CHOL_2	CHOL_2
CHOL_2	CHOL_2	CHOL_2	CHOL_2

If method uses a 20 mL or 40 mL bottle, place label **ON SIDE** of 20 mL or 40 mL reagent bottle.

APPLY LABELS TO A DRY SURFACE

10378162 Rev. A

10376501	Реагент для определения холестерина_2 для автоматических биохимических анализаторов серии ADVIA (ADVIA Chemistry Cholesterol_2 Reagent (CHOL_2), в вариантах исполнения
Регистрационное удостоверение: №РЗН 2018/7441 от 07.08.2018	
Информация об изготовителе: «Сименс Хелскеа Диагностикс Инк.» (Siemens Healthcare Diagnostics Inc.) 511 Benedict Avenue Tarrytown, NY, 10591-5097, USA	Содержимое: 7x38 мл Фасовка 7 x 350 тестов для анализатора ADVIA 1650/1800/2400 Фасовка 7 x 250 тестов для Анализатора ADVIA 1200
Код партии, срок годности, условия хранения и обращения, символы опасности и др. символы указаны на оригинальной упаковке	
Применение для диагностики in vitro	

Рисунок 4. Макет маркировки для РФ внешней упаковки МИ «Реагент для определения холестерина_2 для автоматических биохимических анализаторов серии ADVIA (ADVIA Chemistry Cholesterol_2 Reagent (CHOL_2))»

Всего прошито и пронумеровано
5 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

