

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «ИНТЕРОН»



Пархоменко А.А.

2021 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


Кушетка медицинская

по ТУ 32.50.30-003-24933245-2021


г. Саратов

2021


Кушетка медицинская К-100

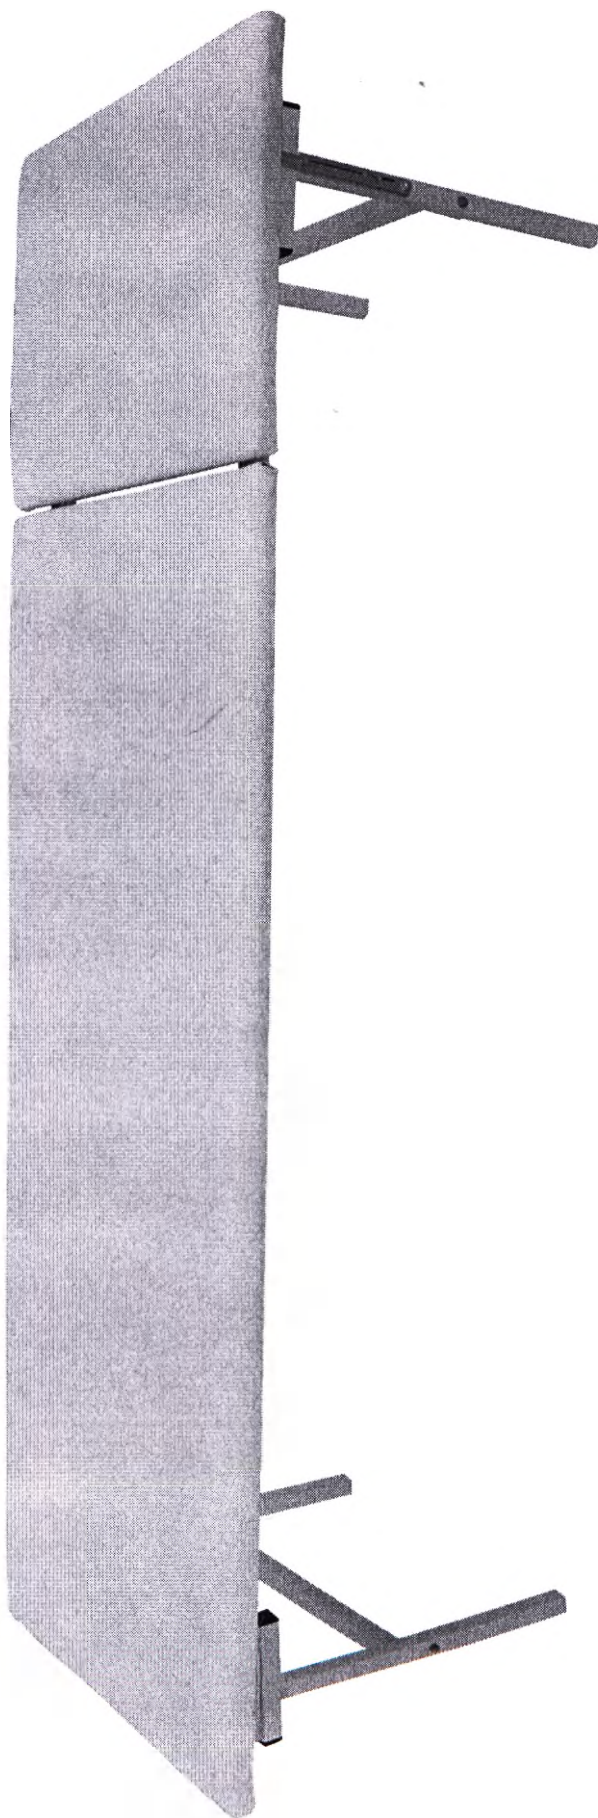


Кушетка медицинская К-101

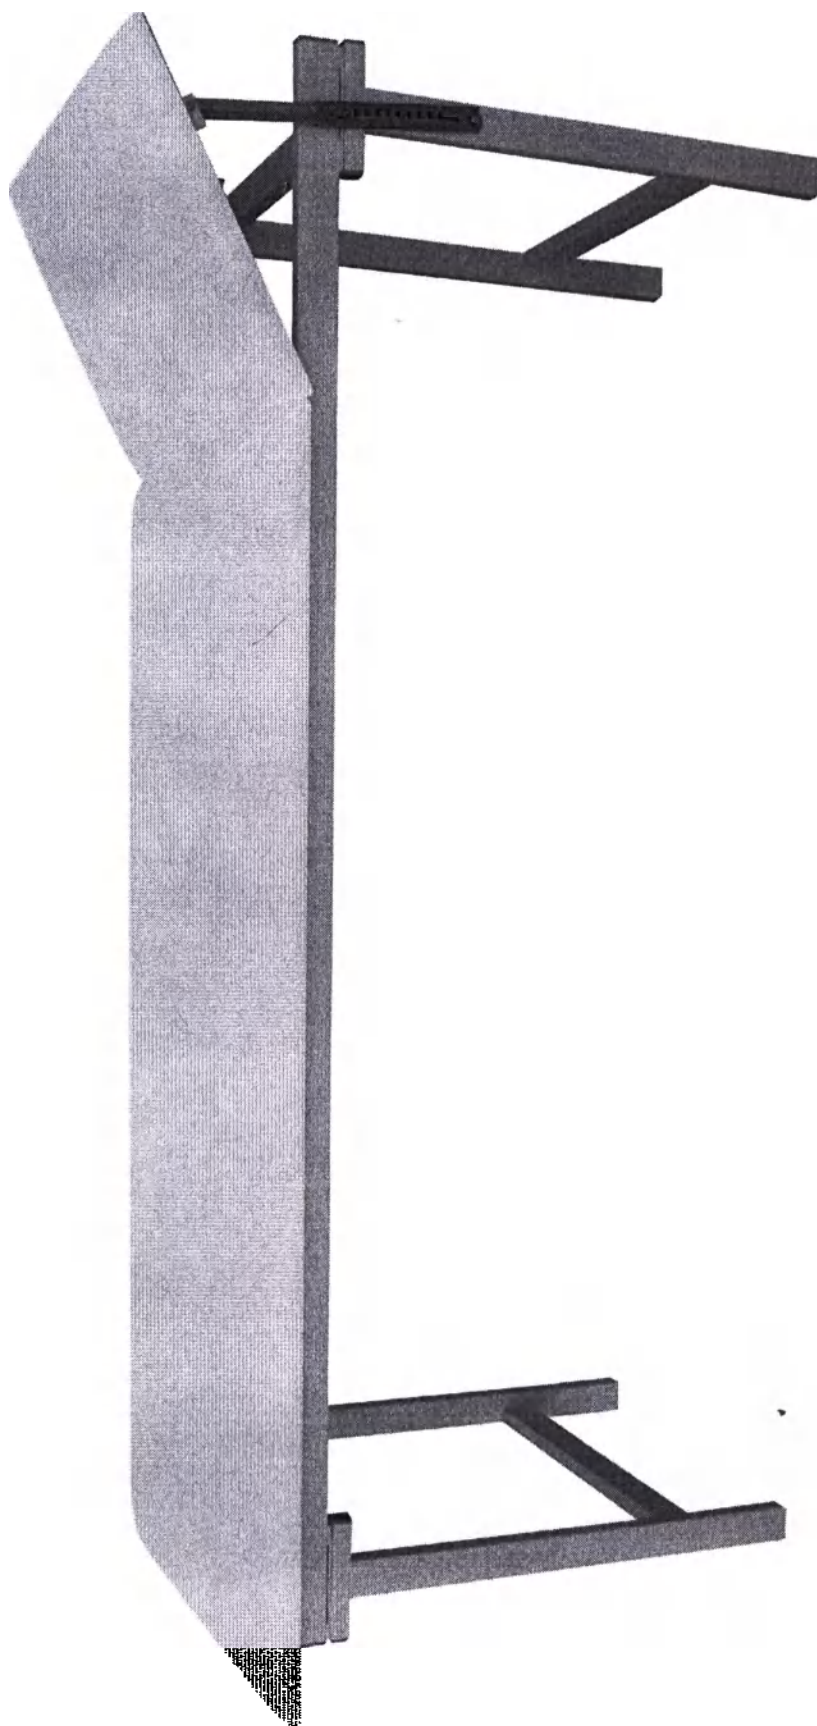


Кушетка медицинская К-102

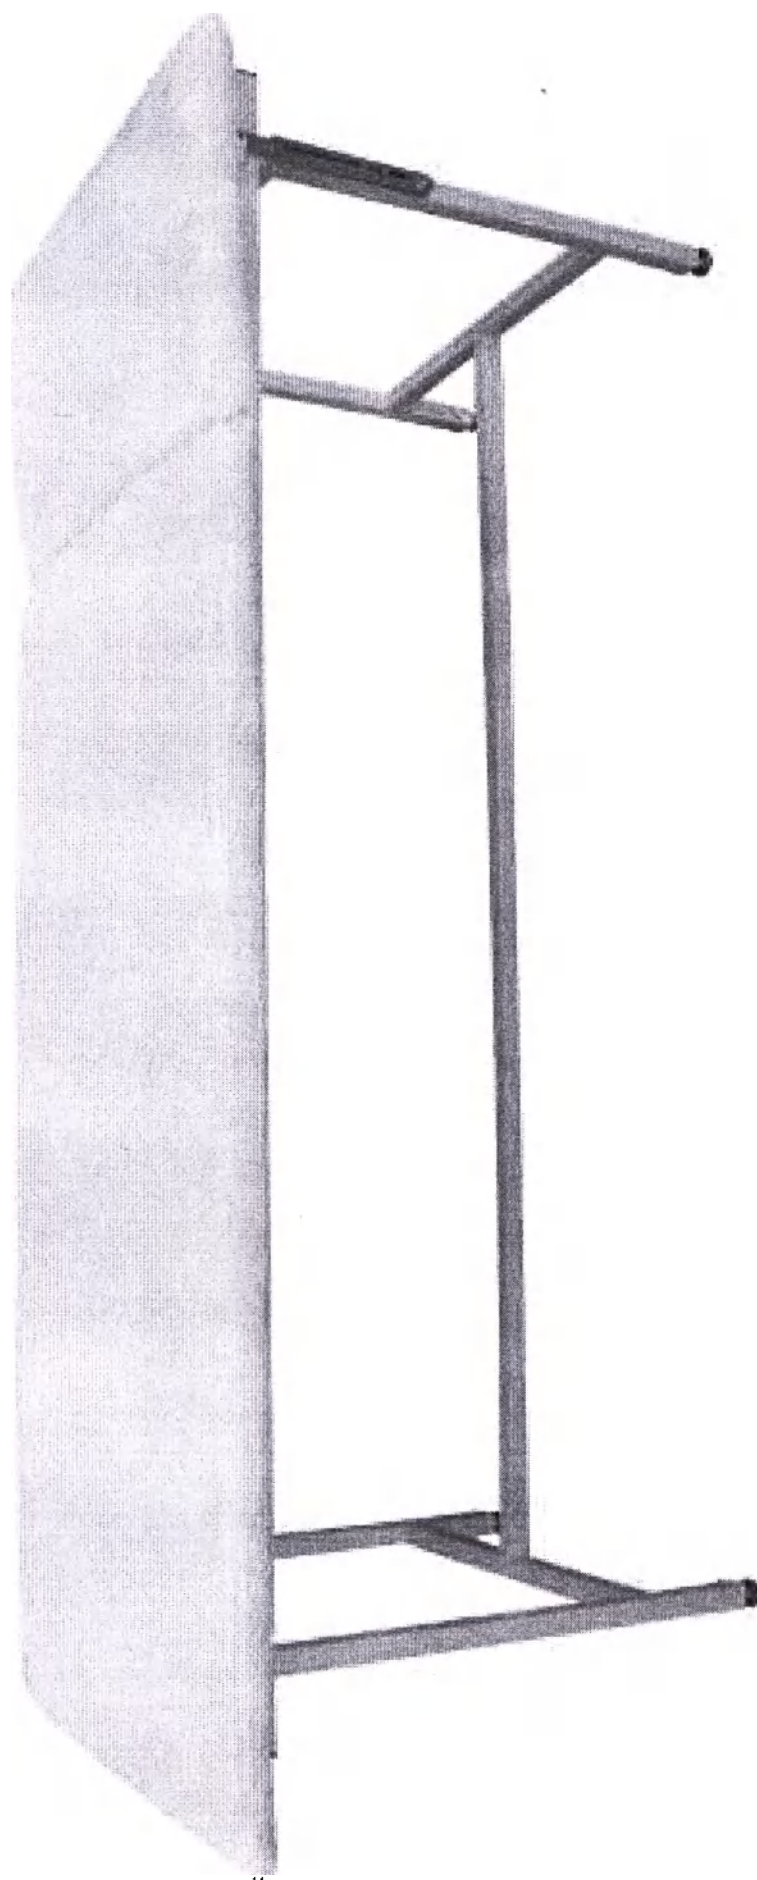


Кушетка медицинская К-103

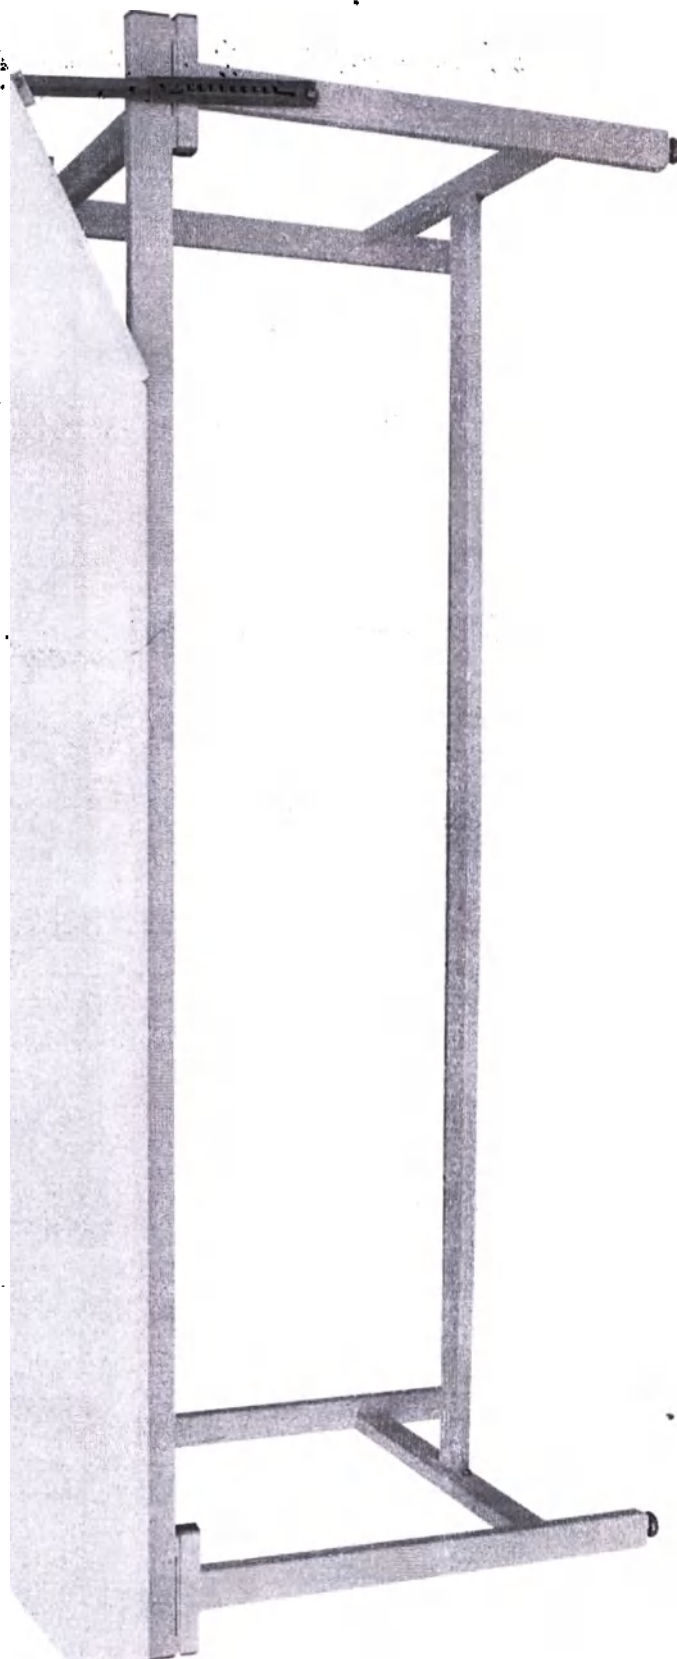

Кушетка медицинская К-104

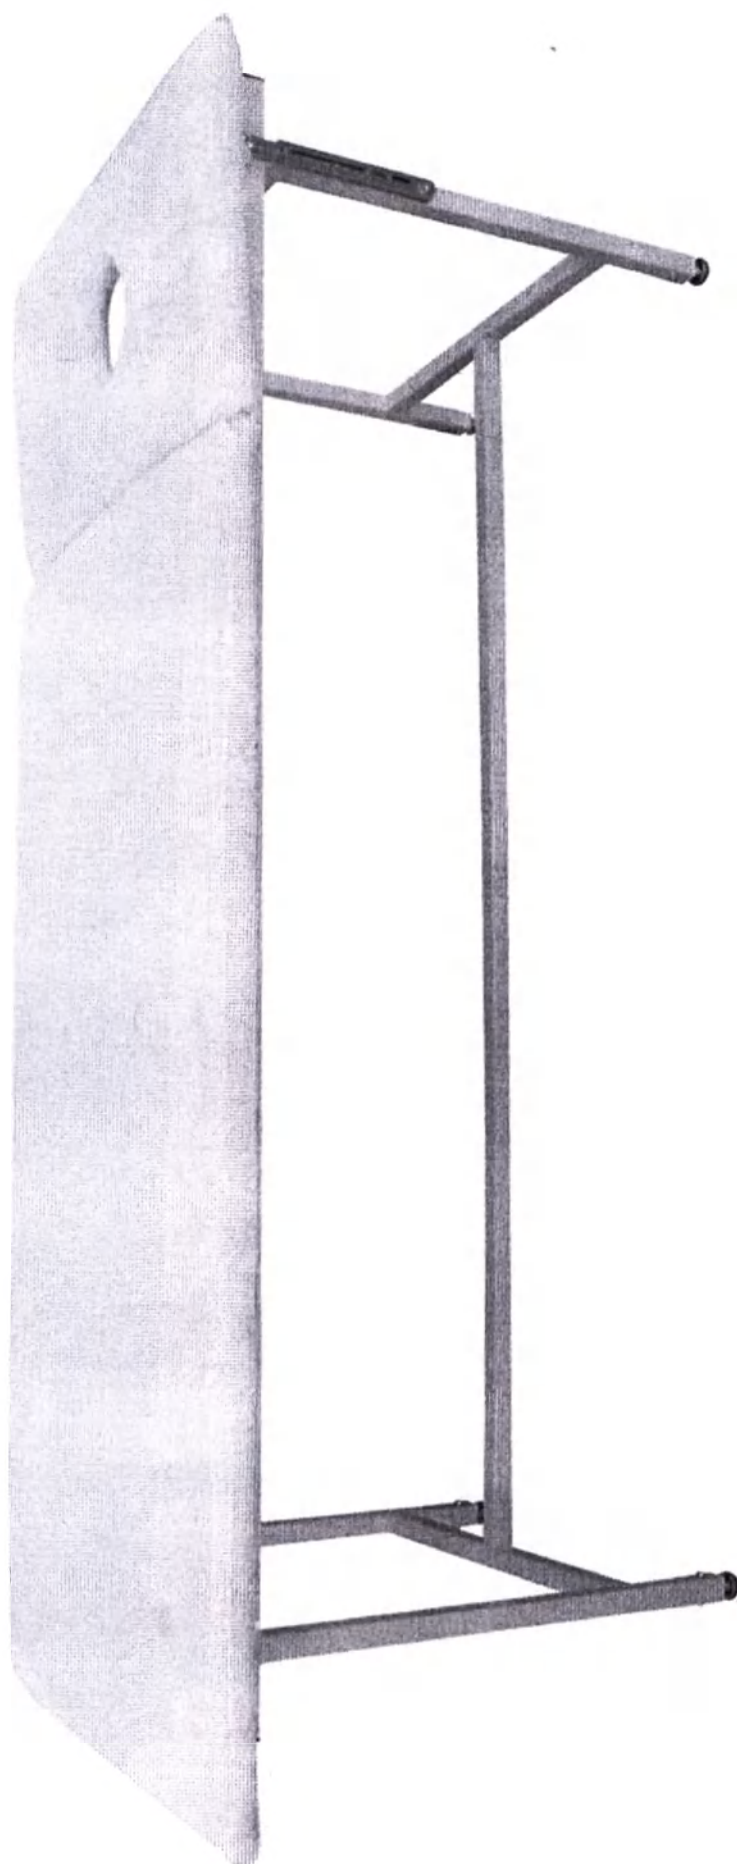

Кушетка медицинская К-105

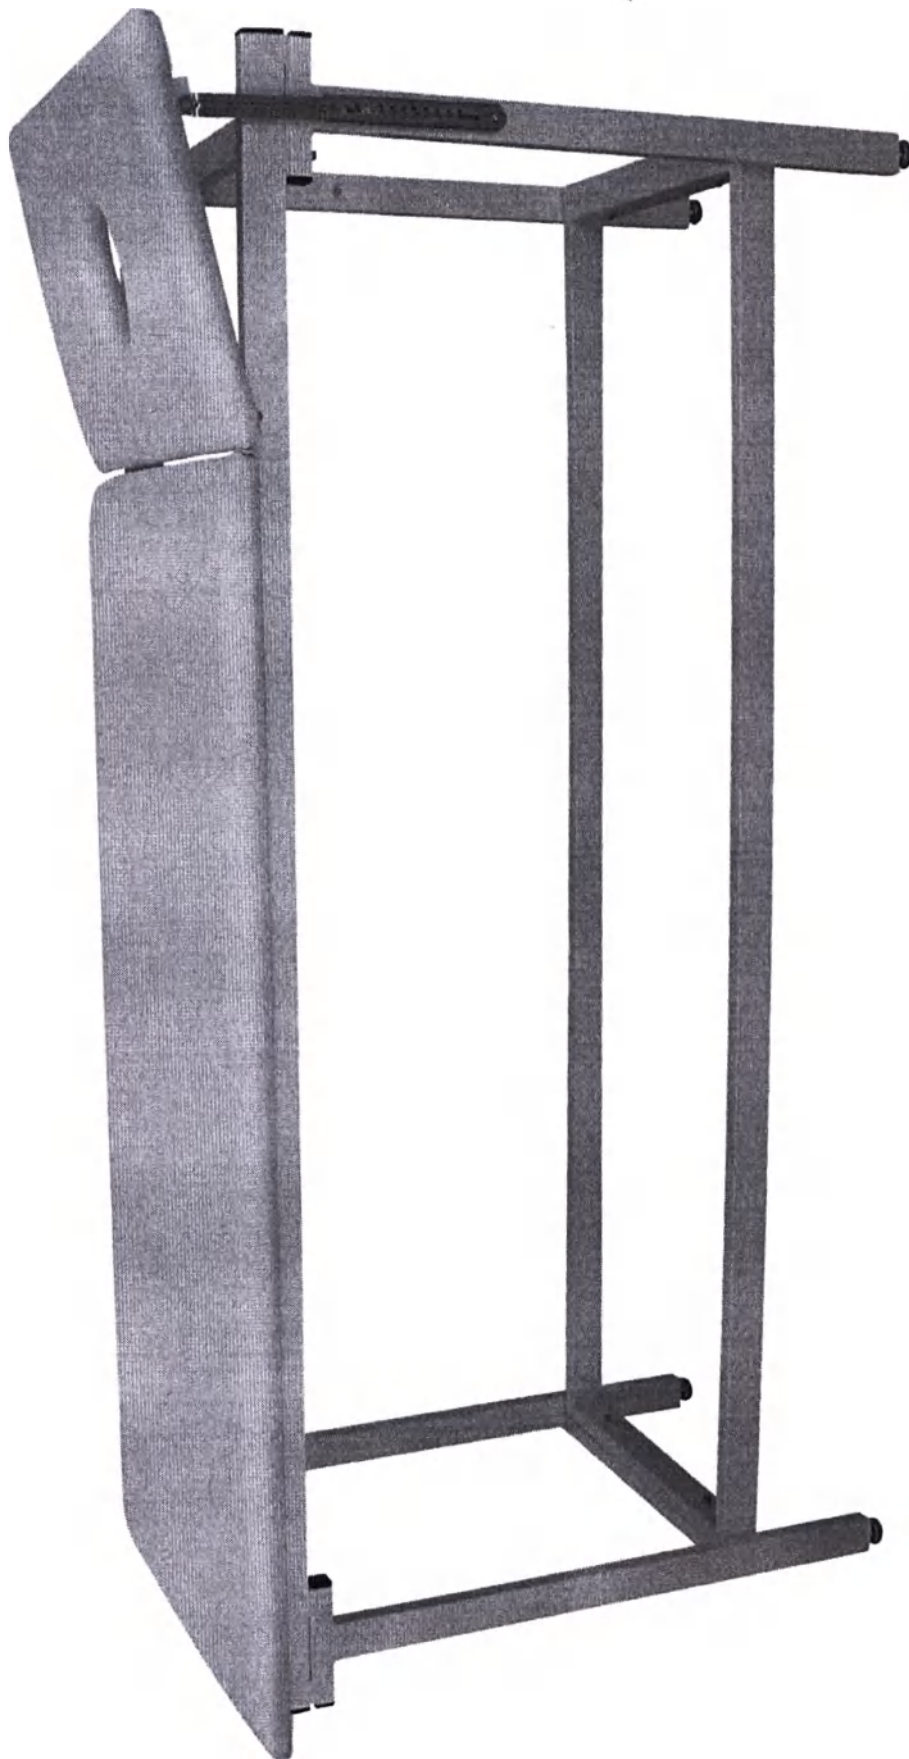

Шаблон маркировки


Юридический адрес: Россия, 410016, область Саратовская, г. Саратов, ул. им Орджоникидзе Г.К., д.6А, офис 7 Тел./Факс 8(927)128-77-87	Кушетка медицинская К-ХХХ по ТУ 32.50.30-003-24933245-2021	Изготовитель: ООО "ИНТЕРОН" Изготовлено в Российской Федерации
Заводской номер: ХХХХХХХХХХ	ГОСТ Р 50444-2020 ТУ 32.50.30-003-24933245-2021	РУ № ____ / ____ от ____
Дата изготовления: ХХХХХХХ	Порядок хранения, гарантии изготовителя: см. Руководство по эксплуатации ИНТН.942819.001 РЭ	Гарантийный срок хранения: 3 месяца Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев Срок службы: не менее 8 лет

Транспортировать изделие при температуре от -50 до +50 С и относительной влажности до 100%.
 Хранить изделие в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже плюс 2
 С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
 Допускается перевозка изделия любым крытым видом транспорта, при соблюдении правил
 транспортировки.


Маркировка изделия на примере

Кушетка медицинская К-100

Юридический адрес: Россия, 410015, область Саратовская, г. Саратов, ул. им Орджоникидзе Г.К., д.6А, офис 7 Тел./Факс 8(927)120-77-87	Кушетка медицинская К-100 по ТУ 32.50.30-003-24933245-2021	Изготовитель: ООО "ИНТЕРОН" Изготовлено в Российской Федерации
Заводской номер: С00011	ГОСТ Р 50444-2020 ТУ 32.50.30-003-24933245-2021	РУ № ____/____ от ____
Дата изготовления: 28.09.2021	Порядок применения, гарантии изготовителя: см. Руководство по эксплуатации ИНТН.942819.001РЭ	Гарантийный срок хранения: 3 месяца Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев Срок службы: не менее 8 лет
Транспортировать изделие при температуре от -50 до +50 С и относительной влажности до 100%. Хранить изделие в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже плюс 2 С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%. Допускается перевозка изделия любым крытым видом транспорта, при соблюдении правил транспортировки.		

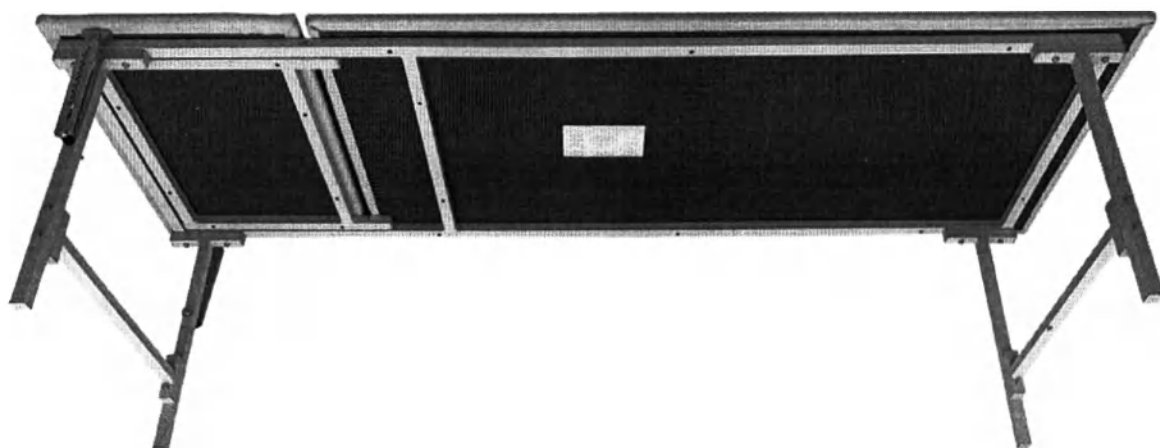

Пример маркировки транспортной упаковки на примере
Кушетка медицинская К-100

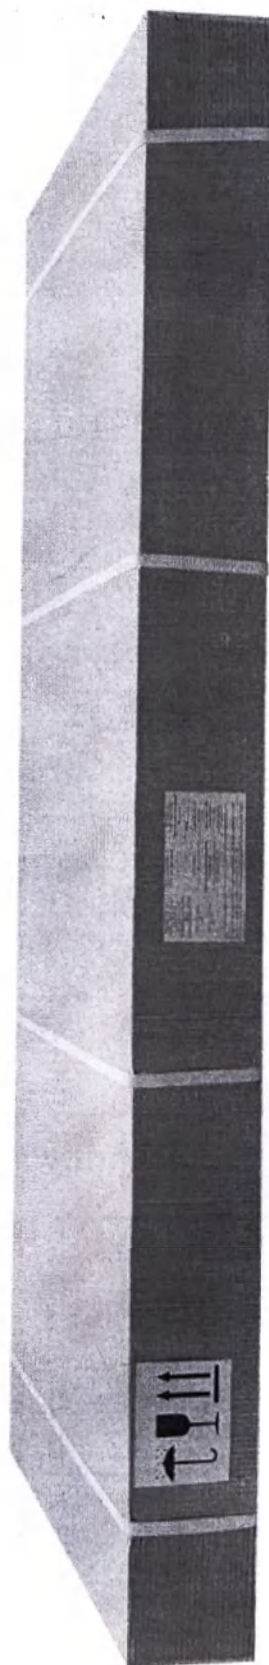

прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 100982386) лист(ов)

Директор ООО «ИНТЕРОН»

Пархоменко А А

« 22 » Января 2021 г.