

Фотографические изображения
медицинского изделия

Антитела конъюгированные IOTest

***CD19 для определения популяций клеток, экспрессирующих
CD19 антиген, методом проточной цитометрии в образцах крови
человека, в вариантах исполнения***

Специалист по регистрации

ООО «Бекмен Культер»

Андросова Ю.В.




«17» декабря 2021 г.


Антитела конъюгированные IOtest CD19-PC5.5 для определения популяции клеток, экспрессирующих CD19 и CD5.5, в проточной цитометрии в образцах крови человека, 50 тестов; первичная упаковка




Антитела конъюгированные IOTest CD19-PC5.5 для определения популяций клеток, экспрессирующих CD19 антиген методом проточной цитометрии в образцах крови человека, 50 тестов; вторичная упаковка

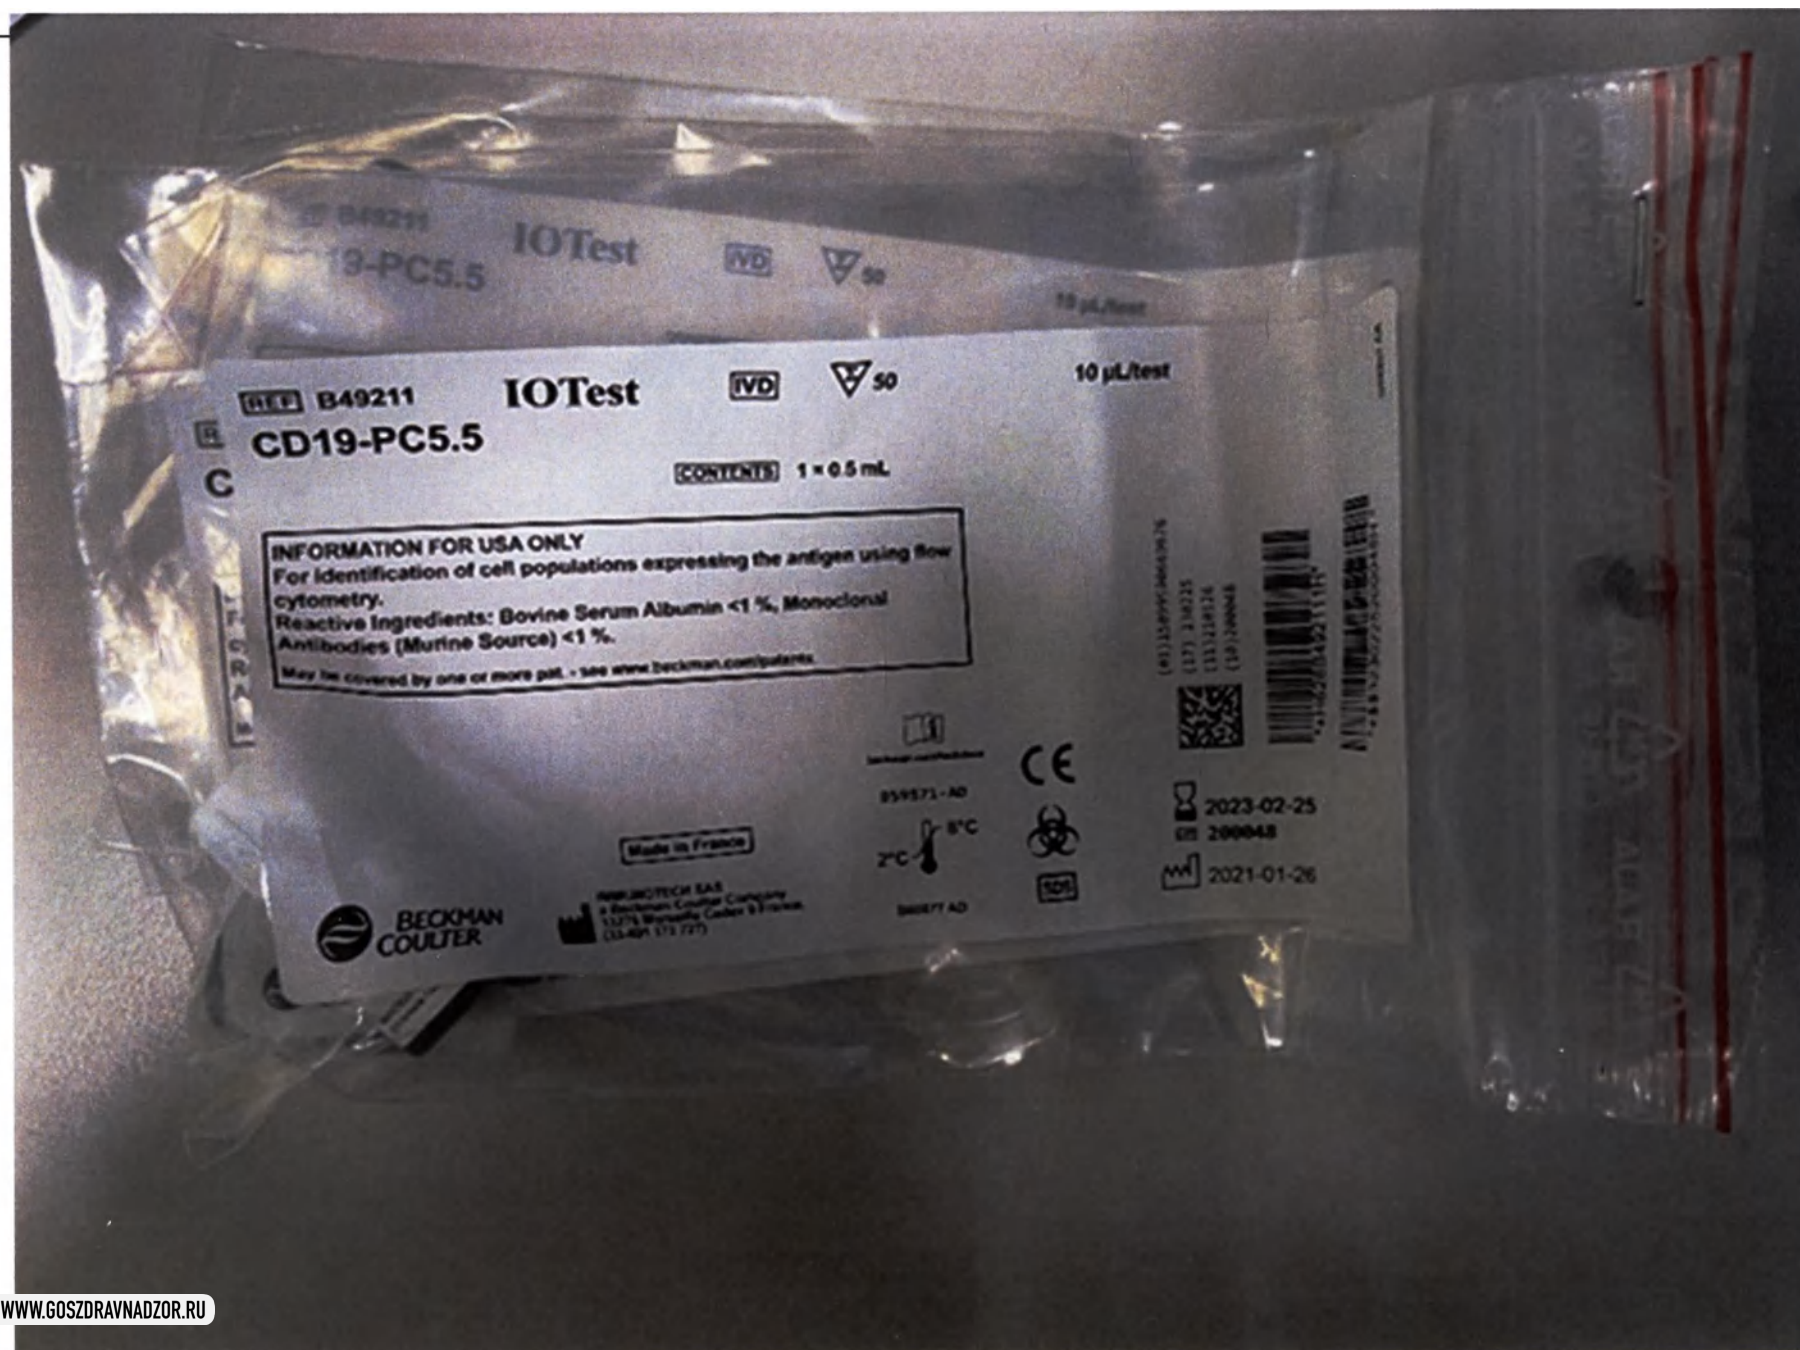


Антитела конъюгированные IOTest CD19 APC-Alexa Fluor 700 для определения популяций клеток, экспрессирующих CD19 антиген методом проточной цитометрии, в образцах крови человека, 50 тестов; первичная упаковка

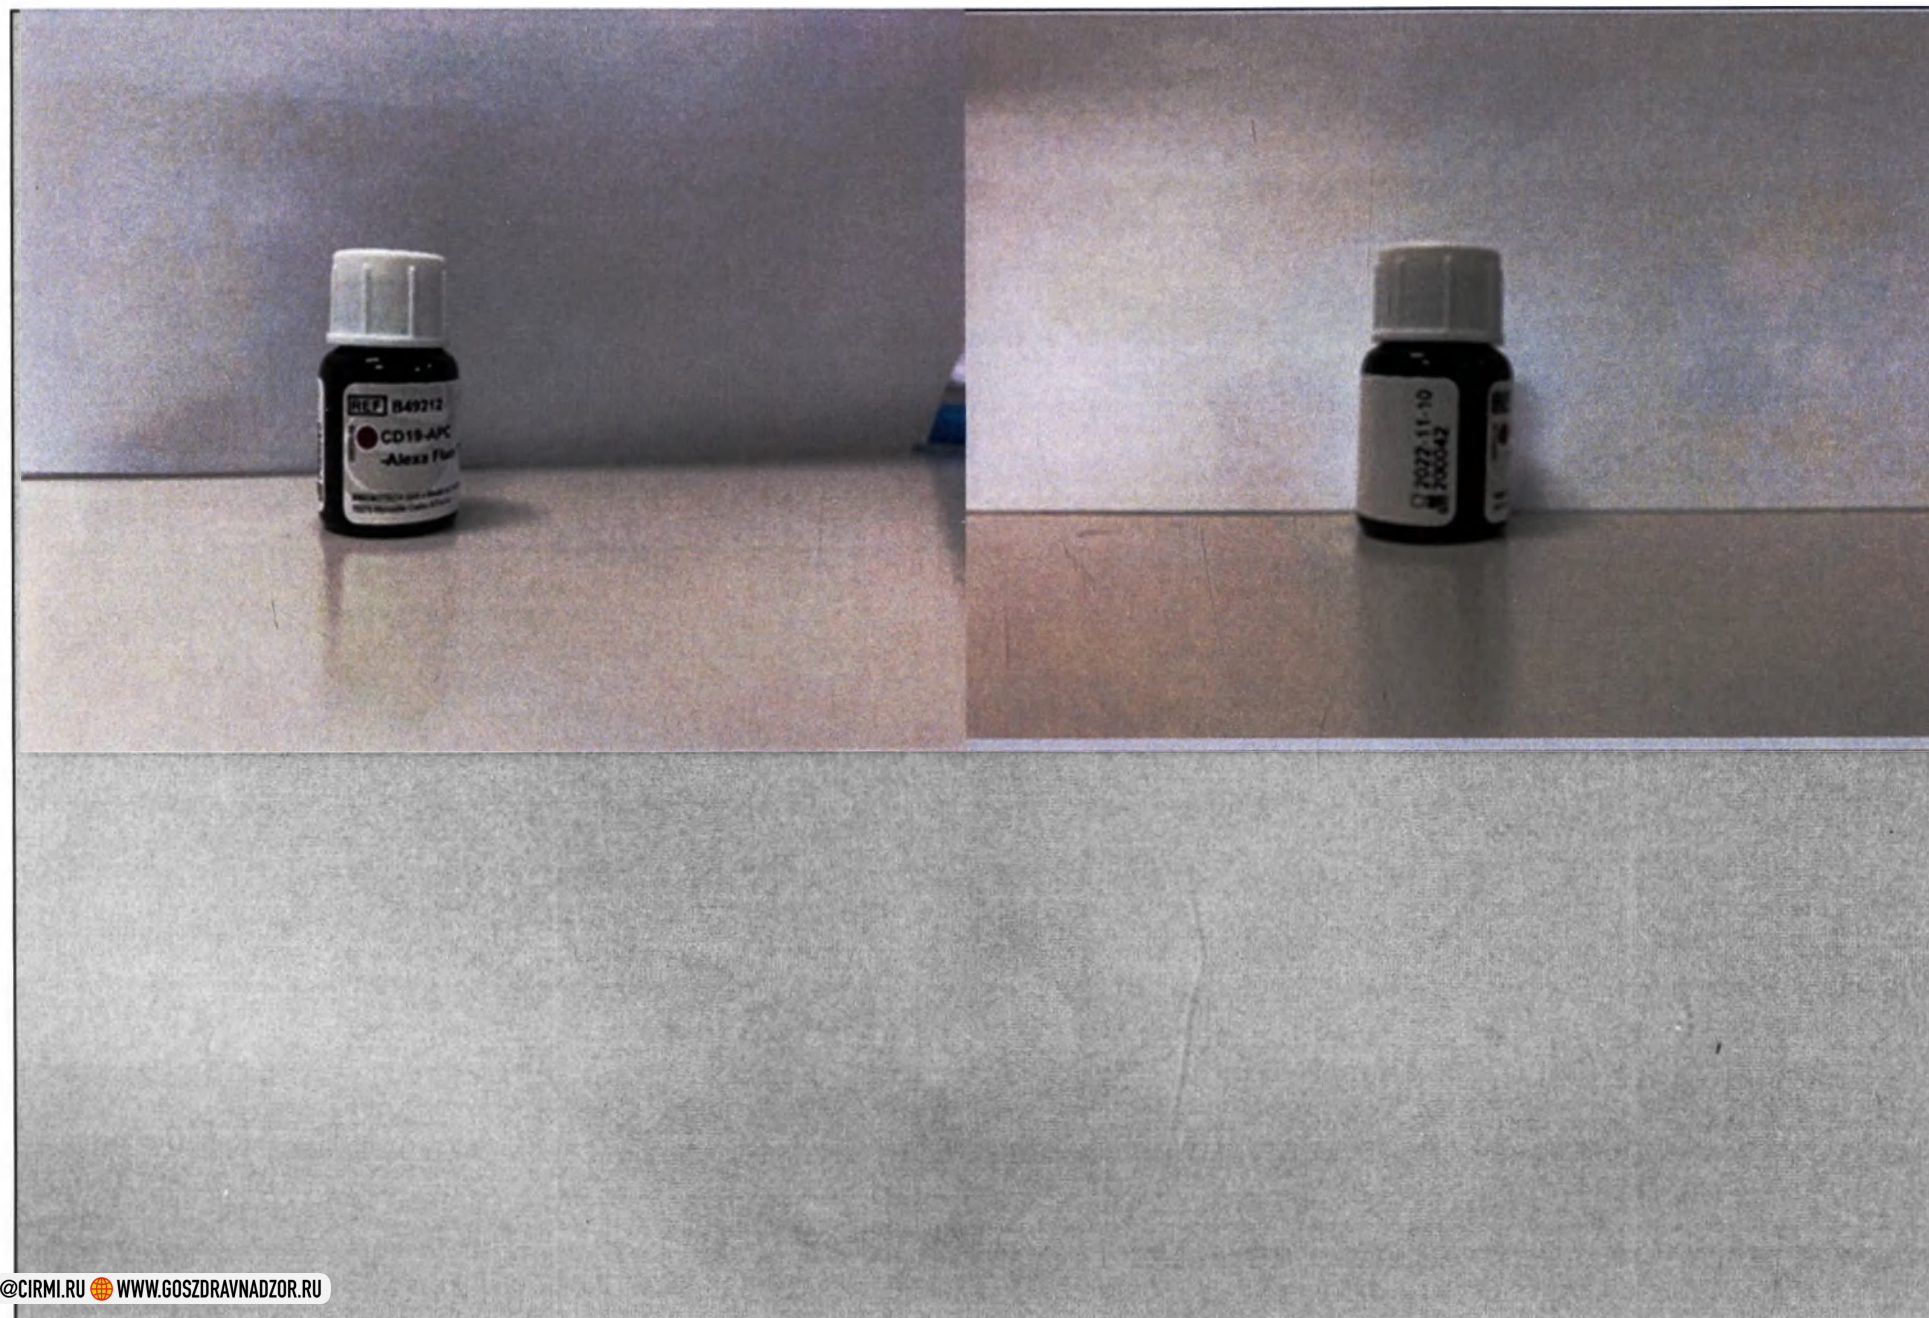


Антитела конъюгированные IOtest CD19 APC-Alexa Fluor 700 для определения популяций клеток, экспрессирующих CD19 антиген методом проточной цитометрии, в образцах крови человека, 50 тестов; вторичная упаковка

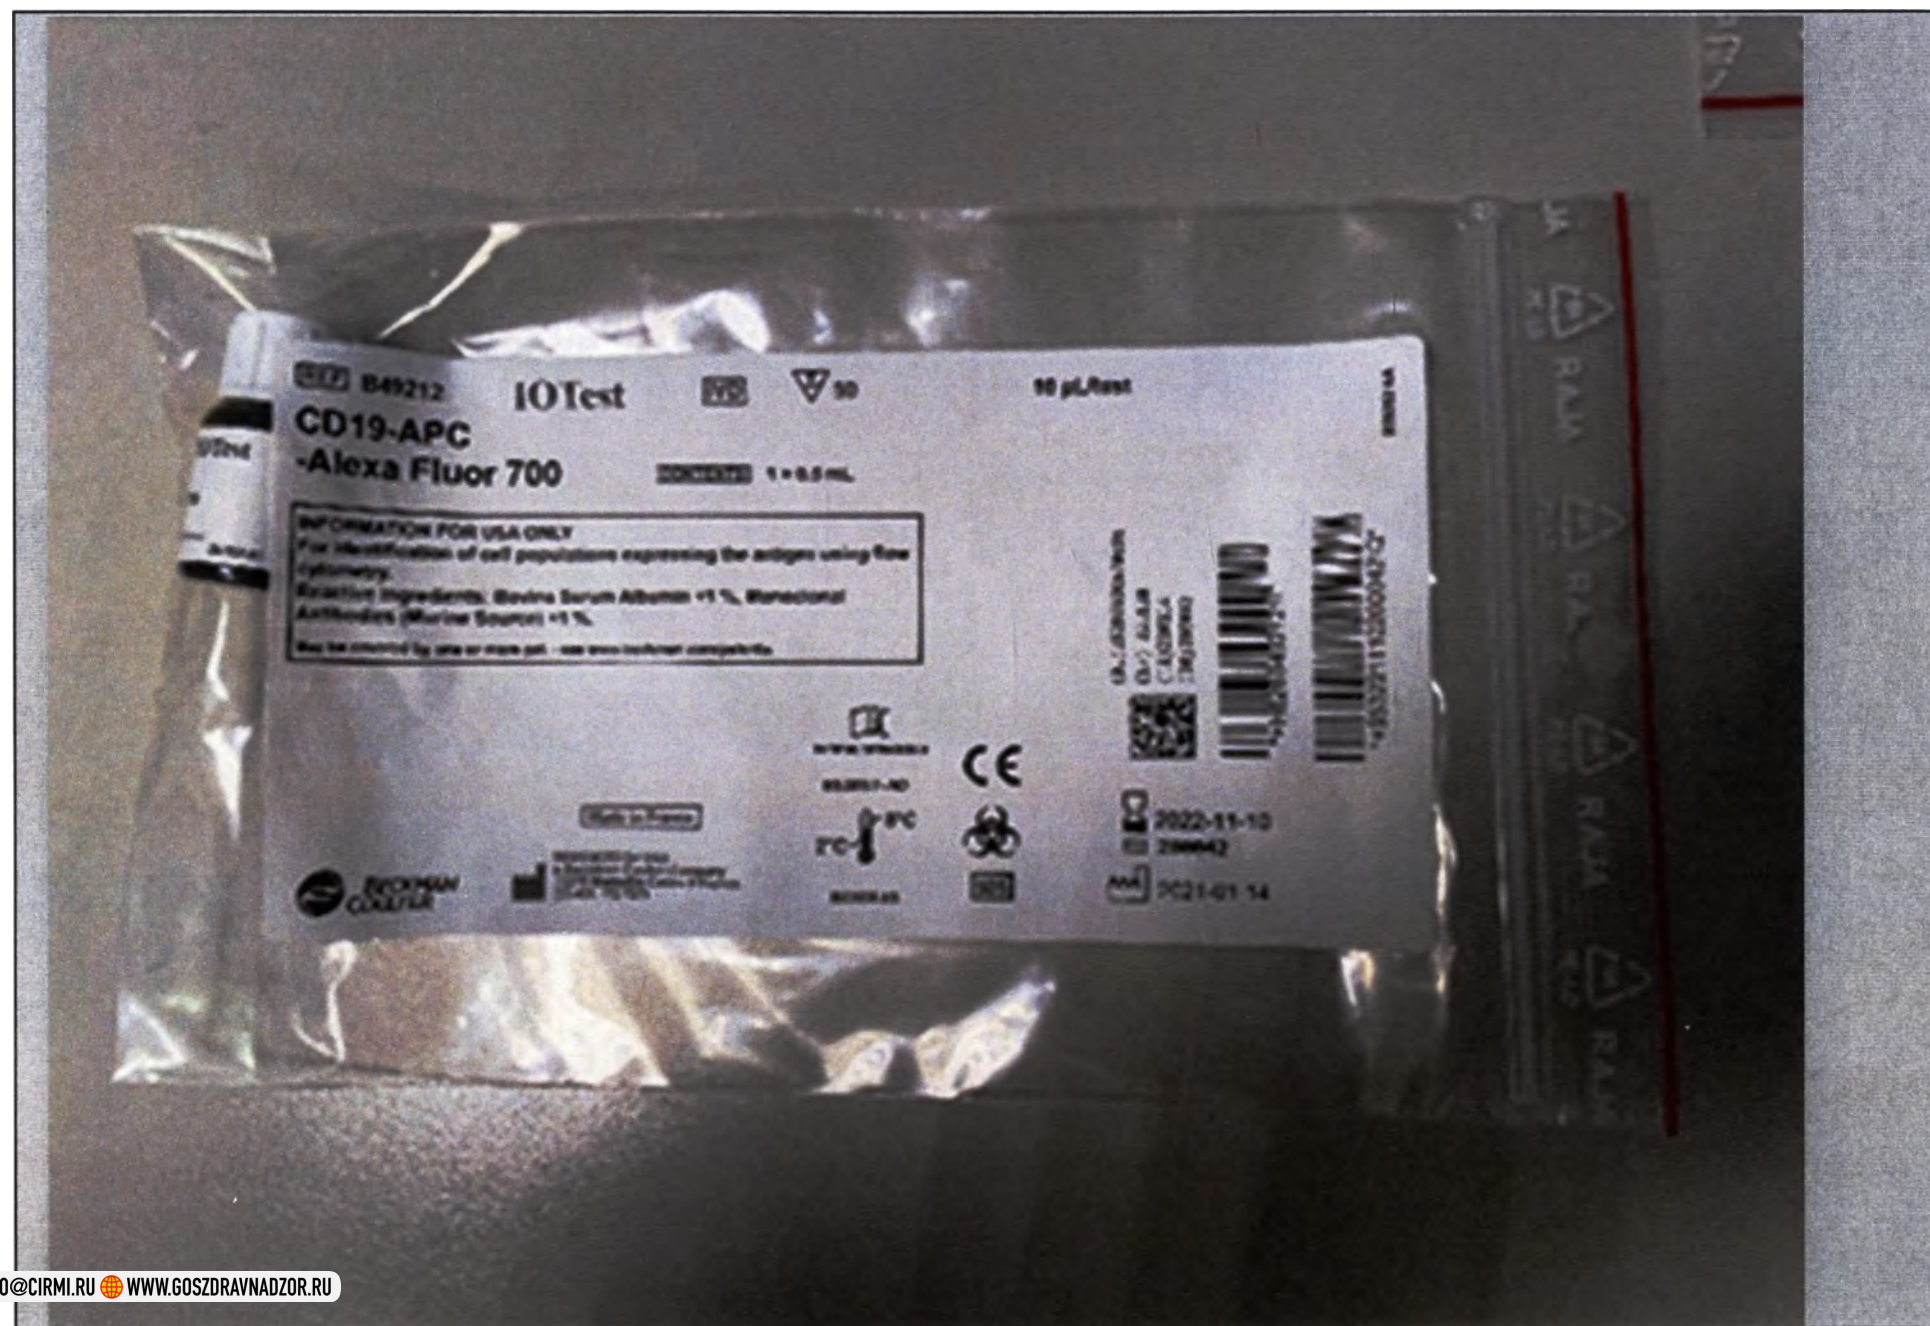

Антитела конъюгированные IOtest CD19 Pacific Blue (PB) для определения популяций клеток, экспрессирующих CD19 антиген методом проточной цитометрии в образцах крови человека, 50 тестов. Первичная упаковка

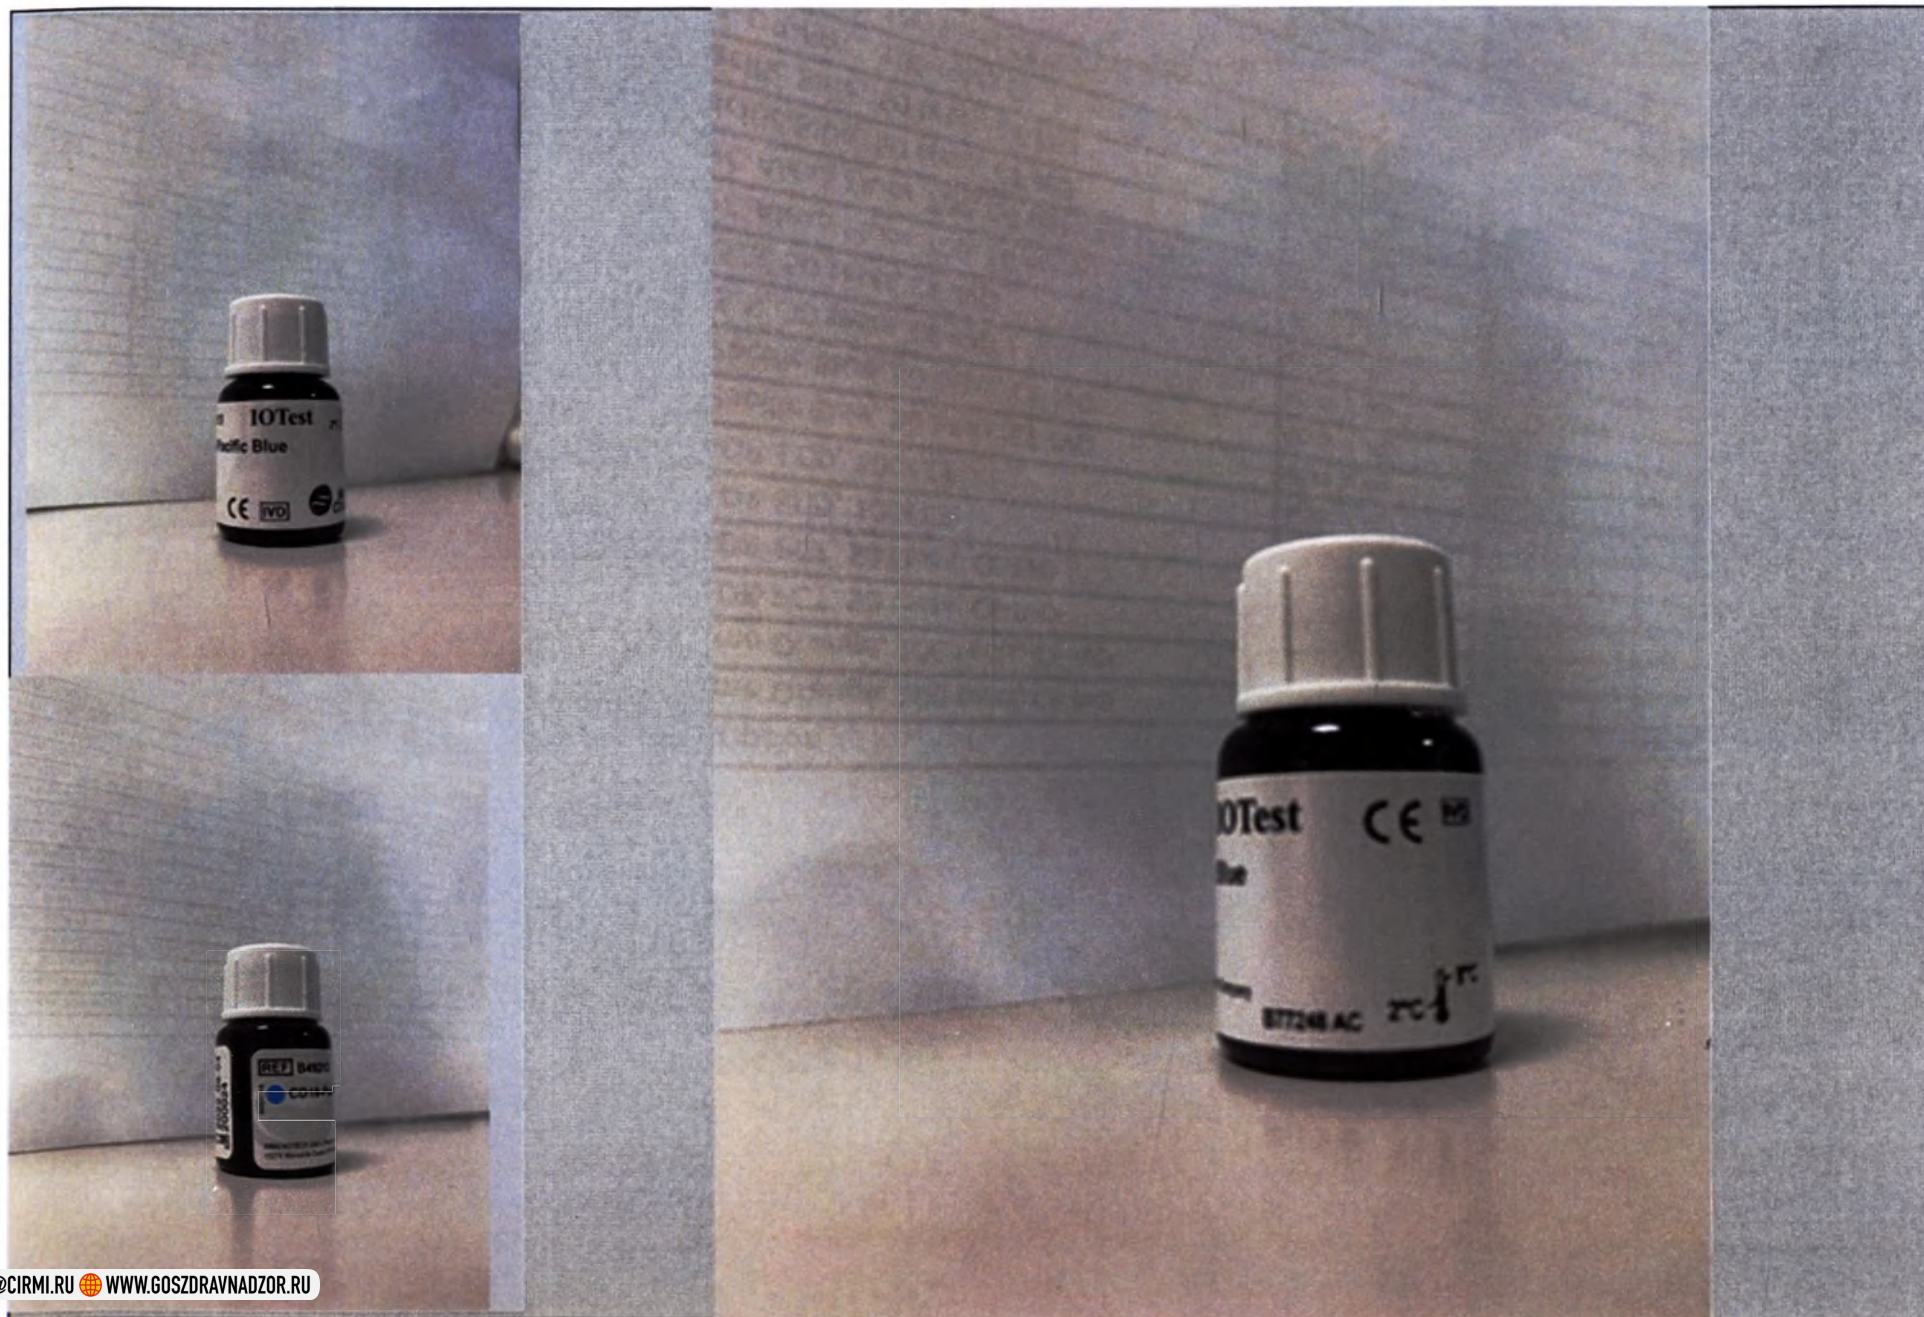

Антитела конъюгированные IOtest CD19 Pacific Blue (PB) для определения популяций клеток, экспрессирующих CD19 антиген методом проточной цитометрии в образцах крови человека, 50 тестов. Вторичная упаковка

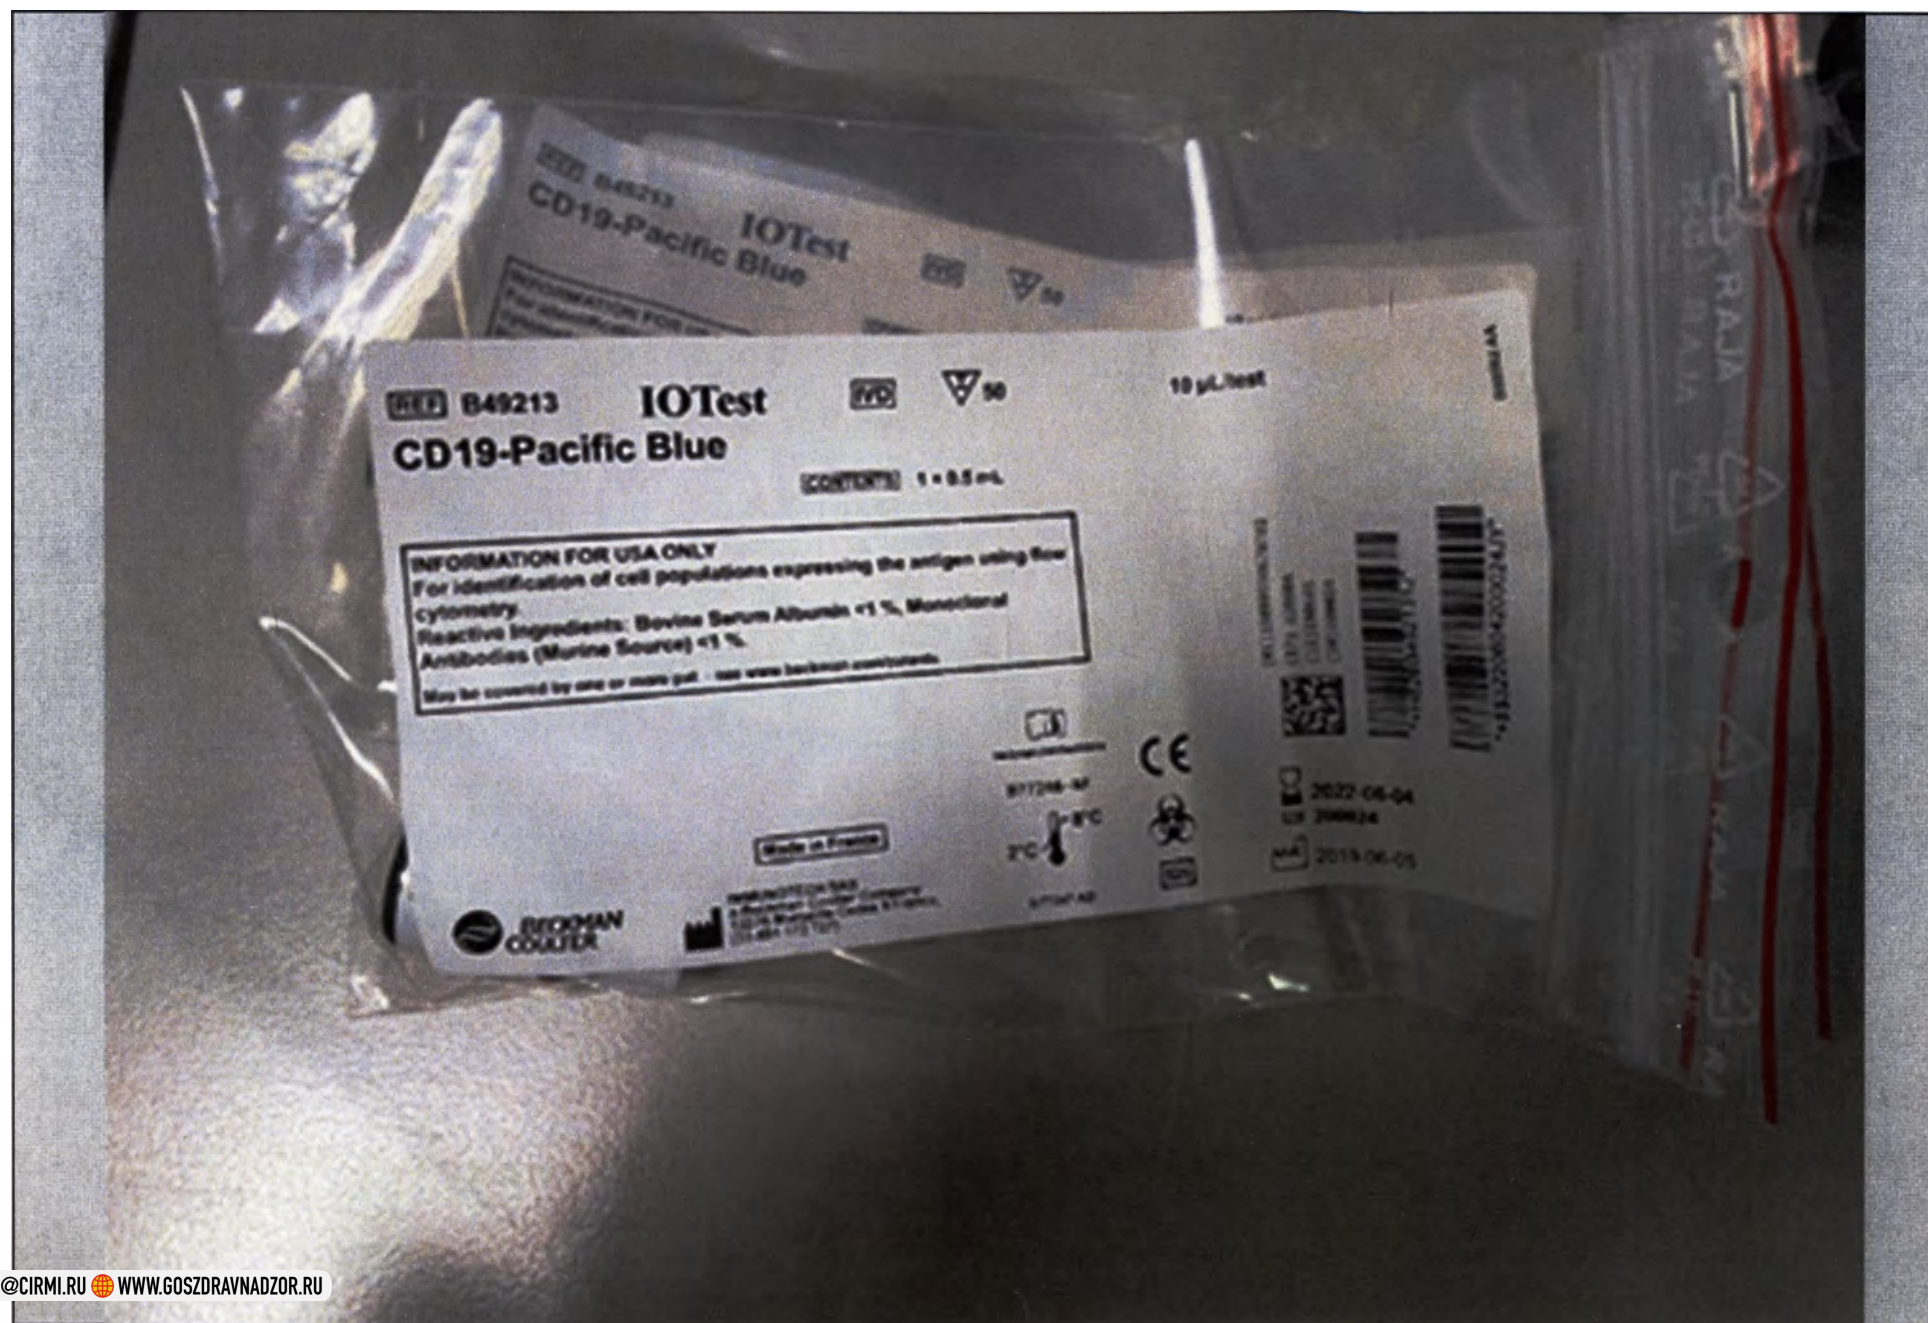

Продублировано
и скреплено печатью

