



ПОДТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО «Эрба Рус»

Иконников М.В.

2022 г.

Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

Устройство автоматическое для иммуногистологического окрашивания и
гибридизации in situ Дако Омнис/Dako Omnis, с принадлежностями



Рисунок 1. Транспортная упаковка Устройство автоматическое для иммуногистологического окрашивания и гибридизации in situ Дако Омнис/Dako Omnis с принадлежностями.



Рисунок 2. Маркировка транспортной упаковки «Устройство автоматическое для иммуногистологического окрашивания и гибридизации in situ Дако Омнис/Dako Omnis с принадлежностями.»



Рисунок 3 Устройство автоматическое для иммуногистологического окрашивания и гибридизации in situ Дако Омнис/Dako Omnis, 1 шт;



КОПИЯ

Одобрено Аджилент Текнолоджис
Сингапур (Интернешнл) Пте. Лтд.

(Approved by Agilent Technologies
Singapore (International) Pte Ltd.)

Сотрудник ("Employee")

Paolo Ratti ФИО

(Paolo Ratti)

« » 18/05/2022 г.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

(BASIC USER GUIDE FOR A MEDICAL DEVICE)

«Устройство автоматическое для иммуногистохимического окрашивания и гибридизации
in situ Дако Омнис/Dako Omnis, с принадлежностями»

производства Agilent Technologies Singapore (International) Pte. Ltd.,
80 Robinson Road #02-00 Singapore (068898) (Сингапур)

2022

Рисунок 4. Дако Омнис Краткое справочное руководство (Dako Omnis Quick Reference Guide), 1 шт.





Рисунок 6. Источник бесперебойного питания для Дакс Омнис, 230 В (UPS Rack 230 V AC Omnis) модель: ABCE 1442-22R (59144-60R), производства (Италия), 1 шт



Рисунок 7. Сервер Дако Омнис и Дако Линк (Dako Omnis and DakoLink Server), модель: HPE ProLiant ML110Gen10, производства Hewlett Packard Enterprise Company, 1 шт.



Рисунок 8. Дако Омнис Рабочая станция (Dako Omnis Workstation Win 10) в составе:

- Системный блок DL 18030 HP Engage Flex Pro, производства HP Inc. - 1 шт;
- Монитор для Рабочей станции/Сервера, 19 дюймов (Monitor for Workstation/Server) HP eliteDisplay E190i LED Backlight IPS Monitor модель: HSTND-3891-W, производства HP Inc. - 1 шт;
- Мышь компьютерная - 1 шт;
- Клавиатура - 1 шт;





Рисунок 10. Монитор для Рабочей станции/Сервера, 19 дюймов (Monitor for Workstation/Server) HP eliteDisplay E190i LED Backlight IPS Monitor модель: HSTND-3891-W, производства HP Inc. - 1 шт;

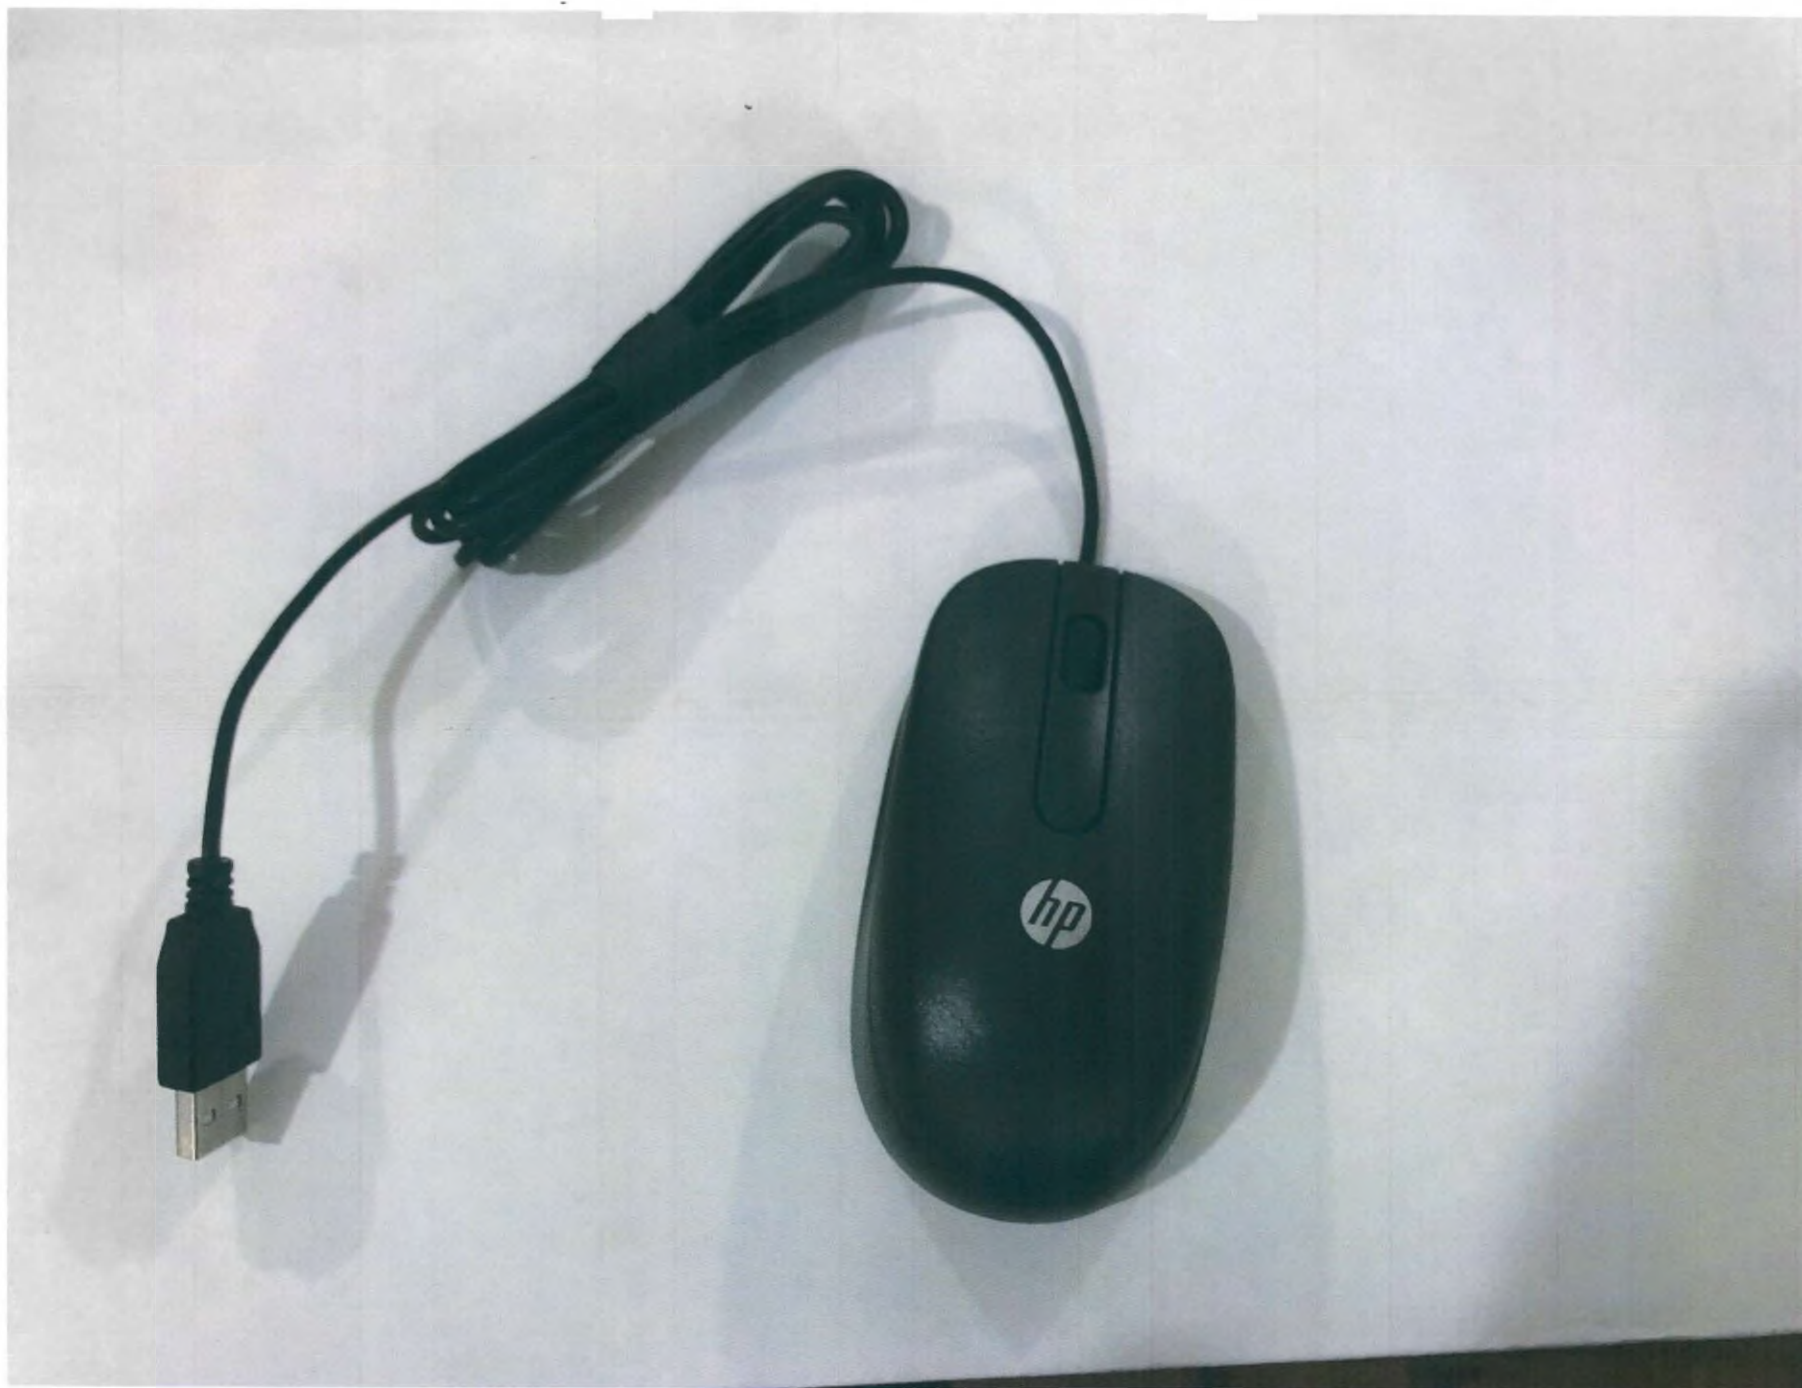


Рисунок 11. Мышь компьютерная - 1 шт



Рисунок 12. Клавиатура - 1 шт.



Рисунок 13. Сетевой принтер для печати этикеток (Network Label Printer) модель: GX430t, производства Zebra Technologies Corporation (при необходимости), не более 5 шт

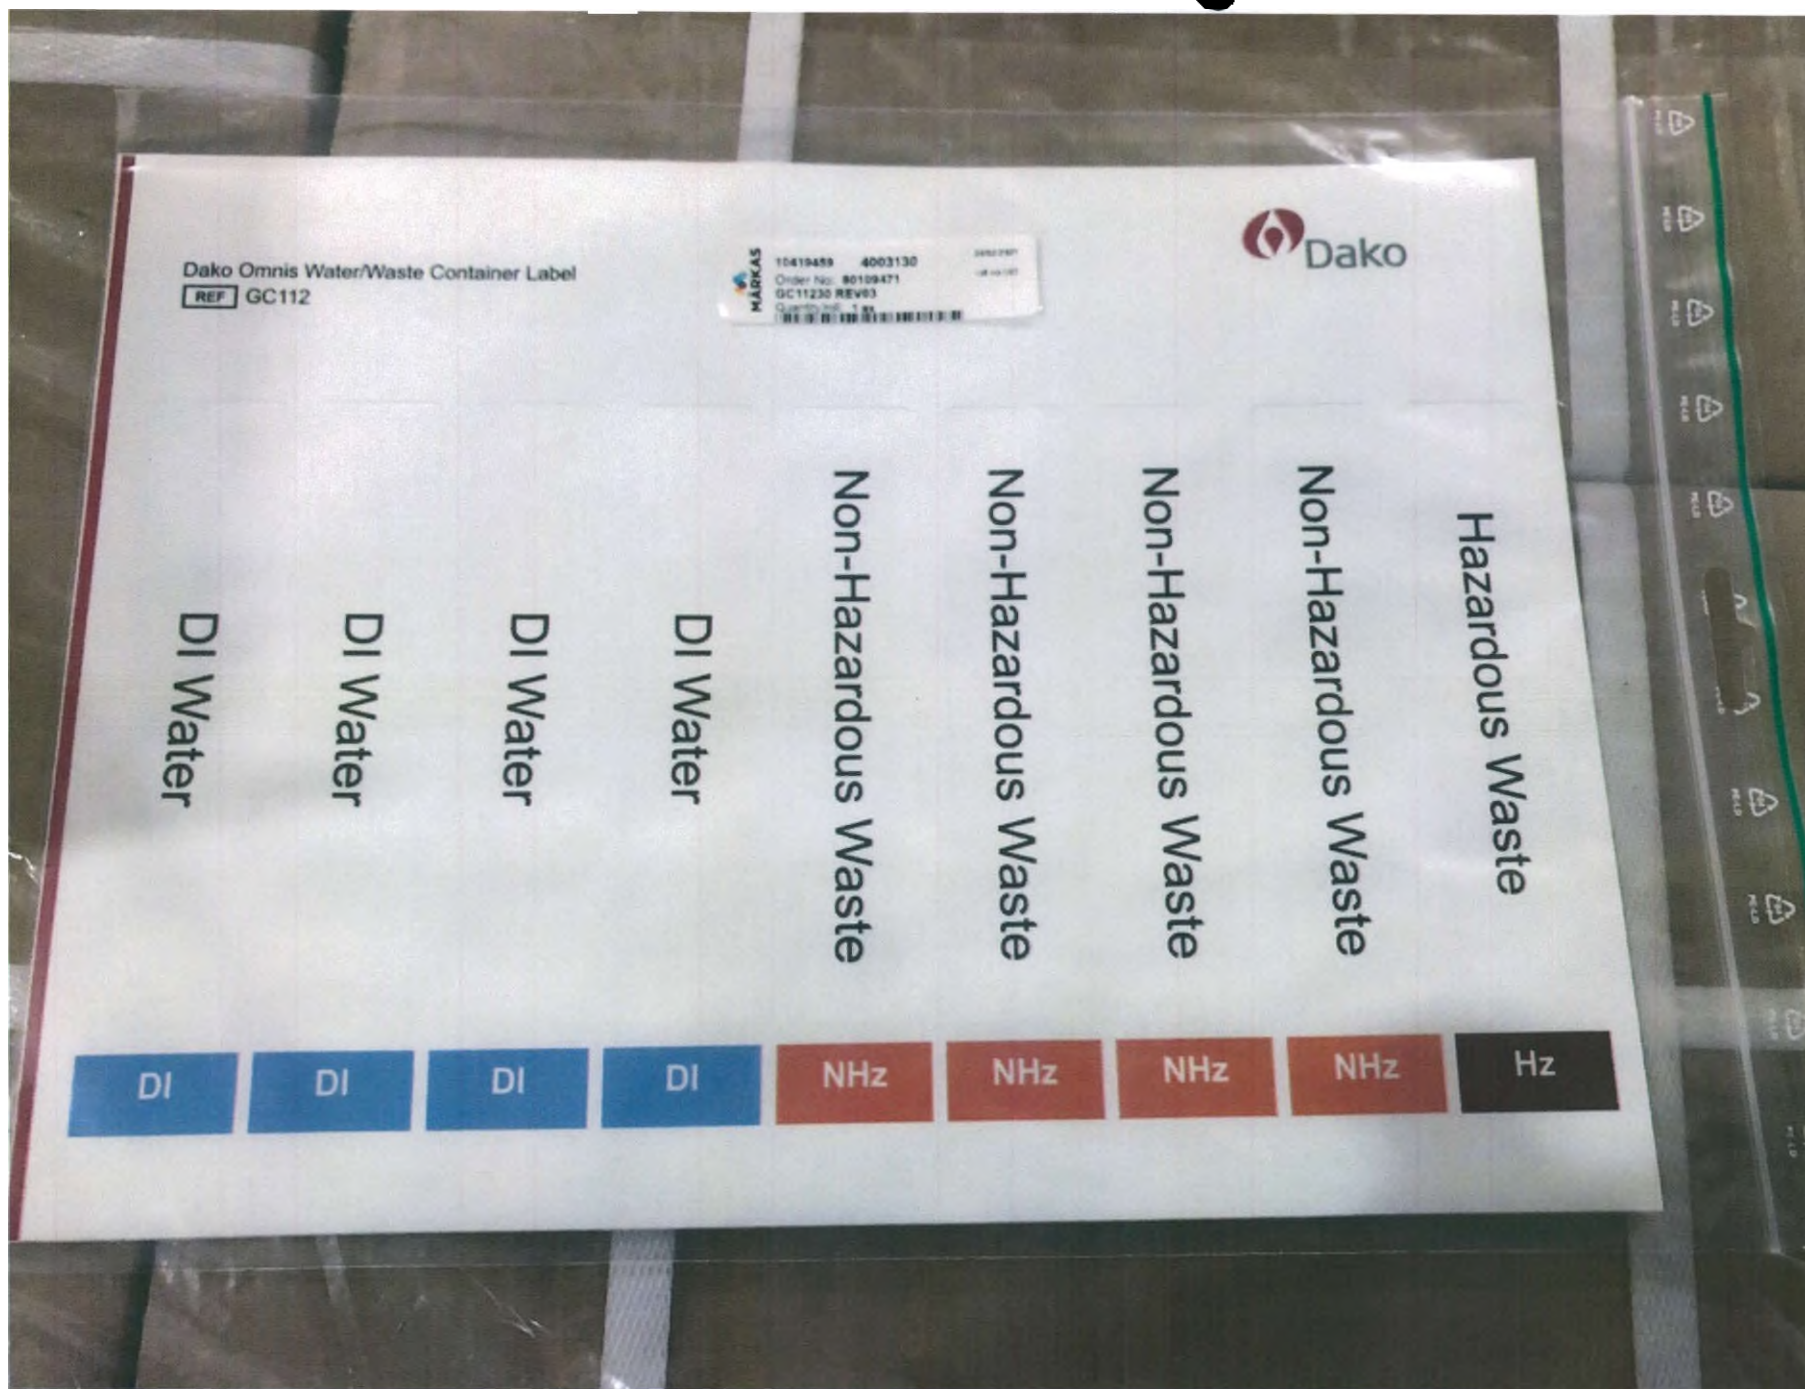


Рисунок 15. Дако Омнис Набор этикеток для бутылей с водой/отходами, 9 шт/лист (Dako Omnis Water/Waste Container Label sets, 9 labs 1 sheet) (при



Рисунок 16. Дако Омнис Набор кодовых штифтов для бутылей, 10 шт/упак (Dako Omnis cont Coding Pin) (при необходимости), не более 10 наборов



Рисунок 17. Принтер для печати отчетов Дако Линк (Dako Link Report Printer EMEA), модель: HP OfficeJet Pro 8210 Printer SNPRC-1603-01



Рисунок 18. Ручной сканер штрих-кодов (Handheld Barcode Scanner), модель: DS4308, производства Symbol Technologies, Inc. (при необходимости), не



Рисунок 19. Подставка для ручного сканера штрих-кодов (Stand for Hand-held Barcode Scanner) (при необходимости), не более 5 шт



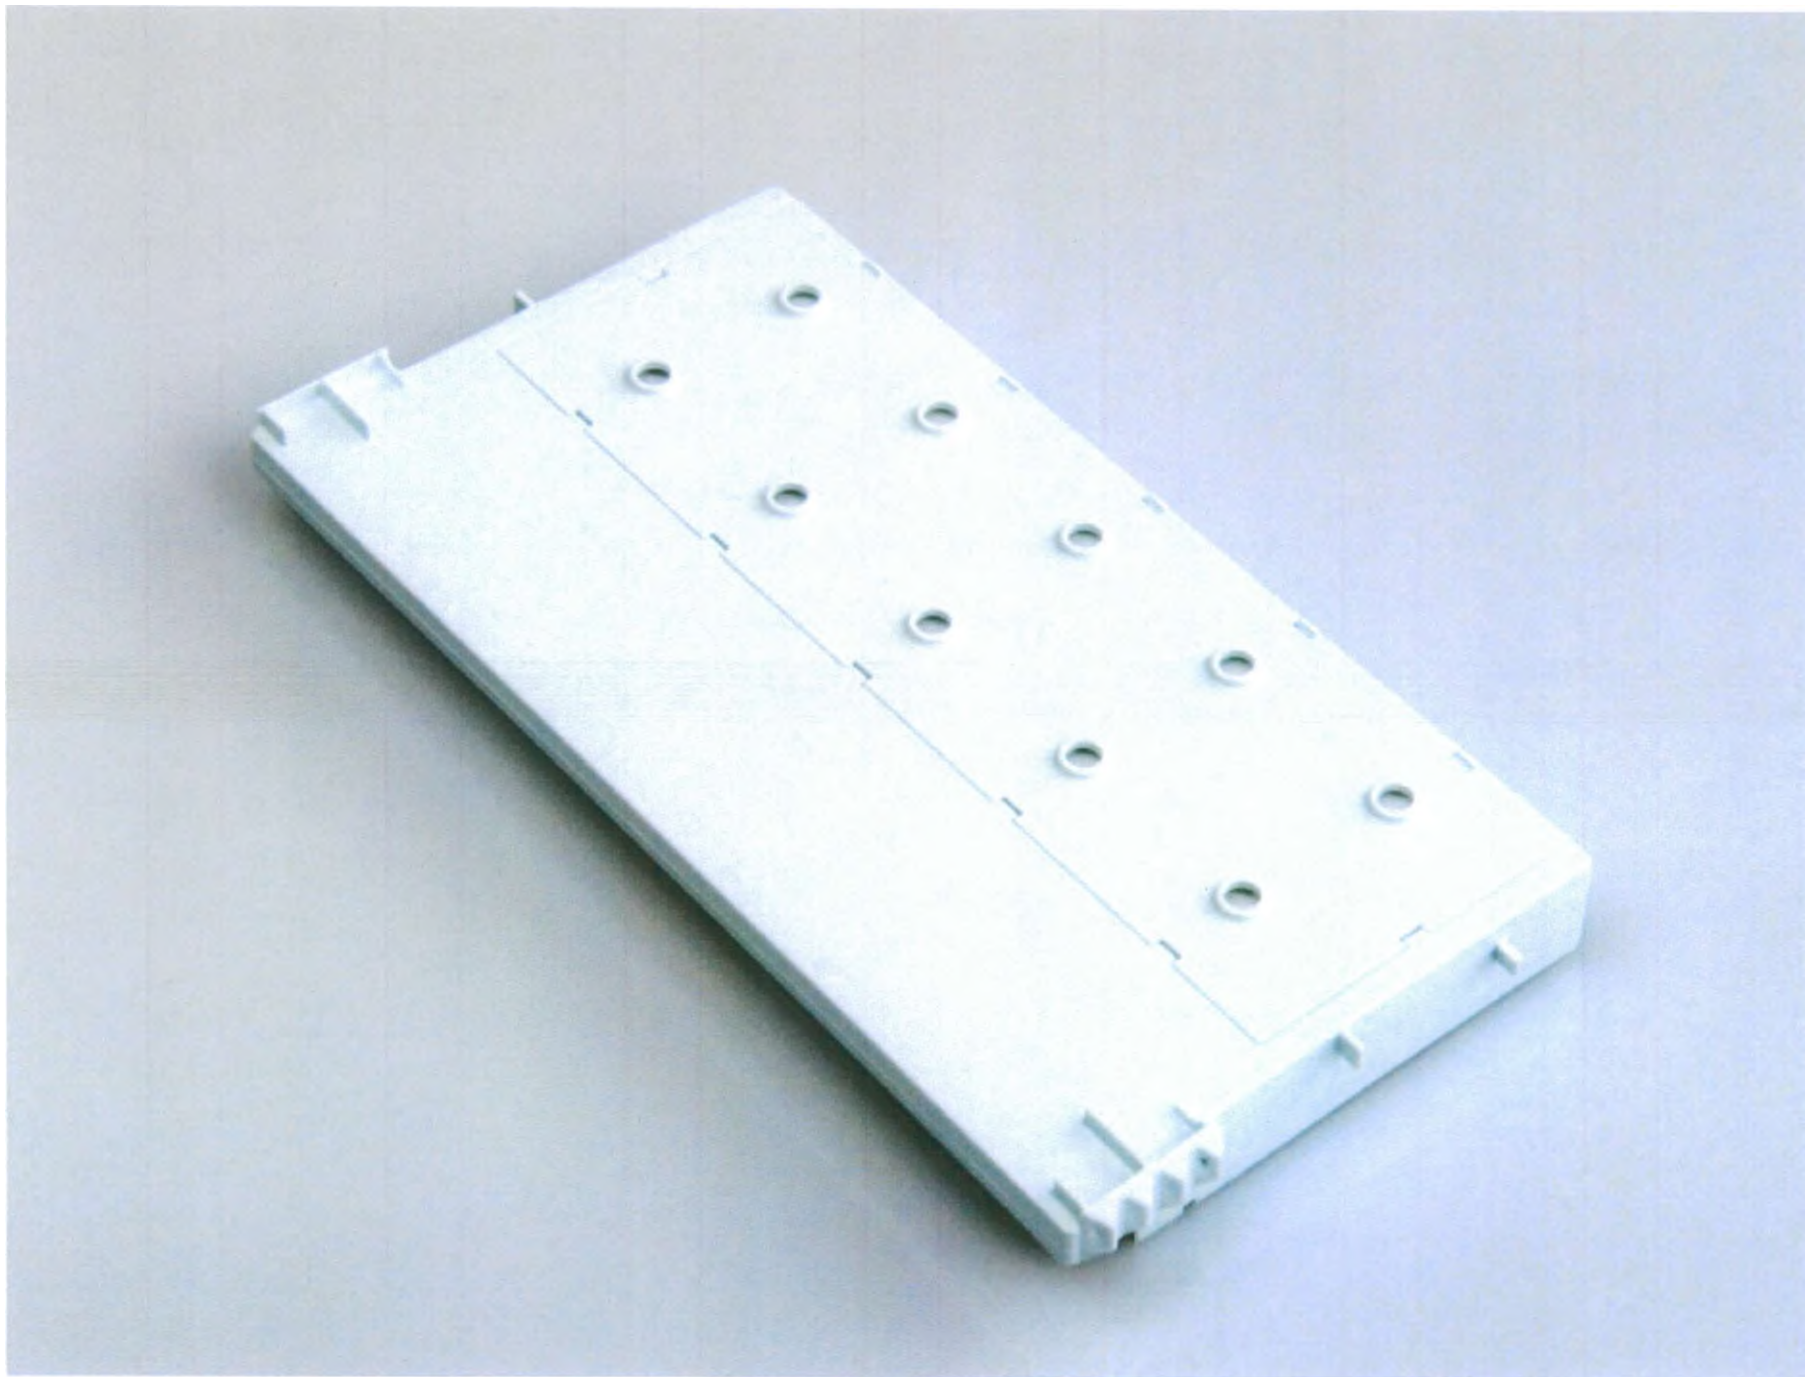




Рисунок 22. Дако Омнис Пакет для твердых отходов, 25 шт/рул (Dako Omnis Solid Waste Bag, 1 roll of 25 bag) (при необходимости), не более 5 рул



Рисунок 23. Дако Омнис Бутыль для буфера/растворителя, 3,5 л, 4 шт/упак (Dako Omnis Buffer/Solv cont, 3.5 L,4 pc) (при необходимости), не более 10

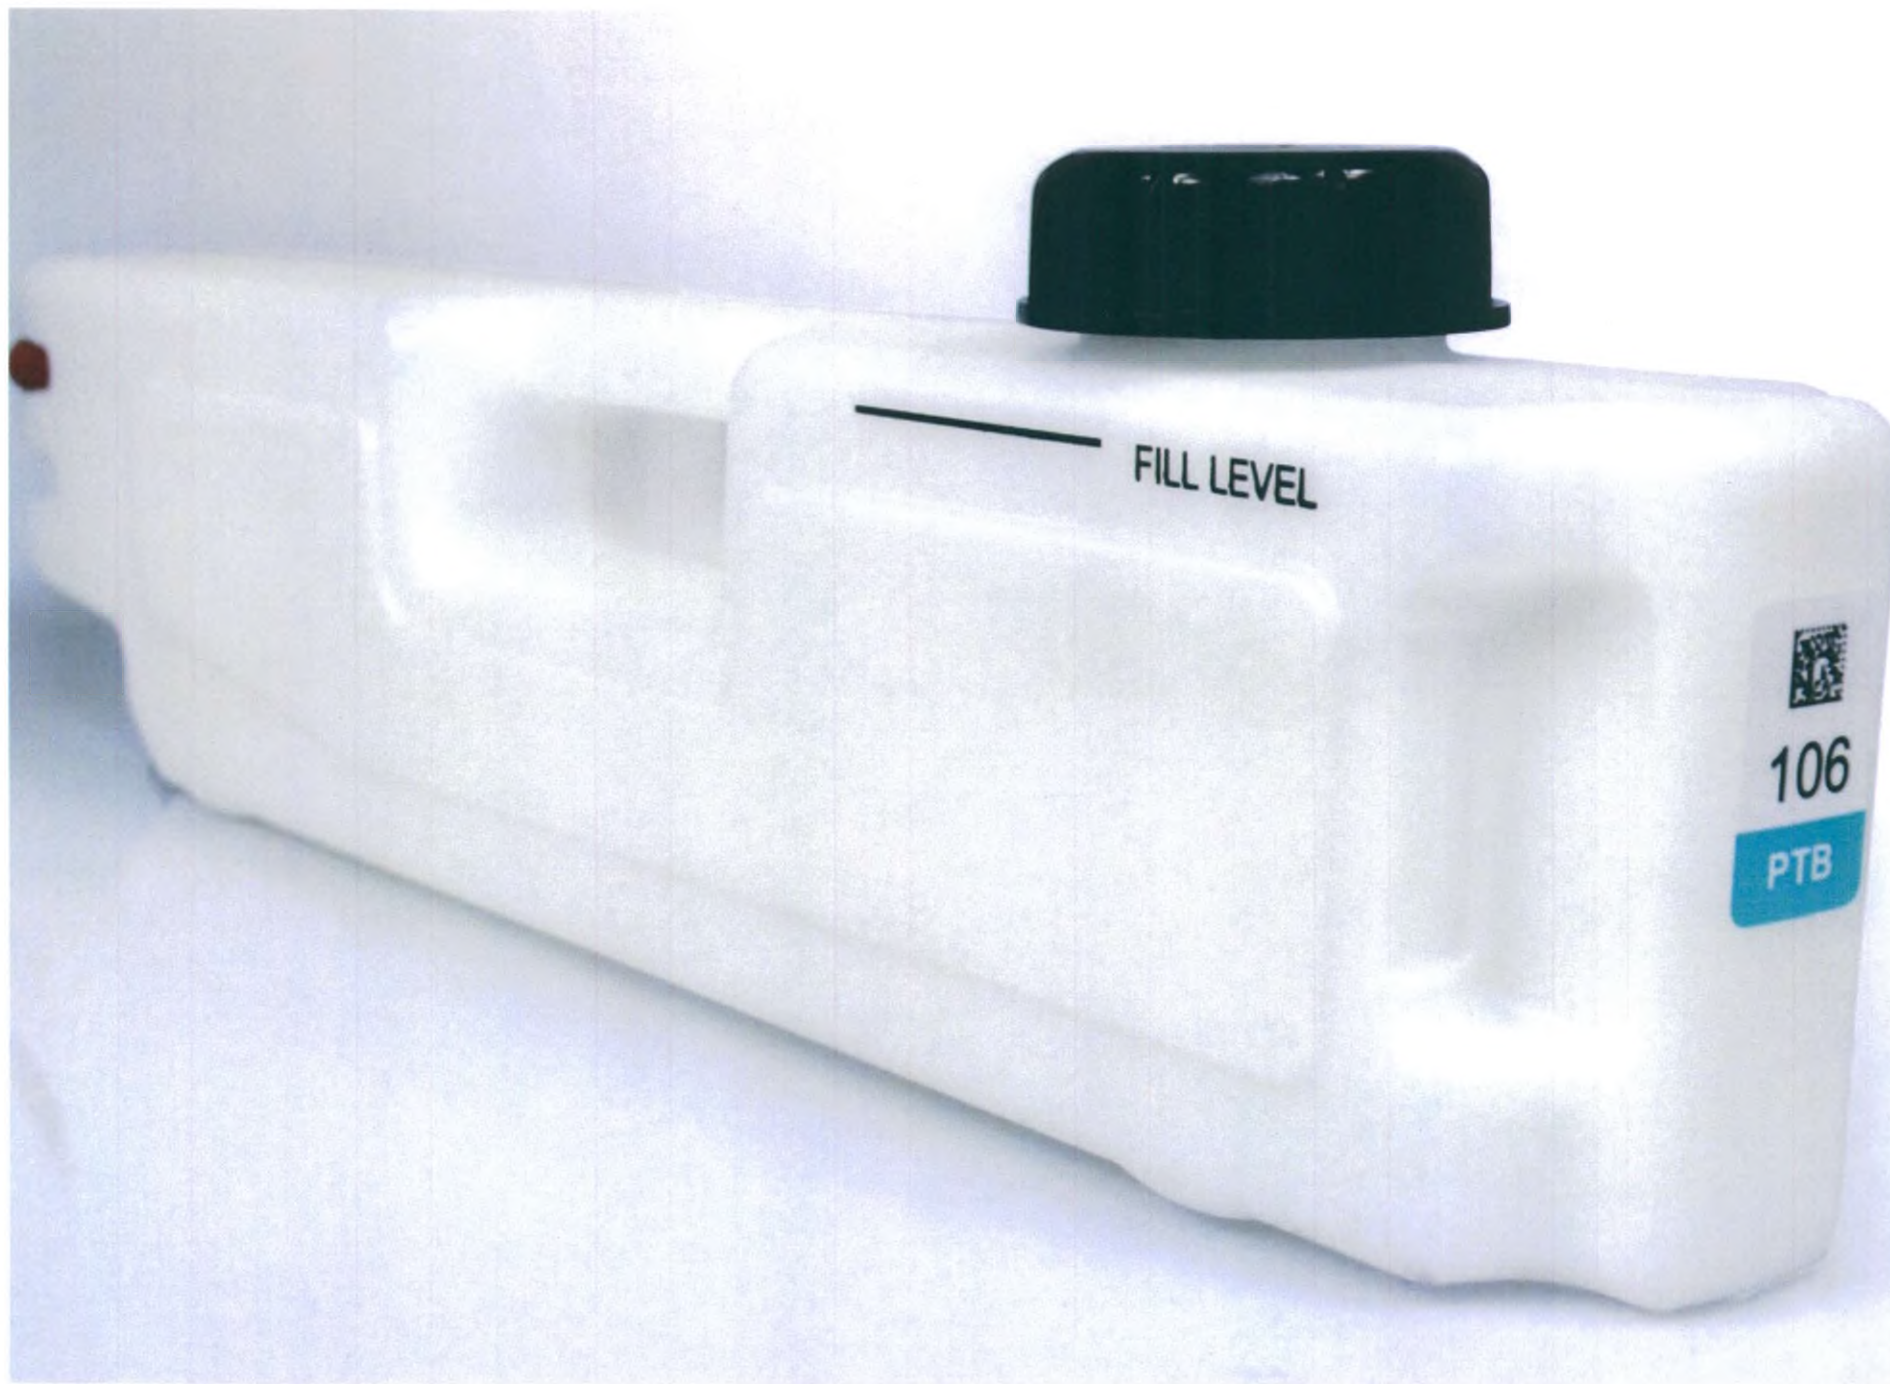


Рисунок 24. Дако Омнис Бутыль для воды, 7 л, 5 шт/упак (Dako Omnis Water cont, 7 L, 5 pcs) (при необходимости), не более 10 упак



Рисунок 25. Дако Омнис Бутыль для отходов (со стальным соединителем), 7 л, 5 шт/упак (Dako Omnis Waste Container, 7 L, steel coupling) (при необходимости), не более 10 упак;

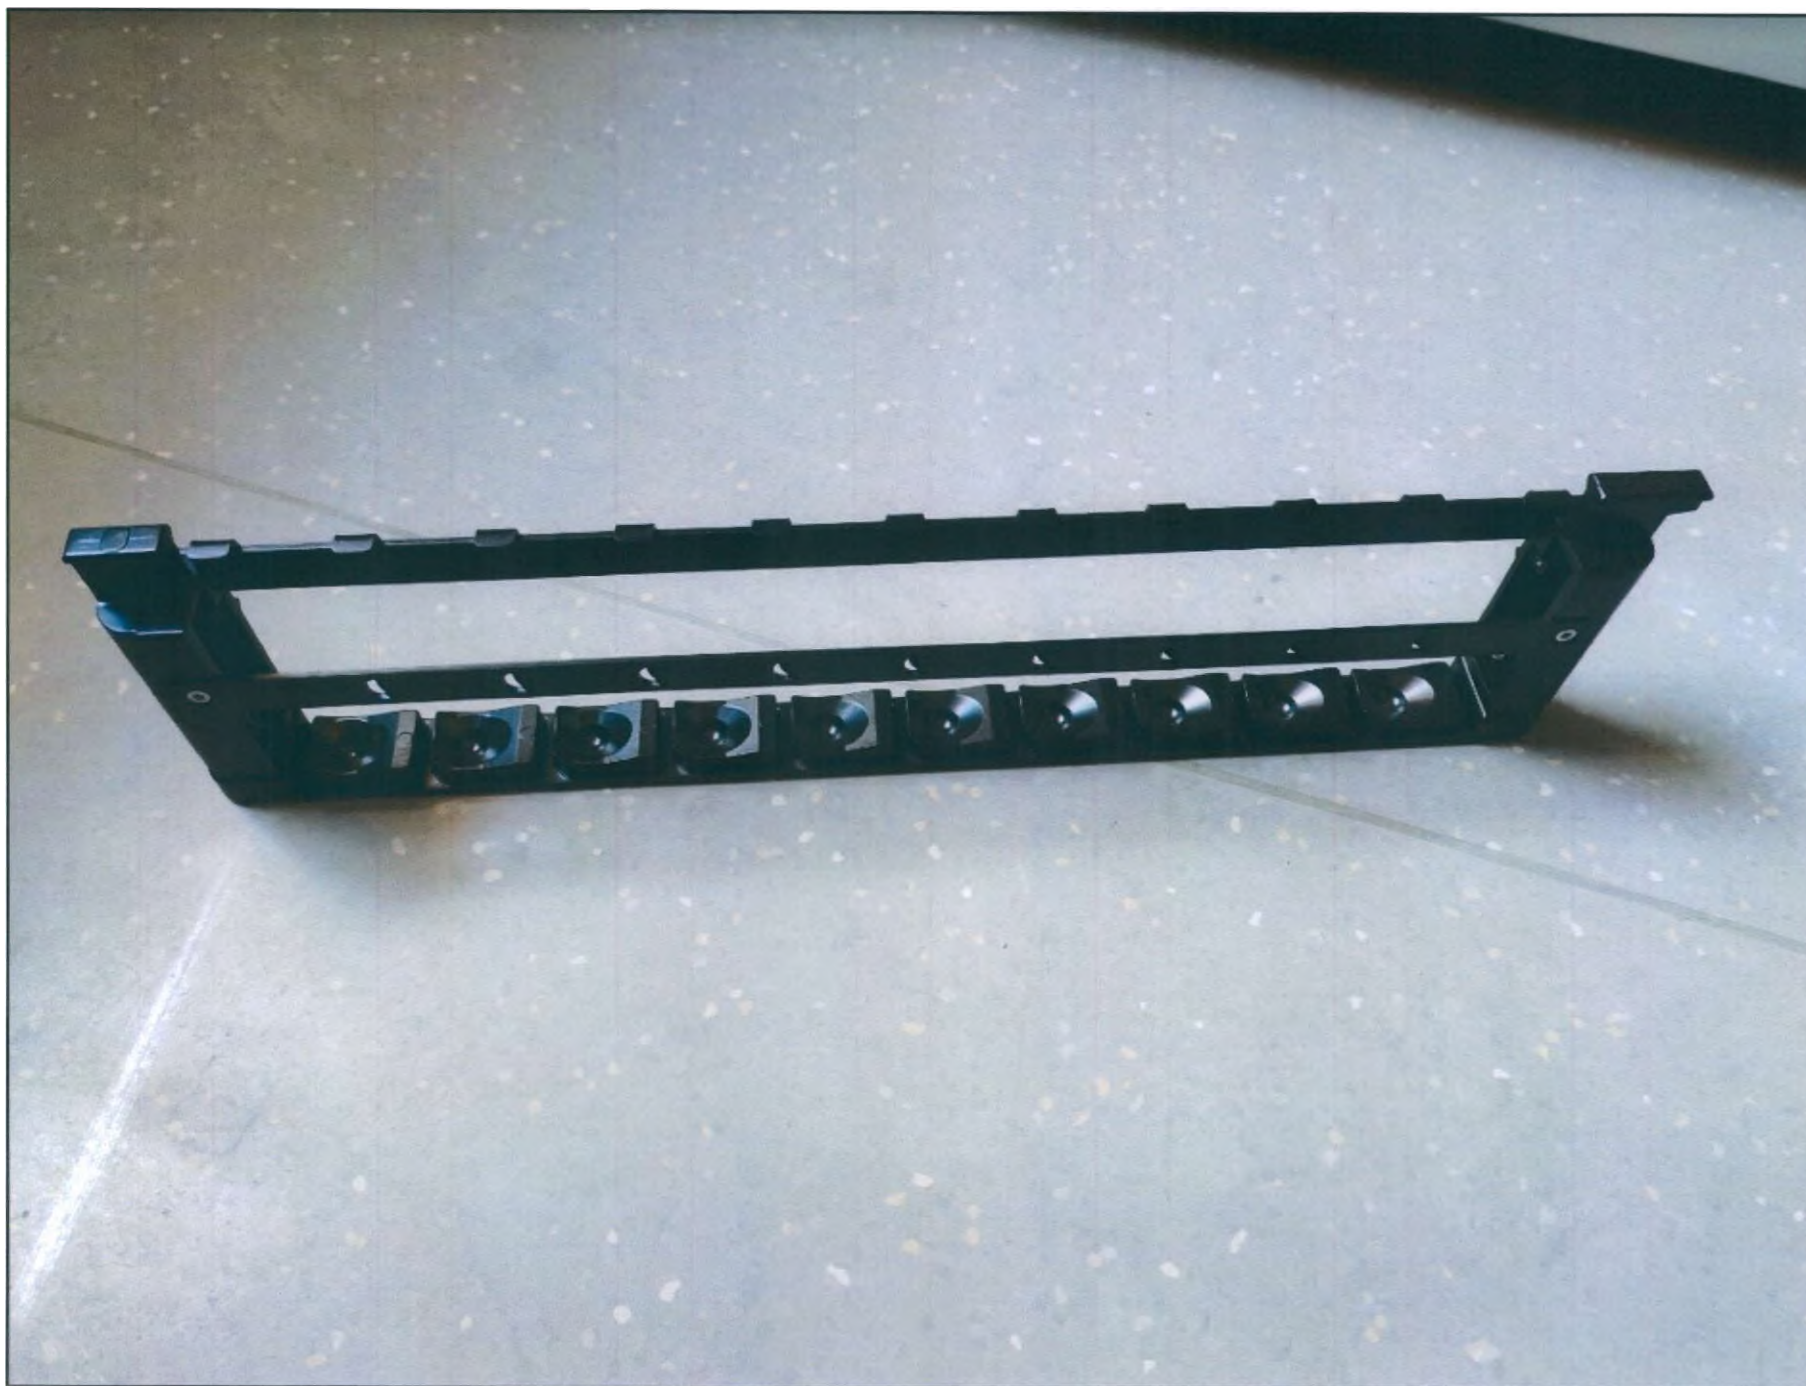




Рисунок 29. Сетевой кабель питания Schoku-C19 EU – 1 шт



Рисунок 30. Набор для маркировки предметных стекол (Seymour Label Kit for 3000 Labels) (при необходимости) – не более 20 уп. в составе:
•Лента клейкая на 500 этикеток/рулон - 6 рулонов;



Рисунок 31. • Набор для маркировки предметных стекол (Seymour Label Kit for 3000 Labels) (при необходимости) – не более 20 уп. в составе:

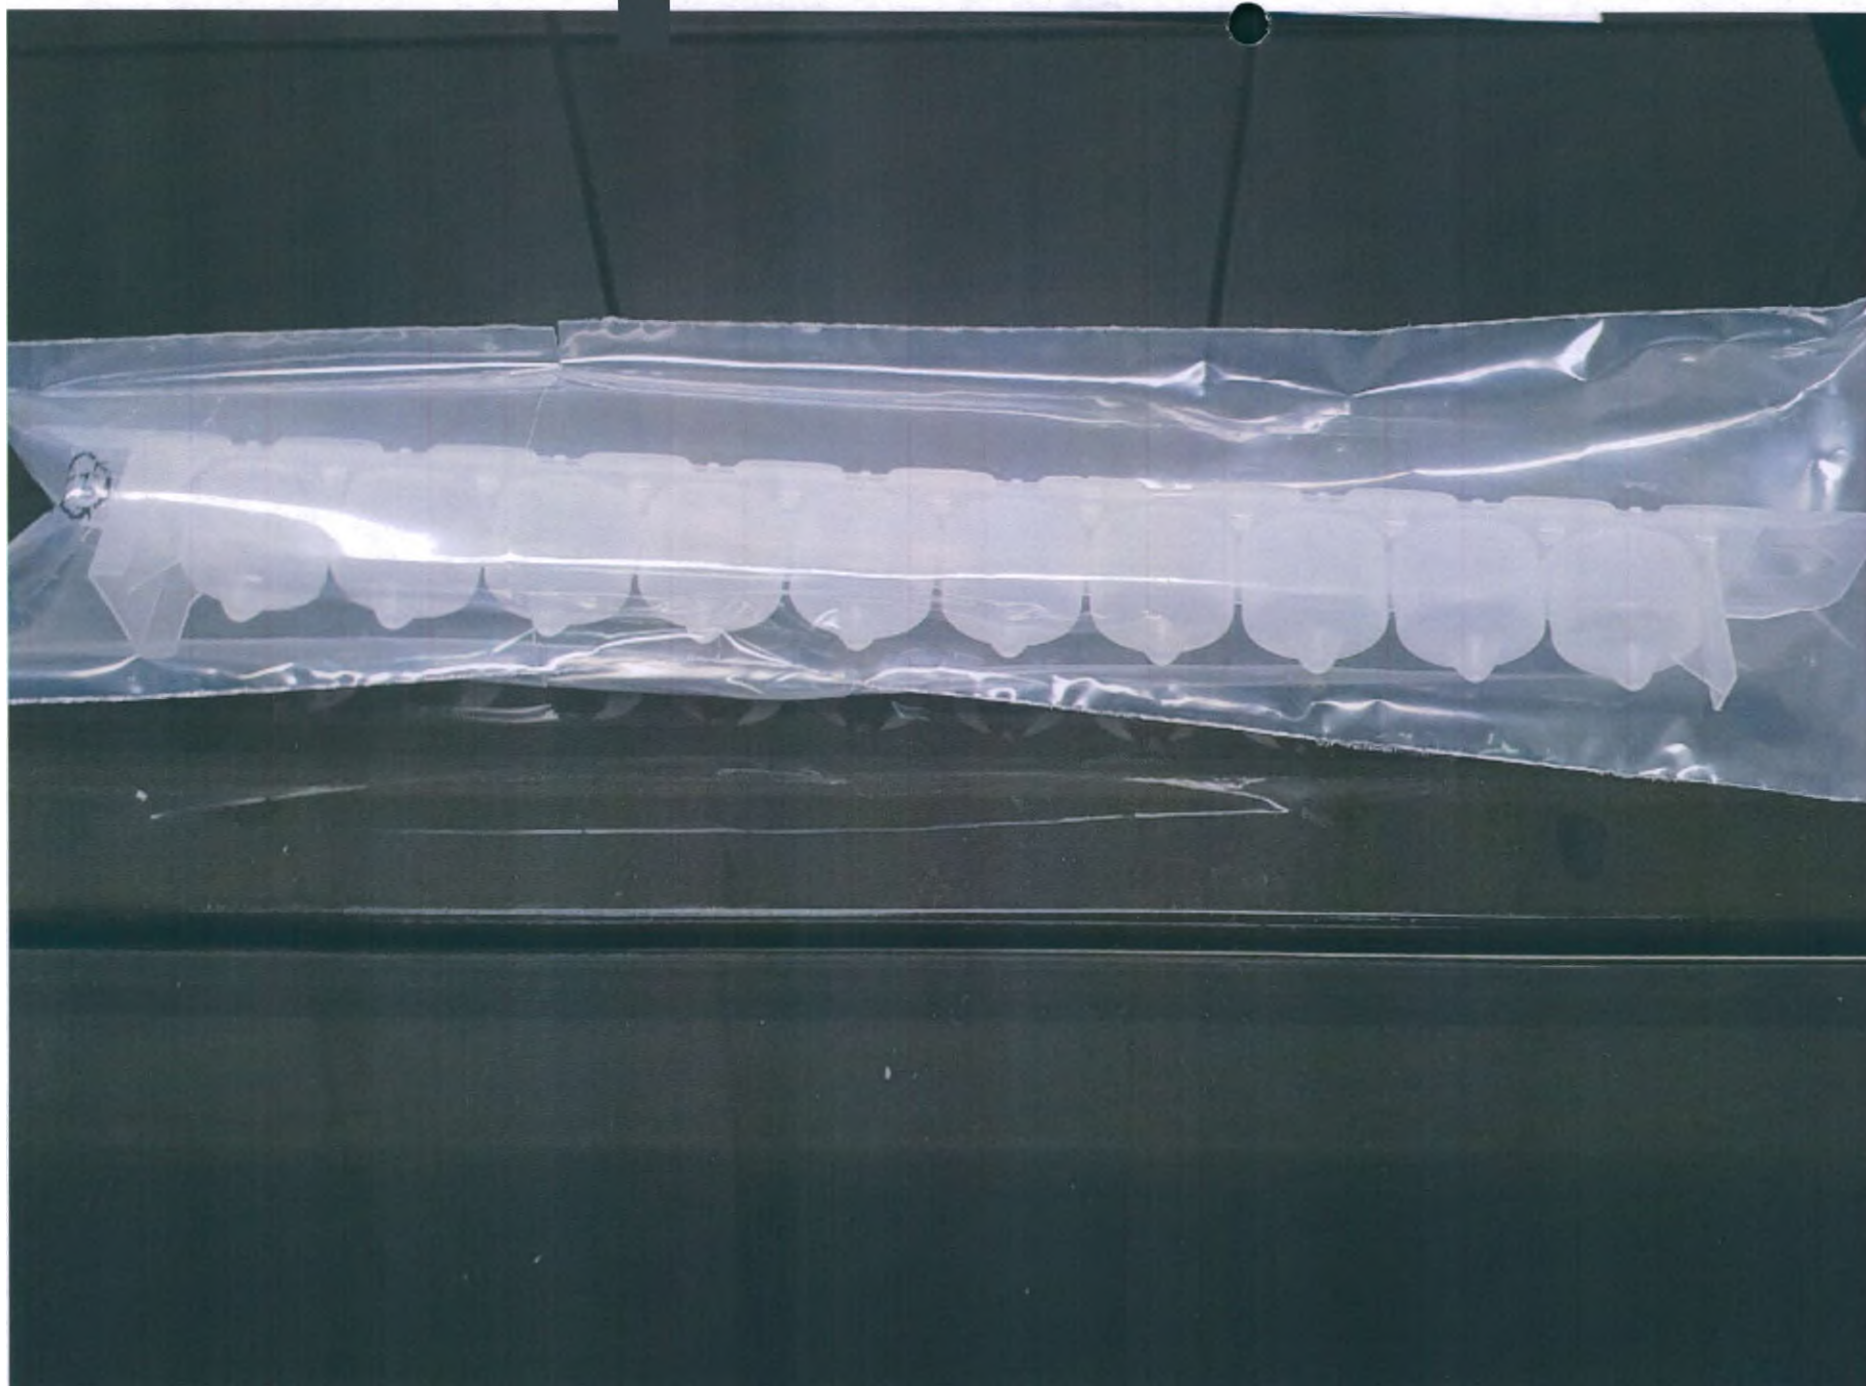


Рисунок 32. Стартовый набор для запуска и наладки «Устройство автоматическое для иммуногистологического окрашивания и гибридизации in situ Дако Омнис/Dako Omnis, с принадлежностями»:

ООО ЦИРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru ания, 25 шт/упак (Dako Omnis Mixing Strip, 25 pcs) - 2 упак;

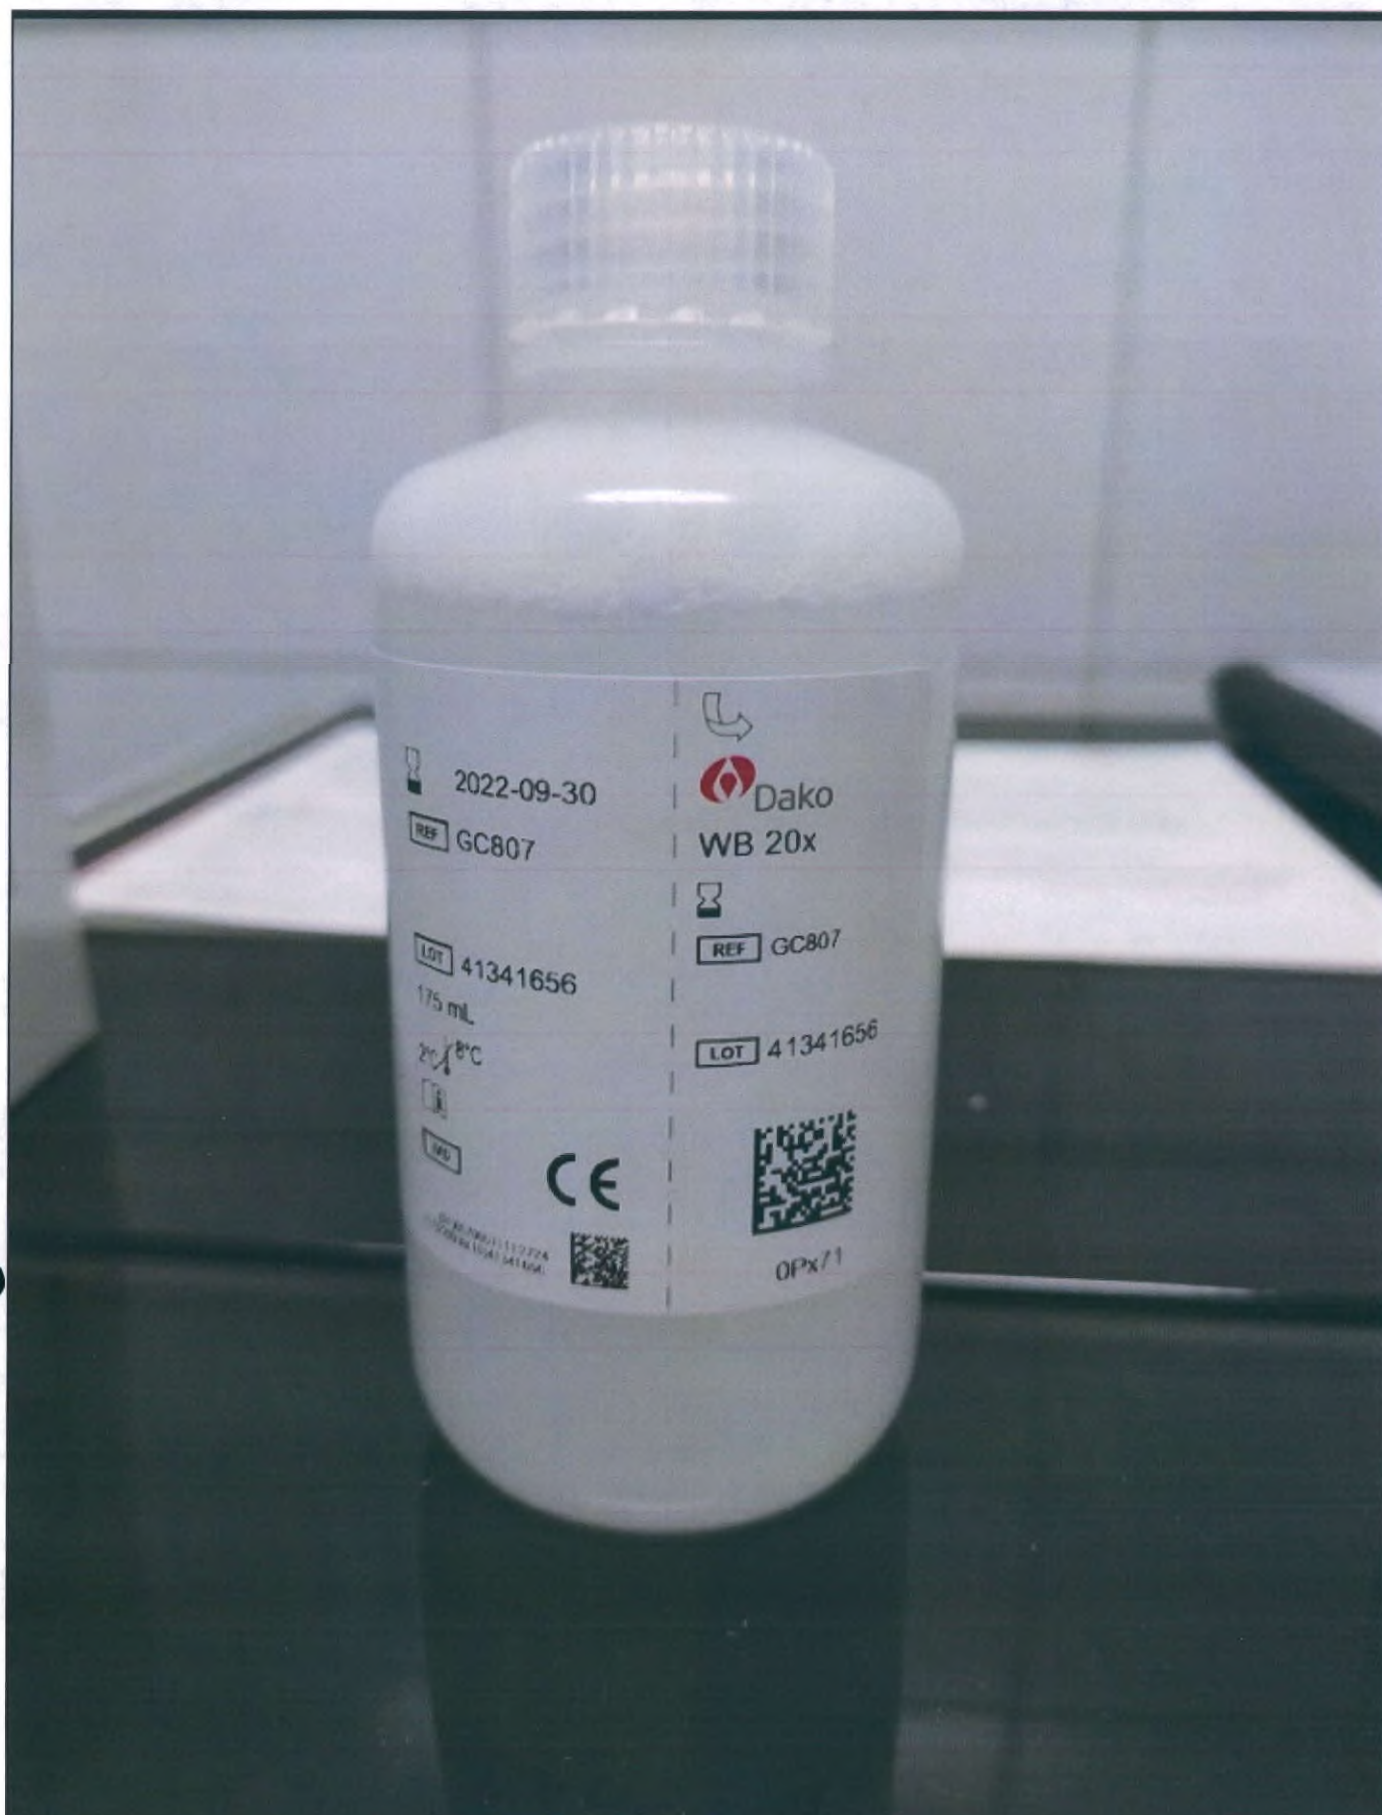


Рисунок 33. • Буфер промывочный, Концентрированный (20x), для использования в Дако Омнис, 20 флаконов по 175 мл, 1700 тестов (Wash Buffer (20x) (Dako Omnis), Concentrate, 20 x 175 mL, 1700 tests) кат № GC807- 1 упак



Рисунок 34. • Антитела моноклональные мышиные к человеческим Цитокератинам, клон AE1/AE3, Готовые к применению, ФЛЕКС, для использования в Дако Омнис, 12 мл - 1 шт. (вид 1 сторона)



Рисунок 35. • Антитела моноклональные мышинные к человеческим Цитокератинам, клон AE1/AE3, Готовые к применению, ФЛЕКС, для использования в Дако Омнис, 12 мл - 1 шт (вид 2 сторона)



Рисунок 36. • Антитела моноклональные мышиные к человеческому CD34 Class II, клон QBEnd 10, Готовые к применению, ФЛЕКС, для использования в Дако Омнис, 12 мл - 1 шт (вид 1 сторона)

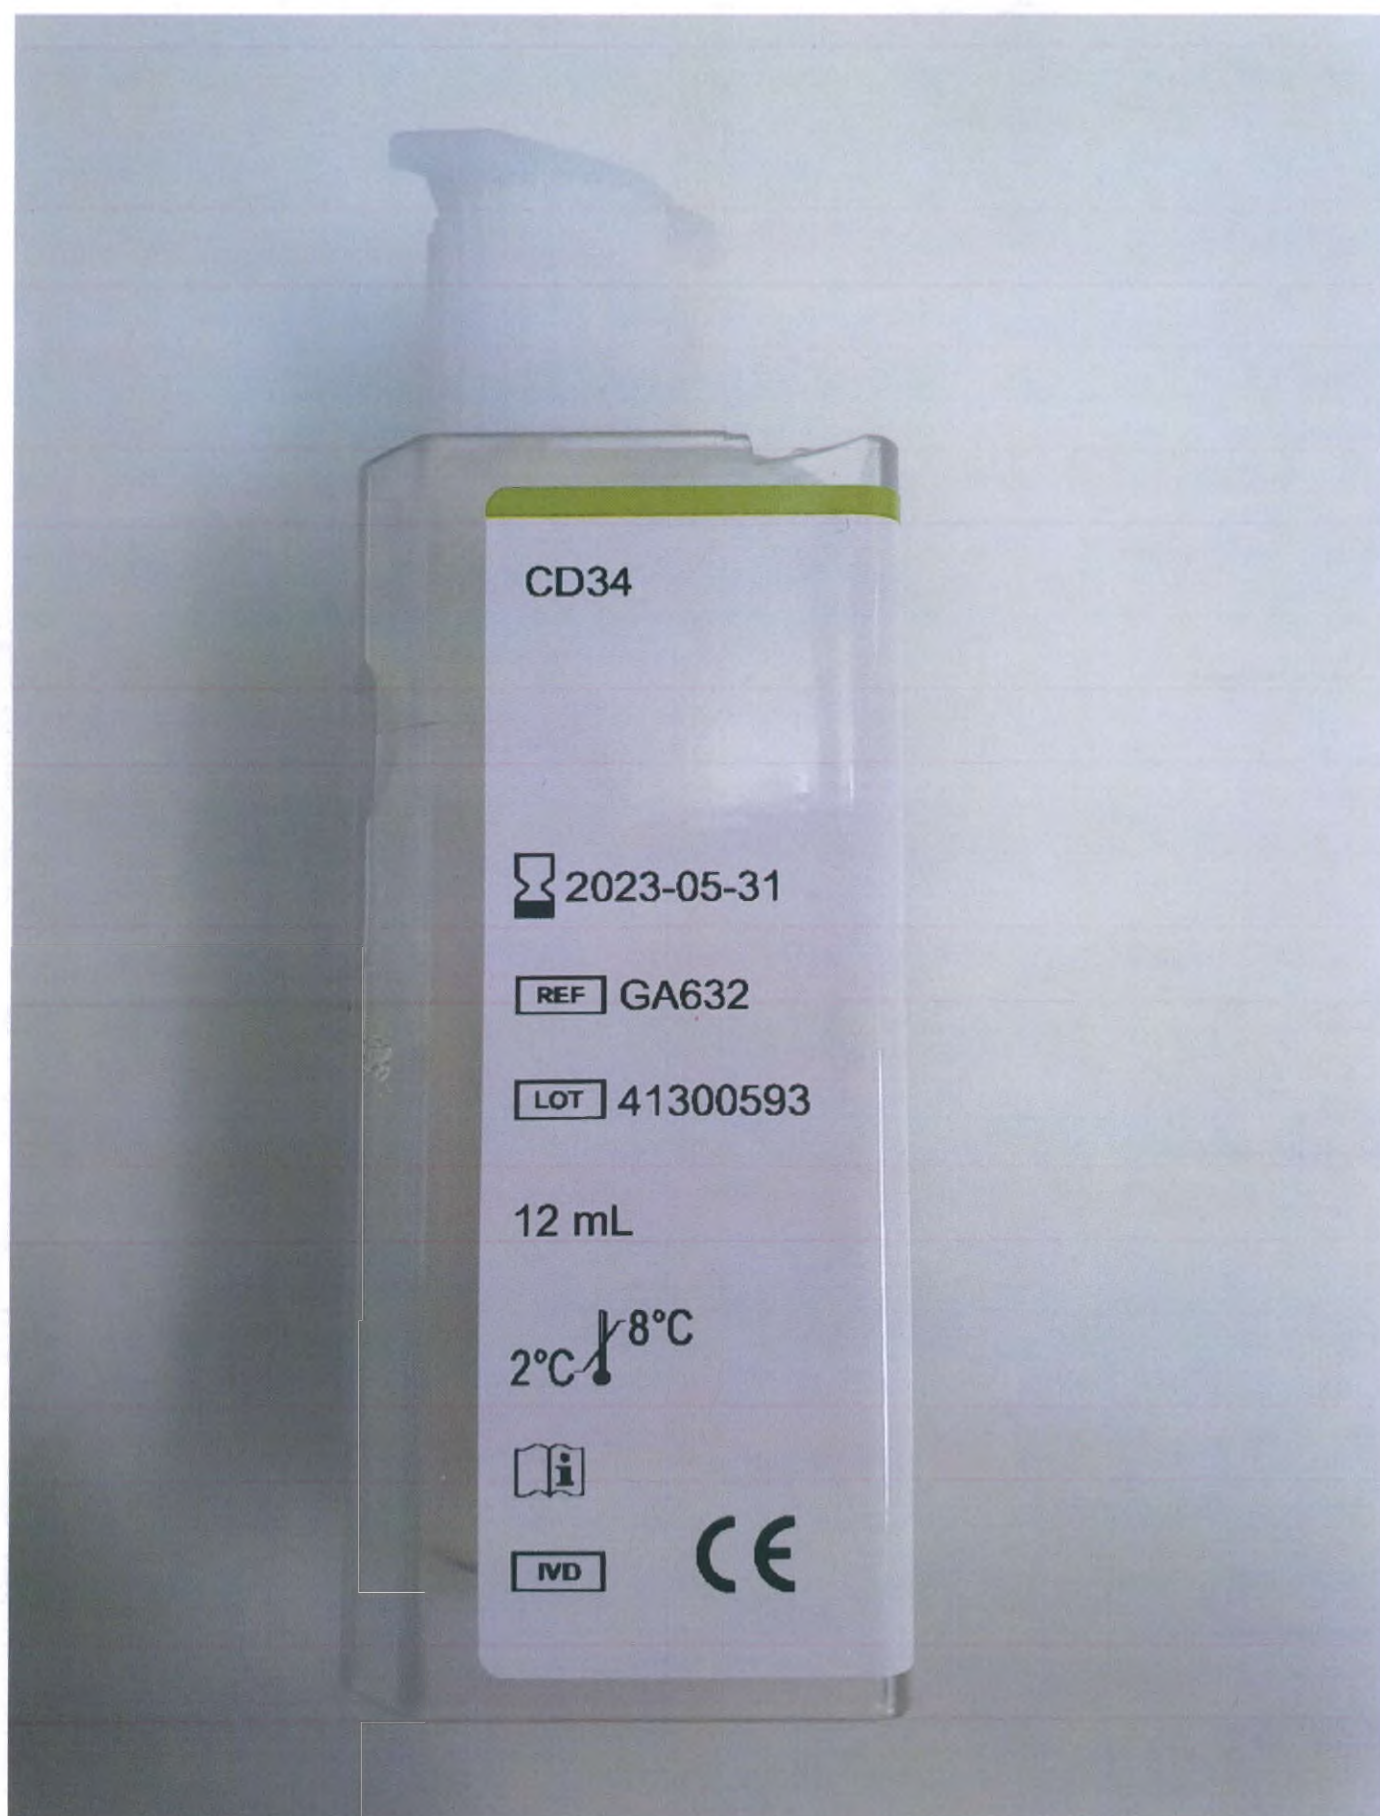


Рисунок 37. Антитела моноклональные мышиные к человеческому CD34 Class II, клон QBEnd 10, Готовые к применению, ФЛЕКС, для использования в Дако Омнис, 12 мл - 1 шт (вид 2 сторона)



Рисунок 38. • Антитела поликлональные кроличьи к человеческому S100, Готовые к применению, ФЛЕКС, для использования в Дако Омнис, 12 мл, не более 1 шт. (вид 1 сторона)



Рисунок 39. Антитела поликлональные кроличьи к человеческому S100, Готовые к применению, ФЛЕКС, для использования в Дако Омнис, 12 мл, не более 1 шт. (вид 2 сторона)



Рисунок 40. • Антитела поликлональные кроличьи к человеческому Глиальному фибриллярному кислому белку (GFAP), Готовые к применению, ФЛЕКС, для использования в Дако Омнис, 12 мл - 1 шт. (вид 1 сторона)



Рисунок 41. Антитела поликлональные кроличьи к человеческому Глиальному фибриллярному кислому белку (GFAP), Готовые к применению, ФЛЕКС, для использования в Дако Омнис, 12 мл - 1 шт. (вид 2 сторона)



Рисунок 42. • Антитела моноклональные мышиные к человеческому CD20cy, клон L26, Готовые к применению, ФЛЕКС, для использования в Дако Омнис, 12 мл - 1 шт. (вид 1 сторона)

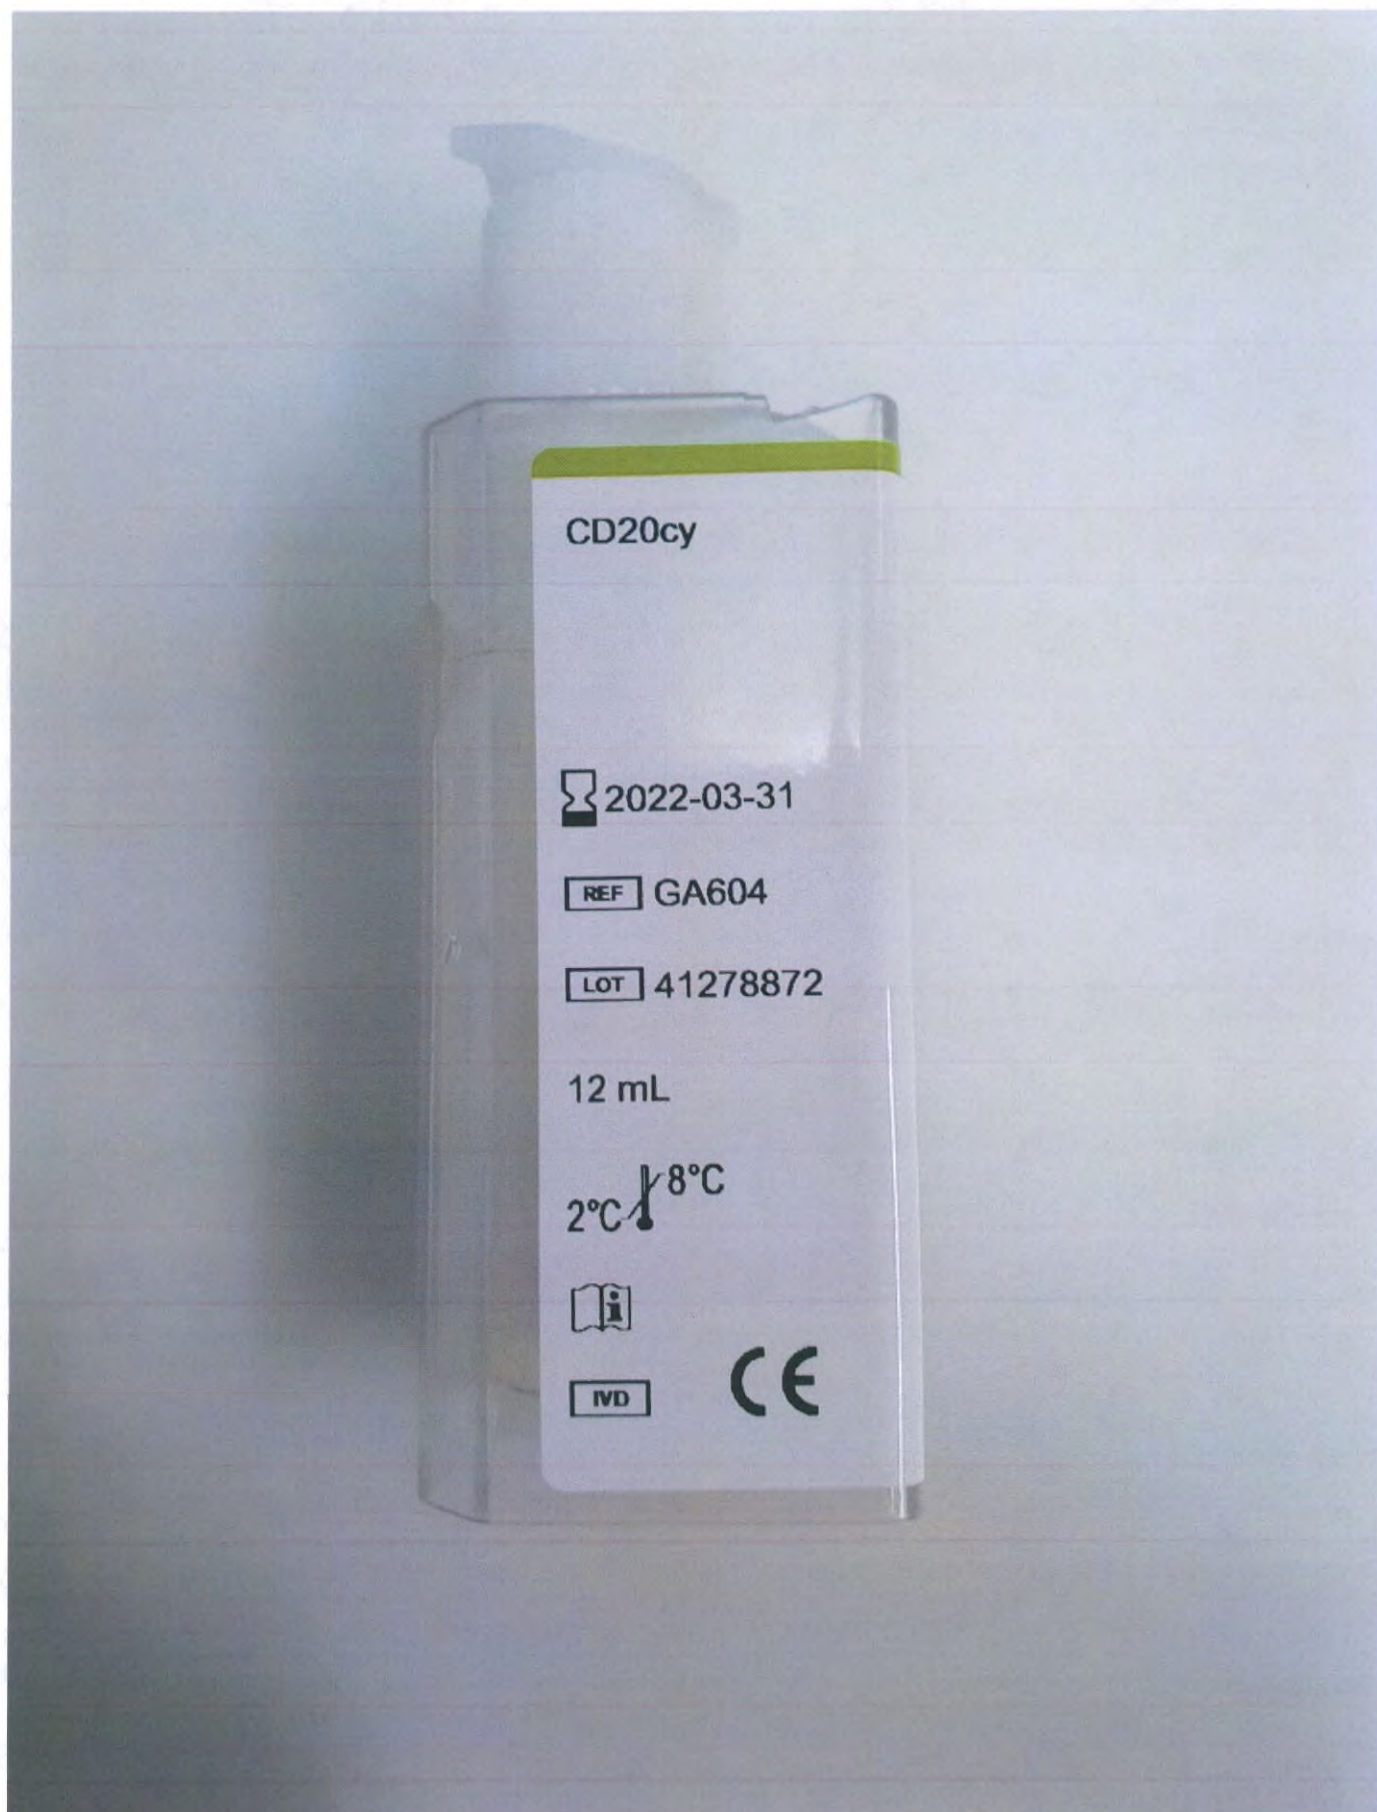


Рисунок 43. • Антитела моноклональные мышиные к человеческому CD20cy, клон L26, Готовые к применению, ФЛЕКС, для использования в Дако Омнис, 12 мл - 1 шт. (вид 2 сторона)



Рисунок 44. • Антитела моноклональные мышиные к человеческому Виментину, клон V9, Готовые к применению, ФЛЕКС, для использования в Дако Омнис, 12 мл - 1 шт. (вид 1 сторона)

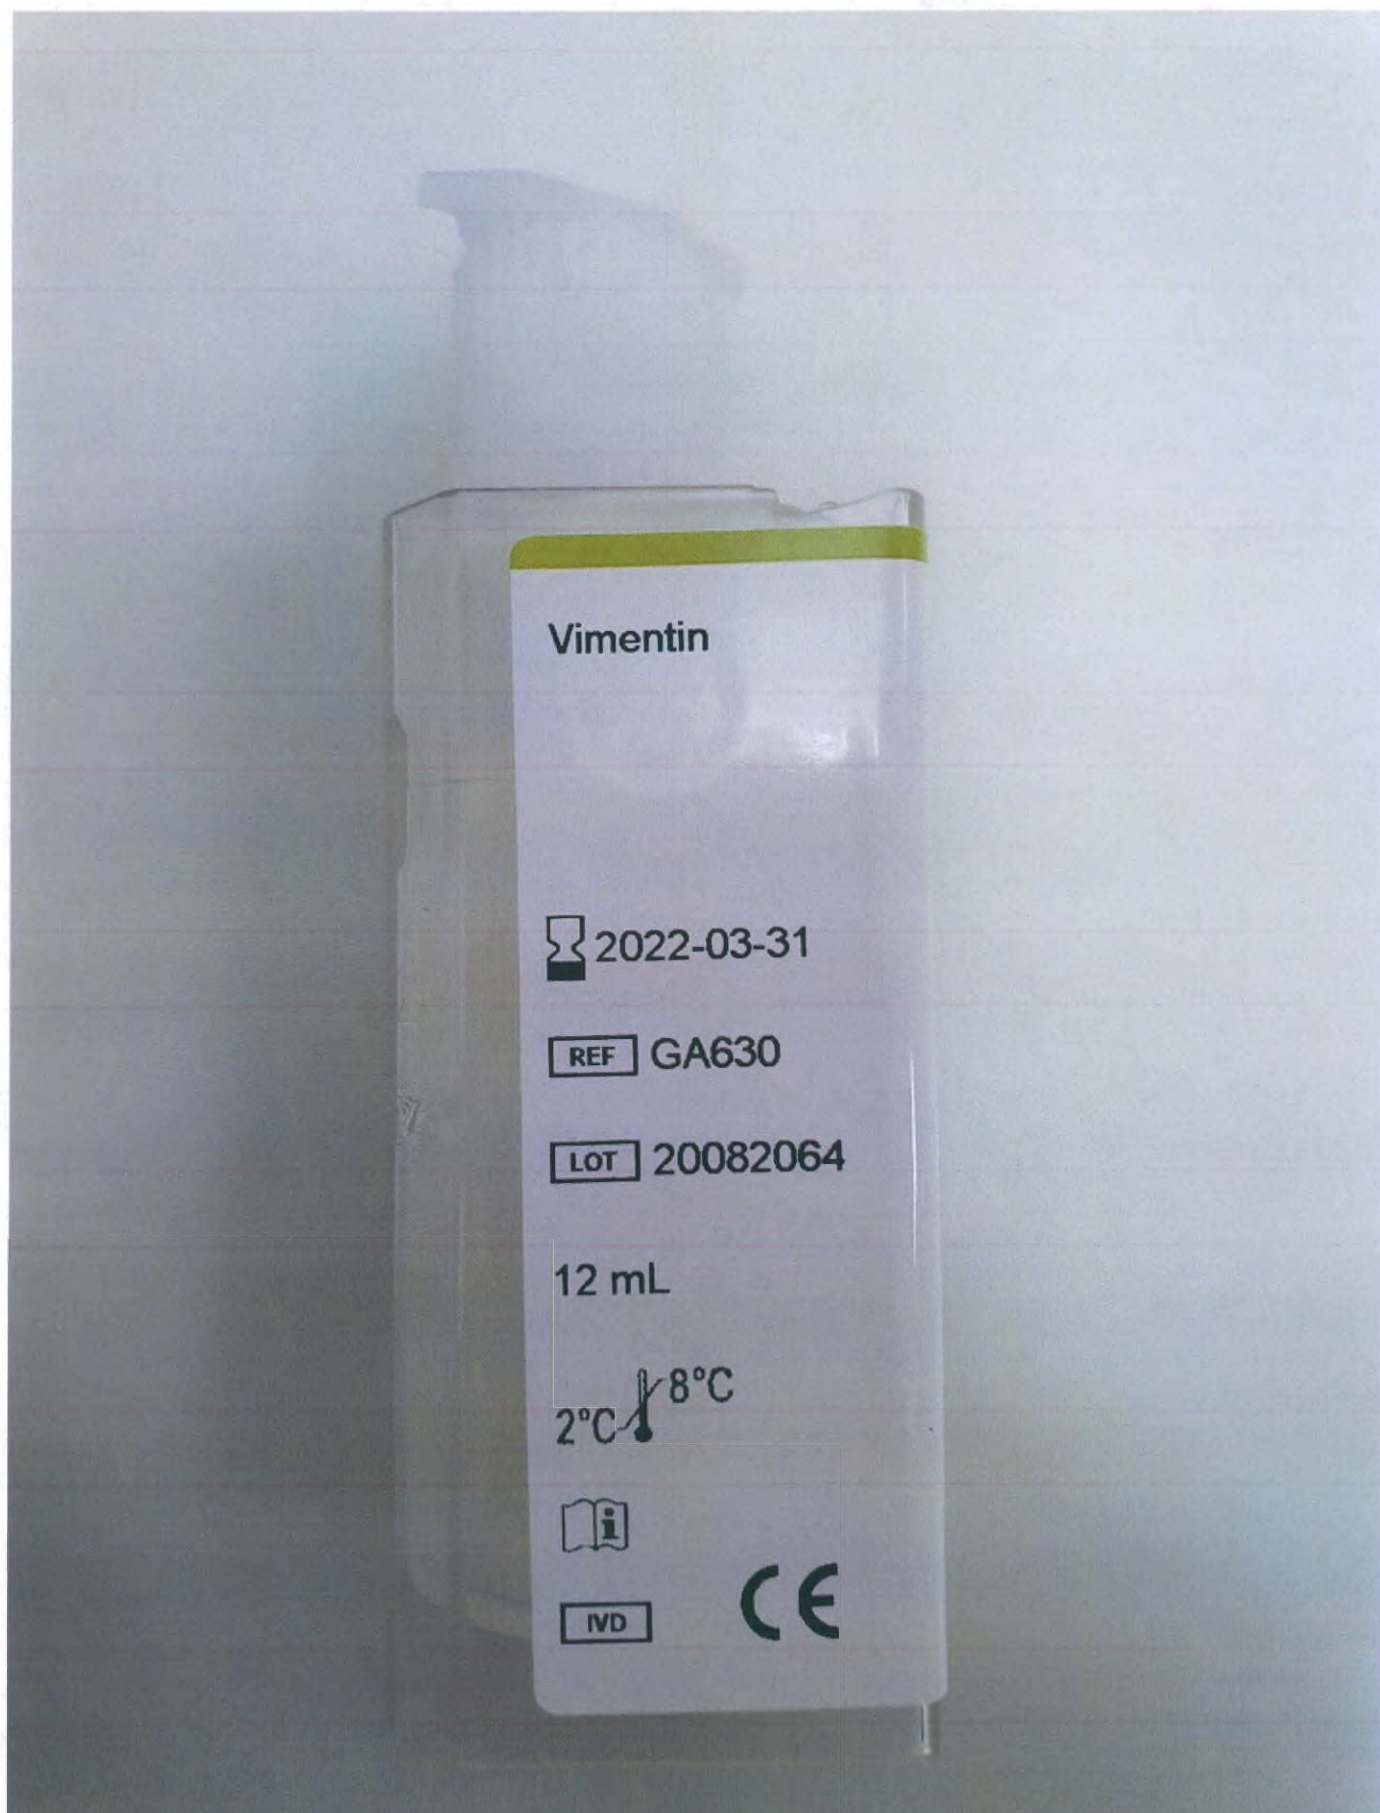


Рисунок 45. • Антитела моноклональные мышиные к человеческому Виментину, клон V9, Готовые к применению, ФЛЕКС, для использования в Дако Омнис, 12 мл - 1 шт. (вид 2 сторона)

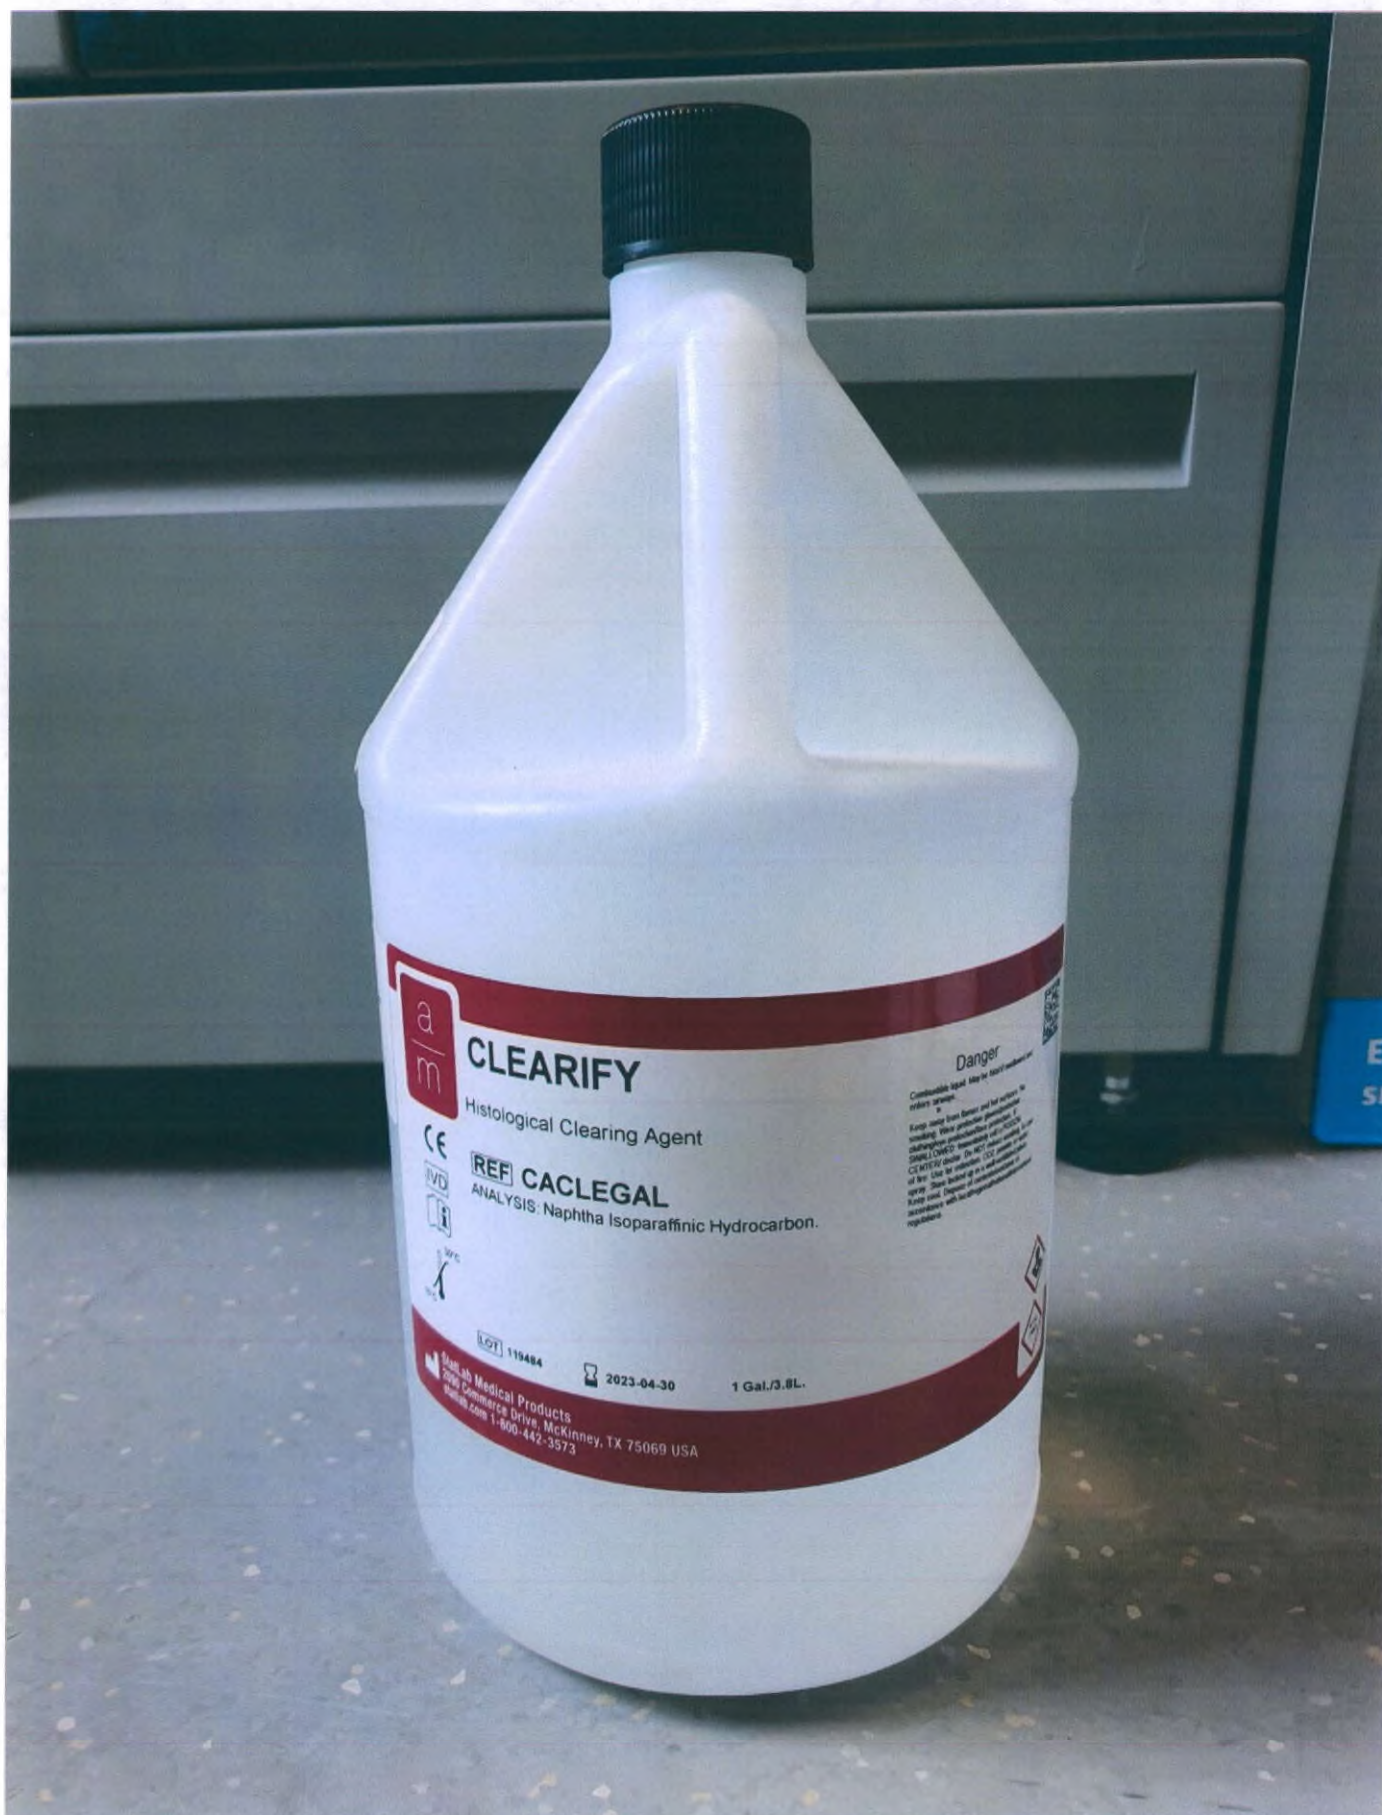


Рисунок 46. • Растворитель Clearify (Clearify, Bulk bottle, General Lab Reagent), 3,8 л - 1 шт

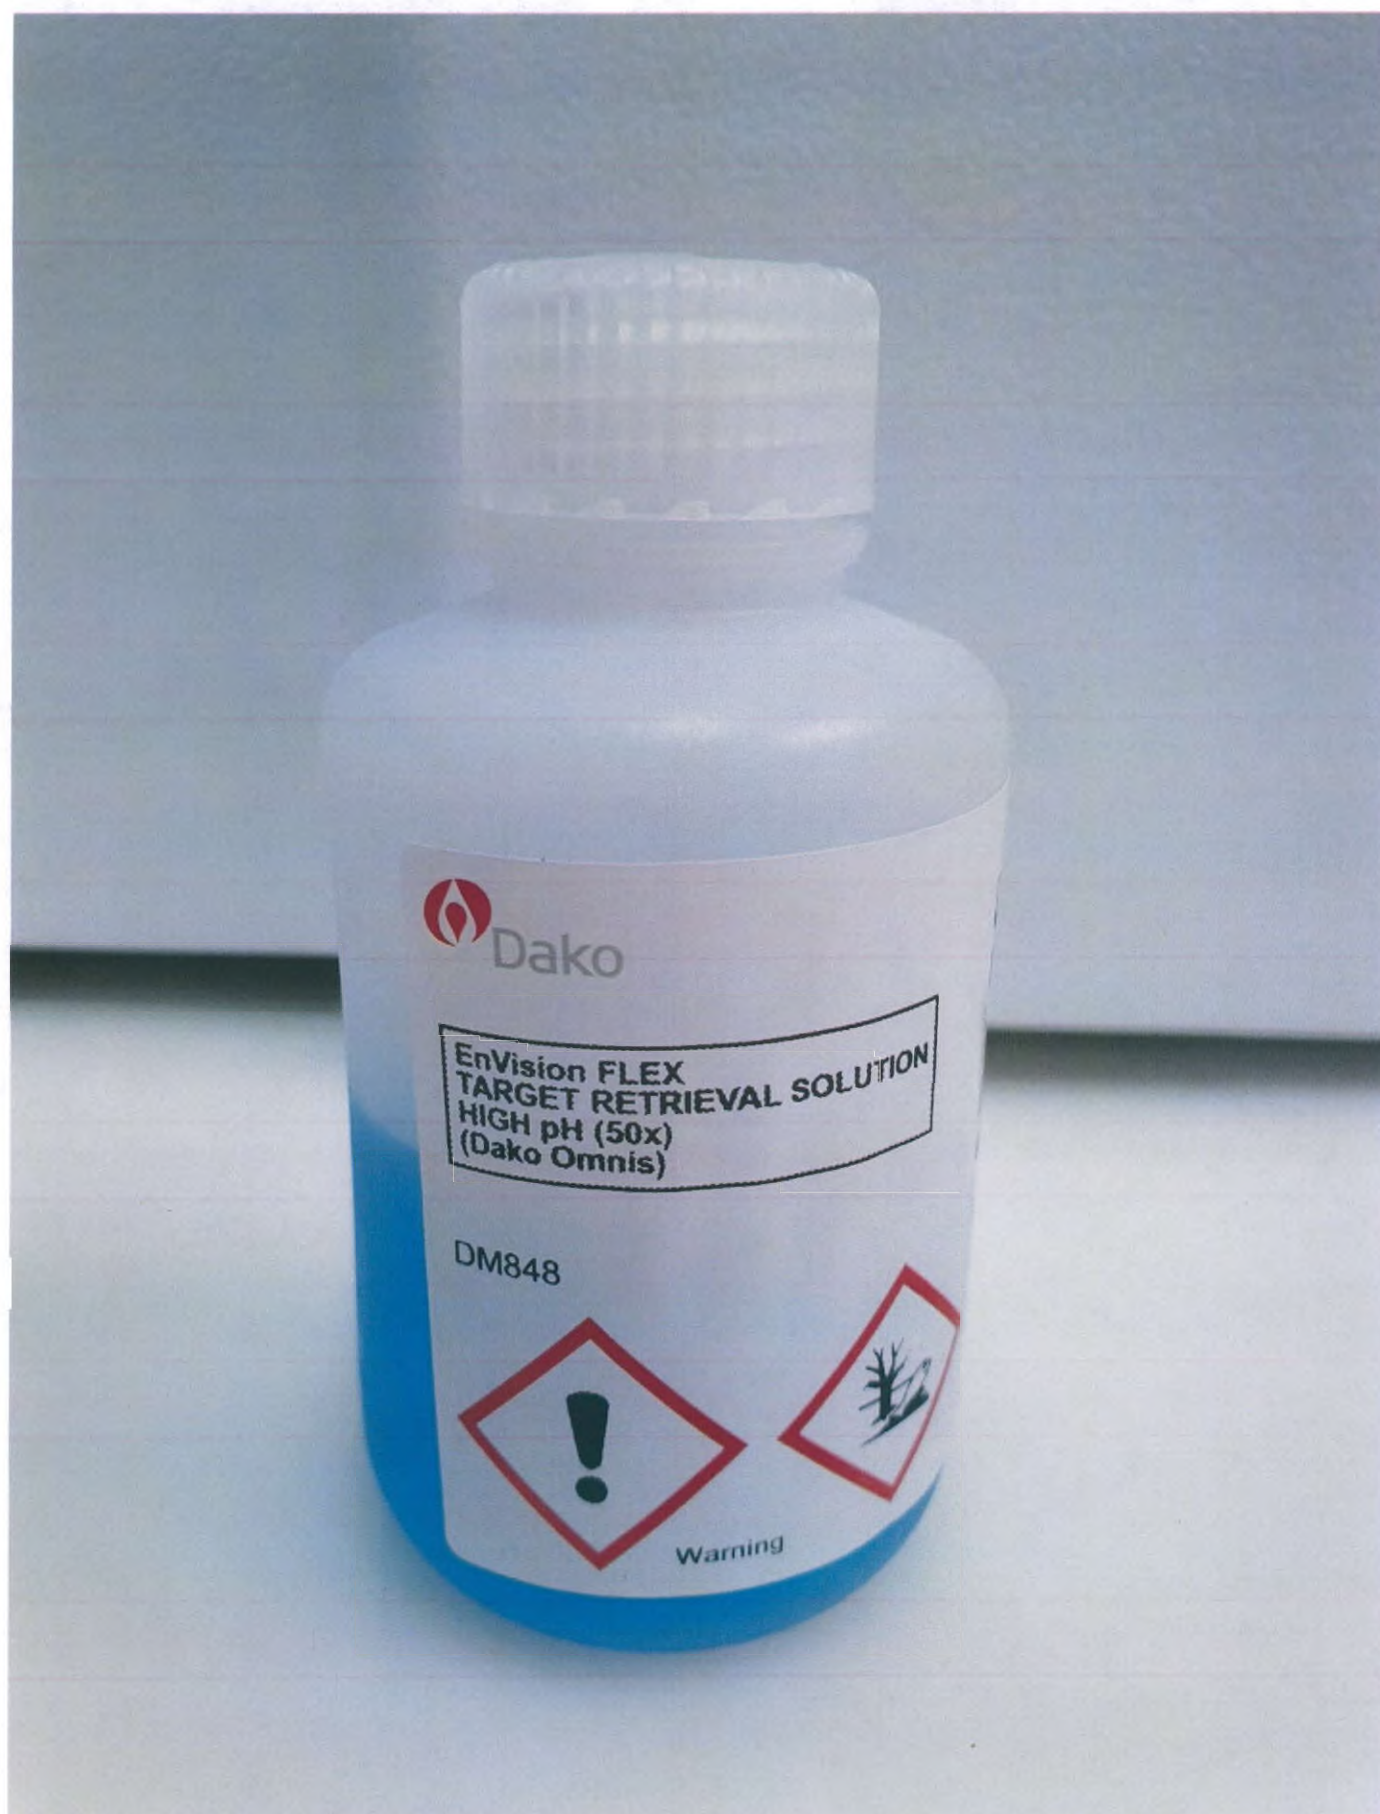


Рисунок 47. • Система детекции ЭнВижи ФЛЕКС для использования в Дако Омнис, 600 тестов (EnVision FLEX (Dako Omnis), 600 tests) - 1 набор
(Буфер для демаскировки, высокий pH, концентрированный 50x (Target retrieval solution high pH)) (вид 1 сторона)

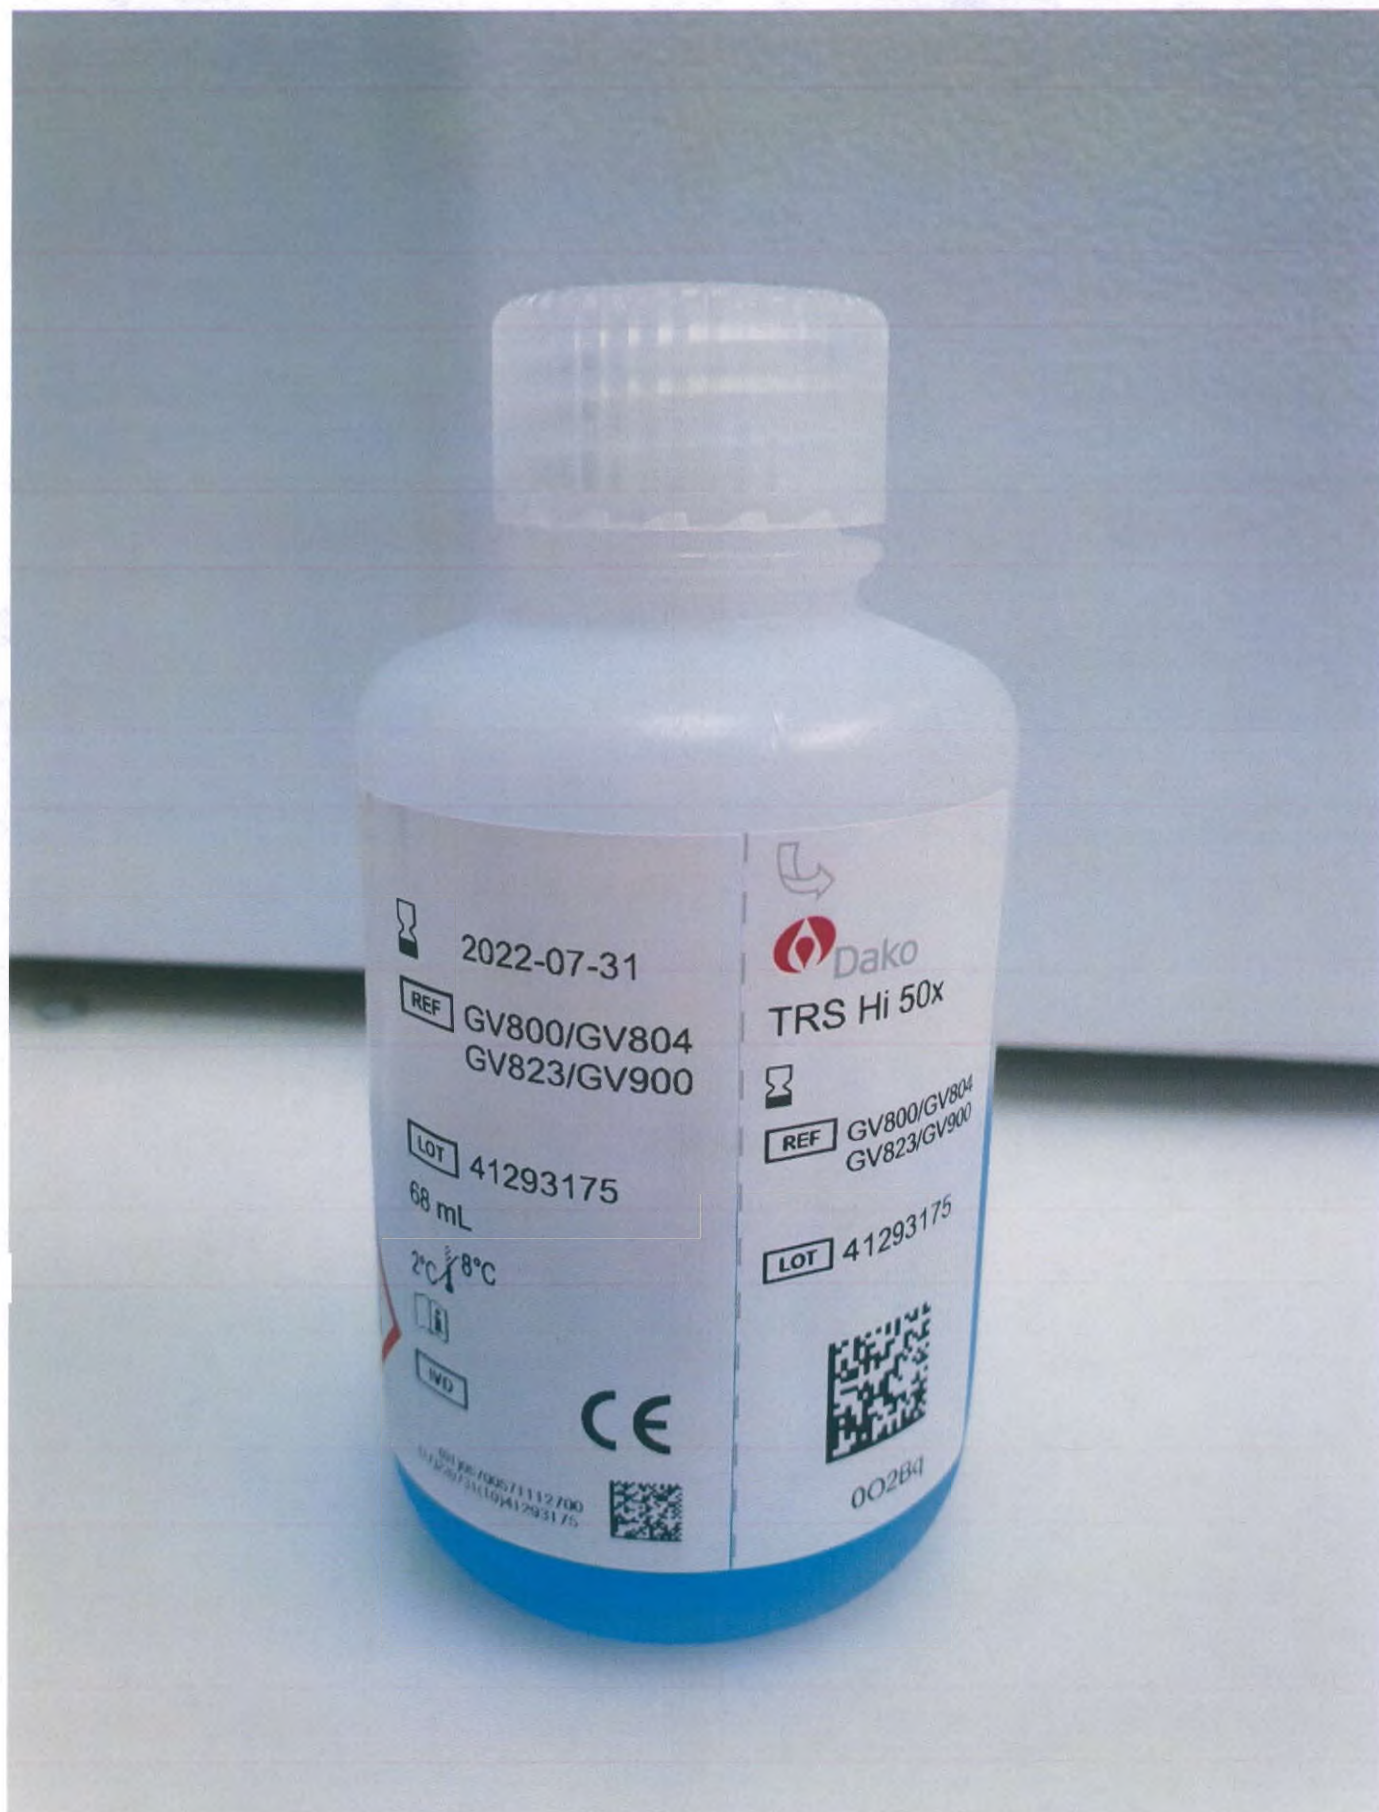


Рисунок 48. • Система детекции ЭнВижн ФЛЕКС для использования в Дако Омнис, 600 тестов (EnVision FLEX (Dako Omnis), 600 tests) - 1 набор
(Буфер для демаскировки, высокий pH, концентрированный 50x (Target retrieval solution high pH)) (вид 2 сторона)



Рисунок 49. • Система детекции ЭнВижи ФЛЕКС для использования в Дако Омнис, 600 тестов (EnVision FLEX (Dako Omnis), 600 tests) - 1 набор (Субстратный буфер (Substrate buffer)) (вид 1 сторона)



Рисунок 50. • Система детекции ЭнВижн ФЛЕКС для использования в Дако Омнис, 600 тестов (EnVision FLEX (Dako Omnis), 600 tests) - 1 набор (Субстратный буфер (Substrate buffer)) (вид 2 сторона)



Рисунок 51. • Система детекции ЭнВижн ФЛЕКС для использования в Дако Омнис, 600 тестов (EnVision FLEX (Dako Omnis), 600 tests) - 1 набор (Реагент для блокировки пероксидазы (Peroxidase-blocking reagent)) (вид 1 торона)



Рисунок 52. • Система детекции ЭнВижн ФЛЕКС для использования в Дако Омнис, 600 тестов (EnVision FLEX (Dako Omnis), 600 tests) - 1 набор
(Реагент для блокировки пероксидазы (Peroxidase-blocking reagent)) (вид 2 сторона)



Рисунок 53. • Система детекции ЭнВижи ФЛЕКС для использования в Дако Омнис, 600 тестов (EnVision FLEX (Dako Omnis), 600 tests) - 1 набор (DAB (диаминобензидин) и DAB плюс раствор хромогена (DAB+ Chromogen)) (вид 1 сторона)



Рисунок 54. • Система детекции ЭнВижн ФЛЕКС для использования в Дако Омнис, 600 тестов (EnVision FLEX (Dako Omnis), 600 tests) - 1 набор (DAB (диаминобензидин) и DAB плюс раствор хромогена (DAB+ Chromogen)) (вид 2 сторона)



Рисунок 55. • Система детекции ЭнВижи ФЛЕКС для использования в Дако Омнис, 600 тестов (EnVision FLEX (Dako Omnis), 600 tests) - 1 набор (FLEX HRP) (вид 1 сторона)

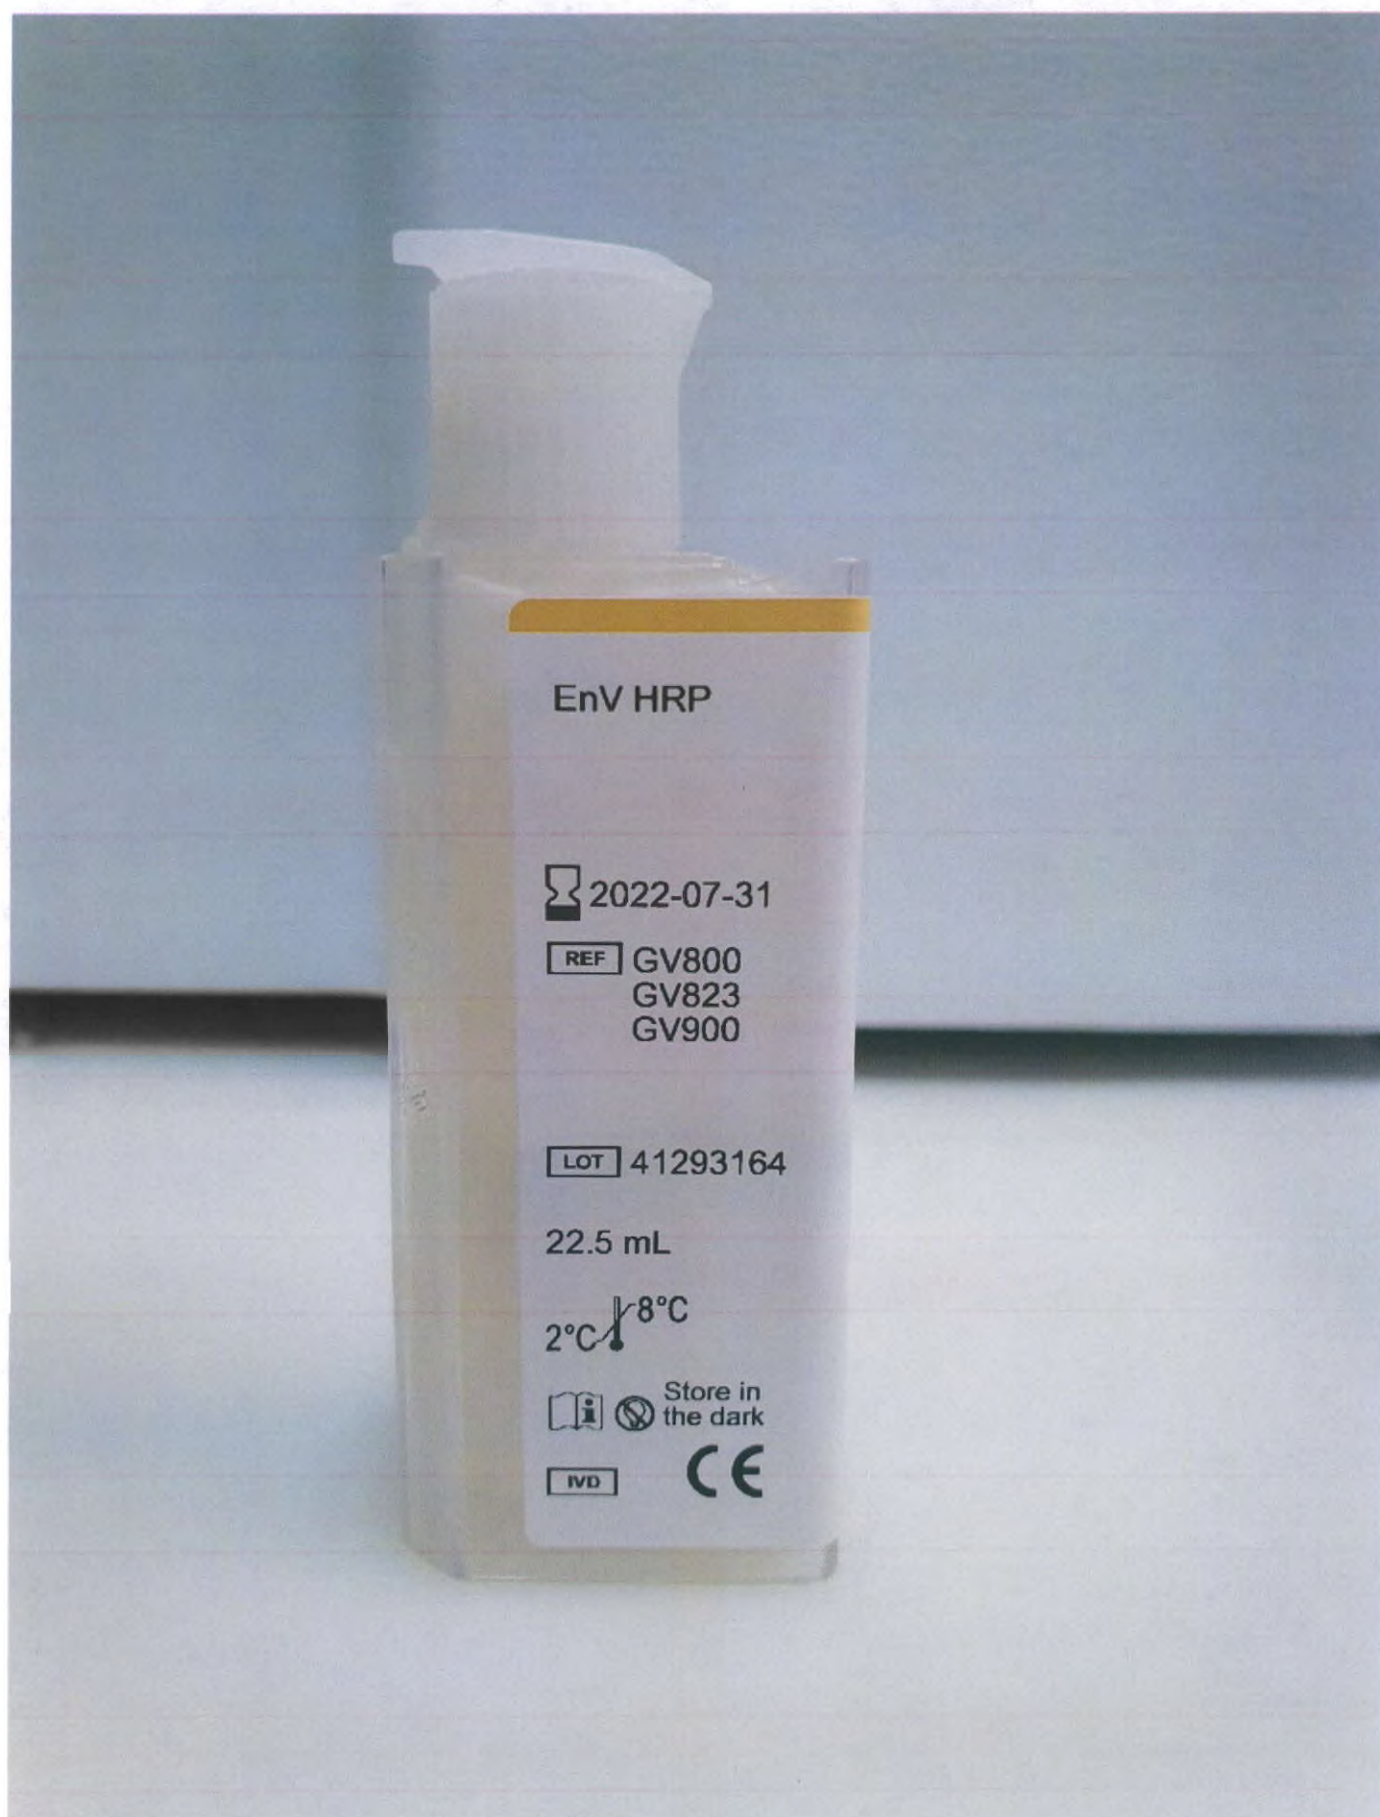


Рисунок 56. • Система детекции ЭнВижи ФЛЕКС для использования в Дако Омнис, 600 тестов (EnVision FLEX (Dako Omnis), 600 tests) - 1 набор (FLEX HRP) (вид 2 сторона)



Рисунок 57 • Линкер мышинный ЭнВижн ФЛЕКС+, Готовый к применению, для использования в Дако Омнис, 1 флакон на 22,5 мл, 75 тестов (EnVision FLEX+ Mouse LINKER (Dako Omnis), Ready-to-use, 22.5 mL, 75 tests) - 3 шт (вид 1 сторона)



Рисунок 58/ • Линкер мышинный ЭнВижн ФЛЕКС+, Готовый к применению, для использования в Дако Омнис, 1 флакон на 22,5 мл, 75 тестов (EnVision FLEX+ Mouse LINKER (Dako Omnis), Ready-to-use, 22.5 mL, 75 tests) - 3 шт (вид 2 сторона)



Рисунок 59 • Гематоксилин, Готовый к применению, для использования в Дако Омнис, 8 флаконов по 22,5 мл, 600 тестов (Hematoxylin (Dako Omnis), Ready-to-use, 8 x 22.5 mL, 600 tests) - 1 упак. (вид 1 сторона)



Рисунок 60. • Гематоксилин, Готовый к применению, для использования в Дако Омнис, 8 флаконов по 22,5 мл, 600 тестов (Hematoxylin (Dako Omnis), Ready-to-use, 8 x 22.5 mL, 600 tests) - 1 упак. (вид 2 сторона)



Рисунок 61 • Зонд HER2 IQFISH pharmDx для определения амплификации антигена HER2, Готовый к применению, для использования в Дако Омнис, 20 тестов, 1,6 мл (HER2 IQFISH pharmDx (Dako Omnis), Ready-to-use, 20 tests, 1.6 mL) - 2 шт, (вид 1 сторона)

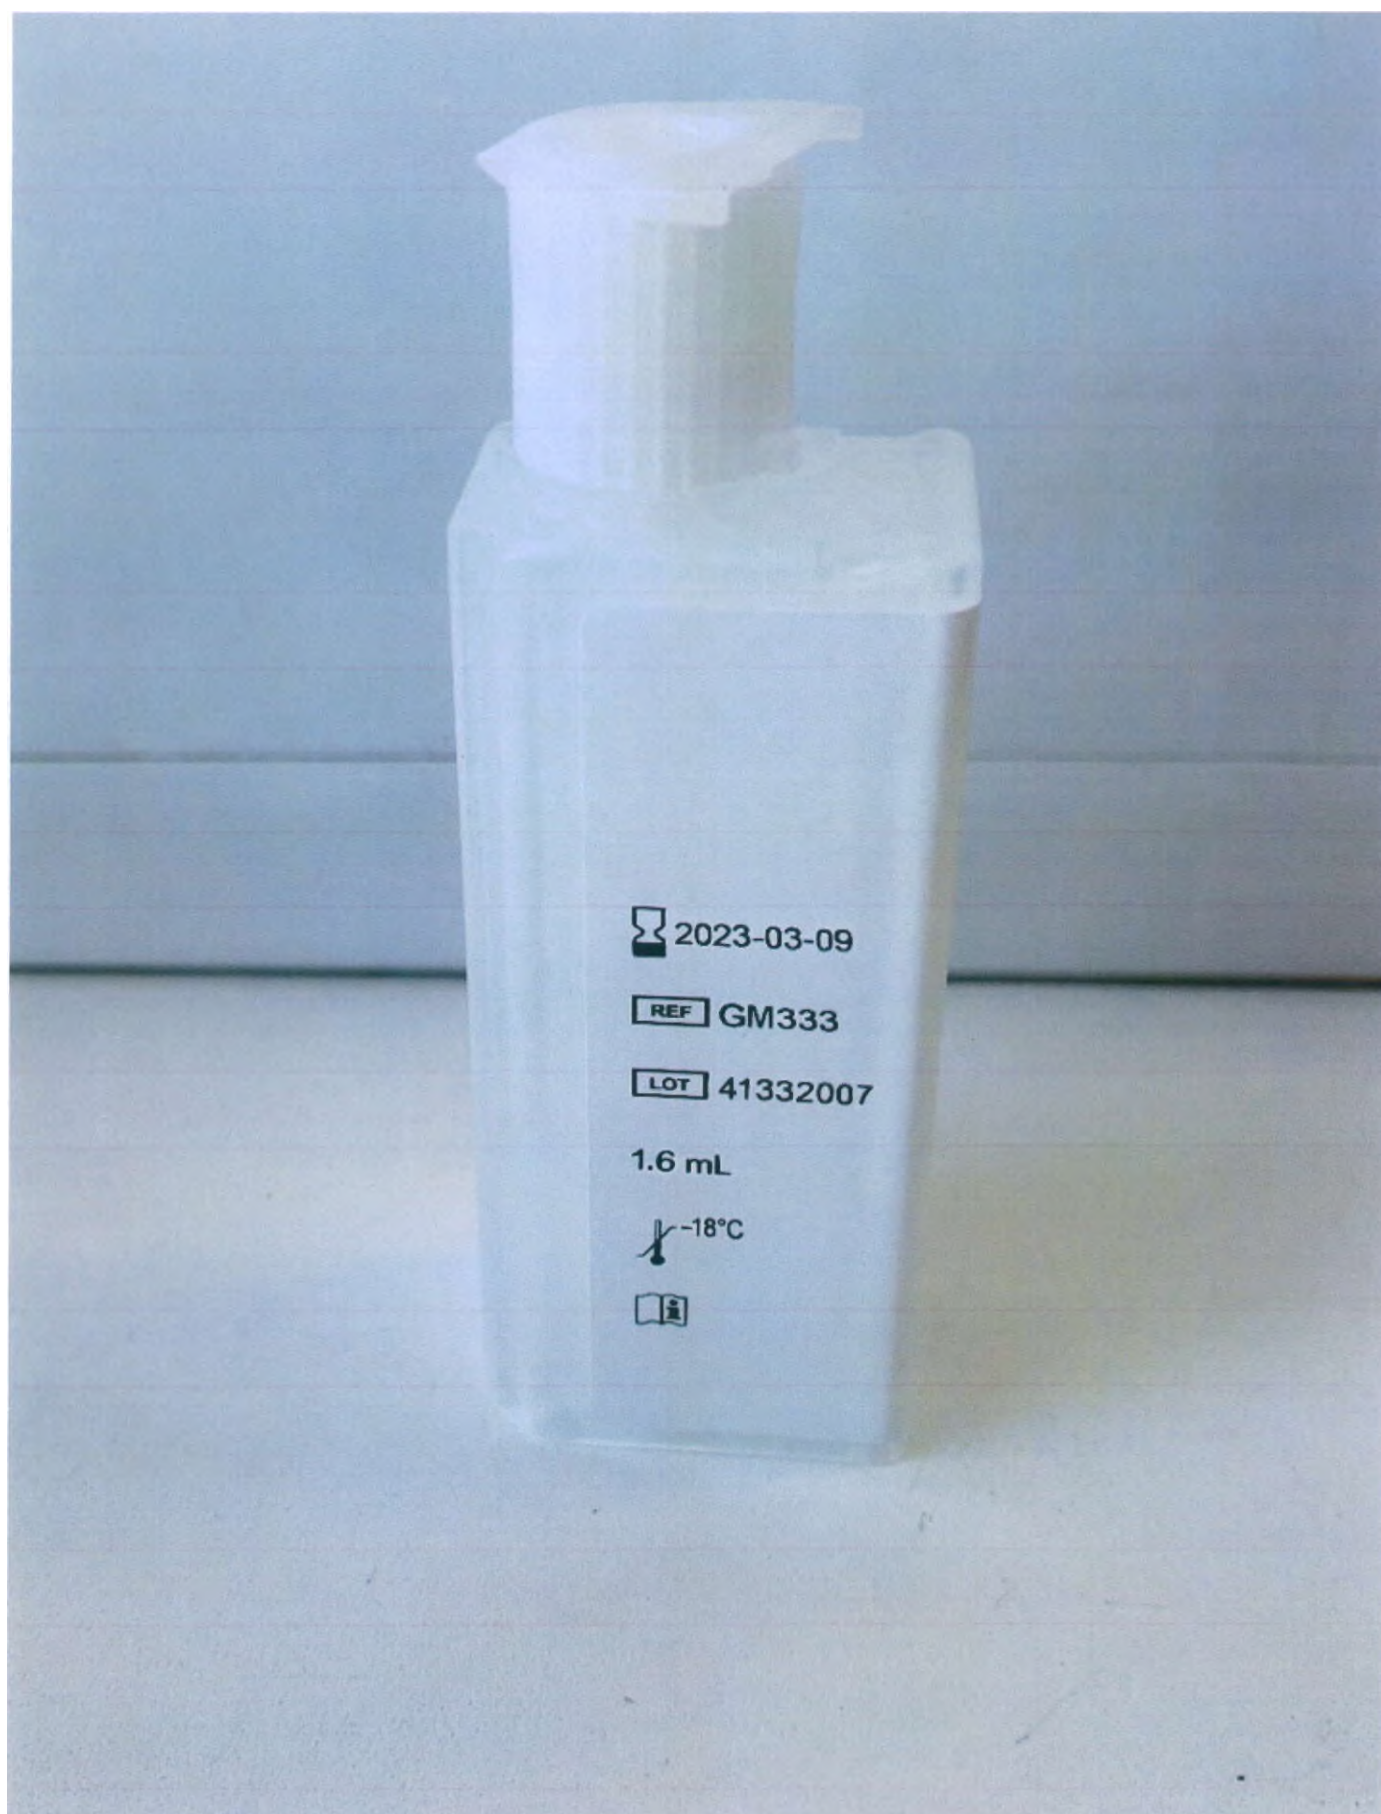


Рисунок 62 Зонд HER2 IQFISH pharmDx для определения амплификации антигена HER2, Готовый к применению, для использования в Дако Омнис, 20 тестов, 1,6 мл (HER2 IQFISH pharmDx (Dako Omnis), Ready-to-use, 20 tests, 1.6 mL) - 2 шт, (вид 2 сторона)

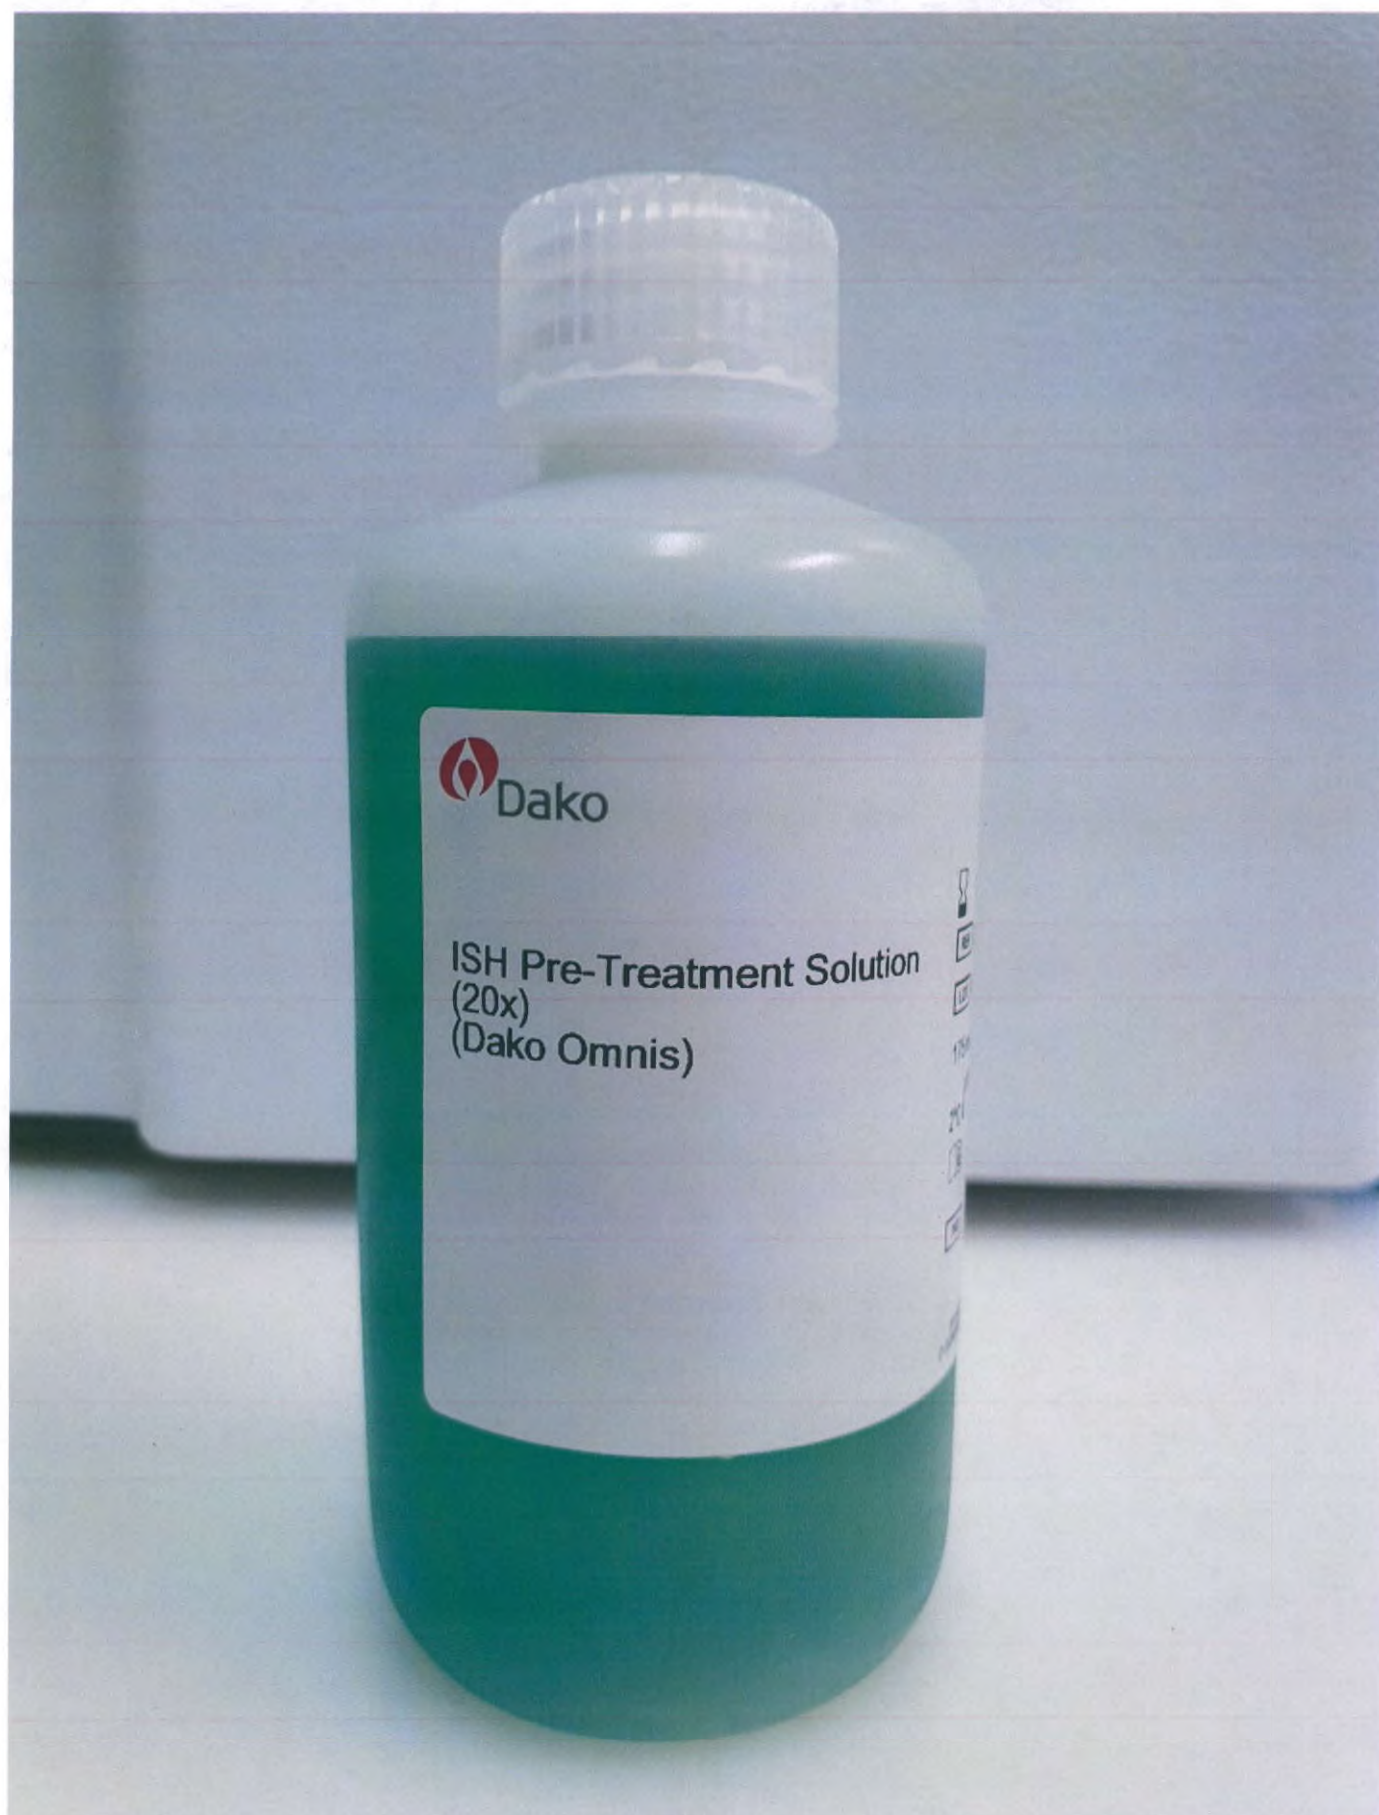


Рисунок 63. • Раствор для предварительной обработки для in situ гибридизации, Концентрированный (20x), для использования в Дако Омнис, 1 флакон на 175 мл (ISH Pre-Treatment Solution (20x) (Dako Omnis), Concentrate, 175 mL) - 2 шт. (вид 1 сторона)



Рисунок 64. • Раствор для предварительной обработки для in situ гибридизации, Концентрированный (20x), для использования в Дако Омнис, 1 флакон на 175 мл (ISH Pre-Treatment Solution (20x) (Dako Omnis), Concentrate, 175 mL) - 2 шт. (вид 2 сторона)



Рисунок 65. • Пепсин для in situ гибридизации, Готовый к применению, для использования в Дако Омнис, 20 тестов, 1 флакон на 7 мл (ISH Pepsin (Dako Omnis), Ready-to-use, 20 tests, 7 mL) - 2 шт. (вид 1 сторона)



Рисунок 66. • Пепсин для *in situ* гибридизации, Готовый к применению, для использования в Дако Омнис, 20 тестов, 1 флакон на 7 мл (ISH Pepsin (Dako Omnis), Ready-to-use, 20 tests, 7 mL) - 2 шт. (вид 2 сторона)

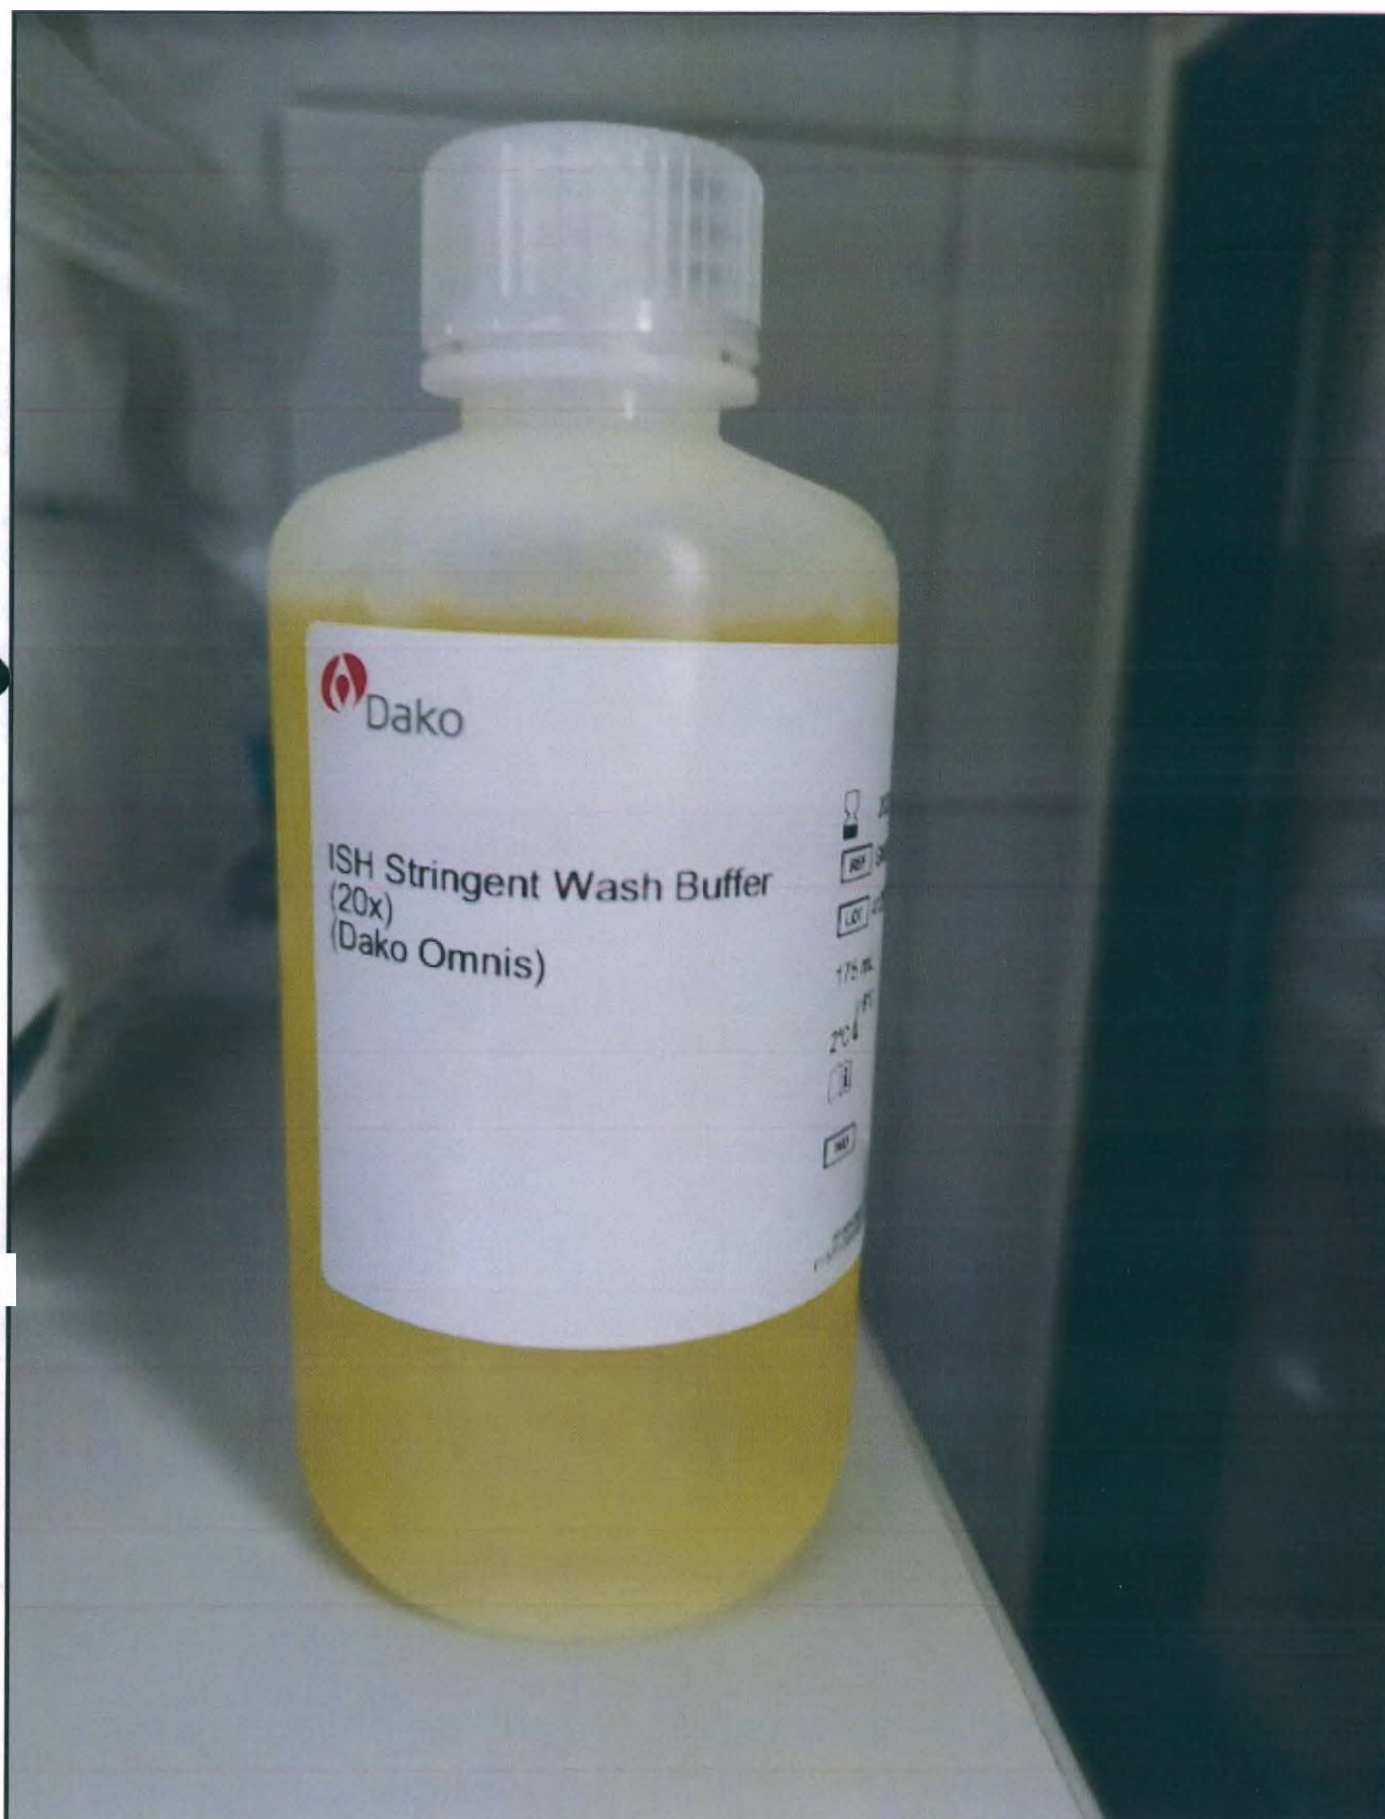


Рисунок 67. • Жесткий промывочный буфер для in situ гибридизации, Концентрированный (20x), для использования в Дако Омнис, 1 флакон на 175 мл (ISH Stringent Wash Buffer (20x) (Dako Omnis), Concentrate, 175 mL) кат № GM 303 - 2 шт, (вид 1 сторона)

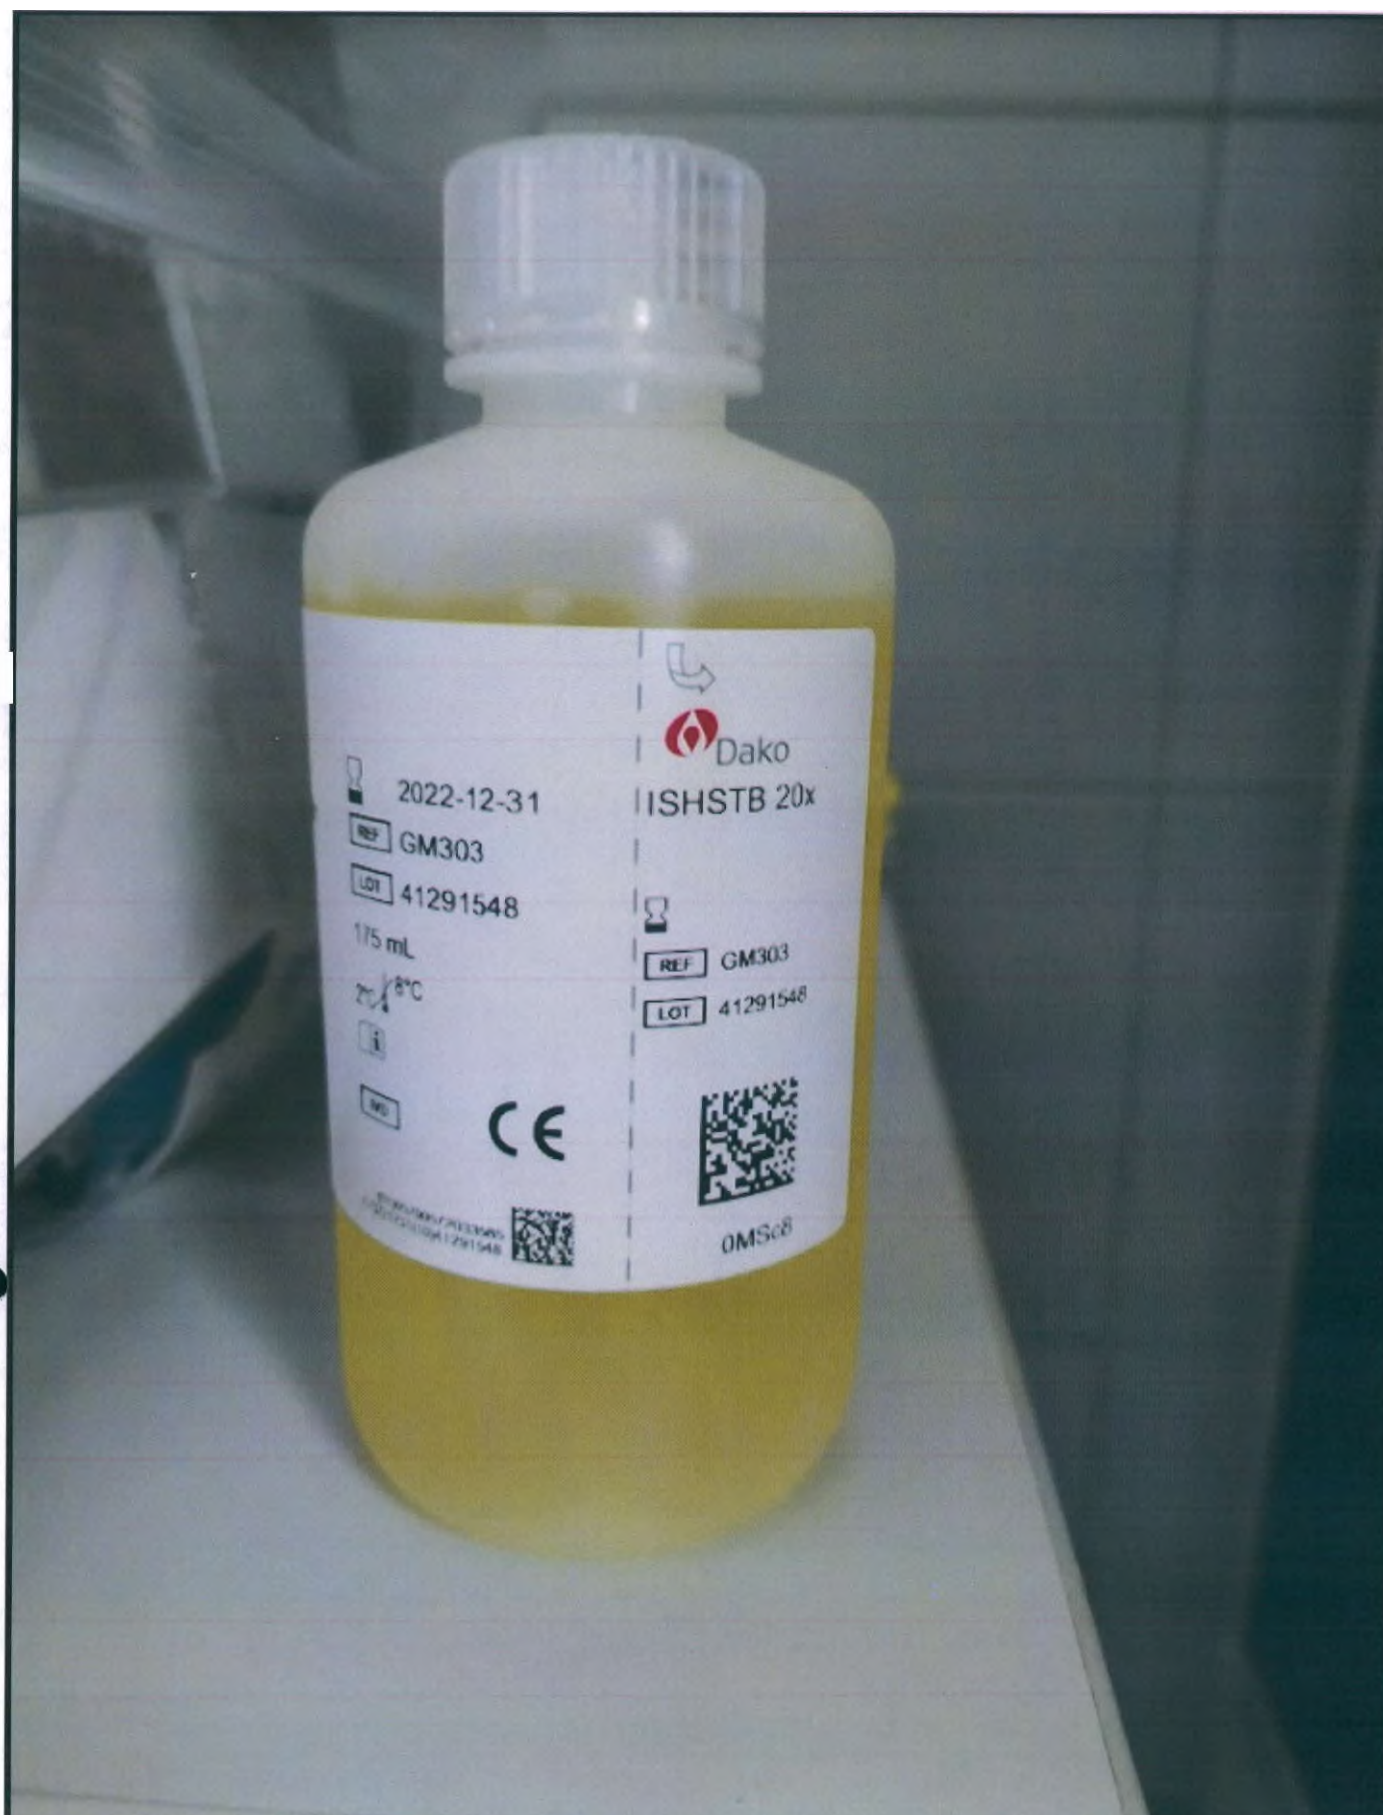


Рисунок 68. Жесткий промывочный буфер для *in situ* гибридизации, Концентрированный (20x), для использования в Дако Омнис, 1 флакон на 175 мл (ISH Stringent Wash Buffer (20x) (Dako Omnis), Concentrate, 175 mL) кат № GM 303 - 2 шт, (вид 2 сторона)

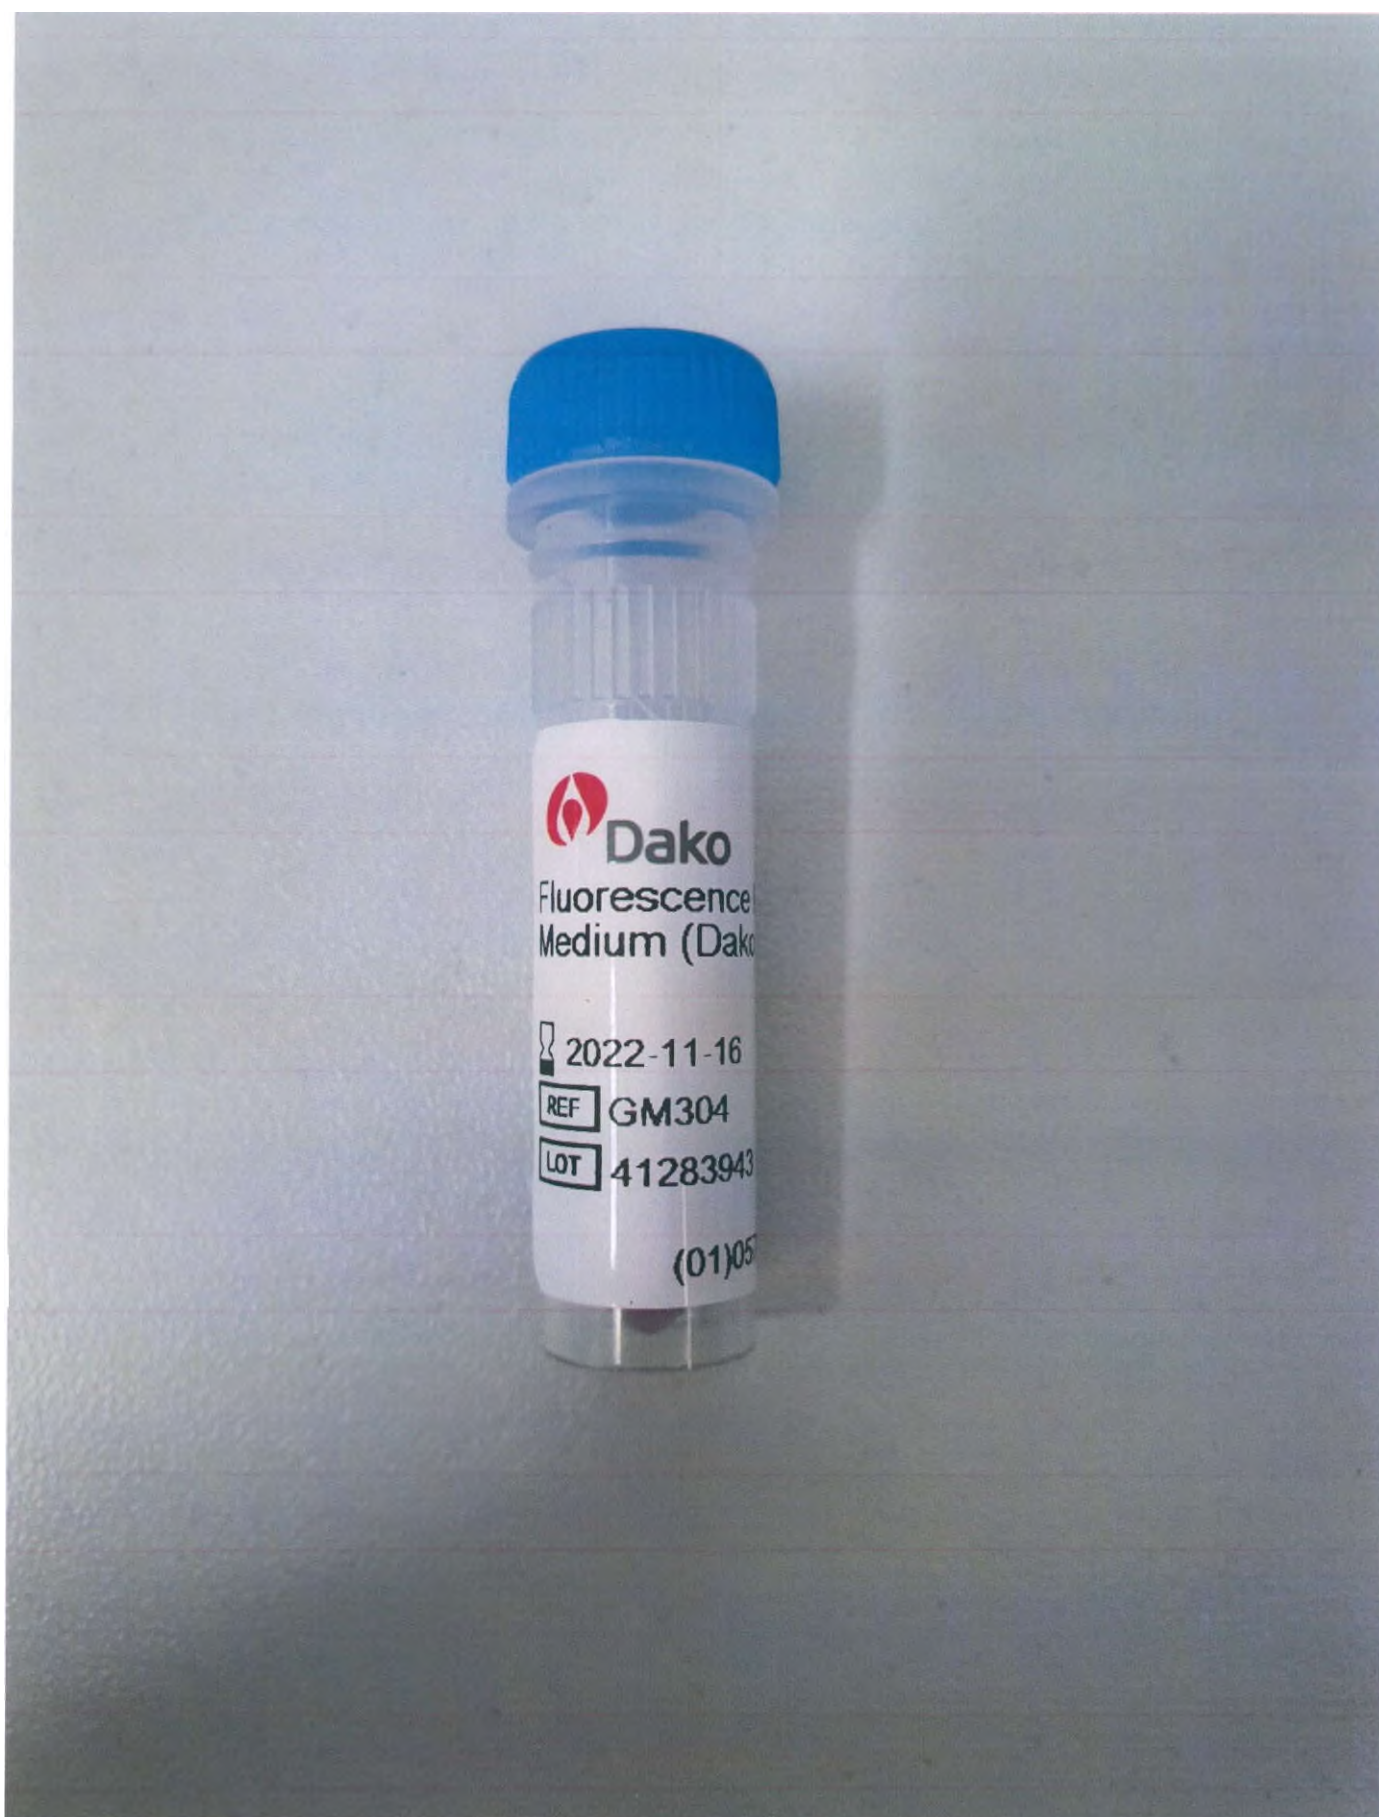


Рисунок 69. • Флуоресцентная монтирующая среда, Готовая к применению, для использования в Дако Омнис, 20 тестов, 1 флакон на 0,8 мл (Fluorescence Mounting Medium (Dako Omnis), Ready-to-use, 20 tests, 0.8 mL), не более 2 шт. (вид 1 сторона)

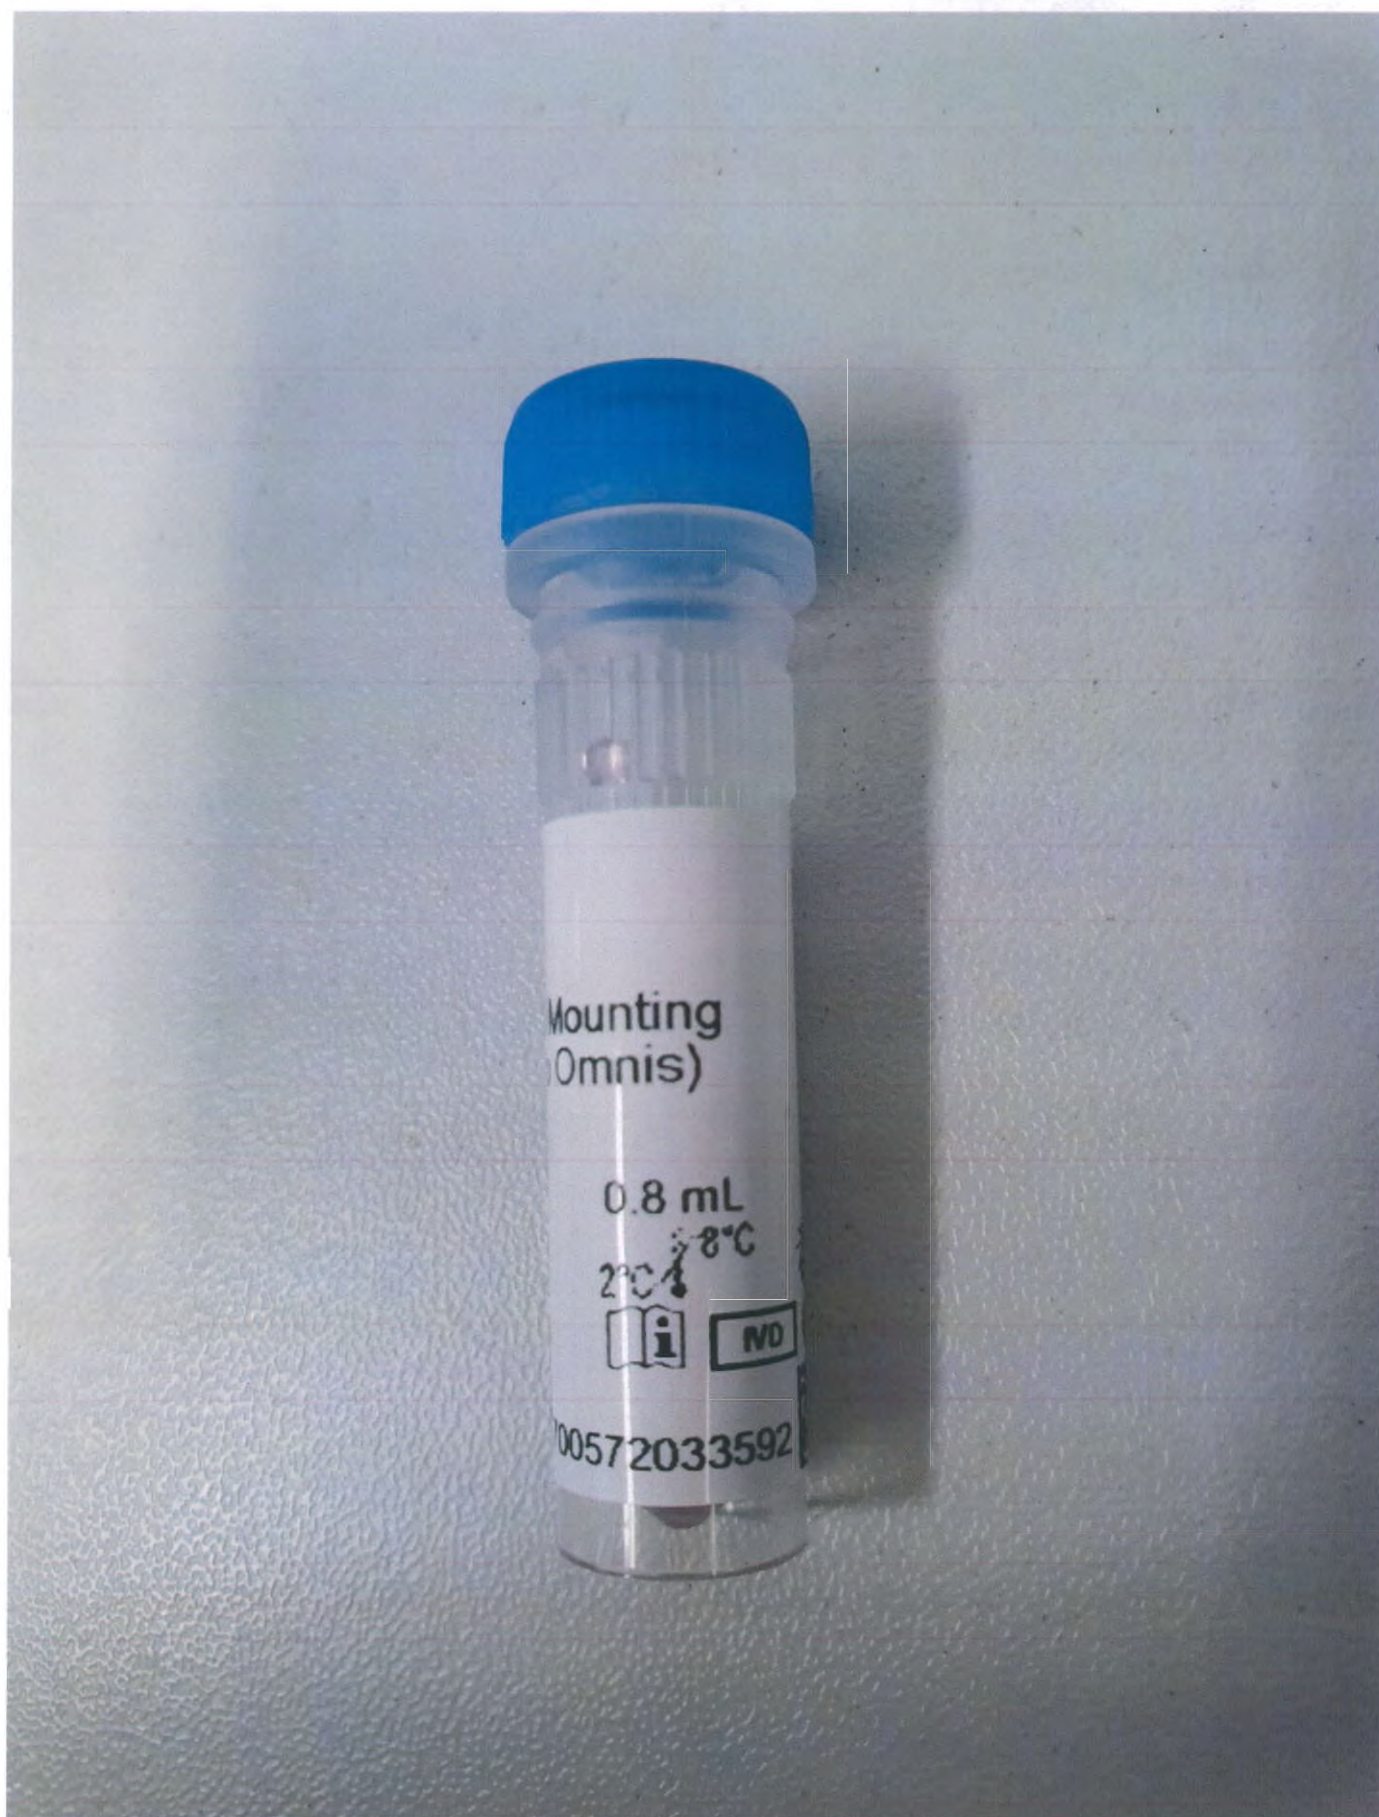


Рисунок 70. • Флуоресцентная монтирующая среда, Готовая к применению, для использования в Дако Омнис, 20 тестов, 1 флакон на 0,8 мл (Fluorescence Mounting Medium (Dako Omnis), Ready-to-use, 20 tests, 0.8 mL), не более 2 шт. (вид 2 сторона)



Рисунок 71. • Чистящий раствор для in situ гибридизации, для использования в Дако Омнис, Готовый к применению, 100 тестов, 10 мл (ISH Cleaning Solution (Dako Omnis), Ready-to-use, 100 tests, 10 mL) - 1 шт. (вид 1 сторона)



Рисунок 72. • Чистящий раствор для in situ гибридизации, для использования в Дако Омнис, Готовый к применению, 100 тестов, 10 мл (ISH Cleaning Solution (Dako Omnis), Ready-to-use, 100 tests, 10 mL) - 1 шт. (вид 2 сторона)



Рисунок 73. • Этанол 96% для *in situ* гибридизации, Готовый к применению, для использования в Дако Омнис, 20 тестов, 1 флакон на 14 мл (ISH Ethanol Solution, 96% (Dako Omnis), Ready-to-use, 20 tests, 14 mL) - 2 шт. (вид 1 сторона)



Рисунок 74. • Этанол 96% для in situ гибридизации, Готовый к применению, для использования в Дако Омнис, 20 тестов, 1 флакон на 14 мл (ISH Ethanol Solution, 96% (Dako Omnis), Ready-to-use, 20 tests, 14 mL) - 2 шт. (вид 2 сторона)



Рисунок 75. • 0,3 М Раствор серной кислоты, реагент для очистки, 10 x 22,5 мл (Sulfuric Acid, 0.3 M, cleaning Reag, 10 x 22.5 mL) - 1 упак. (вид 1 сторона)



Рисунок 76. • 0,3 М Раствор серной кислоты, реагент для очистки, 10 x 22,5 мл (Sulfuric Acid, 0.3 M, cleaning Reag, 10 x 22.5 mL) - 1 упак. (вид 2 сторона)



Dako Omnis
Color Coding Clips,
Red



Agilent Technologies Singapore
(International) Pte. Ltd.
No. 1 Yishun Avenue 7,
Singapore 768923

Manufactured by AMP A/S in Denmark

REF

GC103

PN

GC10330



REV02



25 pcs






Рисунок 78. Дако Омнис Цветной зажим на штатив для стекол, синий, 25 шт/упак (Dako Omnis Slide Rack Color Clip, Blue, 25 ps), 1 упак

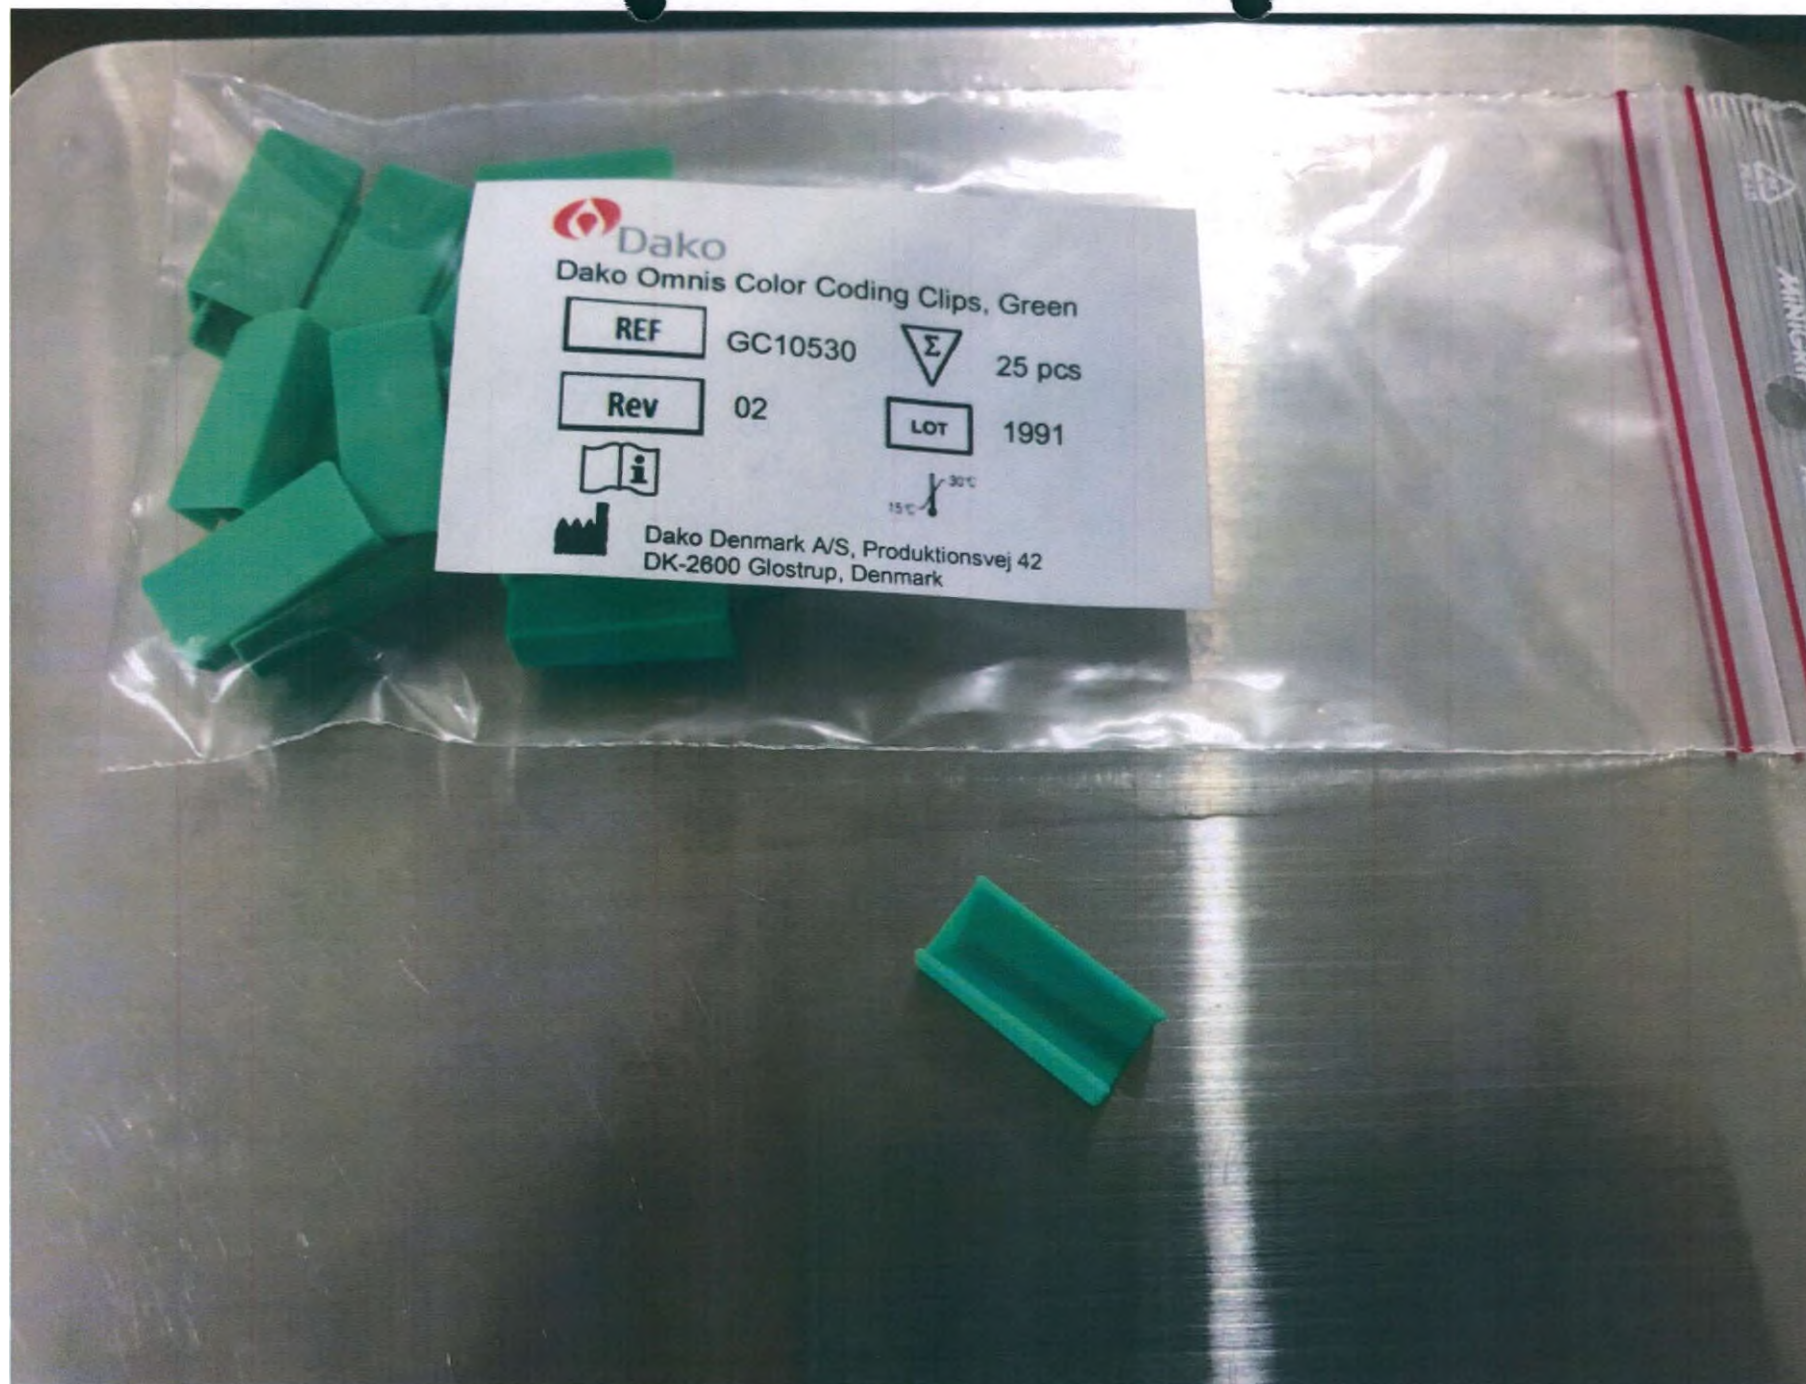


Рисунок 79. Лакс Омнис Цветной зажим на штатив для стекол, зеленый, 25 шт/упак (Dako Omnis Slide Rack Color Clip, Green, 25 ps), 1 упак

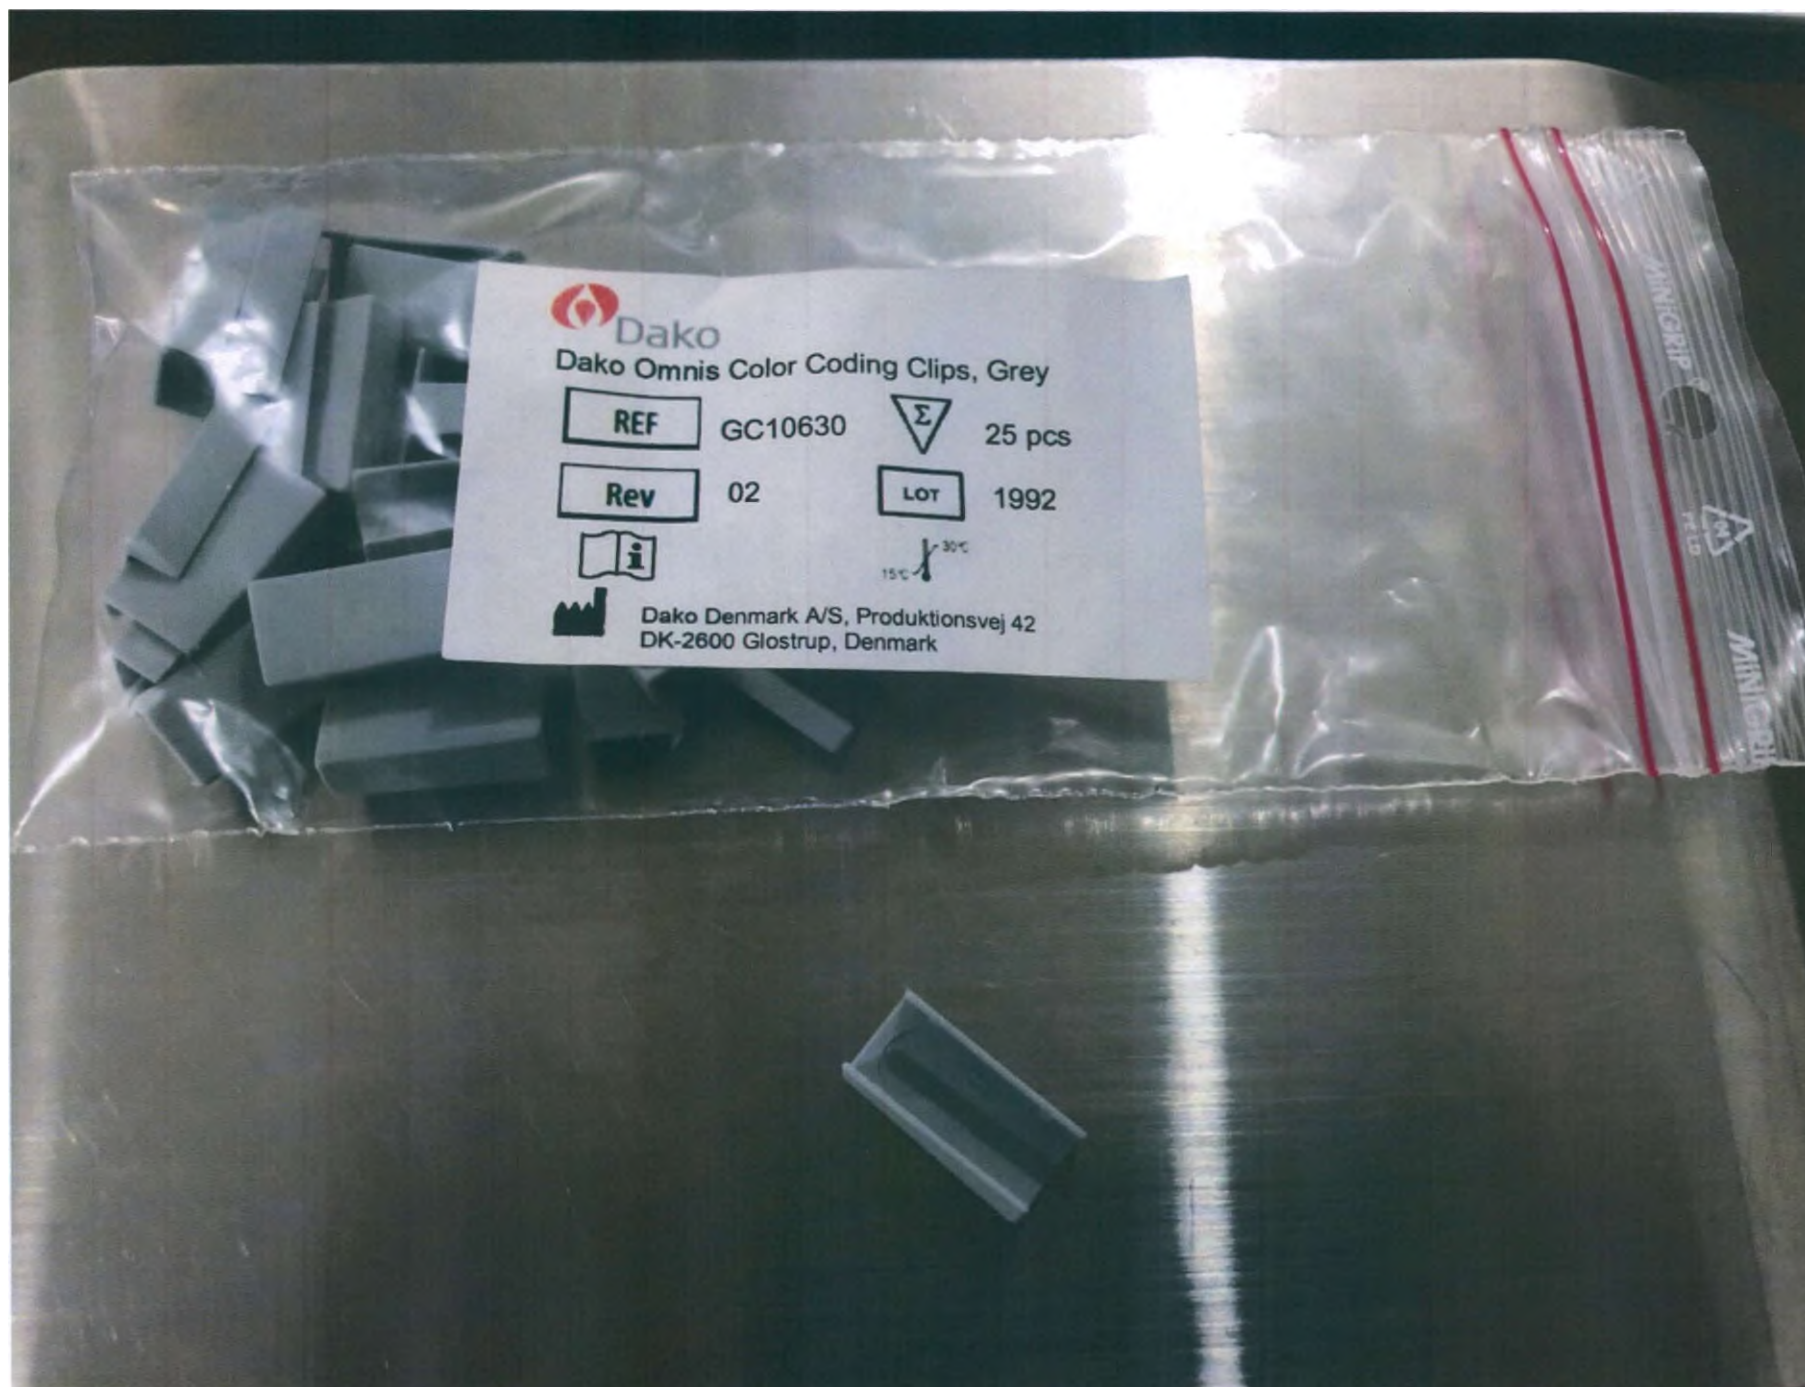


Рисунок 80. Лако Омнис Цветной зажим на штатив для стекол, серый, 25 шт/упак (Dako Omnis Slide Rack Color Clip, Gray, 25 ps), 1 упак



Рисунок 81. Дако Омнис Малый флакон для реагентов, 2 мл, 25 шт/упак (Dako Omnis Small Vial, 2 mL), 1 упак



Рисунок 82. Дако Омнис Большой флакон для реагентов, 30 мл, 25 шт/упак (Dako Omnis Large Vial, 30 mL), 1 упак;



Рисунок 83. Дако Омнис Флакон для реагентов с шариком для перемешивания, 2 мл, 25 шт/упак (Dako Omnis Vial with Mixing Ball, 2 mL), 1 упак;

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

цифрами 83 () листа (ов)
прописью

Должность Генеральный директор АО «Эрба Рус»
Ф.И.О. Иконников М.В.

Подпись _____

КОПИЯ ВЕРНА

