Фотографические изображения общего вида вместе с принадлежностями медицинского изделия:
Комплекс дозиметрический по НРТЦ.412149.001 ТУ

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

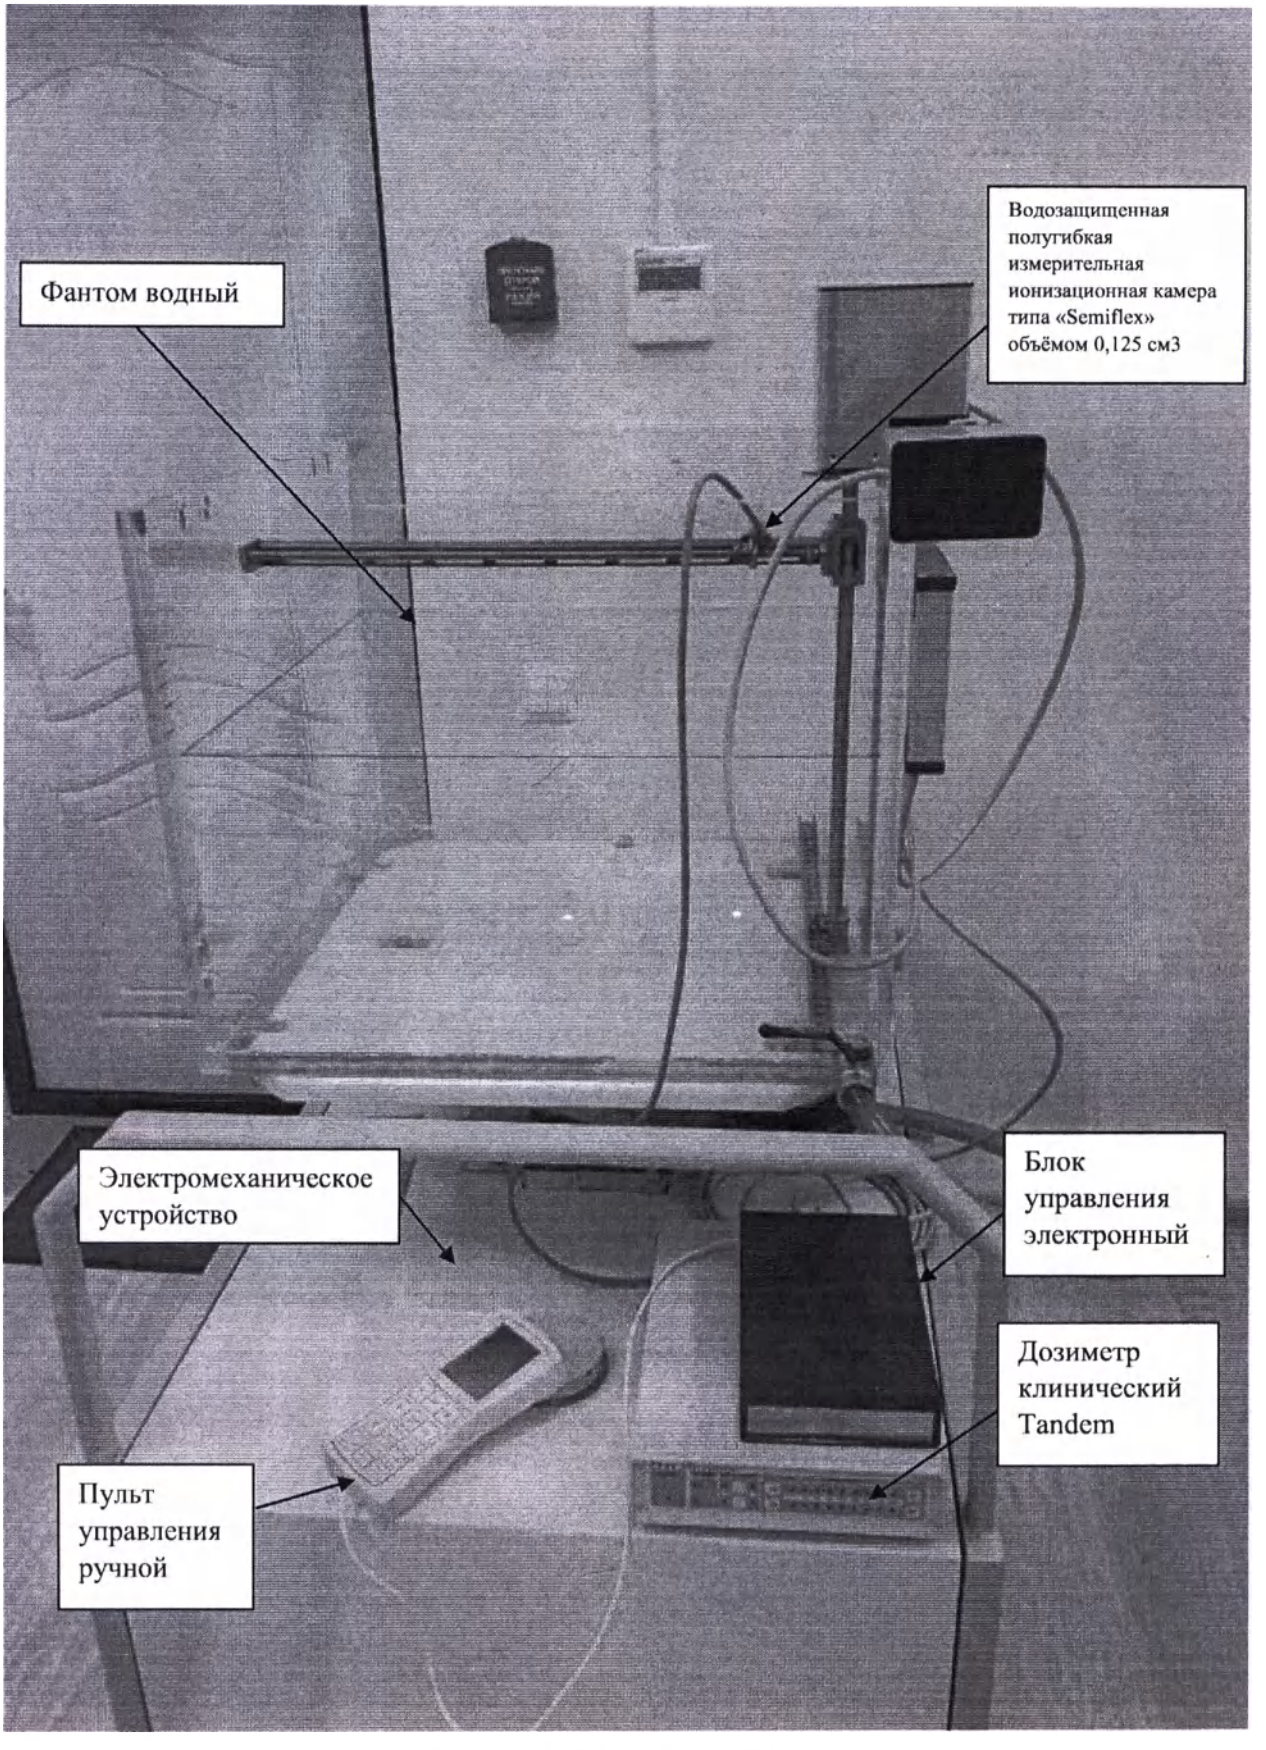

Дозиметрический комплекс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

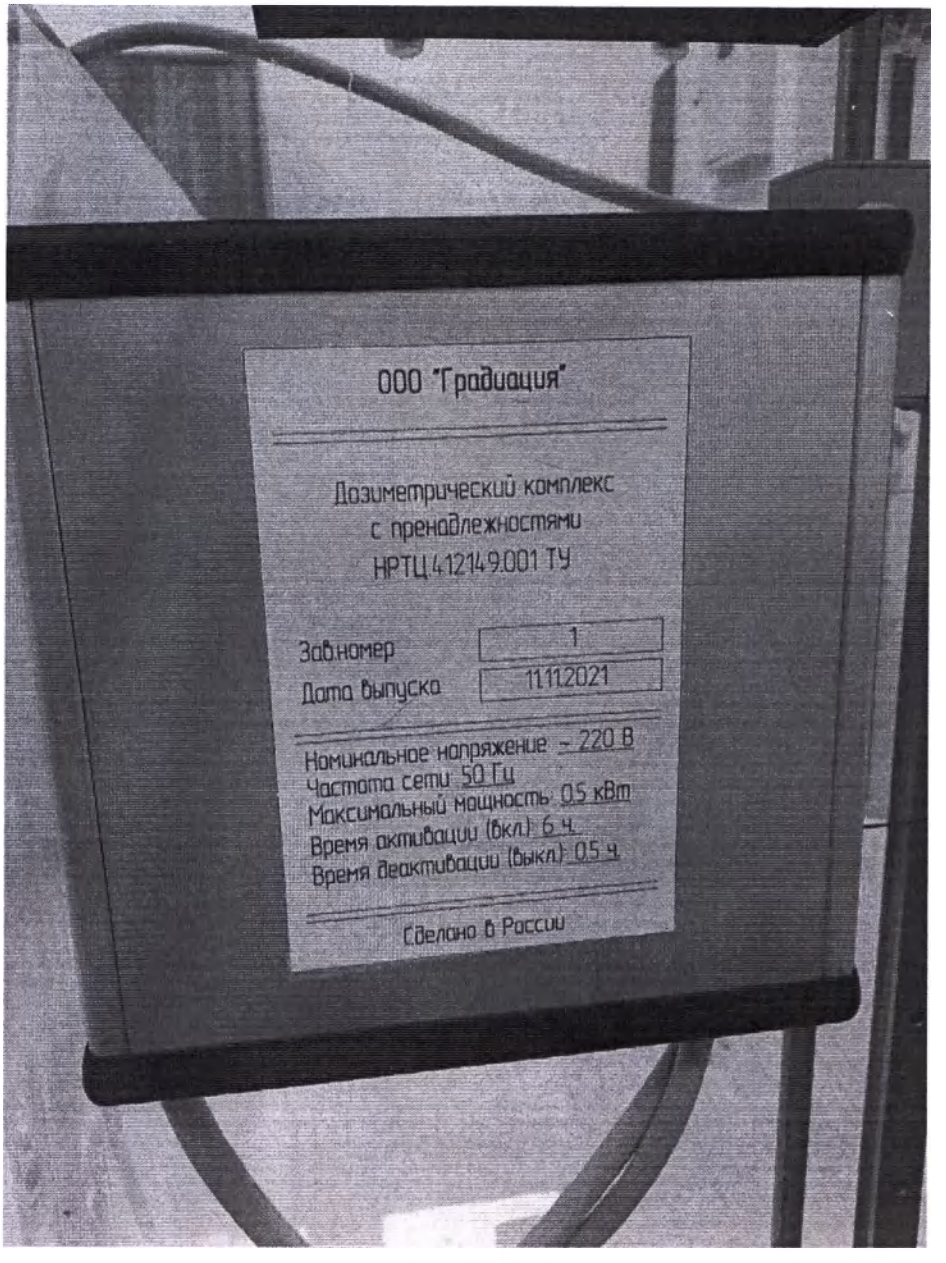

Маркировка

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

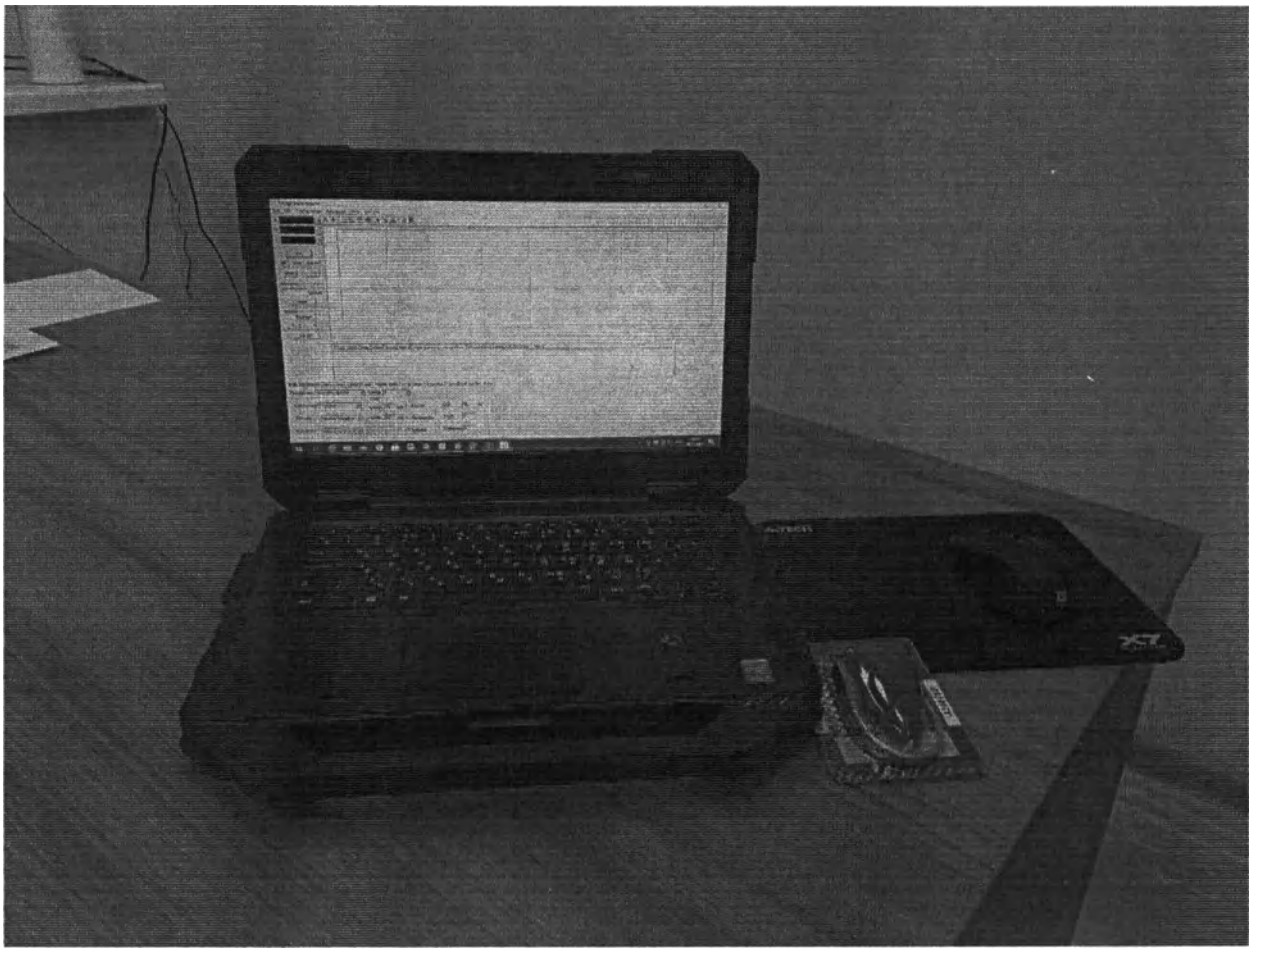

АРМ оператора

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

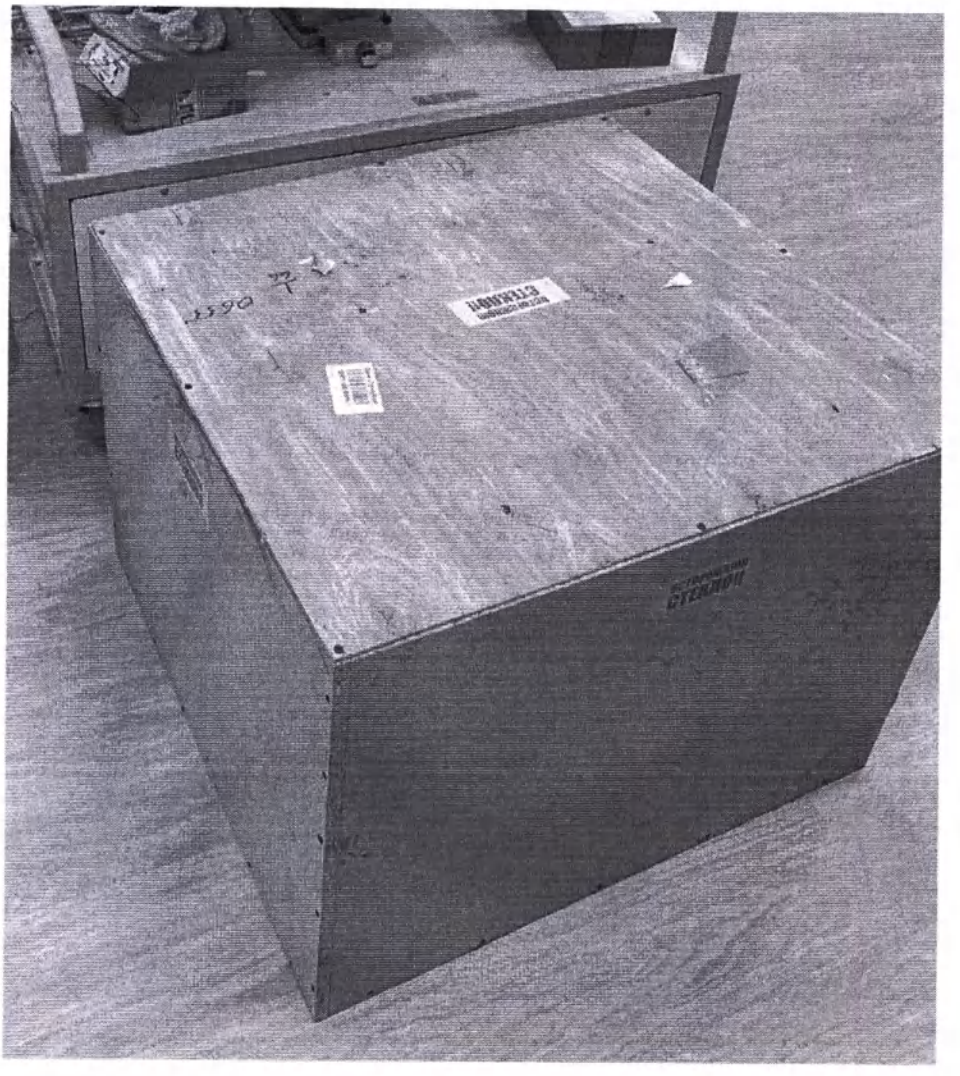

Комплект тары

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

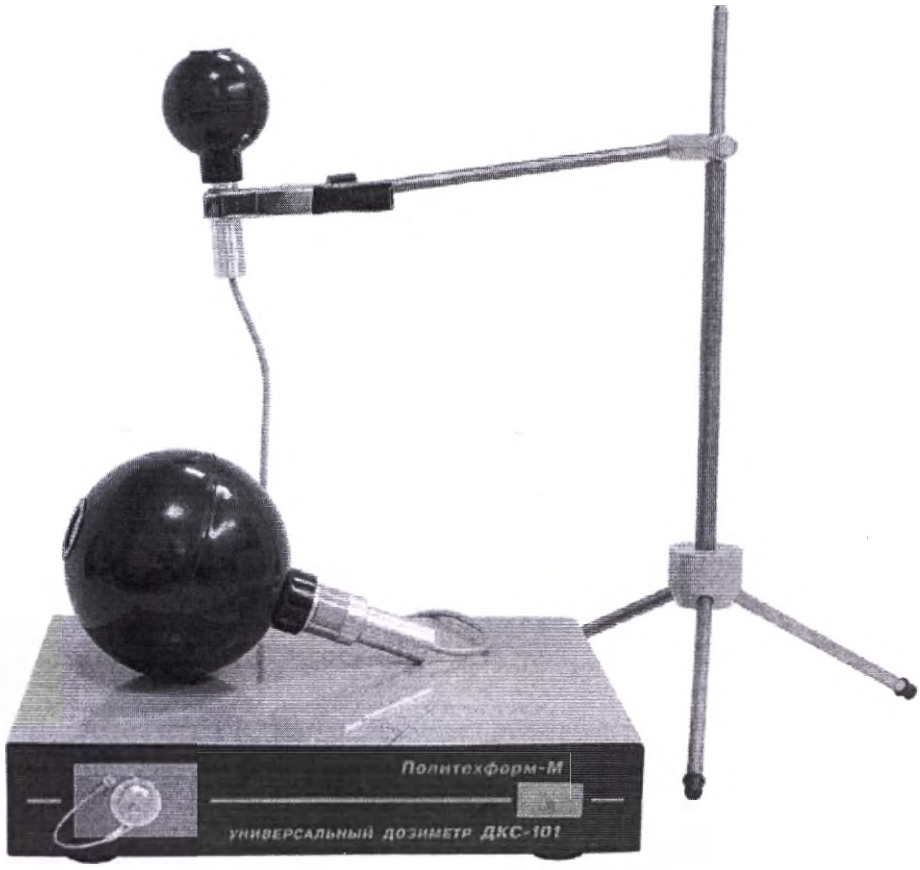

Дозиметр универсальный «ДКС-101», ионизационная камера типа БМК-06 объёмом 0,6 $см^3$, ионизационная камера типа БМК-01 объёмом 0,125 $см^3$

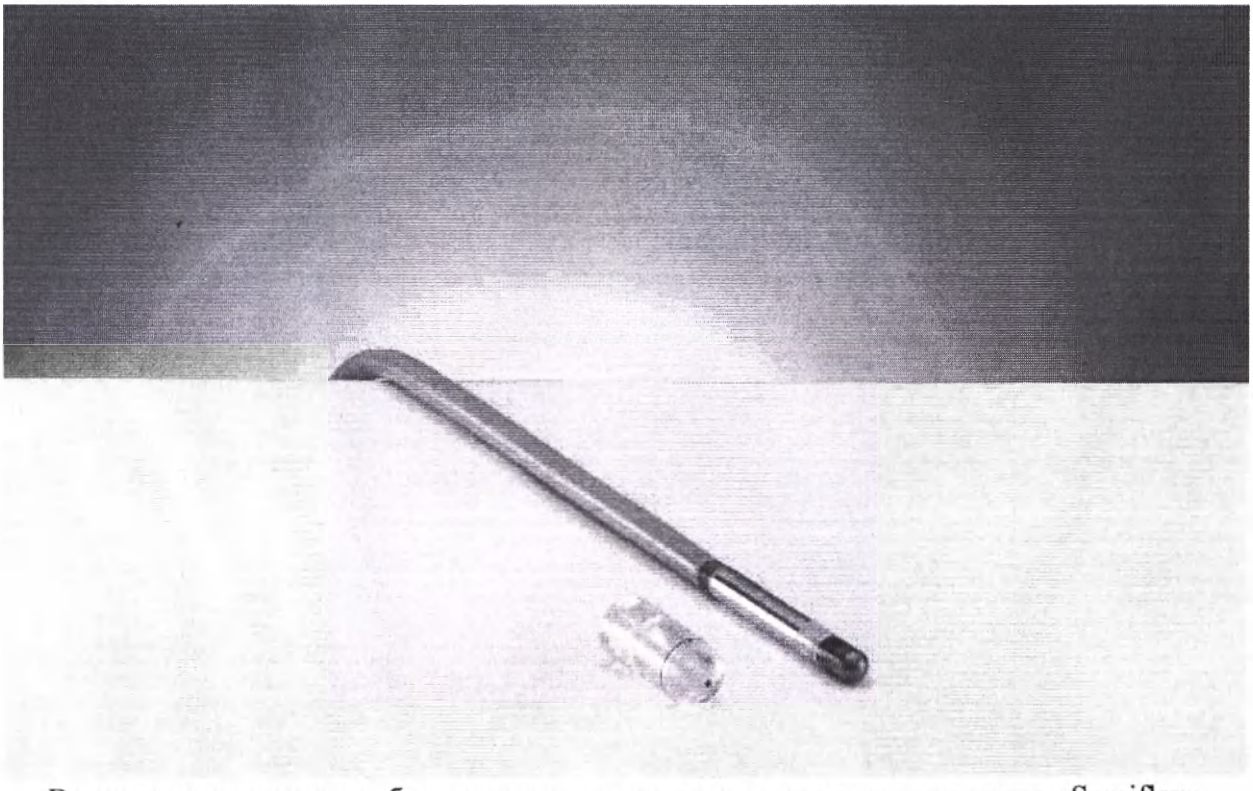

Водозащищенная полугибкая измерительная ионизационная камера типа «Semiflex» объёмом 0,125 $см^3$

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

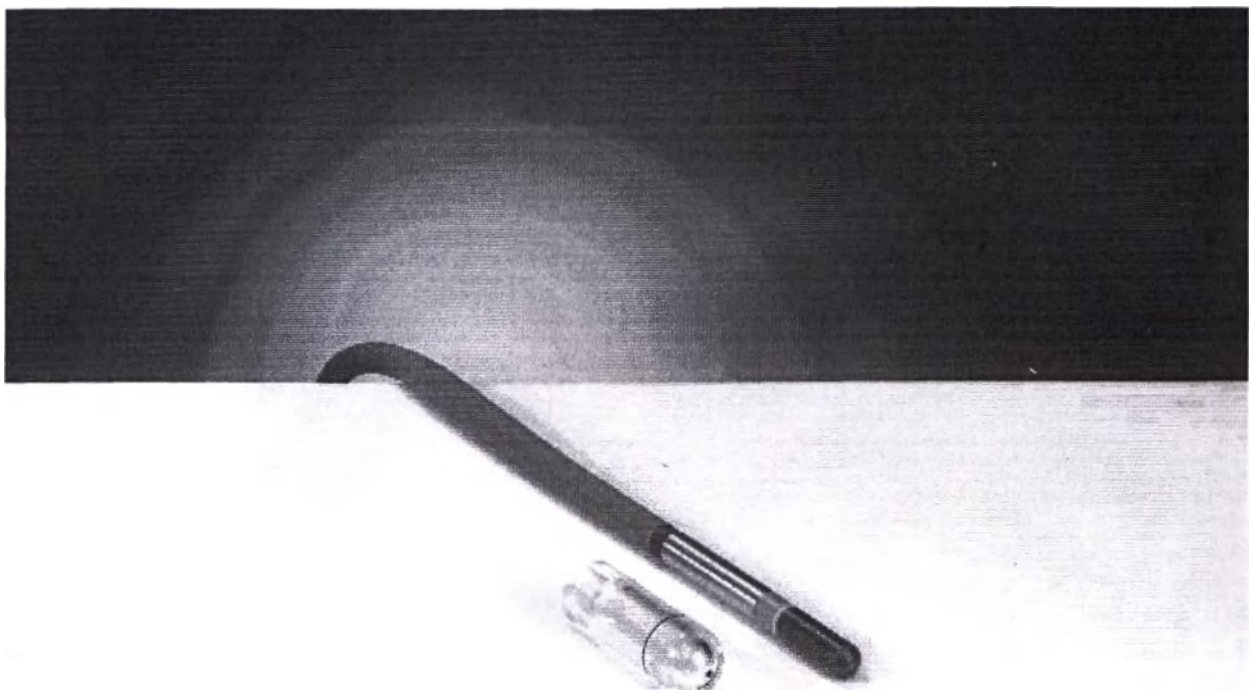

Водозащищенная полугибкая измерительная ионизационная камера типа «Semiflex» объёмом 0,3 см^3

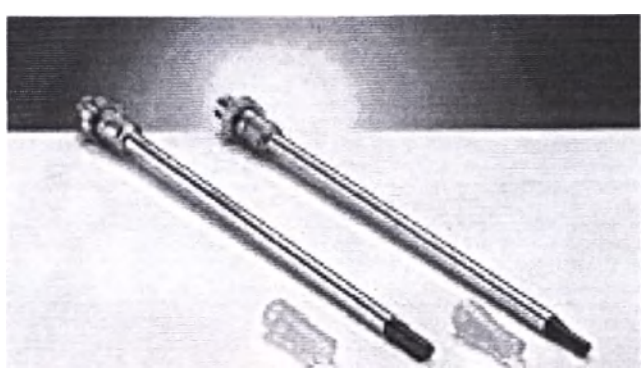

Твердотельная измерительная ионизационная камера типа «Regid Stem» объёмом 0,3 см^3, твердотельная измерительная ионизационная камера типа «Regid Stem» объёмом 1 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

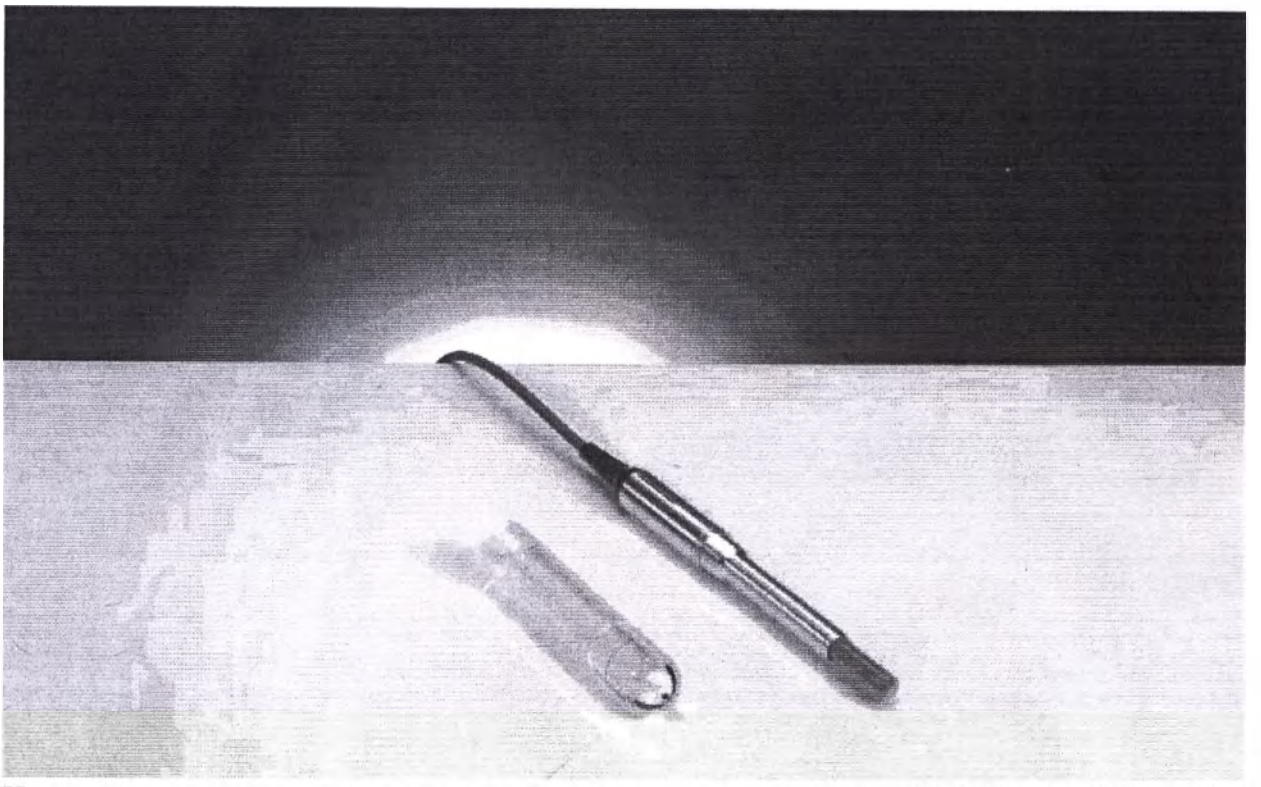

Наперсточная измерительная ионизационная камера типа «Farmer PMMA/Al» объёмом 0,6 $см^3$

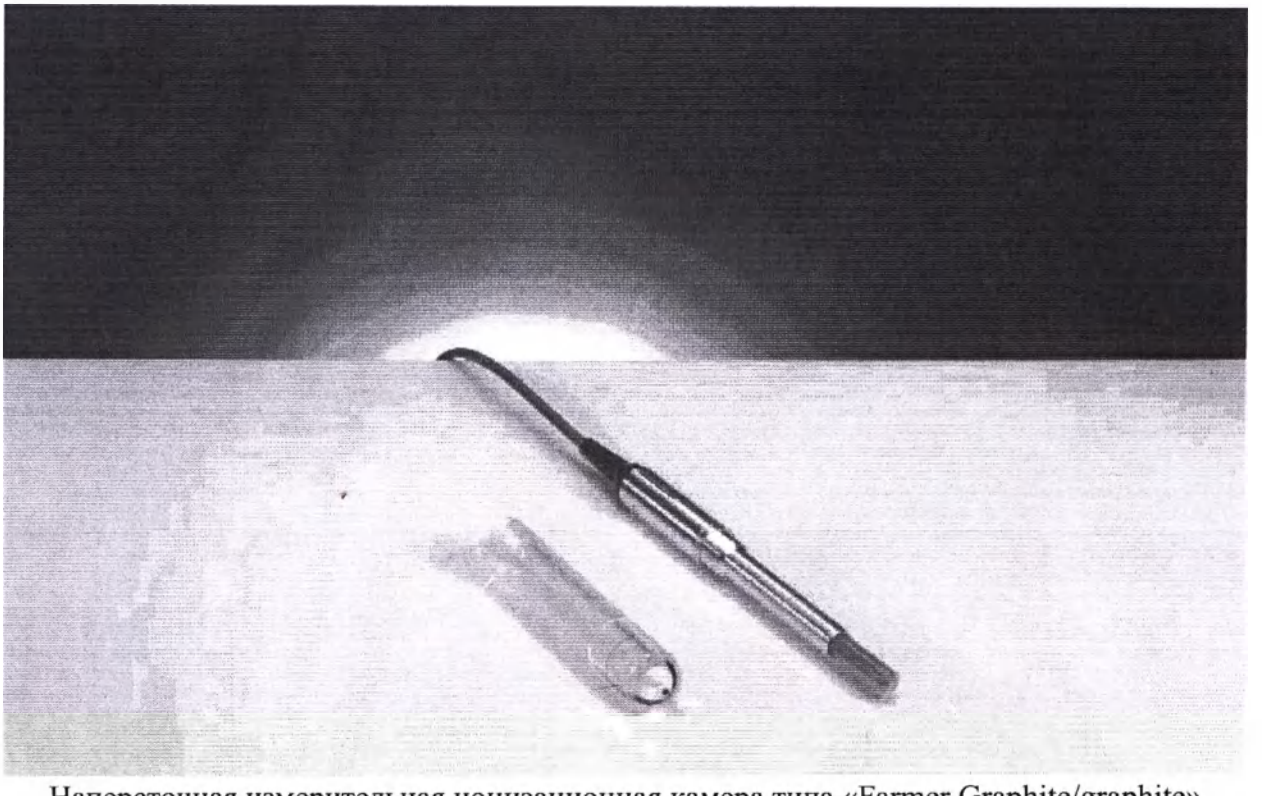

Наперсточная измерительная ионизационная камера типа «Farmer Graphite/graphite» объёмом 0,6 $см^3$

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

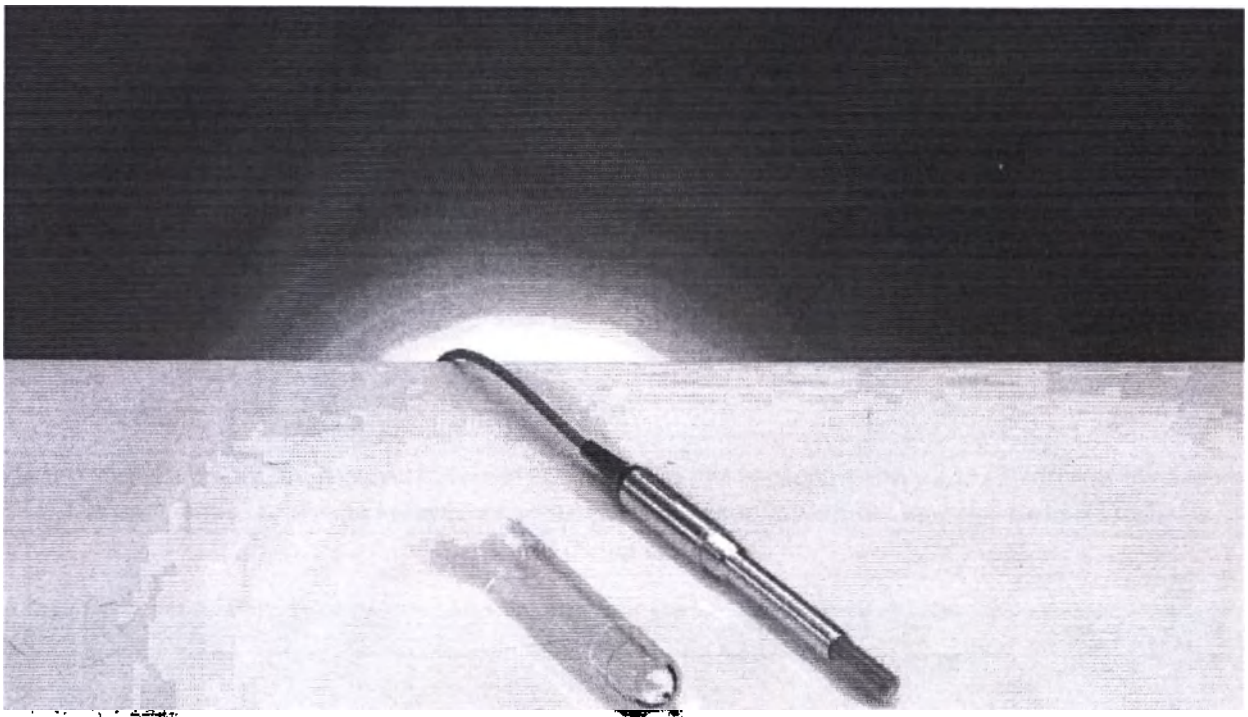

Наперсточная измерительная ионизационная камера типа «Farmer Graphite/Al» объёмом 0,6 см^3

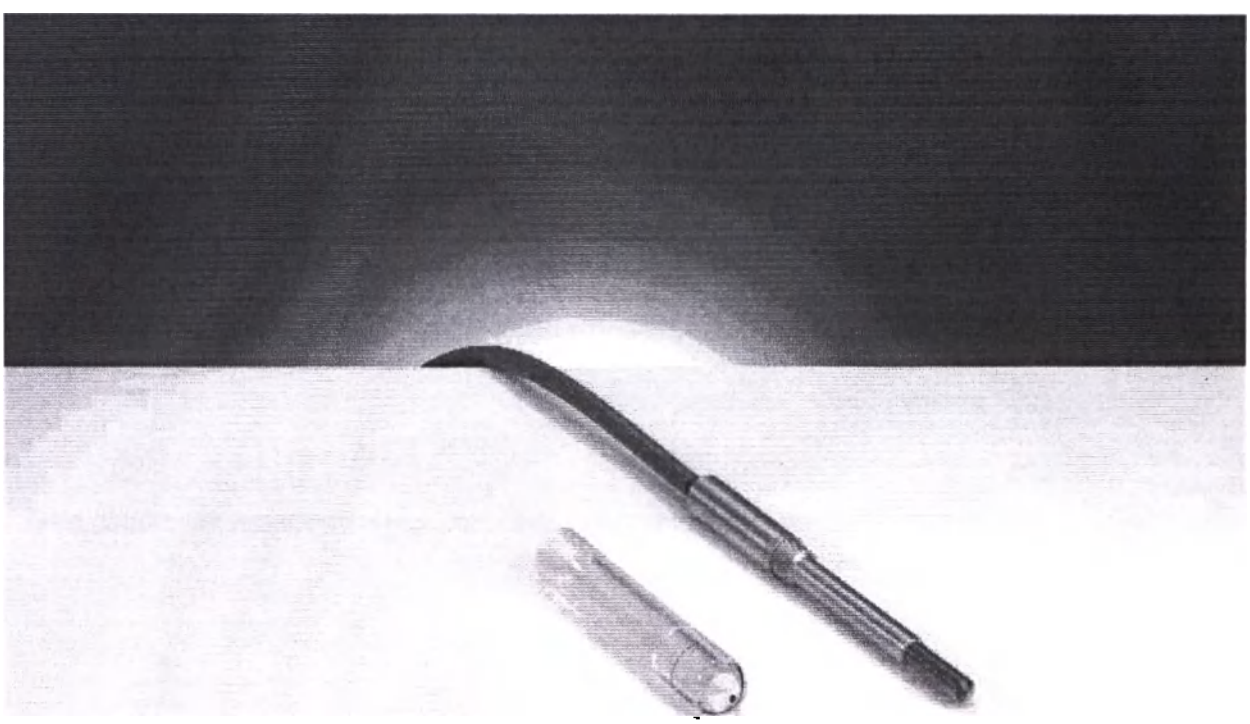

Водозащитная наперсточная измерительная ионизационная камера типа «Farmer Waterproof» объёмом 0,6 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

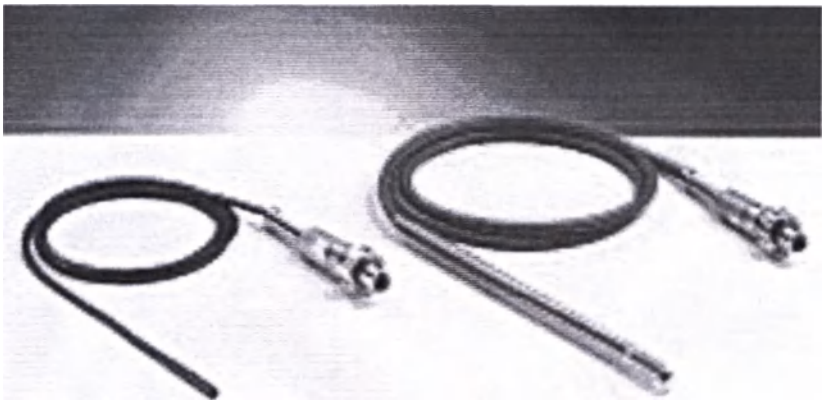

Водозащитная гибкая измерительная ионизационная камера типа «23322 Micro» объёмом 0,125 см^3, водозащитная гибкая измерительная ионизационная камера типа «23322 C» объёмом 0,1 см^3

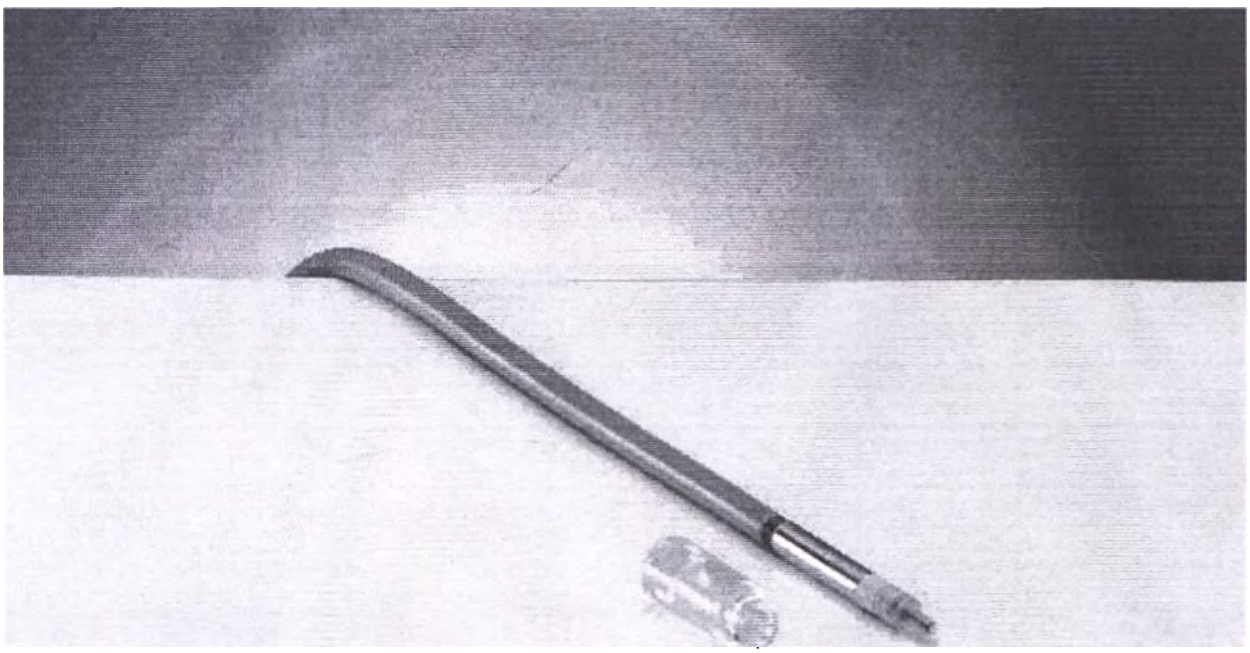

Водозащитная измерительная ионизационная камера типа «PinPoint» объёмом 0,015 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

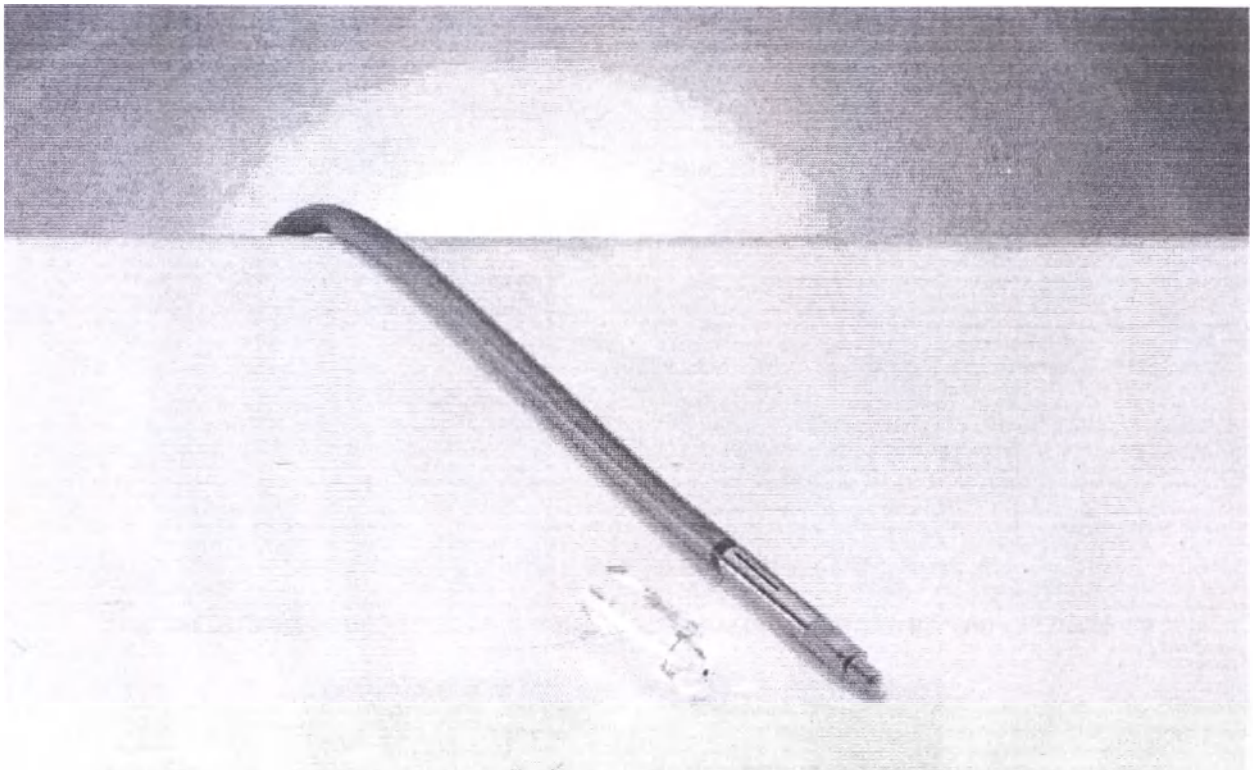

Водозащитная измерительная ионизационная камера типа «PinPoint» объёмом 0,03 см^3

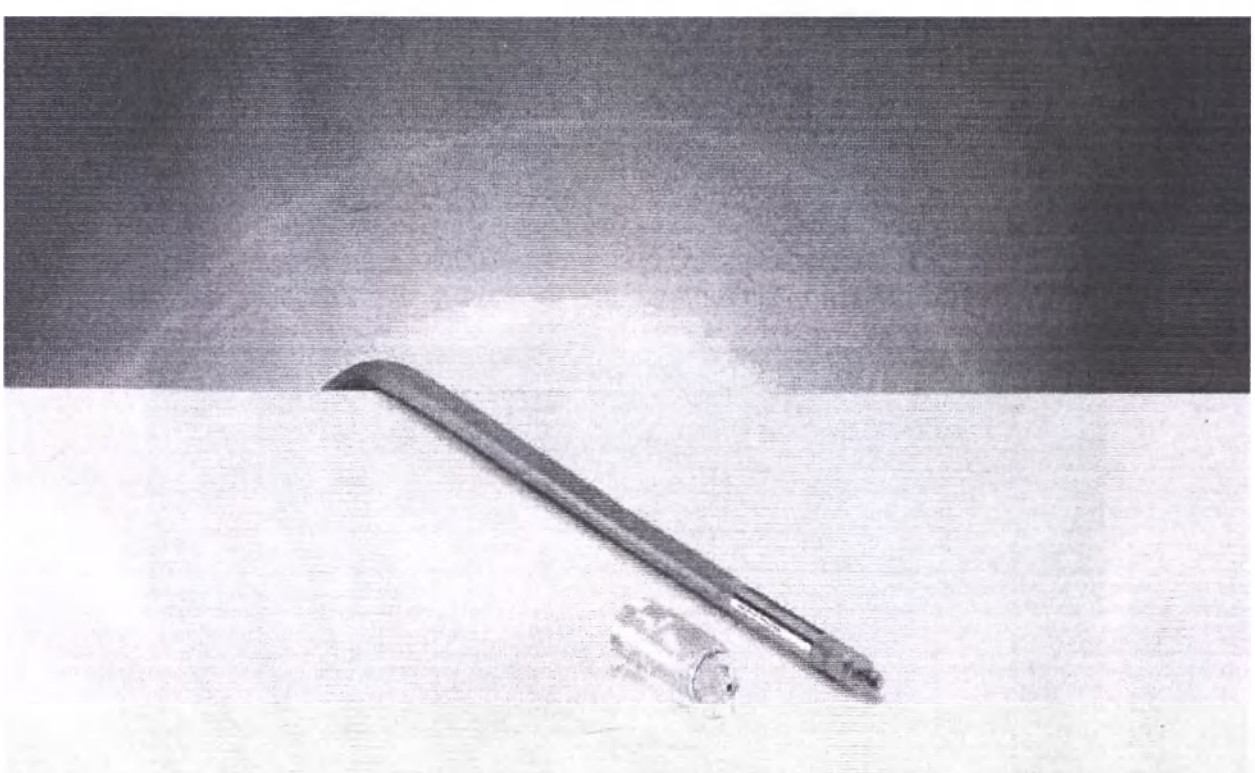

Водозащитная измерительная ионизационная камера типа «PinPoint 3D» объёмом 0,016 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

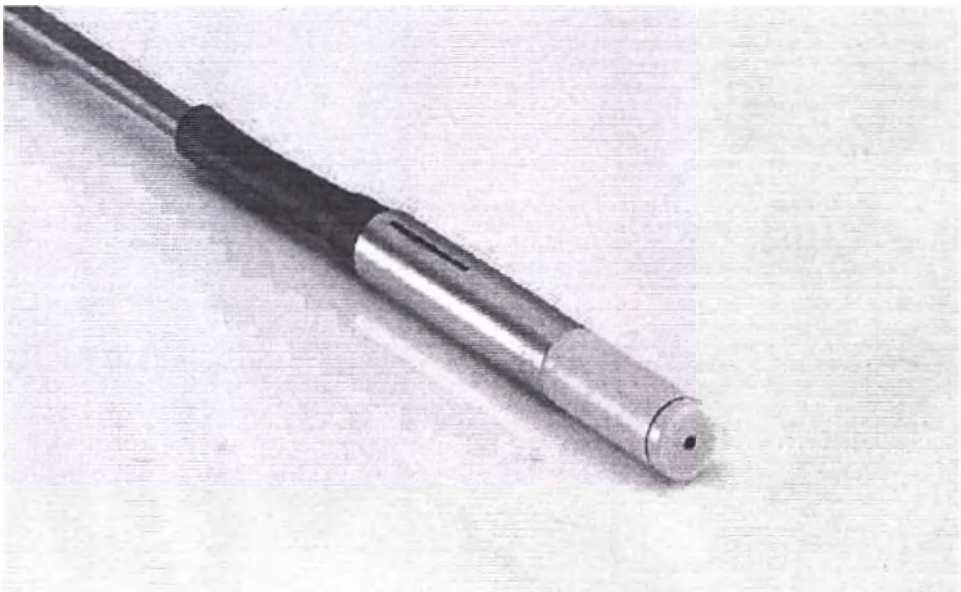

Водозащитный измерительный полупроводниковый детектор типа «Diode P»

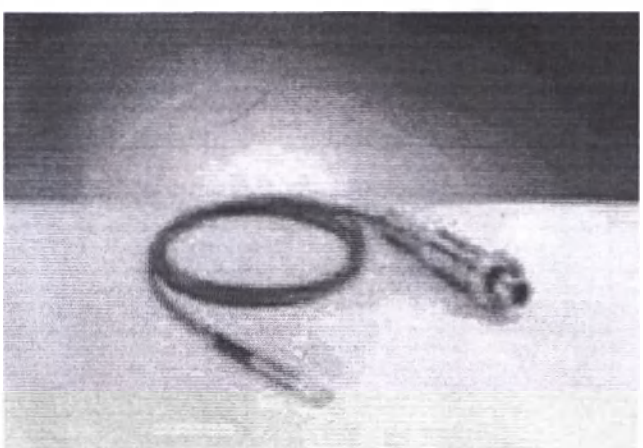

Водозащитный измерительный полупроводниковый детектор типа «Diode E»

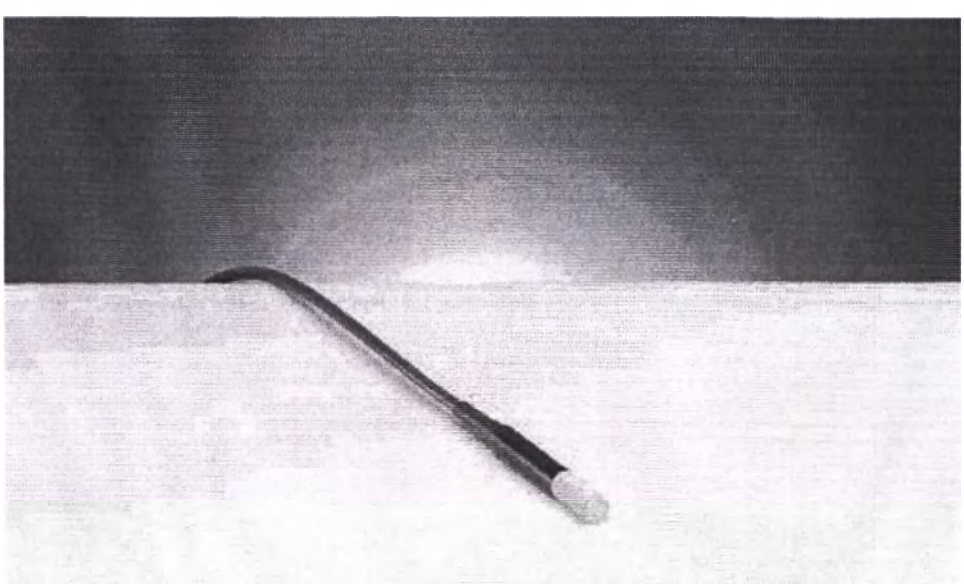

Водозащитный измерительный детектор типа «Diamond» для высокоэнергичных фотонных и электронных пучков

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

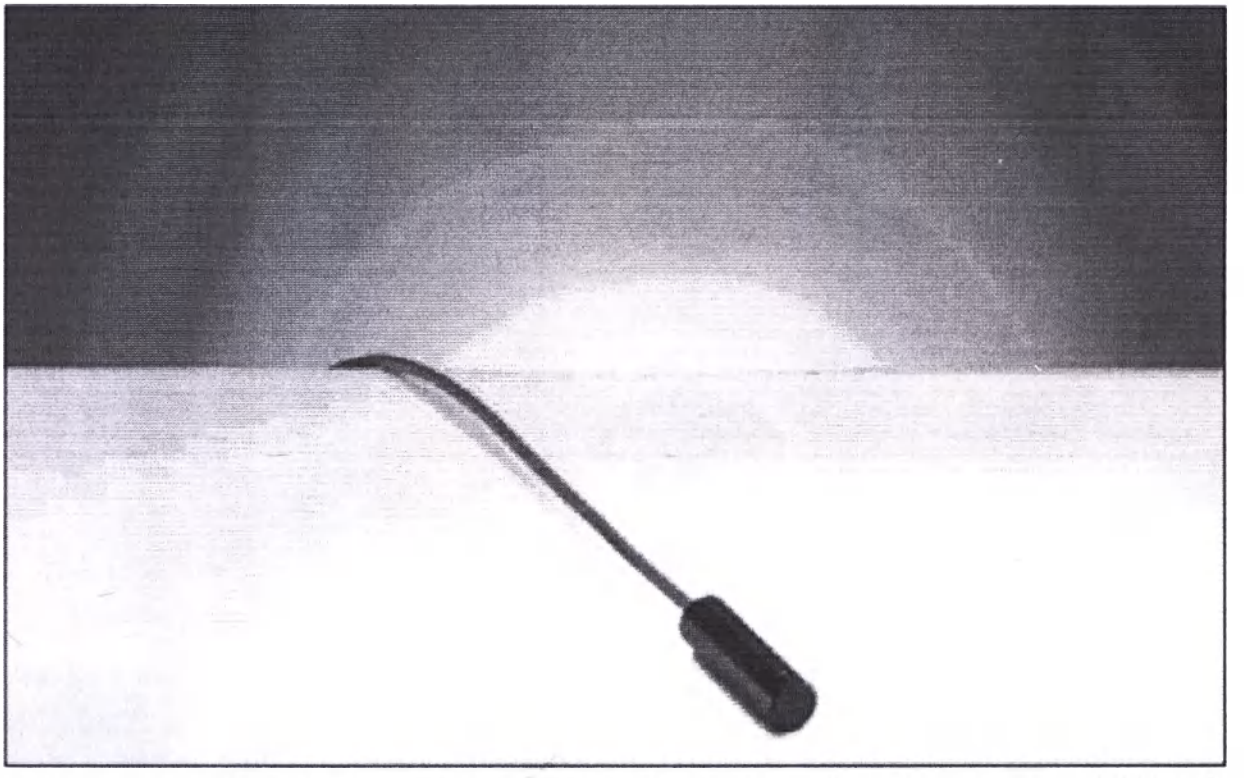

Жидкостная измерительная ионизационная камера типа «microLion» объёмом 0,002 см^3

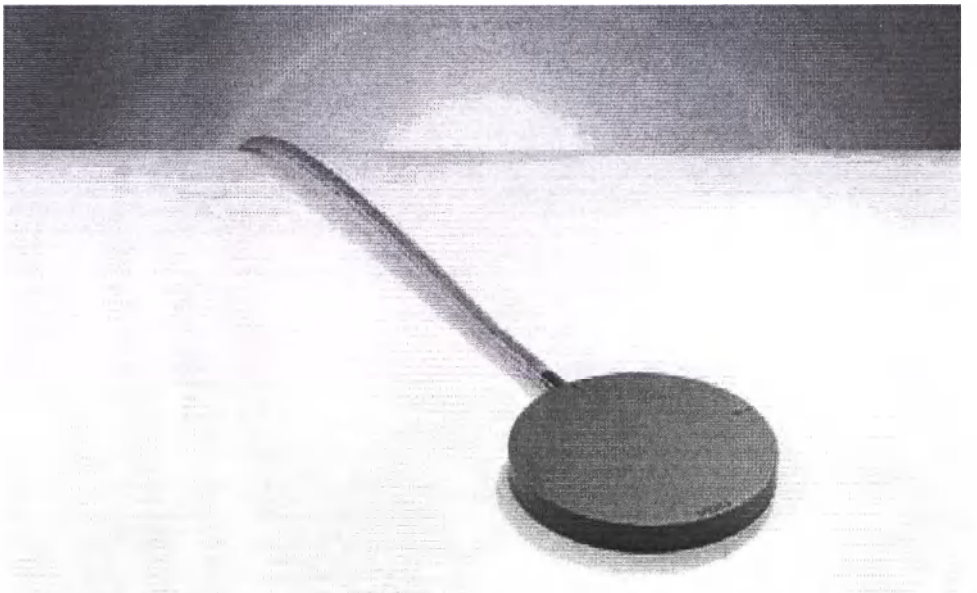

Плоско-параллельная измерительная камера типа «Bragg Peak» объёмом 10,5 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

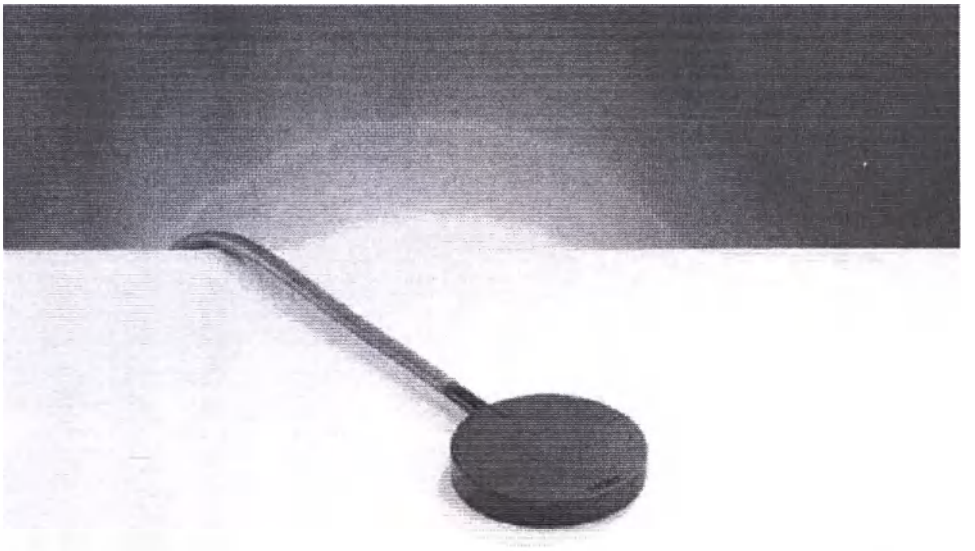

Плоско-параллельная измерительная камера типа «Bragg Peak» объёмом 2,5 см^3

Плоско-параллельная измерительная камера типа «Advanced Markus» объёмом 0,02 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

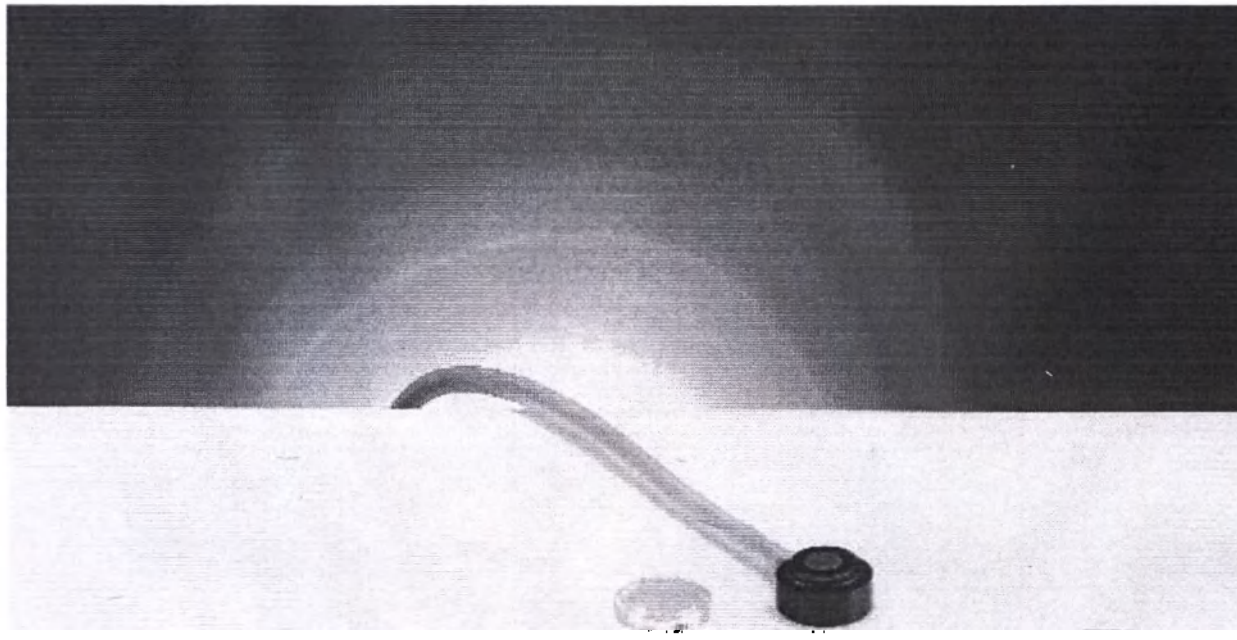

Плоско-параллельная измерительная камера типа «Classik Markus» объёмом 0,055 см^3

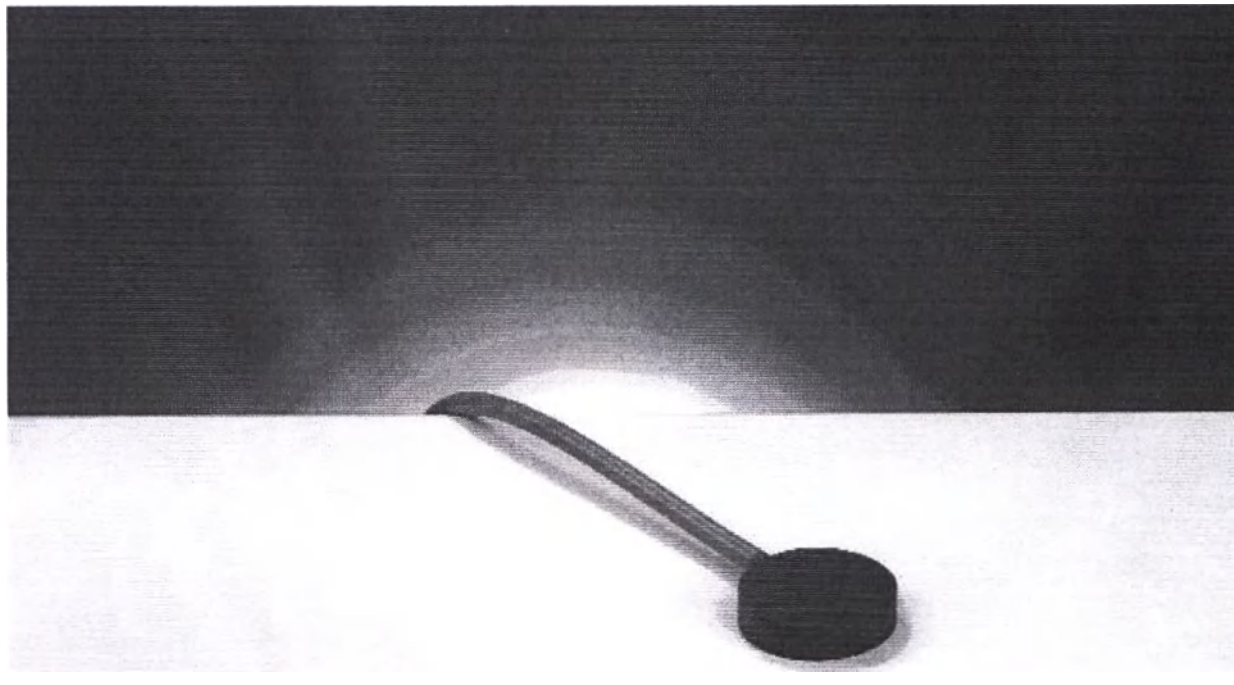

Плоско-параллельная измерительная камера типа «Roos» объёмом 0,35 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

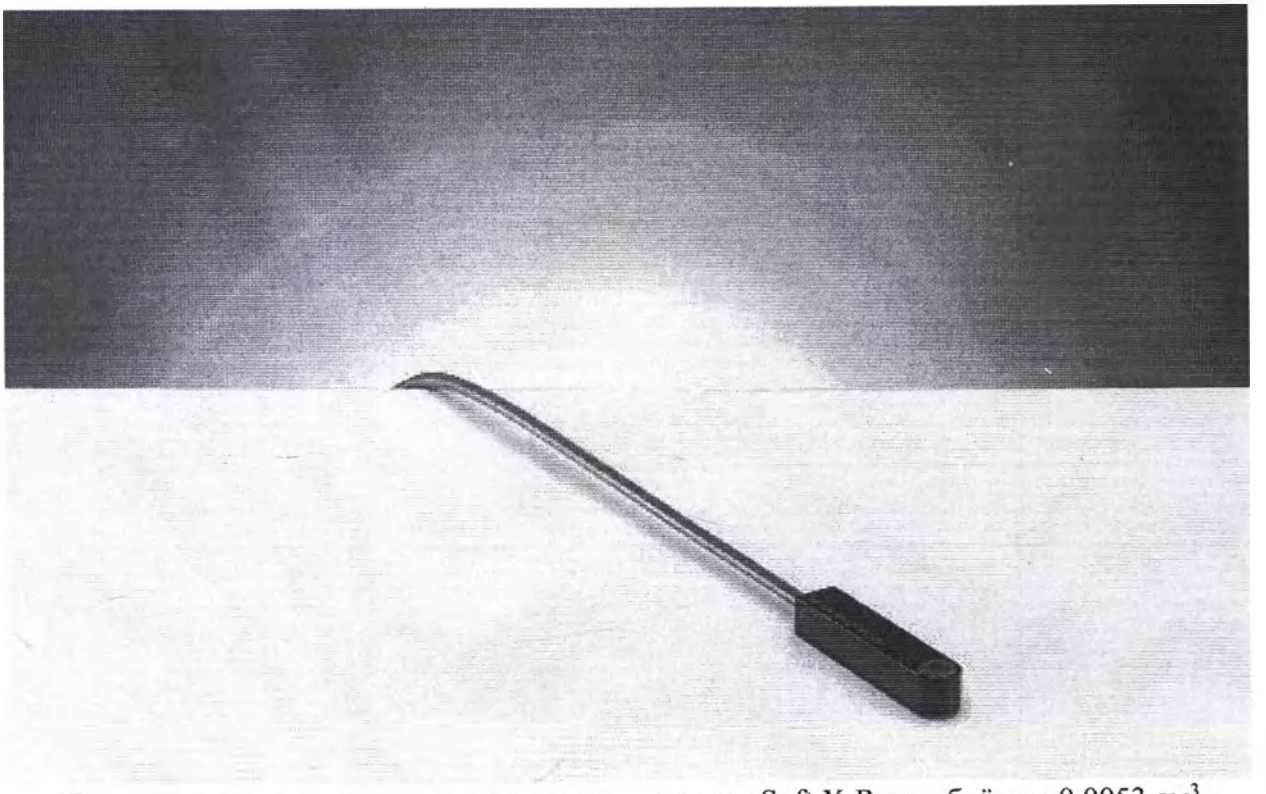

Плоско-параллельная измерительная камера типа «Soft X-Ray» объёмом 0,0053 см^3

Плоско-параллельная измерительная камера типа «Soft X-Ray» объёмом 0,02 см^3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

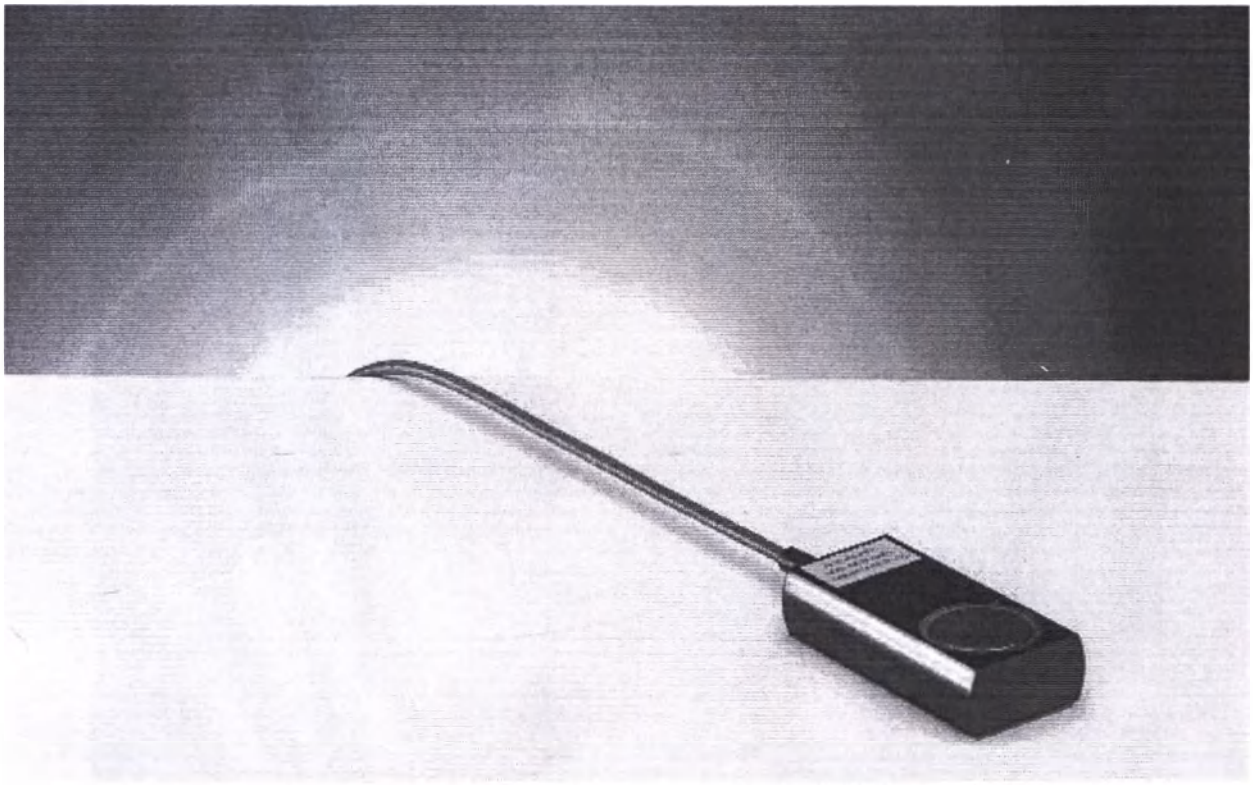

Плоско-параллельная измерительная камера типа «Soft X-Ray» объёмом 0,2 см^3

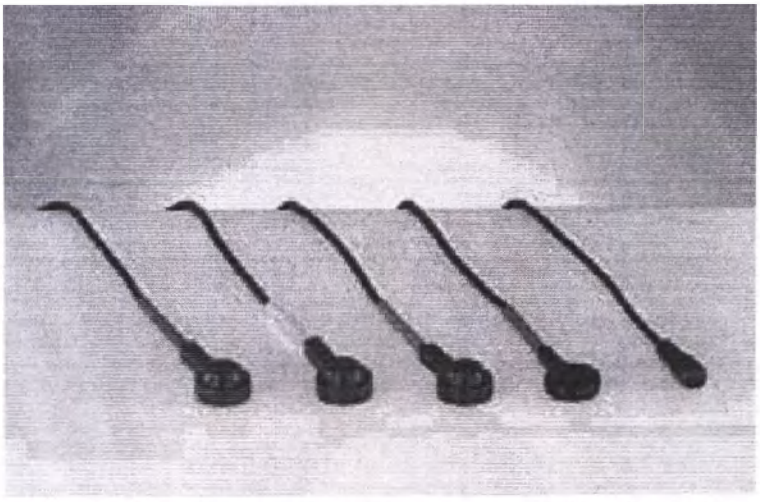

Комплект полупроводниковых детекторов для In-vivo дозиметрии

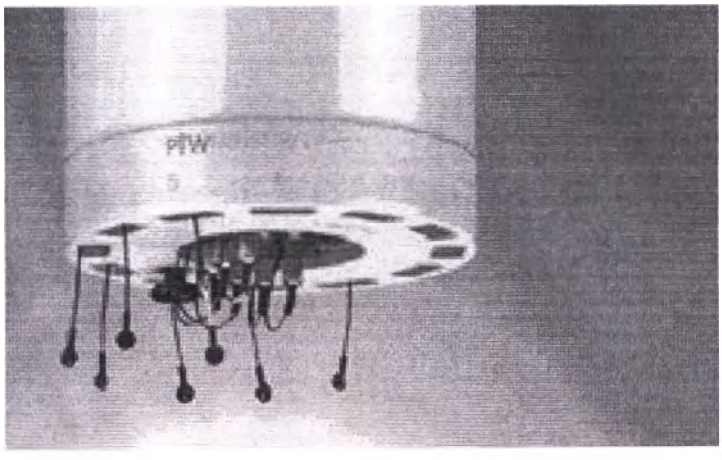

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Распределительная коробка для подключения полупроводниковых детекторов для In-vivo дозиметрии

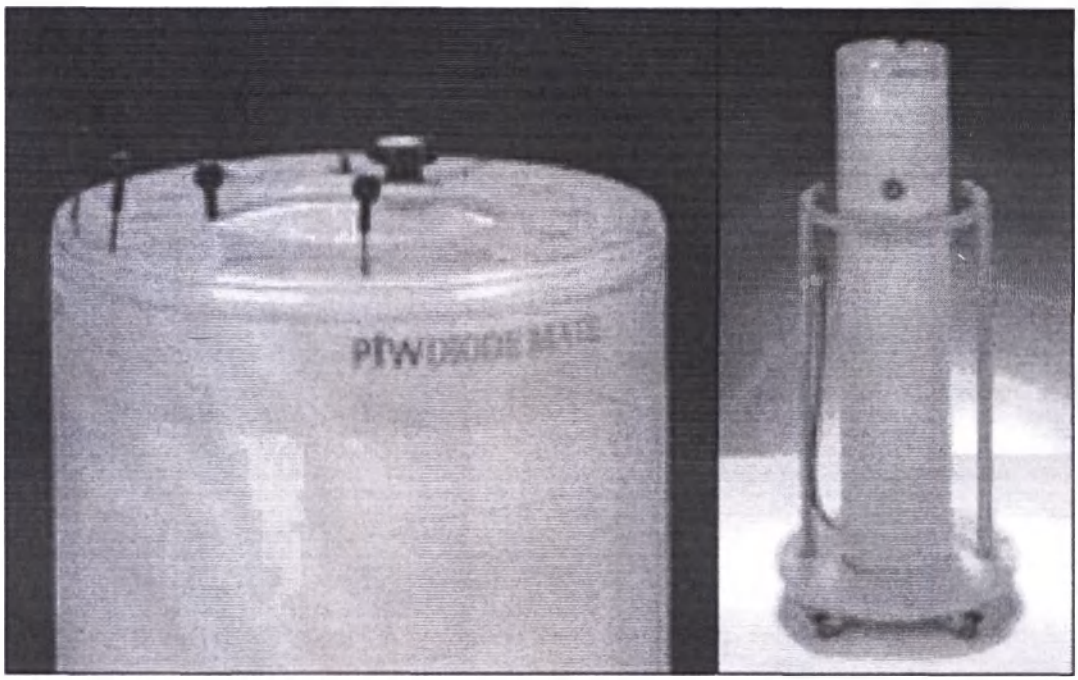

Мобильный блок DIODE MATE для хранения и подключения полупроводниковых детекторов для In-vivo дозиметрии

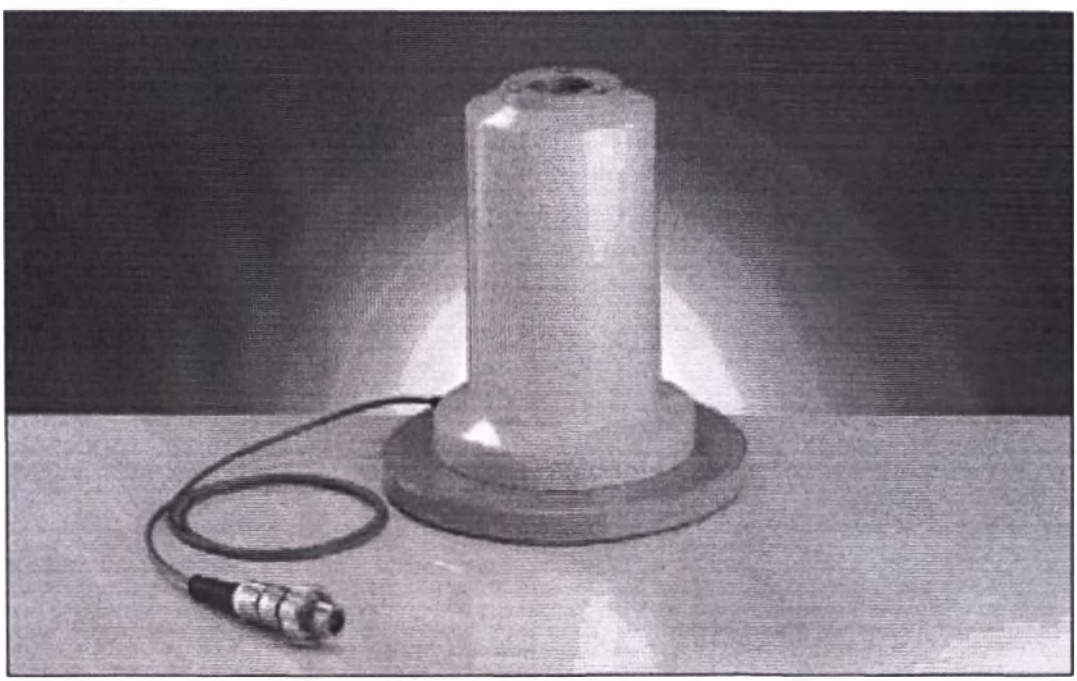

Ионизационная камера колодезного типа «Well-Type» для измерения активности источников в брахитерапии

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА

Прошито и пронумеровано

18 (восемнадцать)

листов

Директор

ООО «Градиация»

Д.И. Гранин

«08» марта 2022г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU