

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ЮМед»

Турдыбеков С.К.

29.05.2022 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО
ИЗДЕЛИЯ:**

Система для фиксации позвоночника


2022

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИМПЛАНТАТОВ СИСТЕМЫ


I. Система для фиксации переднего шейного отдела позвоночника:



Фотографическое изображение комплектующей - Пластина титановая для переднего шейного отдела позвоночника, тип III - 4 отверстия, длина 16 мм в первичной упаковке

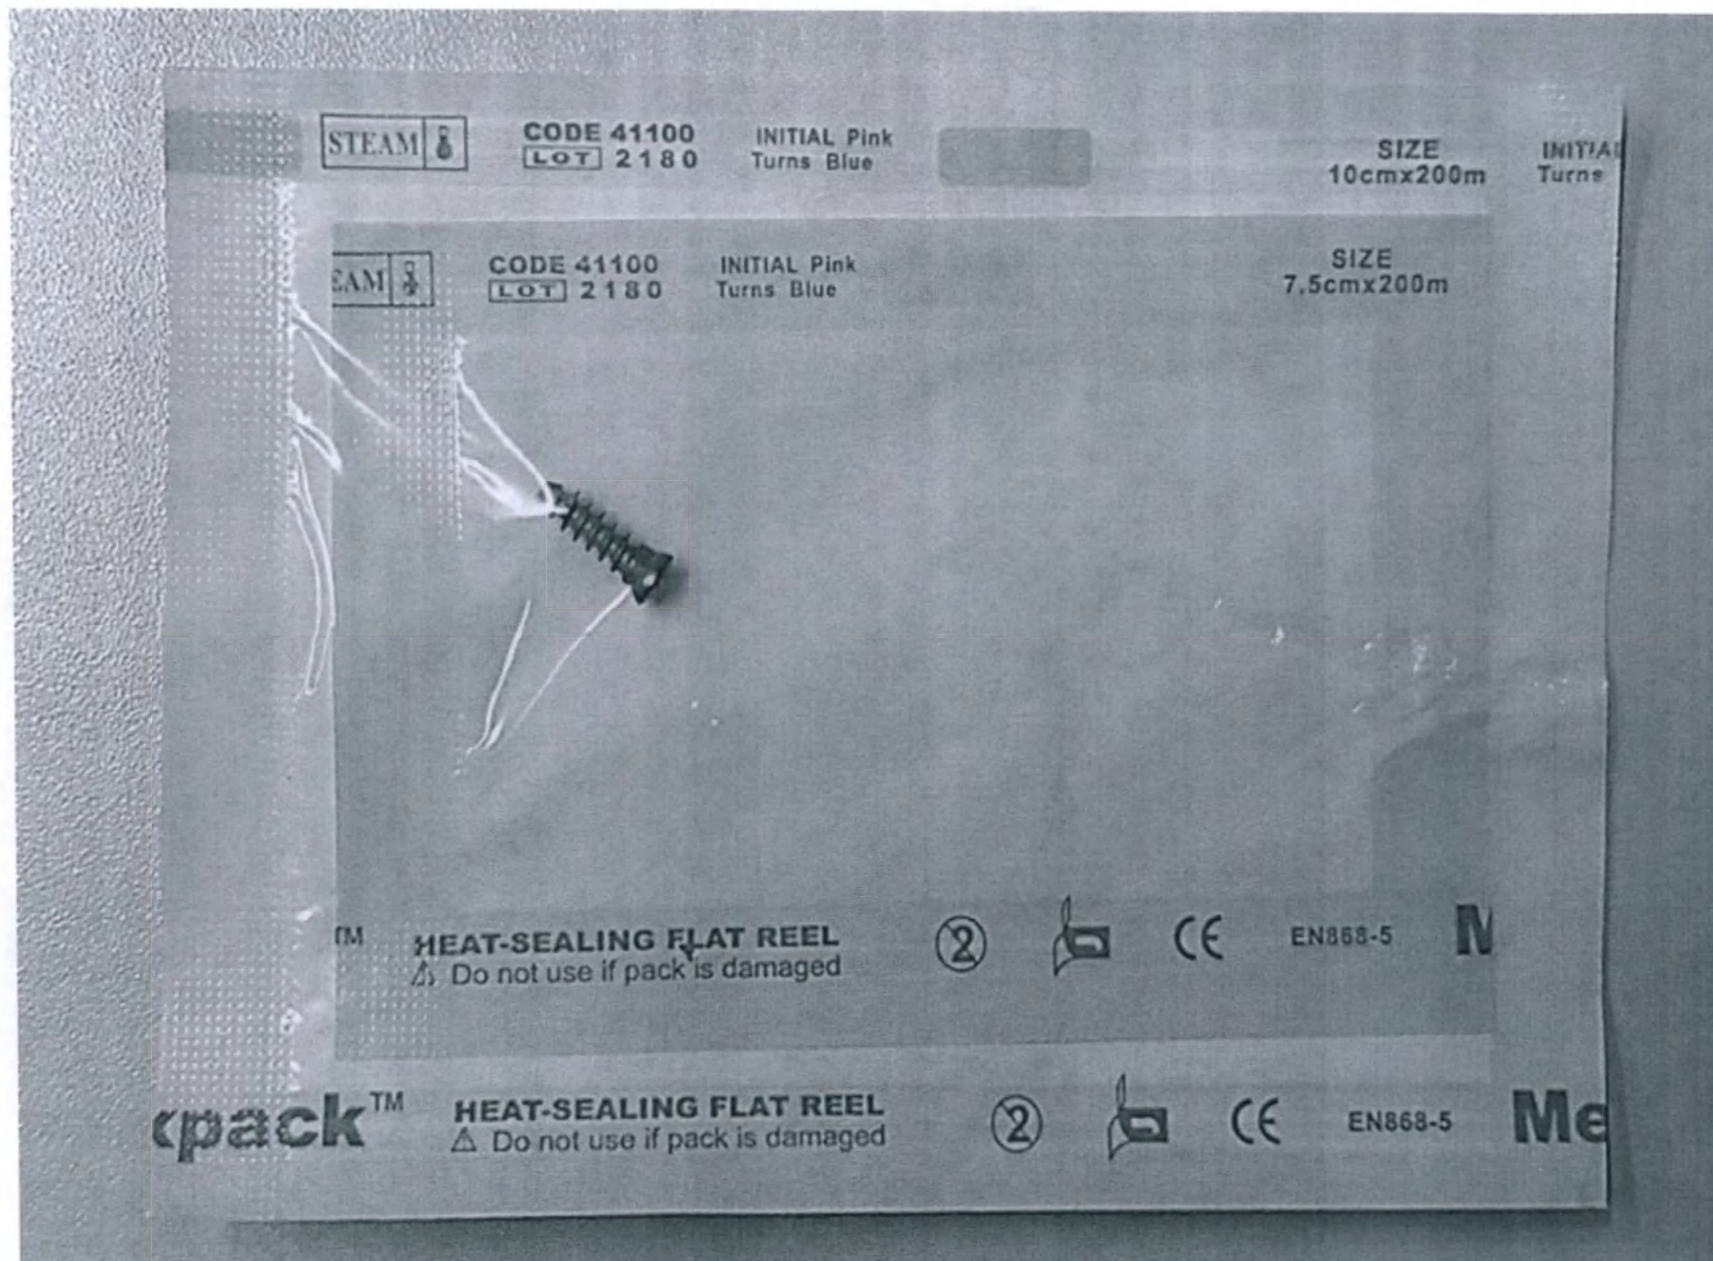


Фотографическое изображение комплектующей - Костный винт, длина 14 мм
в первичной упаковке

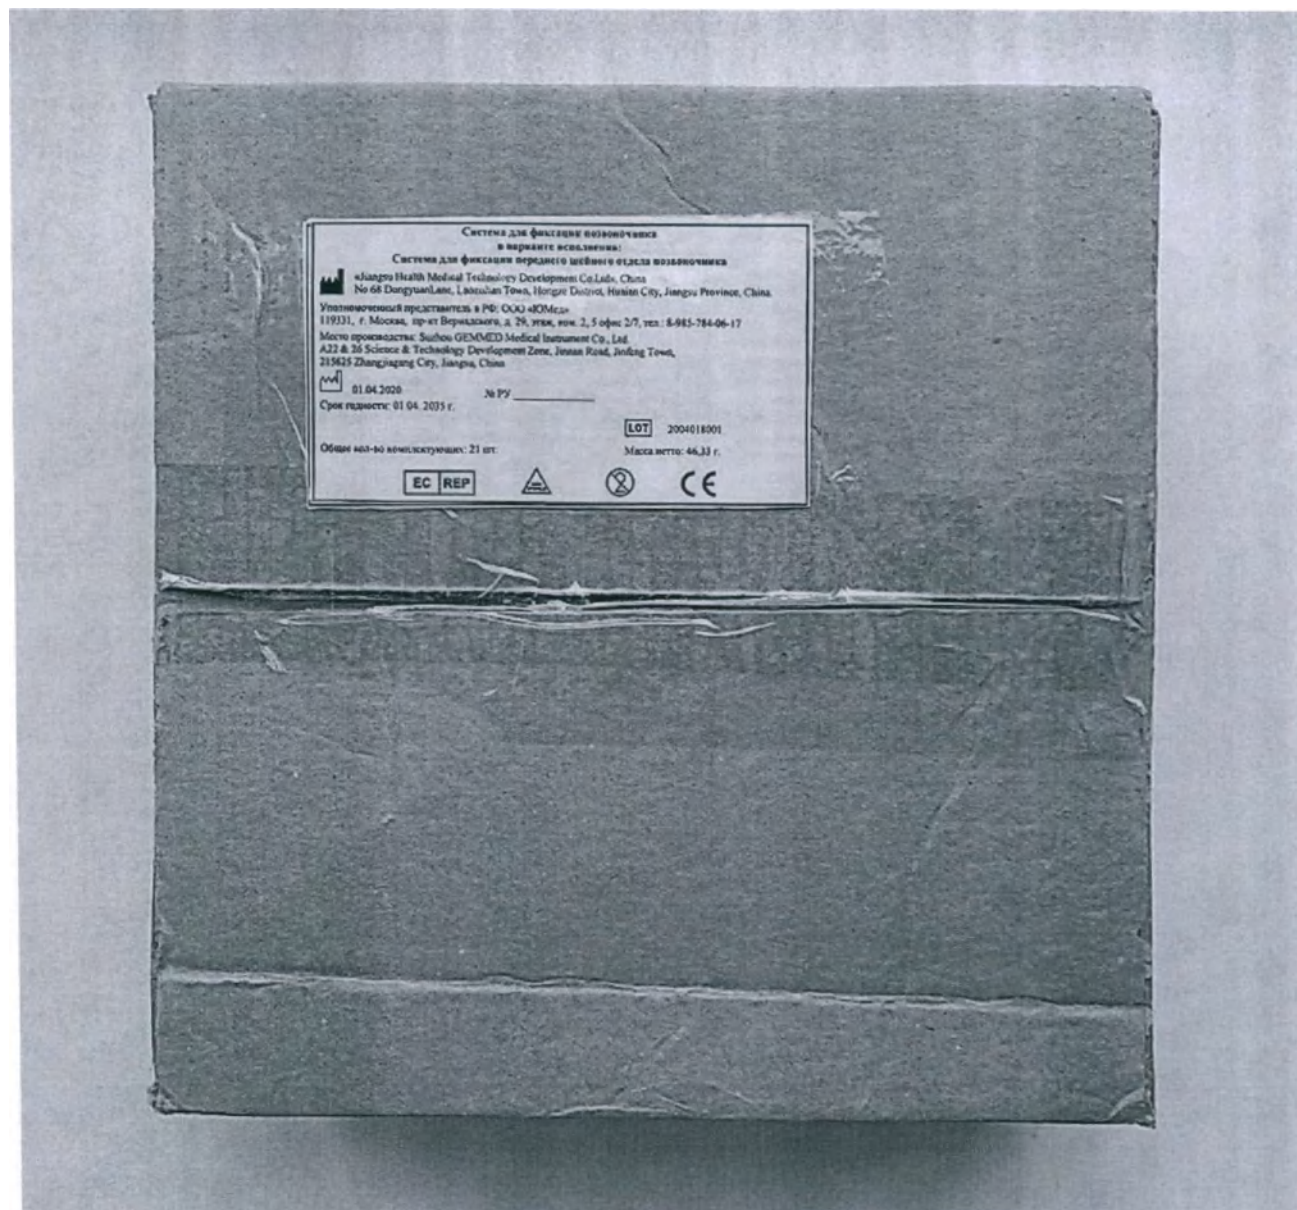

**Фотографическое изображение изделия «Система для фиксации позвоночника»
в варианте исполнения «Система для фиксации переднего шейного отдела позвоночника» во вторичной упаковке.**

II. Система для фиксации заднего шейного отдела позвоночника:

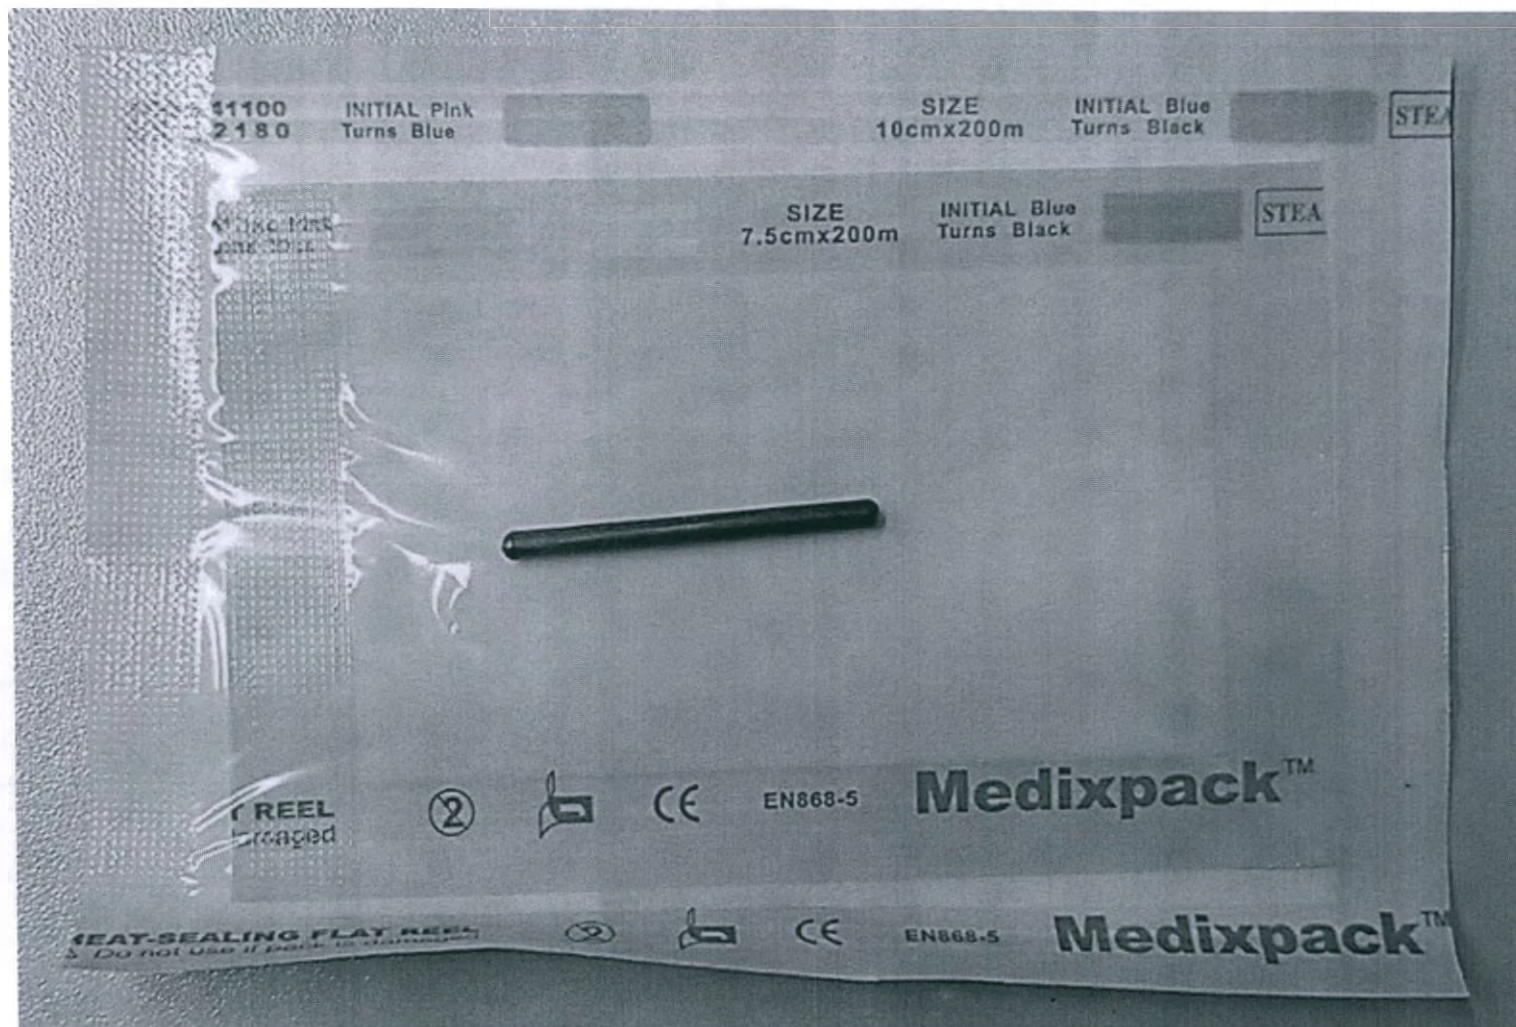

Фотографическое изображение комплектующей - Стержень, диаметр 3.2 мм, длина 40 мм
в первичной упаковке



Фотографическое изображение комплектующей - Ламинарный крючок, маленький
в первичной упаковке




Фотографическое изображение комплектующей - Пластина для затылочной кости, 4 отверстия
в первичной упаковке




Фотографическое изображение комплектующей - Поперечная стяжка, длина 25 мм
в первичной упаковке



Фотографическое изображение комплектующей - Поперечная стяжка, длина 80 мм
в первичной упаковке

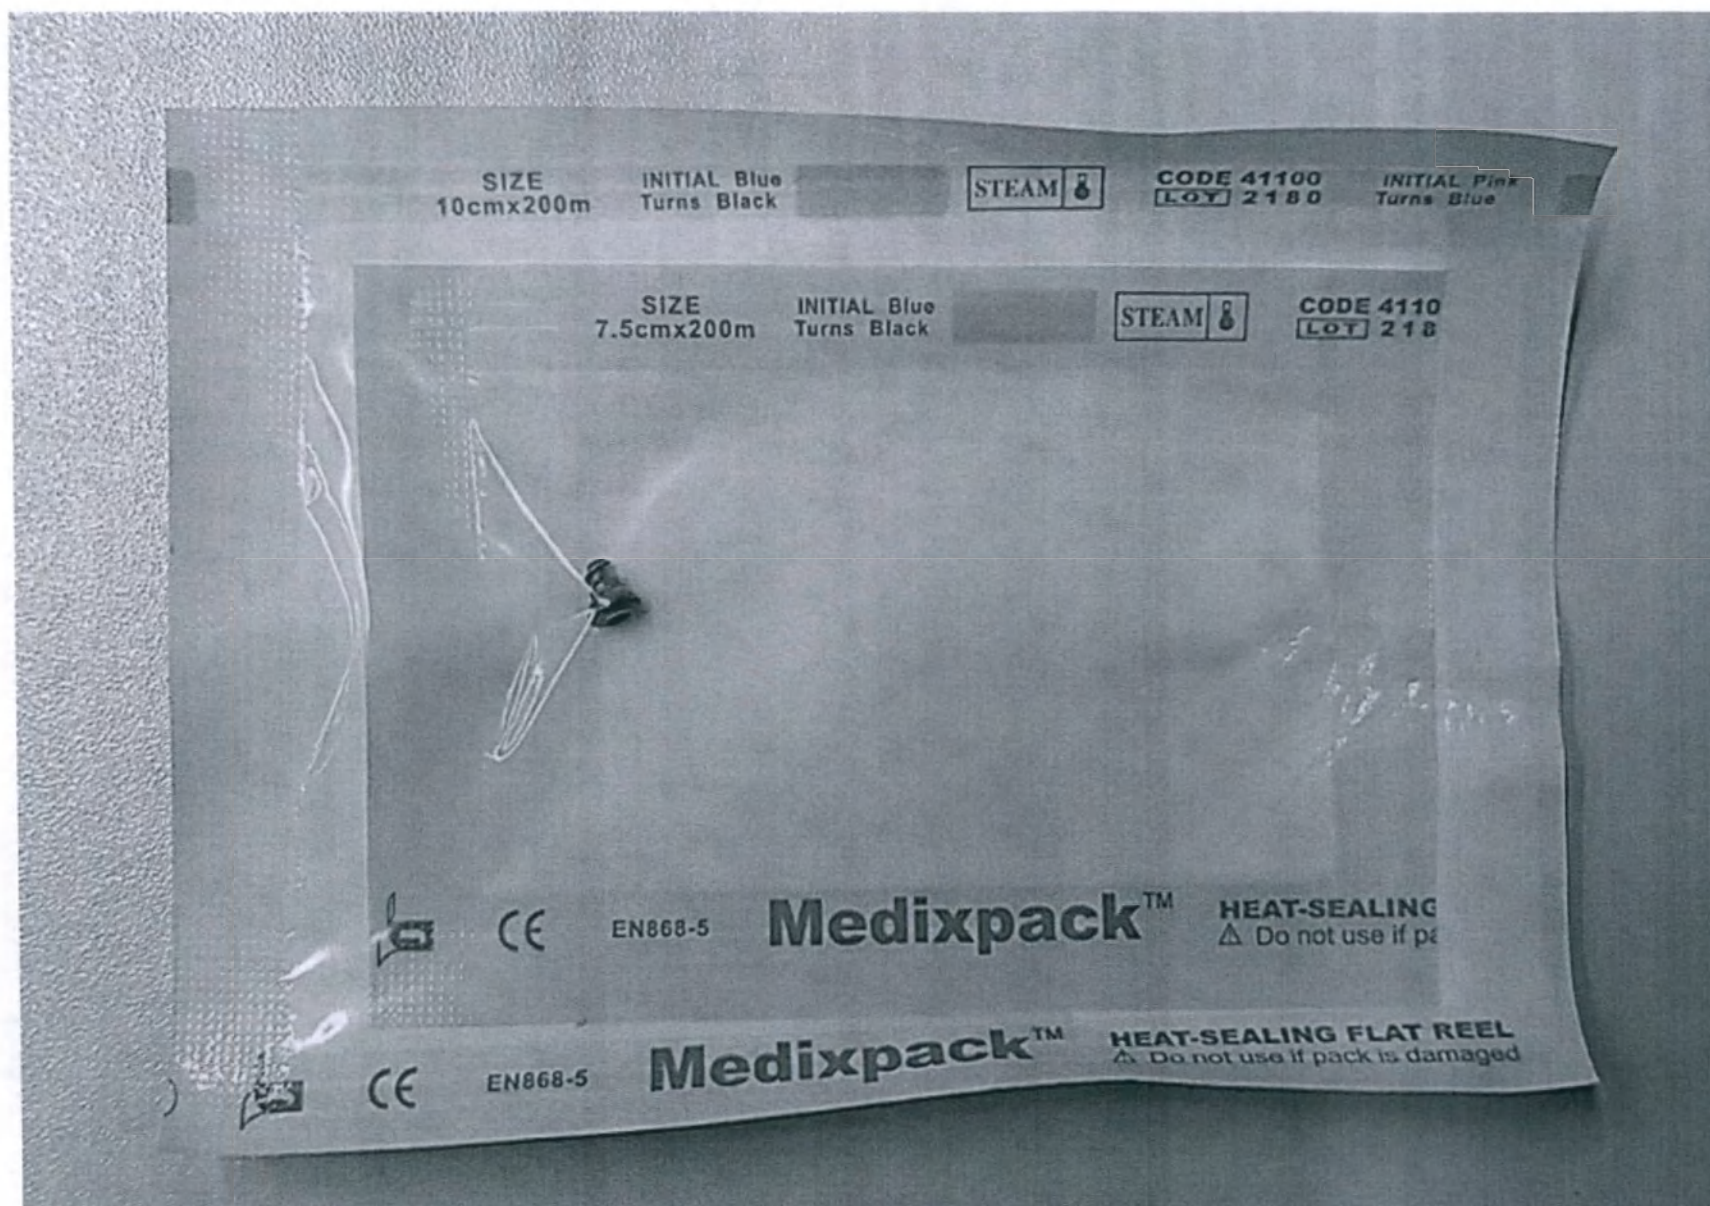


Фотографическое изображение комплектующей - Винт для затылочной кости, диаметр 3,5, длина 6 мм
в первичной упаковке

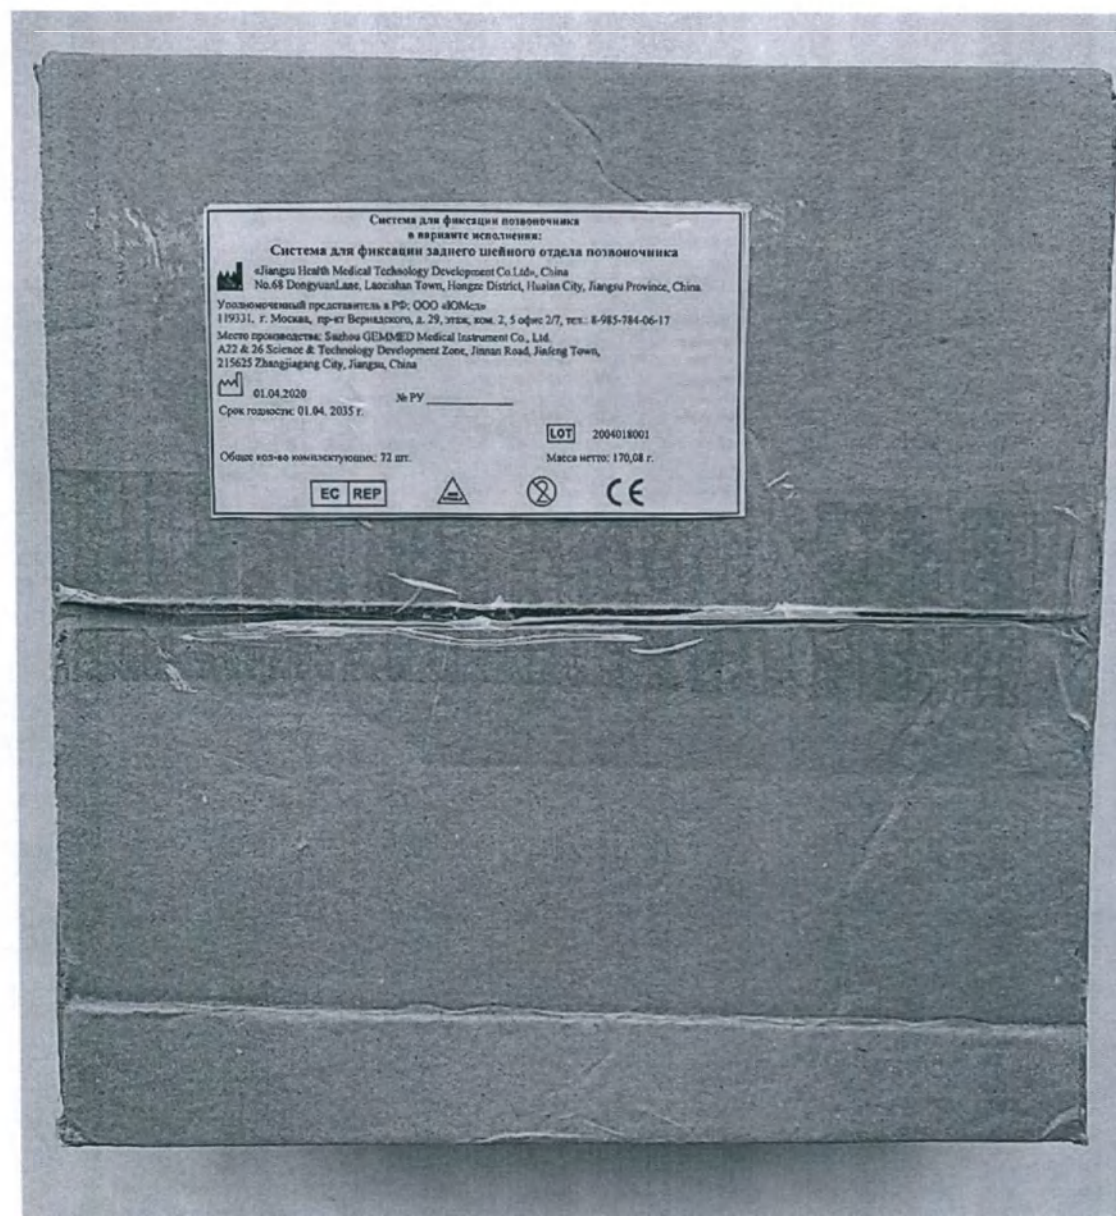


Фотографическое изображение изделия «Система для фиксации позвоночника»
в варианте исполнения « Система для фиксации заднего шейного отдела позвоночника» во вторичной упаковке.

III. Система для фиксации заднего отдела позвоночника:

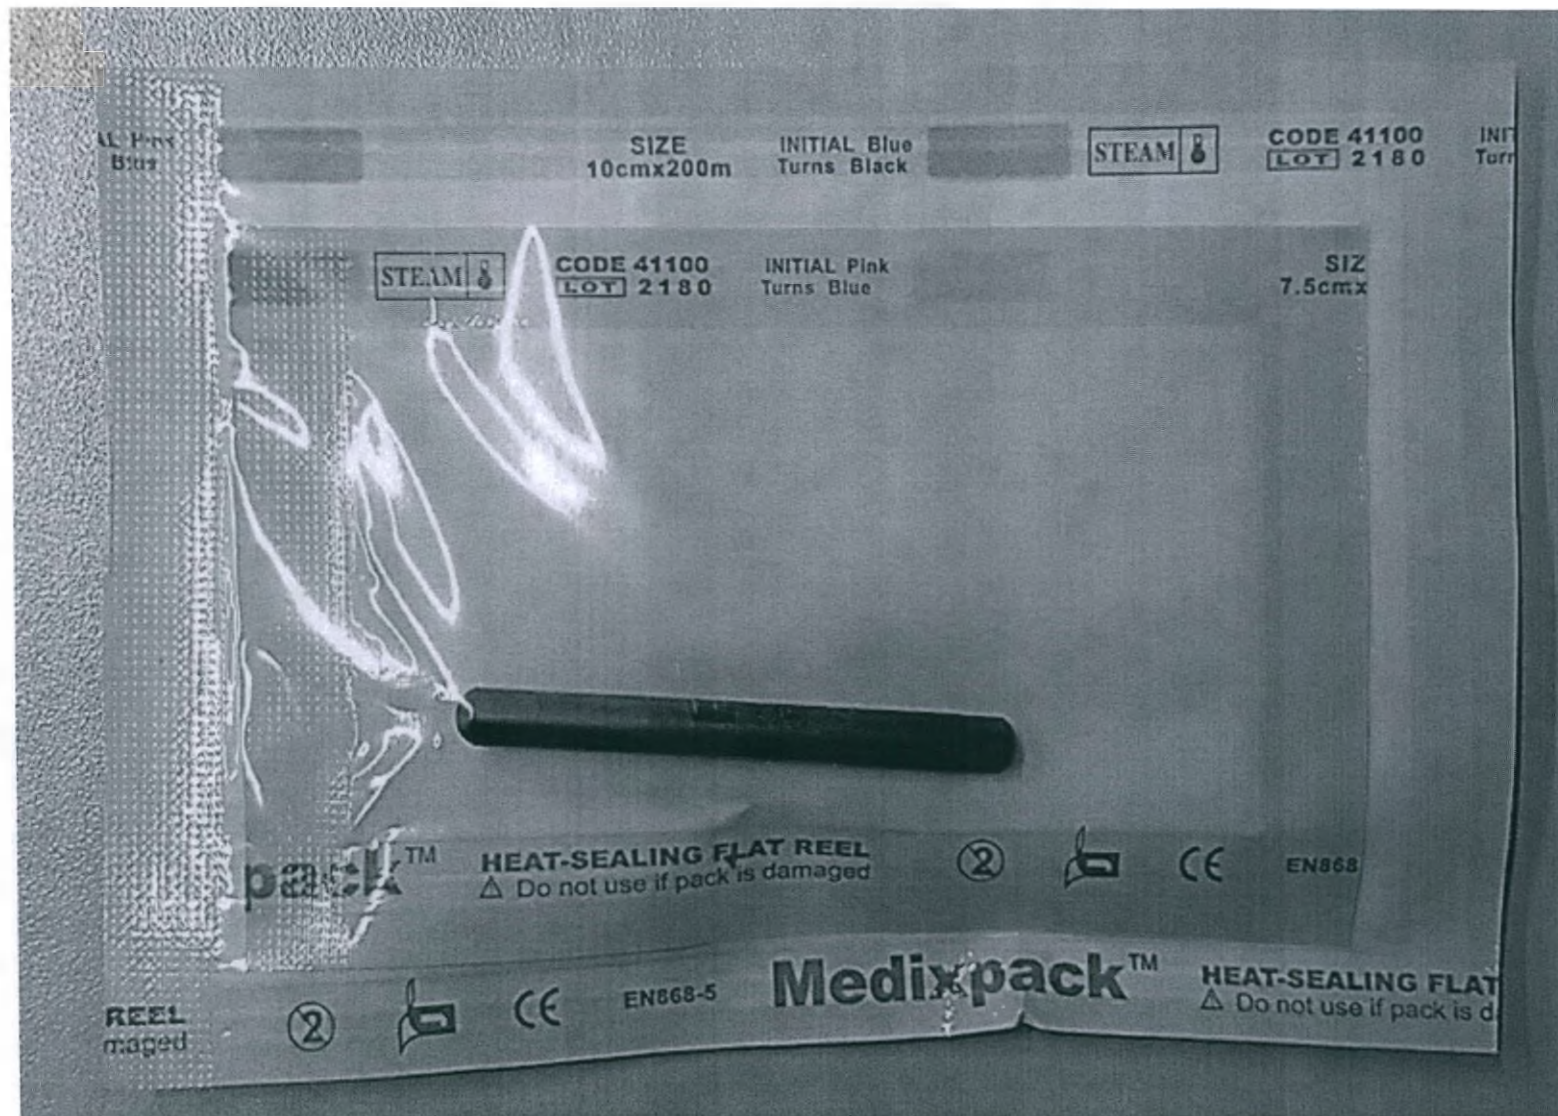


Фотографическое изображение комплектующей - Стержень, диаметр 6 мм, длина 60 мм
в первичной упаковке

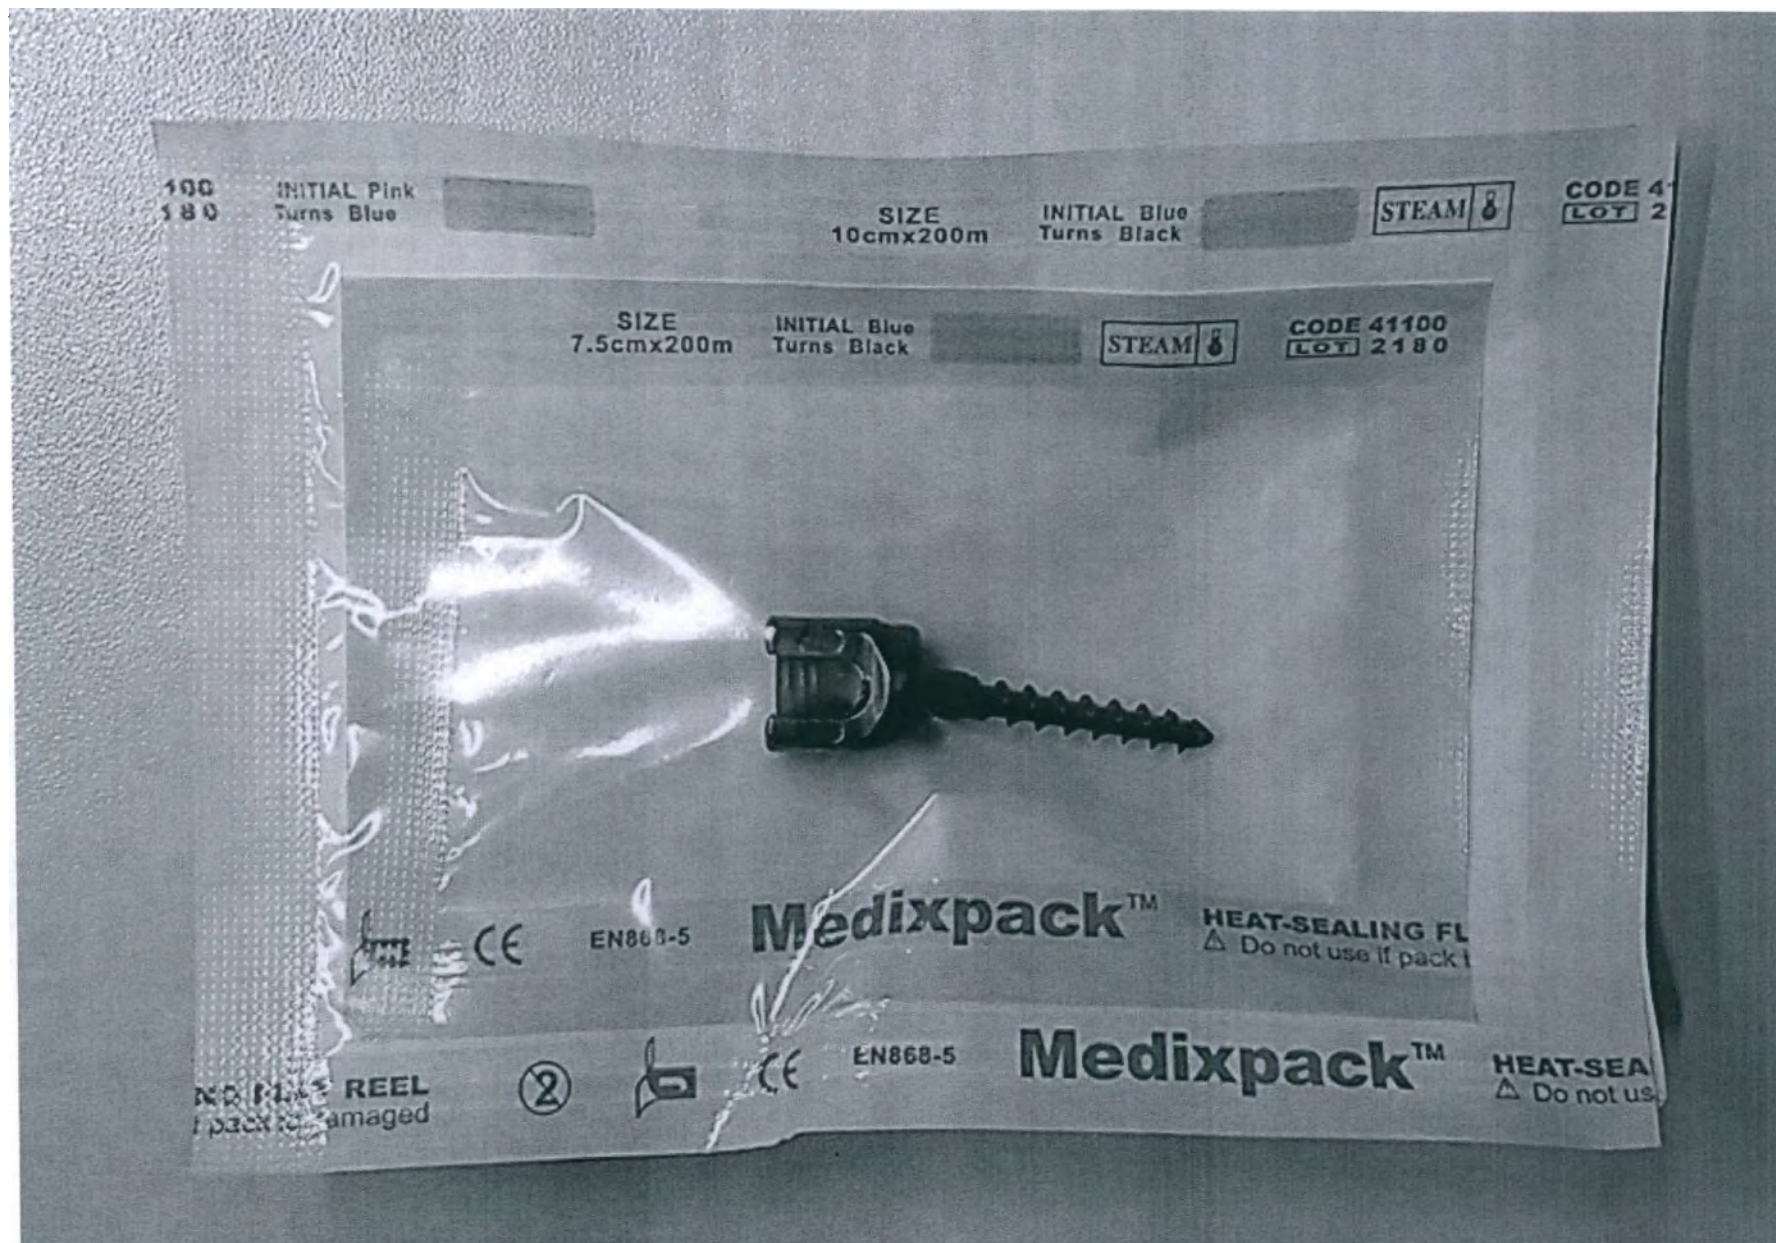

Фотографическое изображение комплектующей - Транспедикулярный полиаксиальный винт, диаметр 6.5 мм, длина 45 мм в первичной упаковке




Фотографическое изображение комплектующей - Транспедикулярный полиаксиальный редукционный винт, диаметр 4.5 мм, длина 50 мм в первичной упаковке

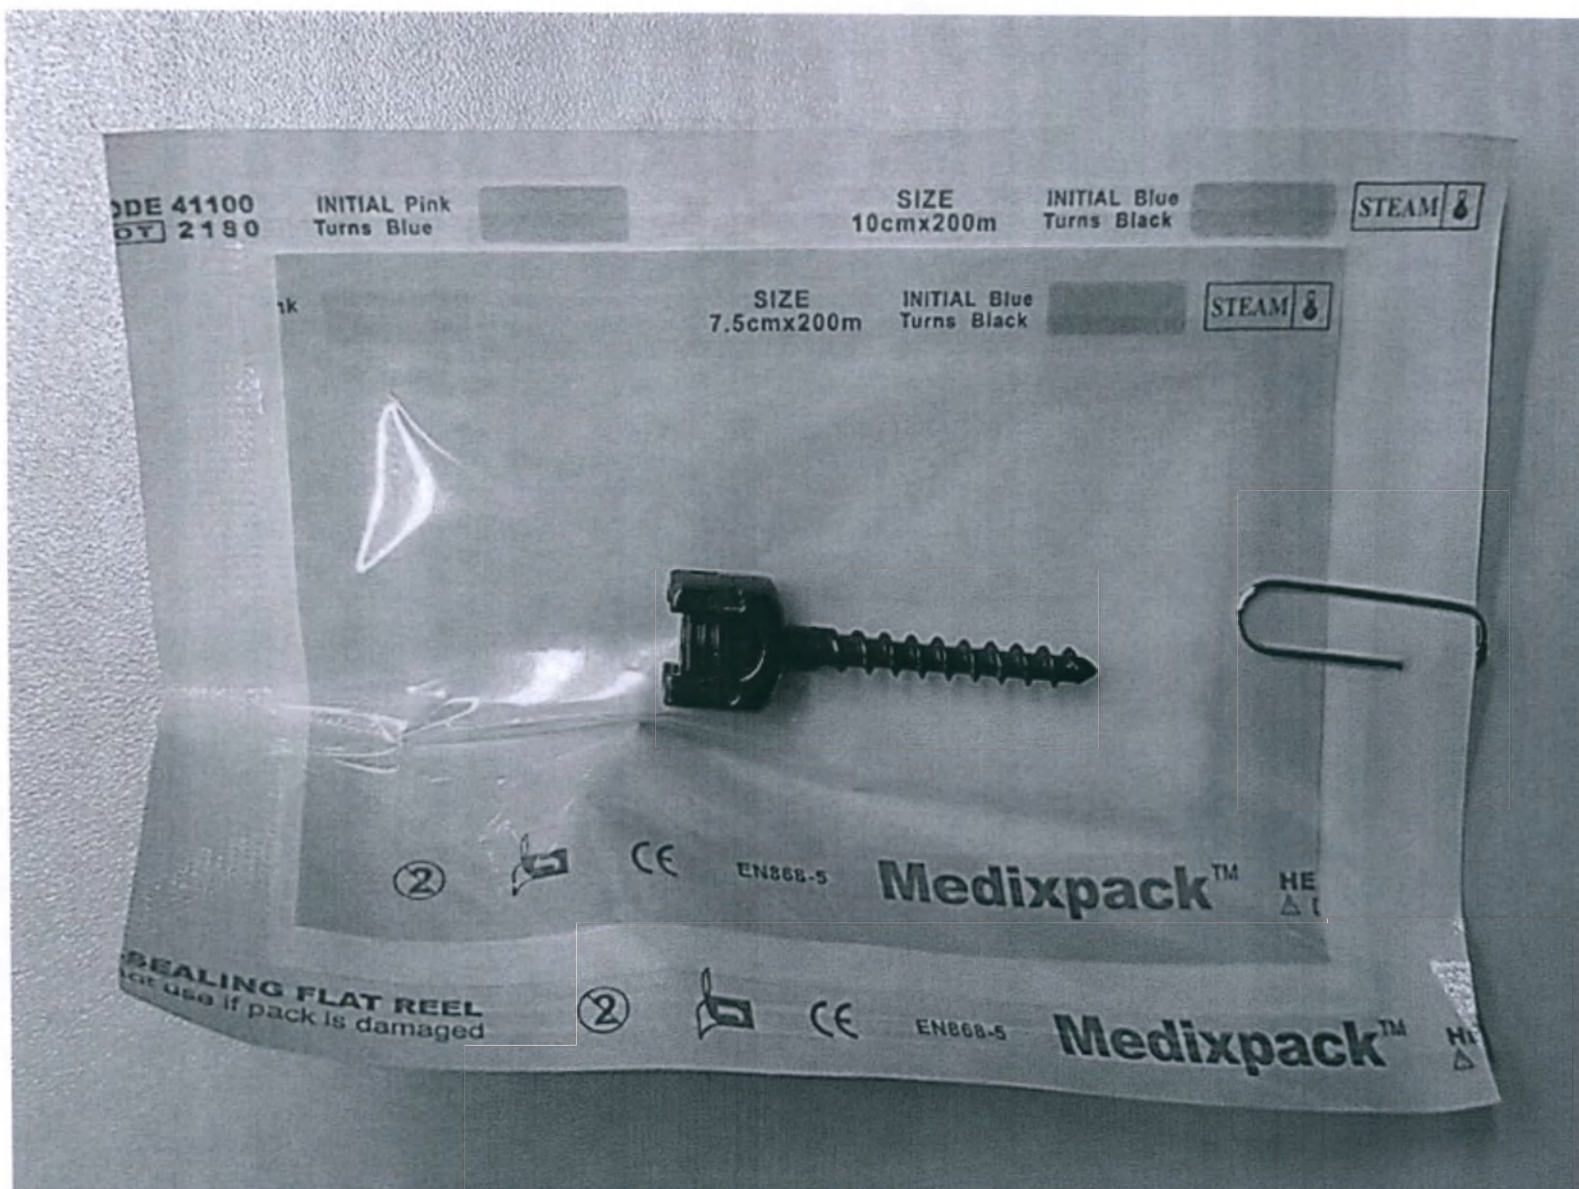

Фотографическое изображение комплектующей - Транспедикулярный винт, диаметр 5.0 мм, длина 30 мм
в первичной упаковке



Фотографическое изображение комплектующей - Транспедикулярный винт, диаметр 6 мм, длина 50 мм
в первичной упаковке

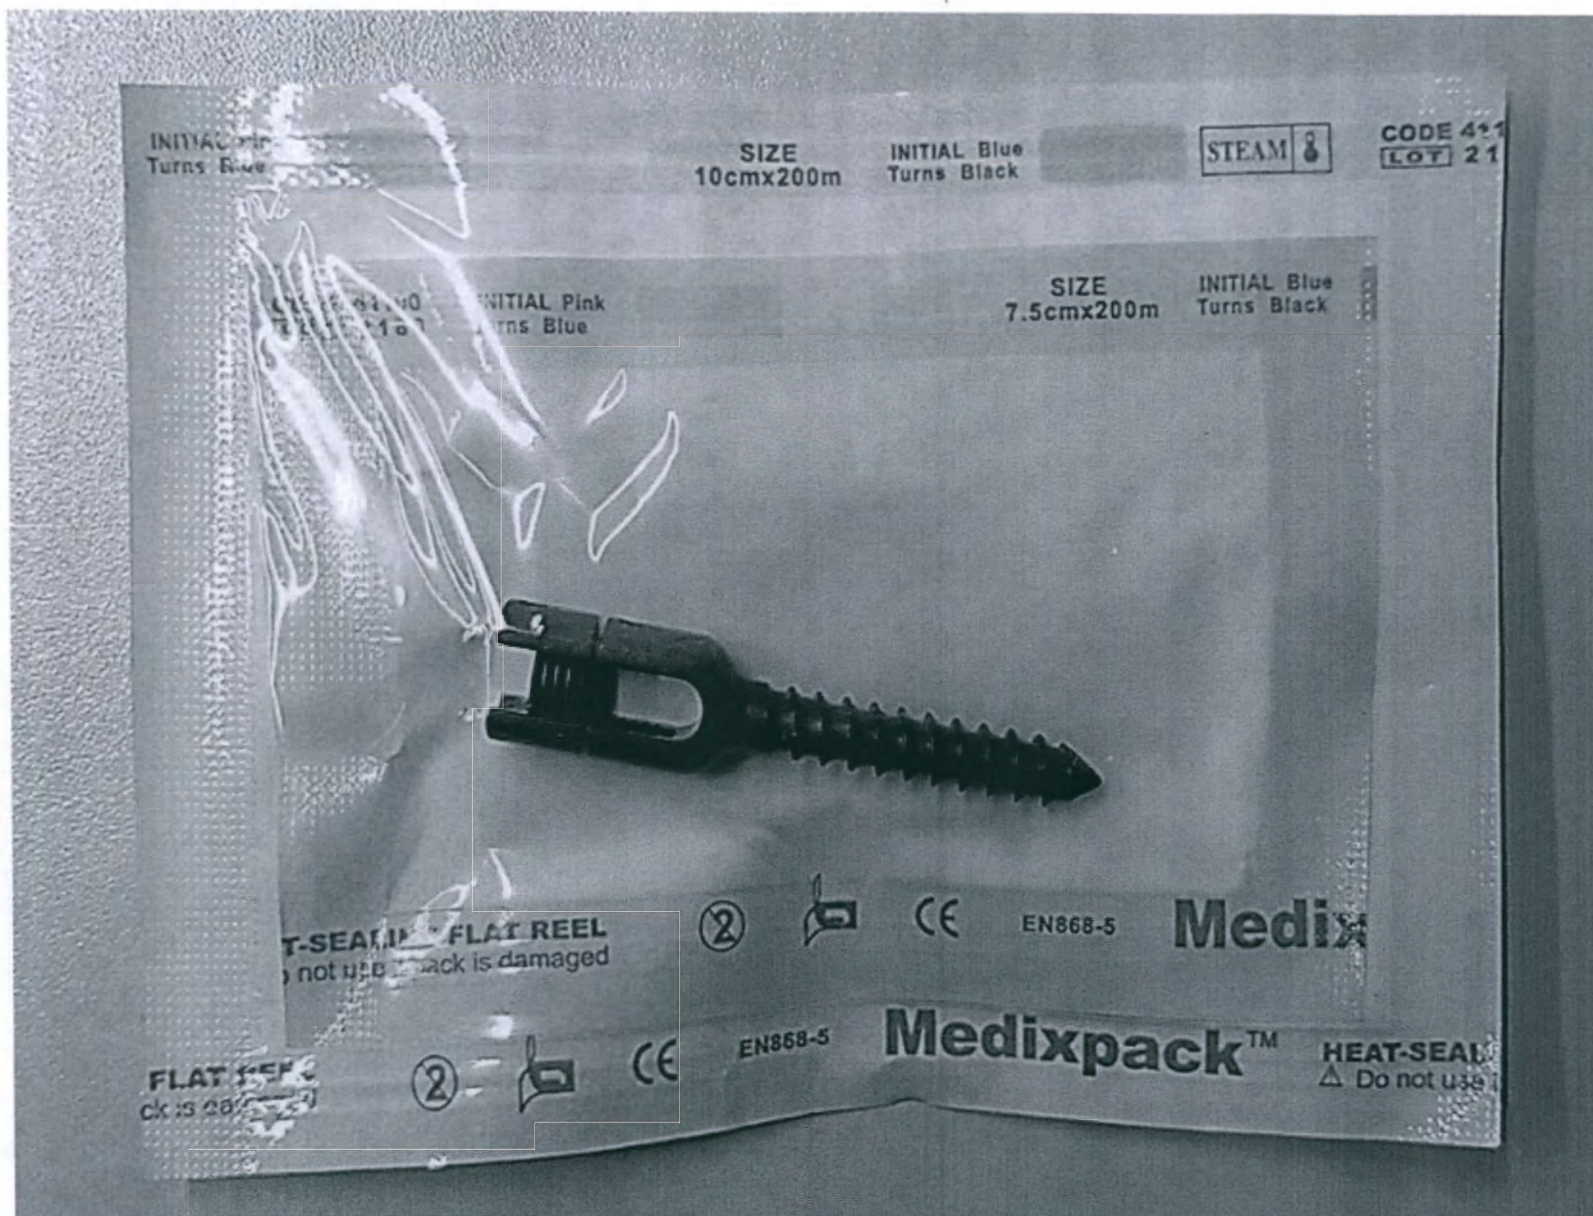


Фотографическое изображение комплектующей - Транспедикулярный редукционный винт, диаметр 7 мм, длина 40 мм в первичной упаковке



Фотографическое изображение комплектующей - Поперечная стяжка, тип III, длина 57 мм
в первичной упаковке



Фотографическое изображение комплектующей - Поперечная стяжка, тип III, длина 72 мм
в первичной упаковке

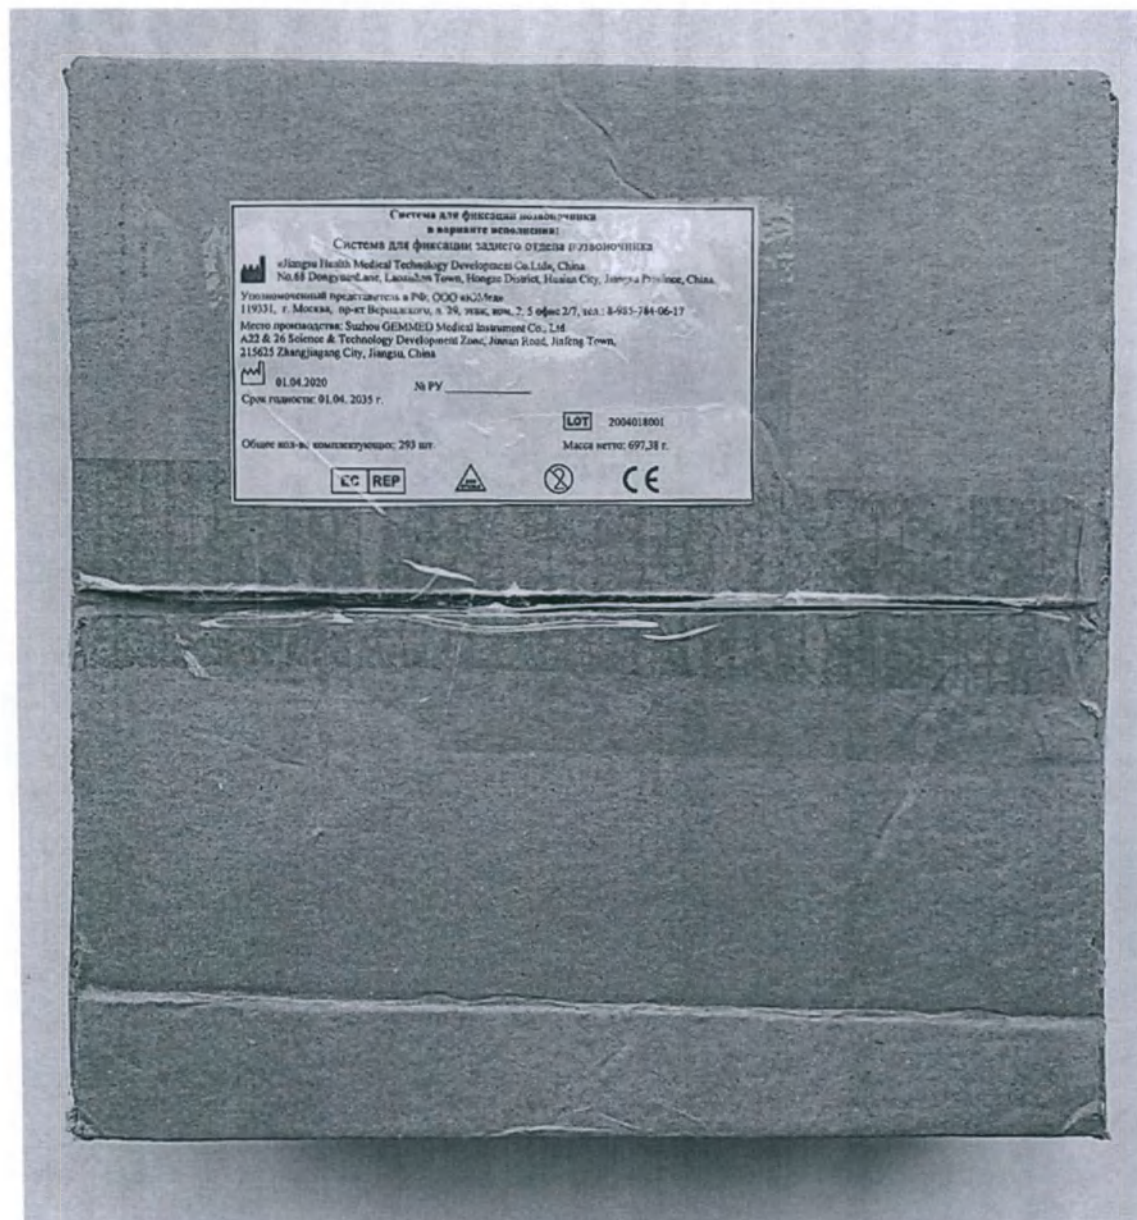


Фотографическое изображение изделия «Система для фиксации позвоночника»
в варианте исполнения « Система для фиксации заднего отдела позвоночника» во вторичной упаковке.

IV. Система для фиксации заднего отдела позвоночника, тип II



Фотографическое изображение комплектующей - Транспедикулярный полиаксиальный винт, тип II, диаметр 4.5мм, длина 30 мм в первичной упаковке

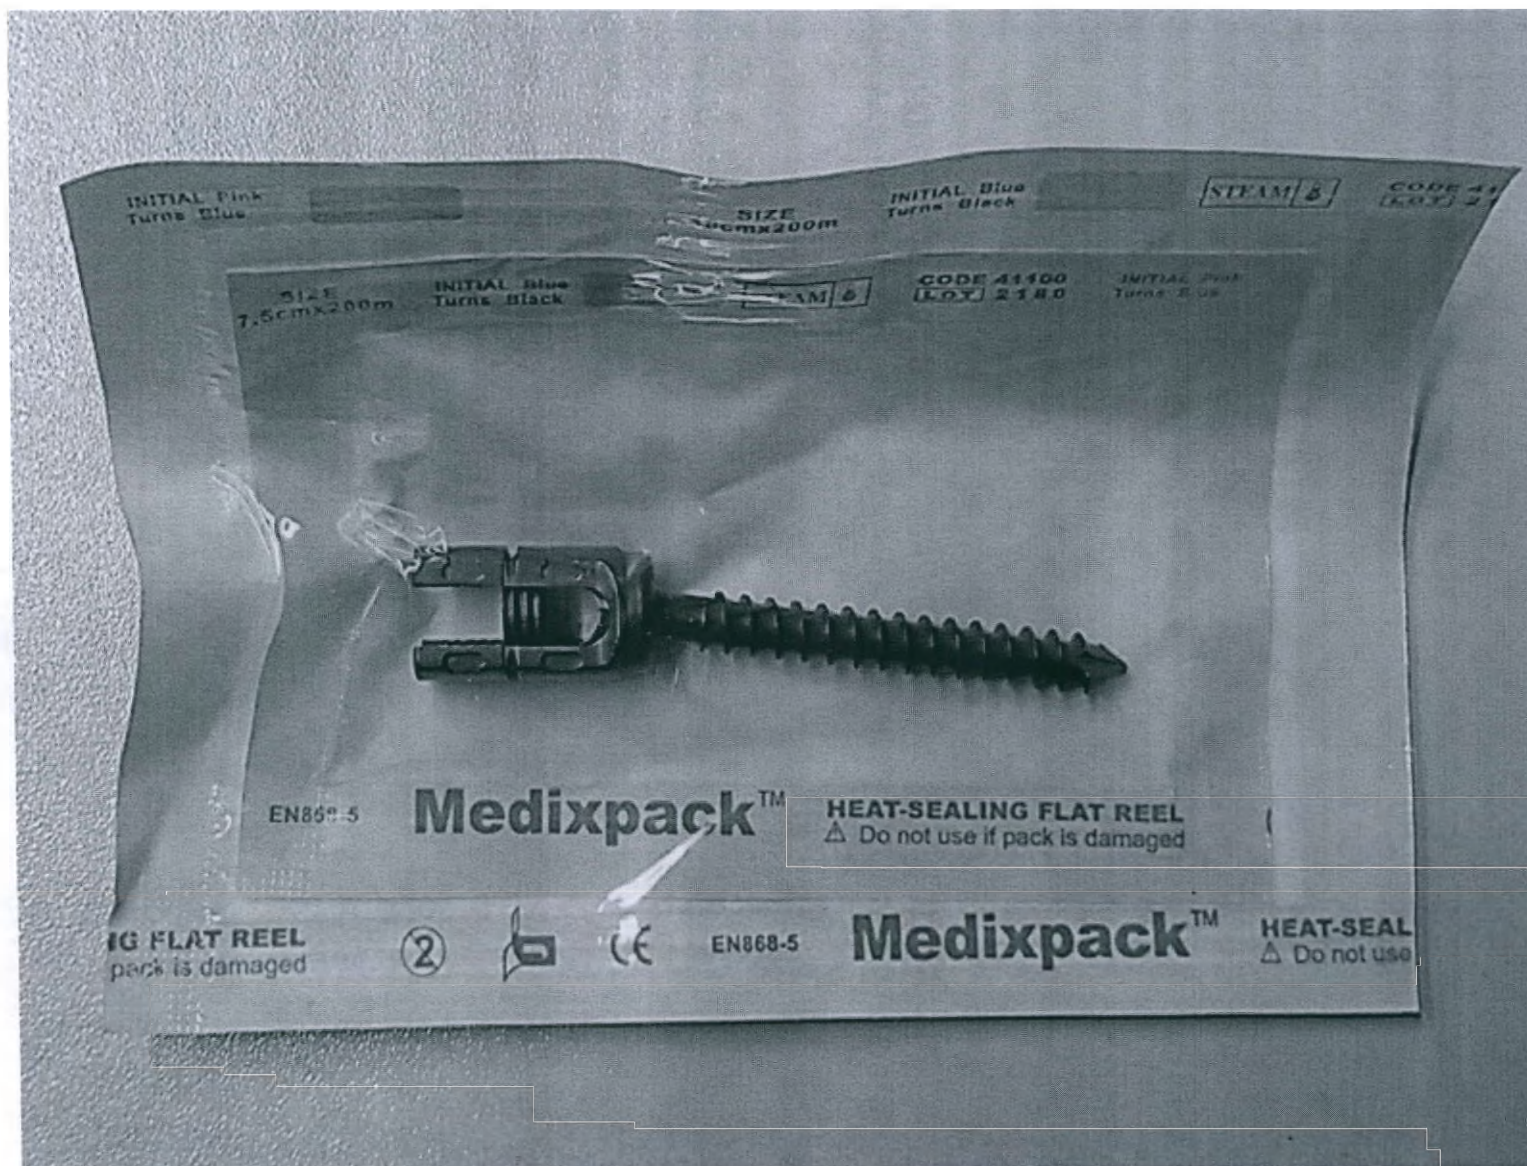


Фотографическое изображение комплектующей - Транспедикулярный полиаксиальный редукционный винт, тип II, диаметр 6.5мм, длина 55 мм в первичной упаковке




Фотографическое изображение комплектующей - Транспедикулярный редукционный винт, тип II, диаметр 5.5мм, длина 30 мм
в первичной упаковке




Фотографическое изображение комплектующей - цилиндрические кейджи, диаметр 10мм, длина 60 мм
в первичной упаковке

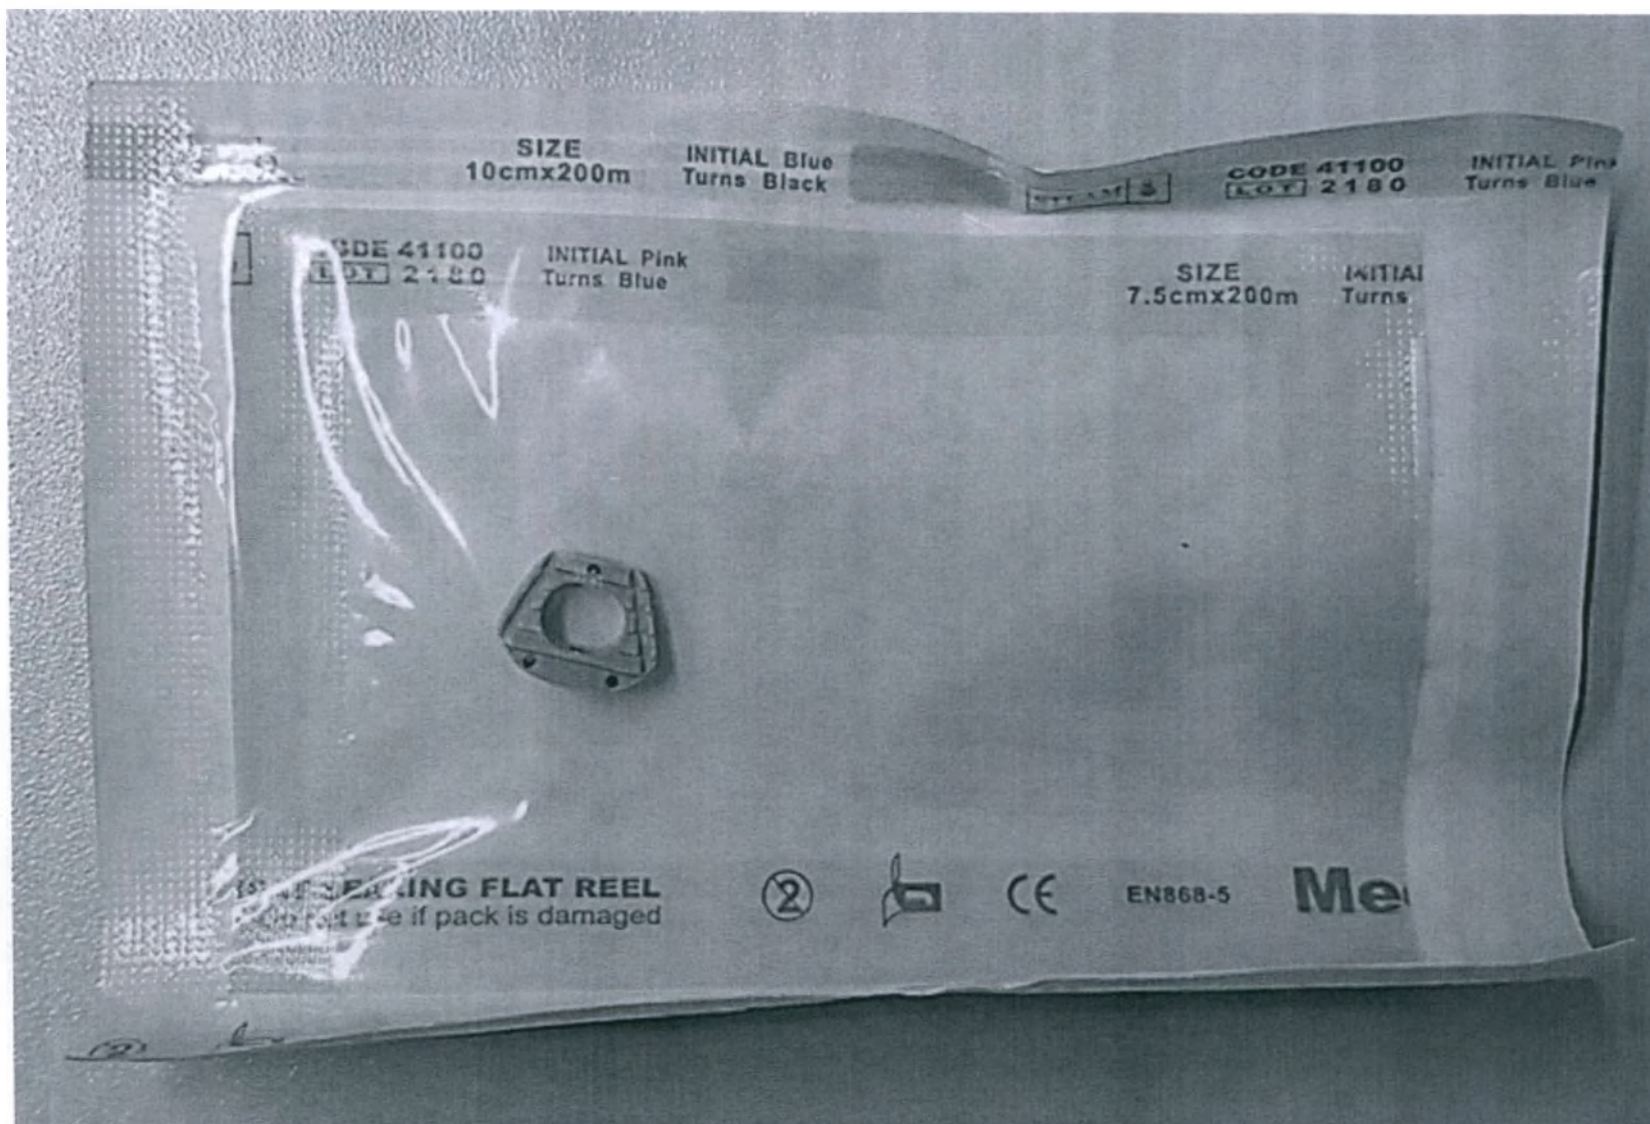


Фотографическое изображение комплектующей - межпозвоночные кейджи, тип JZ02, размер 4*13*16 мм
в первичной упаковке

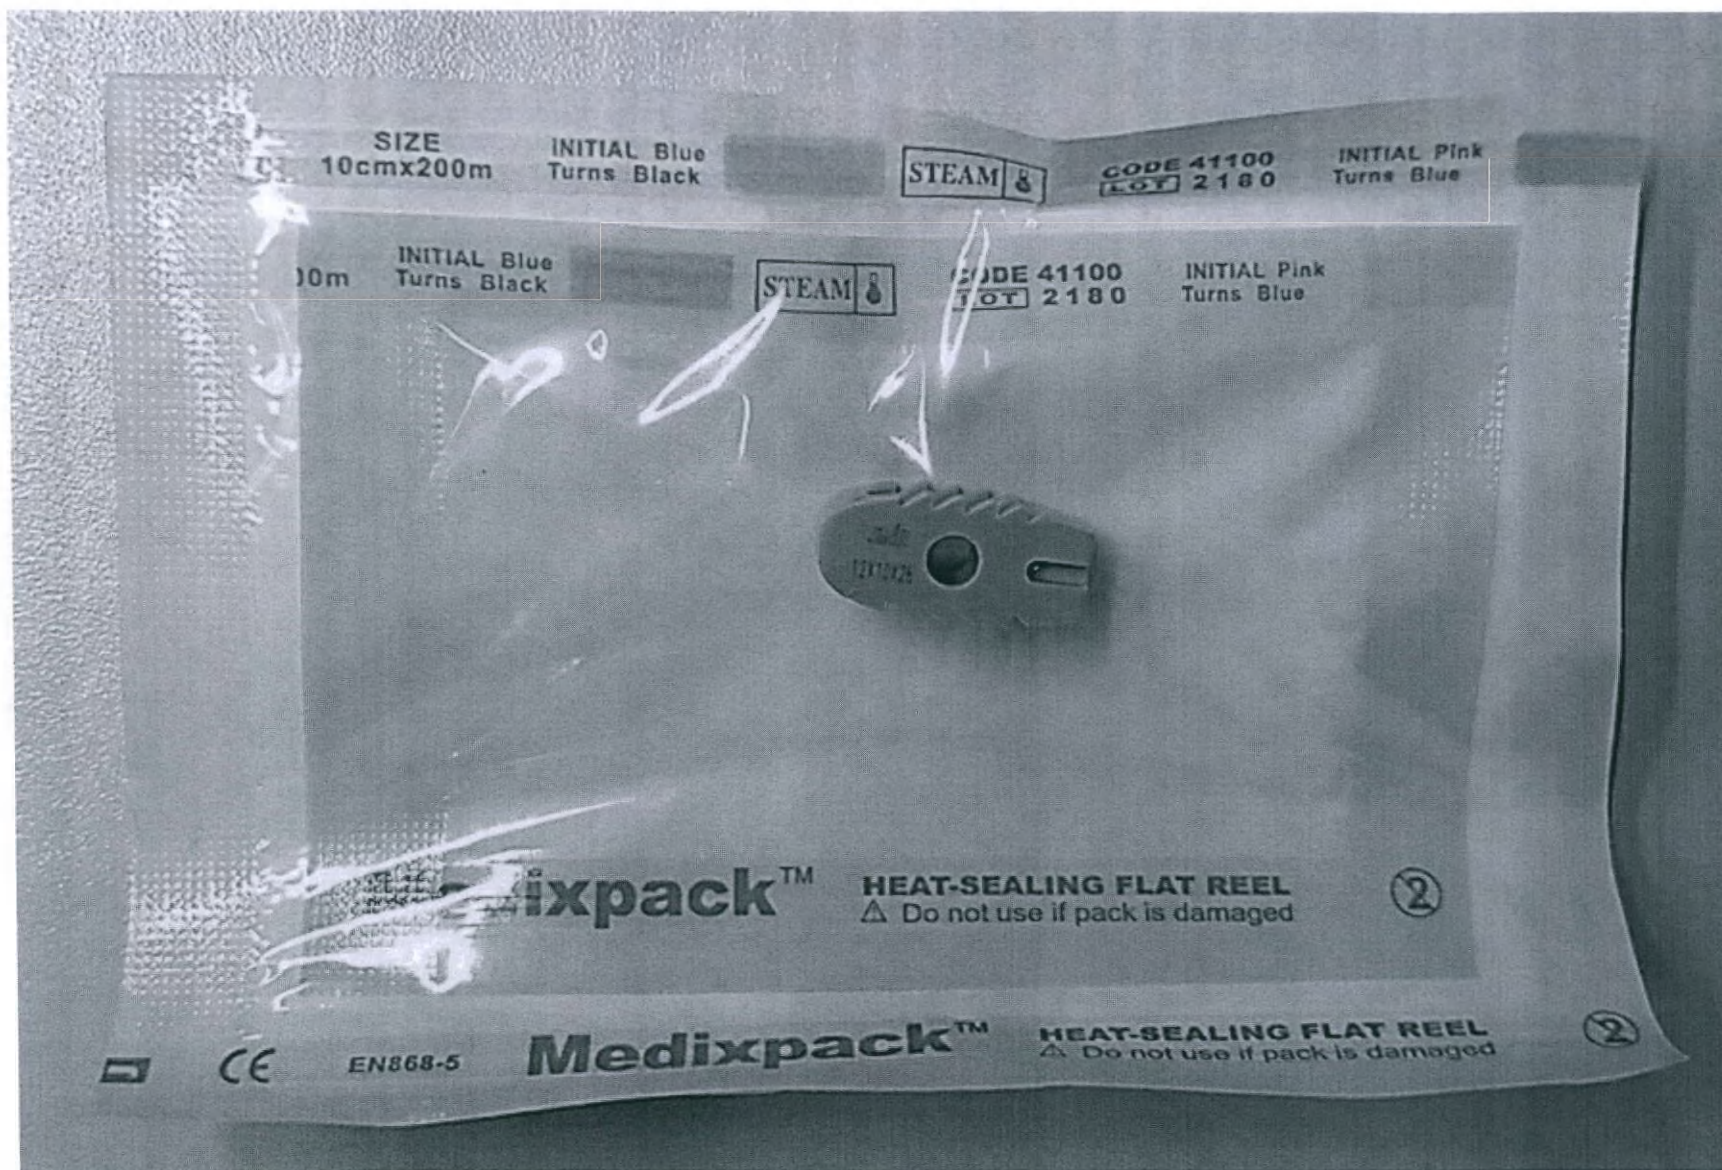


Фотографическое изображение комплектующей - межпозвоночные кейджи, тип YZ01, размер 12*10*26 мм
в первичной упаковке

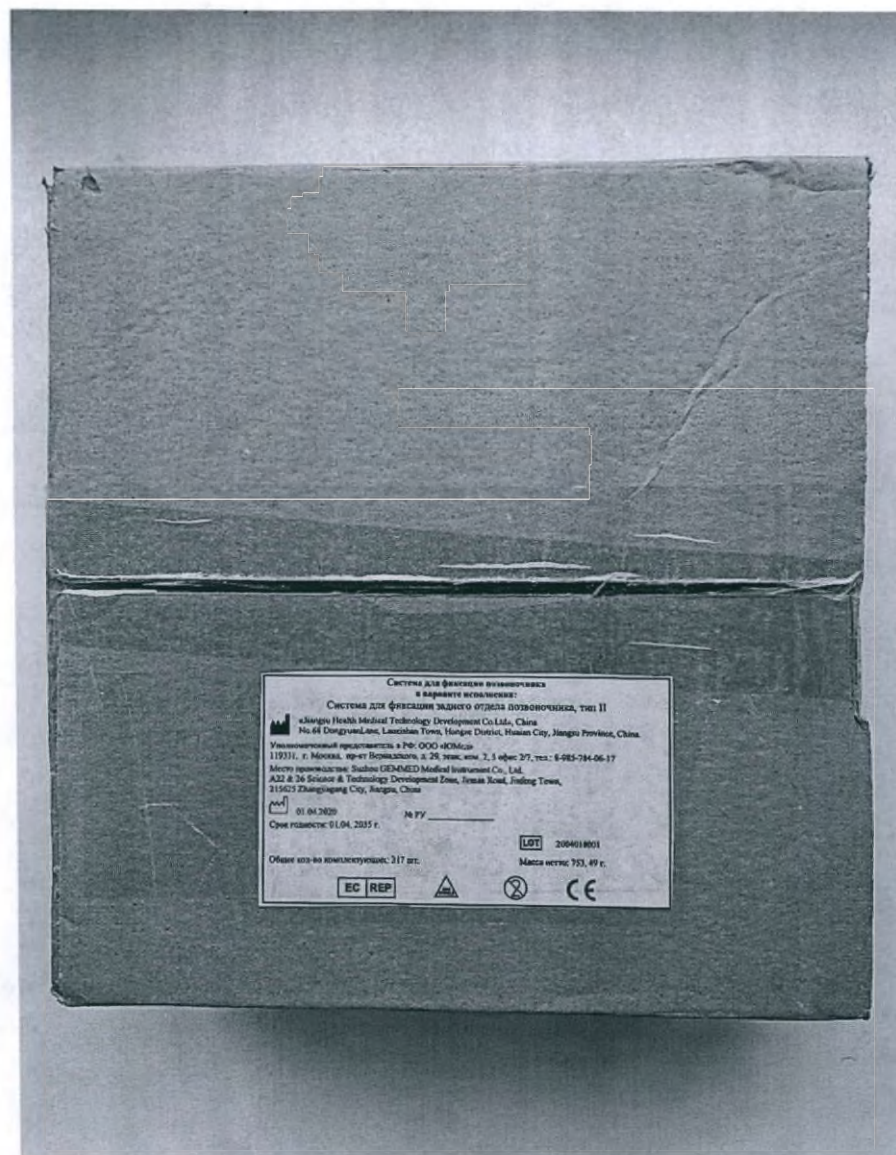

Фотографическое изображение изделия «Система для фиксации позвоночника»
в варианте исполнения « Система для фиксации заднего отдела позвоночника, тип II» во вторичной упаковке.

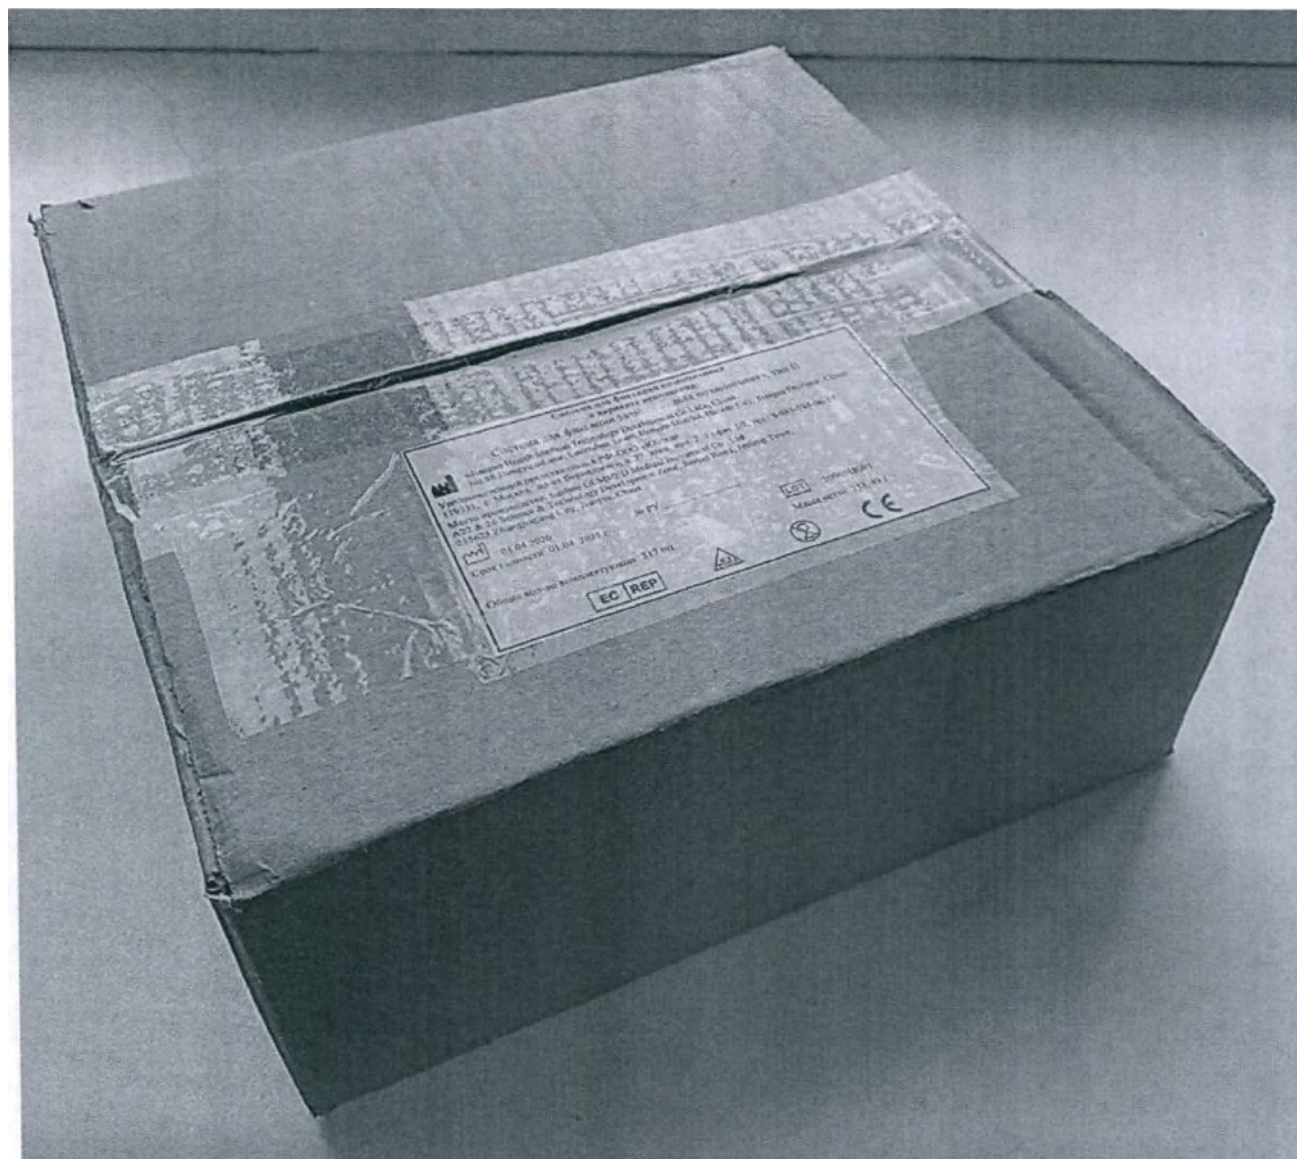

**Фотографическое изображение изделия «Система для фиксации позвоночника»
в варианте исполнения «Система для фиксации заднего отдела позвоночника, тип II» во вторичной упаковке.**

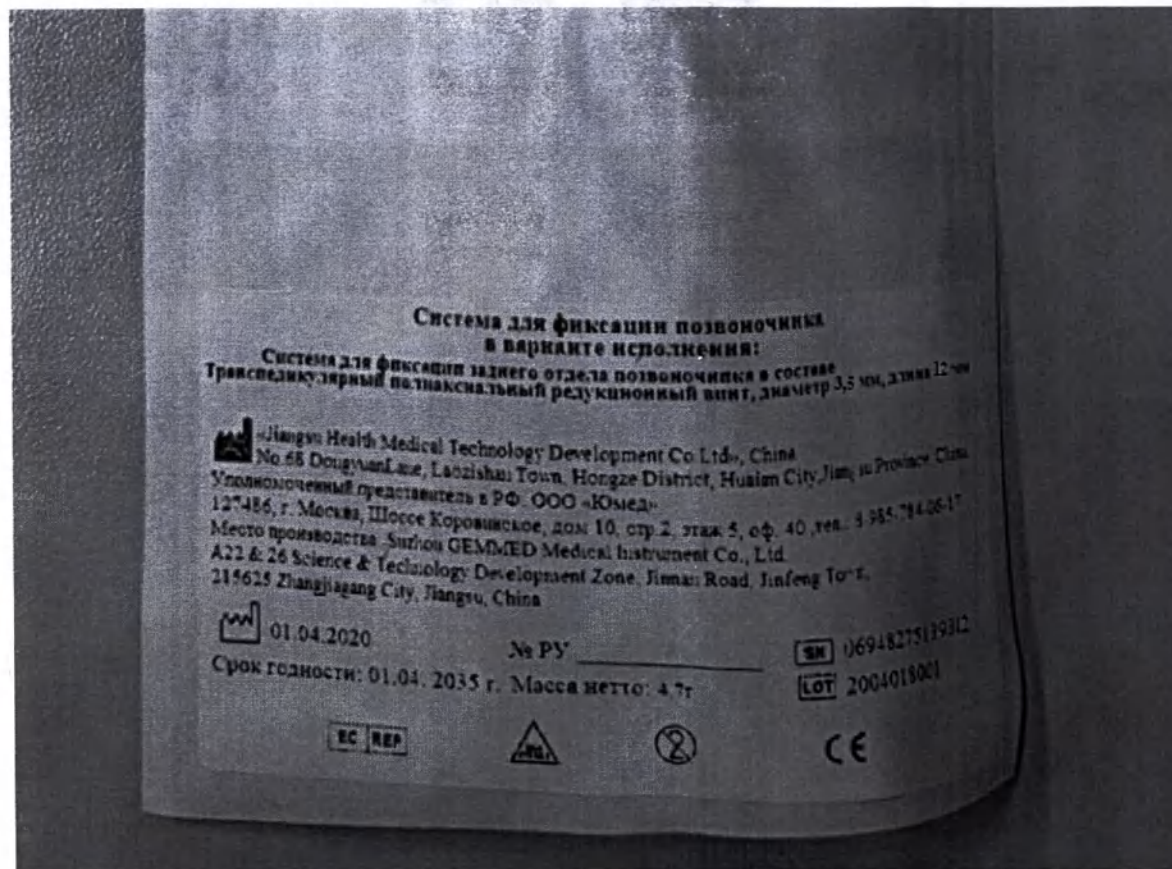

Фотографическое изображение образца маркировки первичной упаковки

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 29 (двадцать девять) листов
Генеральный директор ООО «ЮМед»
_____ / Турдыбеков С.К./

