

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Компания «БиВи»

Т.А. Носова

2022 г.





ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 5987789

КУСАЙЛО Р. В.

Фотографические изображения изделия:

**Набор реагентов для количественного определения D-димера
электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (D-
Dimer STAT (eCLIA) / D-Dimer STAT)**


Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.
(«Шэньчжэнь Лайфотроник Технолоджи Ко., Лтд.»), Китай

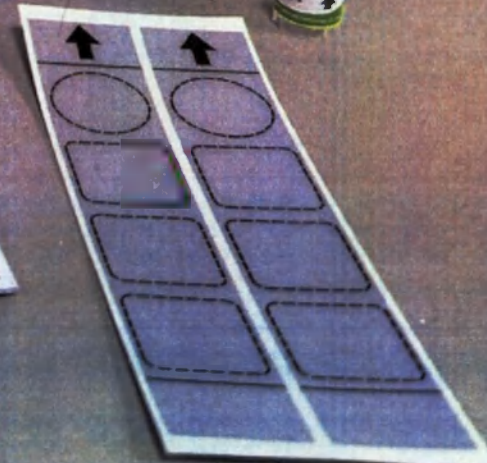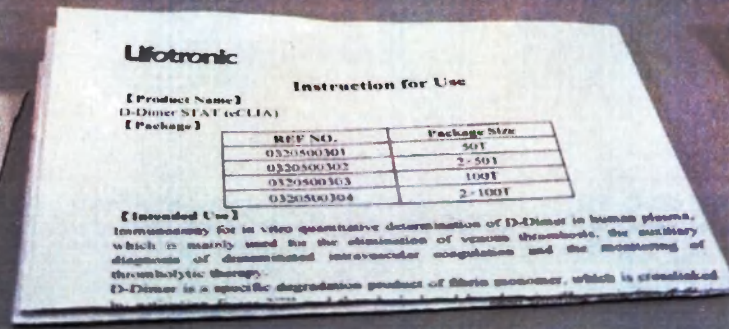




Общий вид медицинского изделия (Набор реагентов для количественного определения D-димера электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (D-Dimer STAT (eCLIA) / D-Dimer STAT))



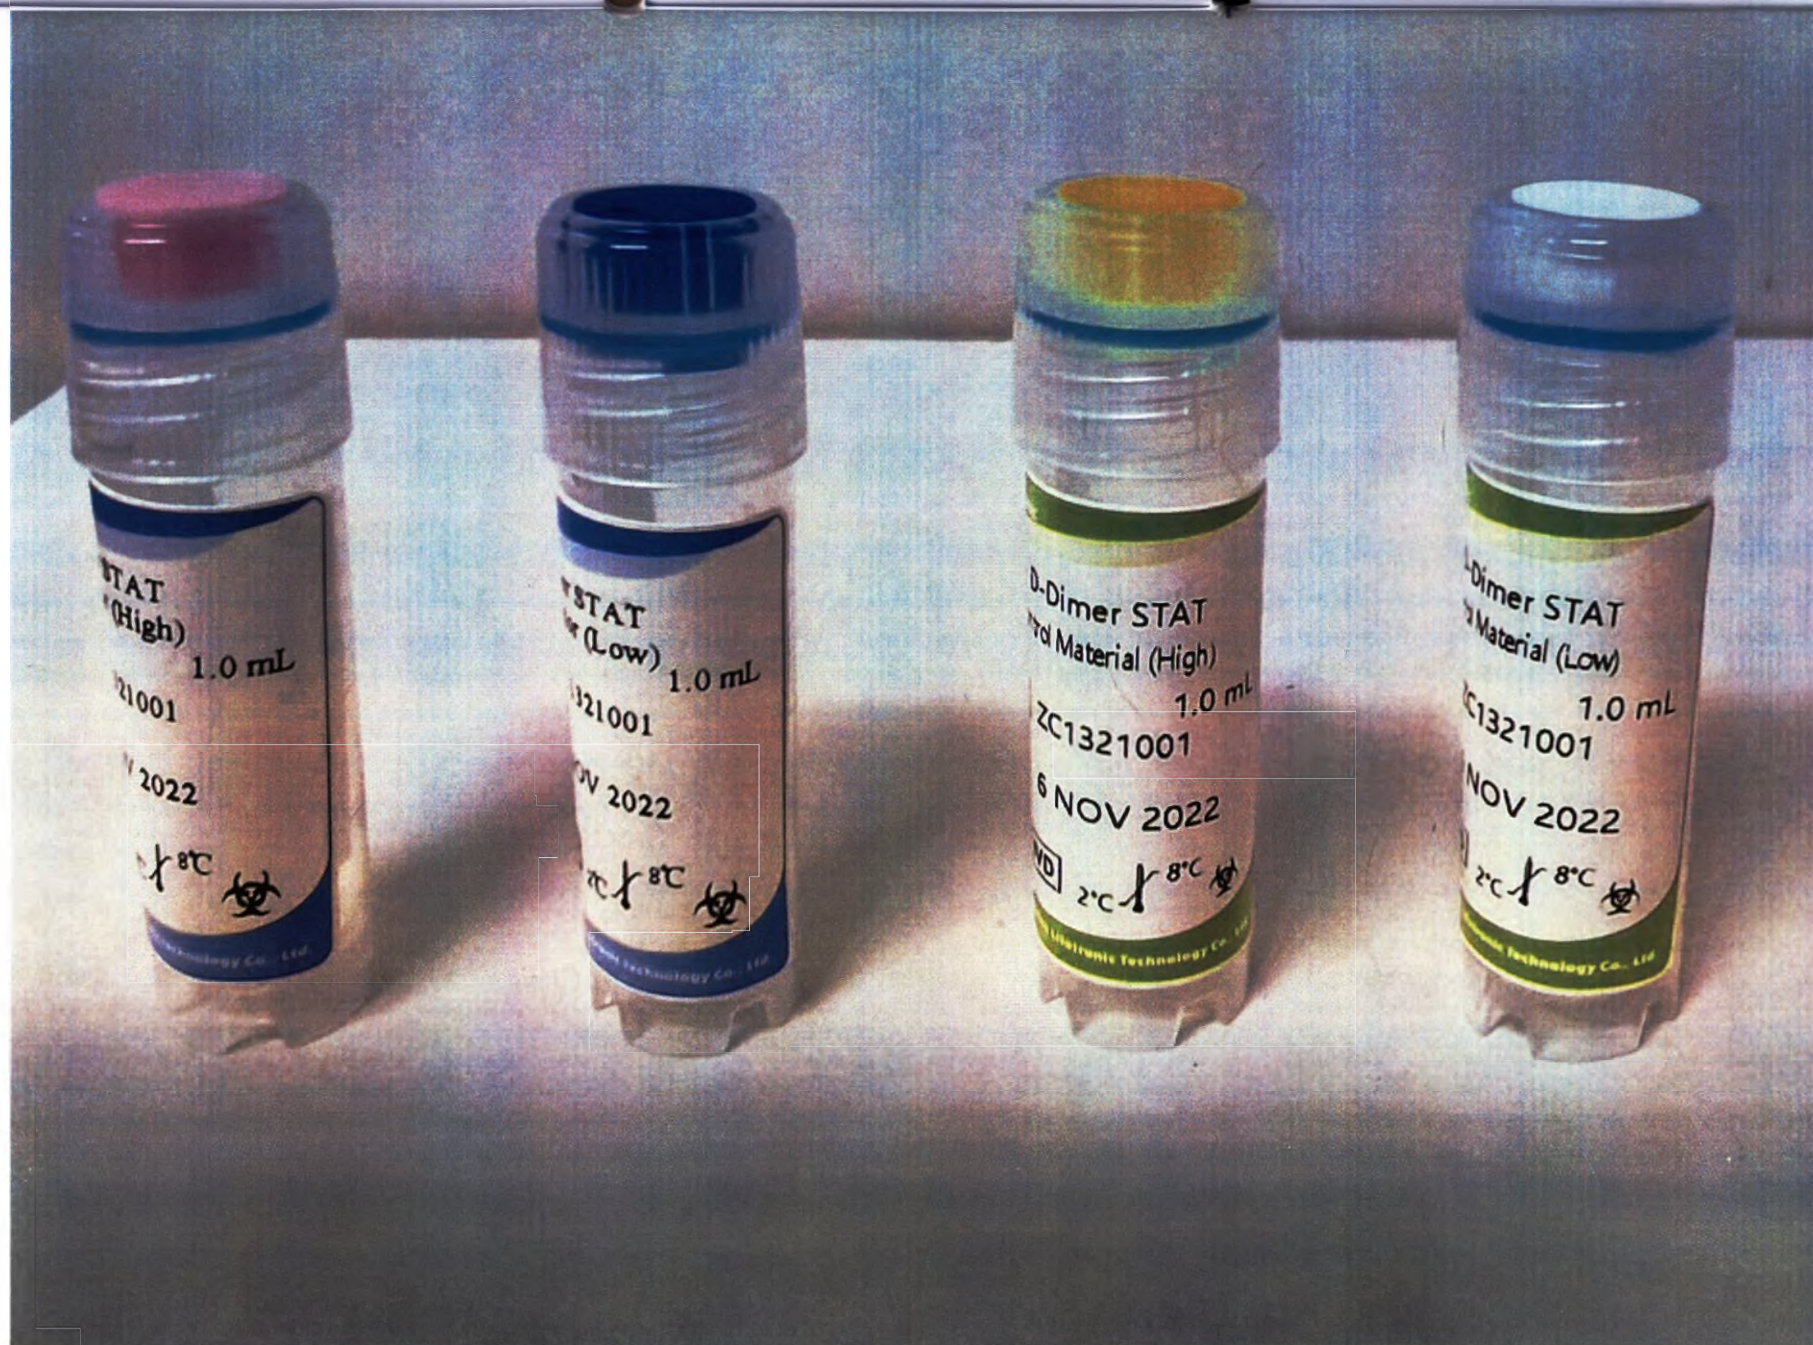

Калибратор (низкий и высокий уровень), Материал контрольный (низкий и высокий уровень) (Набор реагентов для количественного определения D-димера

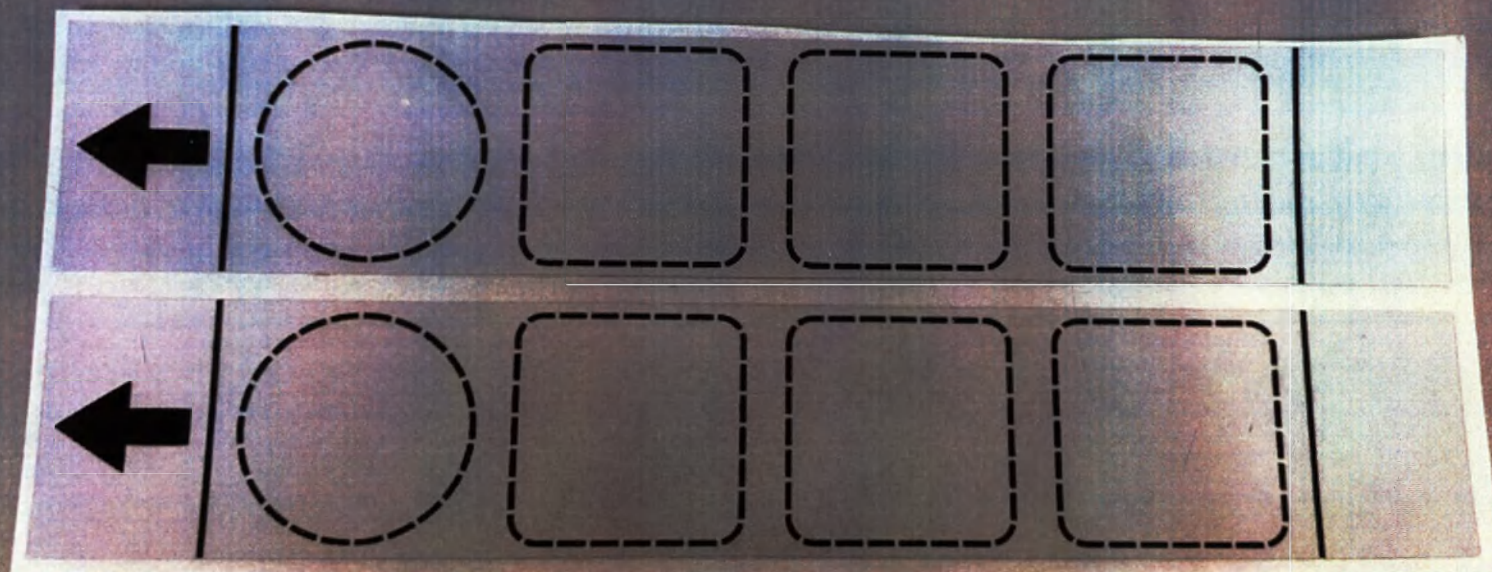

Этикетки для запечатывания флаконов (Набор реагентов для количественного определения D-димера электрохемилюминесцентным методом

D-Dimer STAT Quality Control Card

LOT


ZC1321001




6 NOV 2022

QC Range(Low): 0.246-0.654 μg FEU/mL

QC Range(High): 1.911-3.555 μg FEU/mL



Этикетка результатов значений материалов контрольных (Набор реагентов для количественного определения D-димера электрохемилюминесцентным методом



D-Dimer STAT(eCLIA)

D-Dimer STAT



Components

MB 3.5 mL

RB 7.5 mL

RA 7.5 mL

LOT ZC1321001

SN 00013

6 NOV 2022



2°C 8°C

Кассета с реагентами (Набор реагентов для количественного определения D-димера электрохемилюминесцентным методом

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 8 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А.
М.П.

