

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Фишер энд Пэйкел Хелскэр»



Филиппов А.А.

« 10 » _____ 2022 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Одноразовый домашний дыхательный контур AirSpiral для подачи
увлажненных дыхательных смесей в вариантах исполнения»

производства Fisher & Paykel Healthcare Ltd, Новая Зеландия

2022

Фото 1 - Дыхательный контур 900PT560




Фото 2 - Дыхательный контур 900PT560E



Фото 3- маркировка (стикер) для поставки в РФ дыхательного контура

F&P myAIRVO™

Breathing Tube

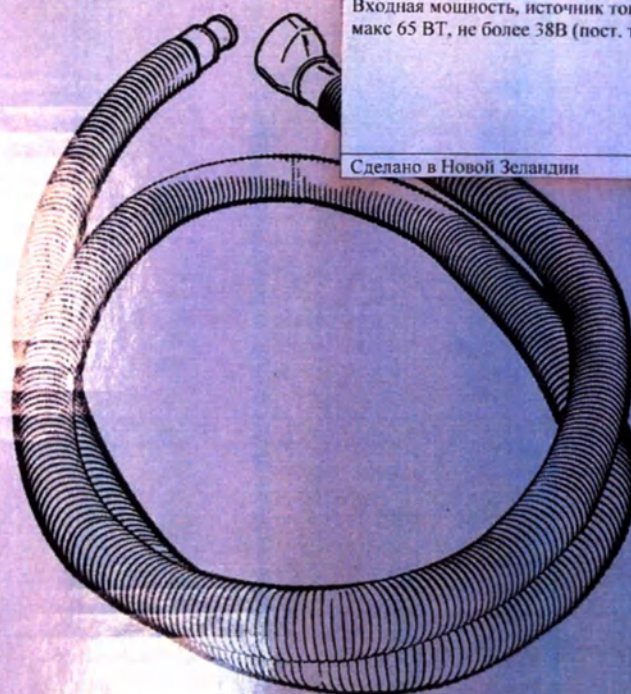

REF	900PT560E
Одноразовый домашний дыхательный контур AirSpiral для подачи увлажненных дыхательных смесей в варианте исполнения Дыхательный контур 900PT560E	
Производитель	«Фишер энд Пэйкел Хелскэр Лимитед» (Fisher & Paykel Healthcare Limited) Морис Пэйкел Плейс 15, Ист Тамаки, Окленд 2013, Новая Зеландия
Получатель	ООО «Фишер энд Пэйкел Хелскэр» 109428, г. Москва, Рязанский, дом 10, строение 18, эт. 10, комн. №7А Тел. +7 495 782 21 50
Свидетельство о регистрации:	РЗН 202Х/XXXX ДД.ММ.ГГГГ
Условия хранения	- 10 до 50 °С
Спецификация:	Одноразового использования
Срок годности до:	05-05-2023
Обратитесь к инструкции по эксплуатации Входная мощность, источник тока: макс 65 Вт, не более 38В (пост. ток) 2,1 А	
Сделано в Новой Зеландии	



REF 900PT560E QTY: 1 EA
UoM: EA

(en) Heated Breathing Tube
(es) Tubo de Respiración Calentado

Fisher & Paykel
HEALTHCARE
Made in New Zealand

Fisher & Paykel Healthcare Ltd
15 Maurice Paykel Place, East Tamaki
Auckland 2013, New Zealand
Tel: +64 9 574 0100 Fax: +64 9 574 0158

EC REP
Fisher & Paykel Healthcare SAS
10 Av. du Québec, Bât. F5, BP 512,
91946 Courtaboeuf Cedex, France


For patent information, see www.fphcare.com/p

Rx only CE 0123 Single Use

LOT 2101100876
2020-05-05
2023-05-05

(01)09420012448040(10)2101100876(11)200505(17)230505

Фото 4- макрировка (стикер) для поставки в РФ дыхательного контура

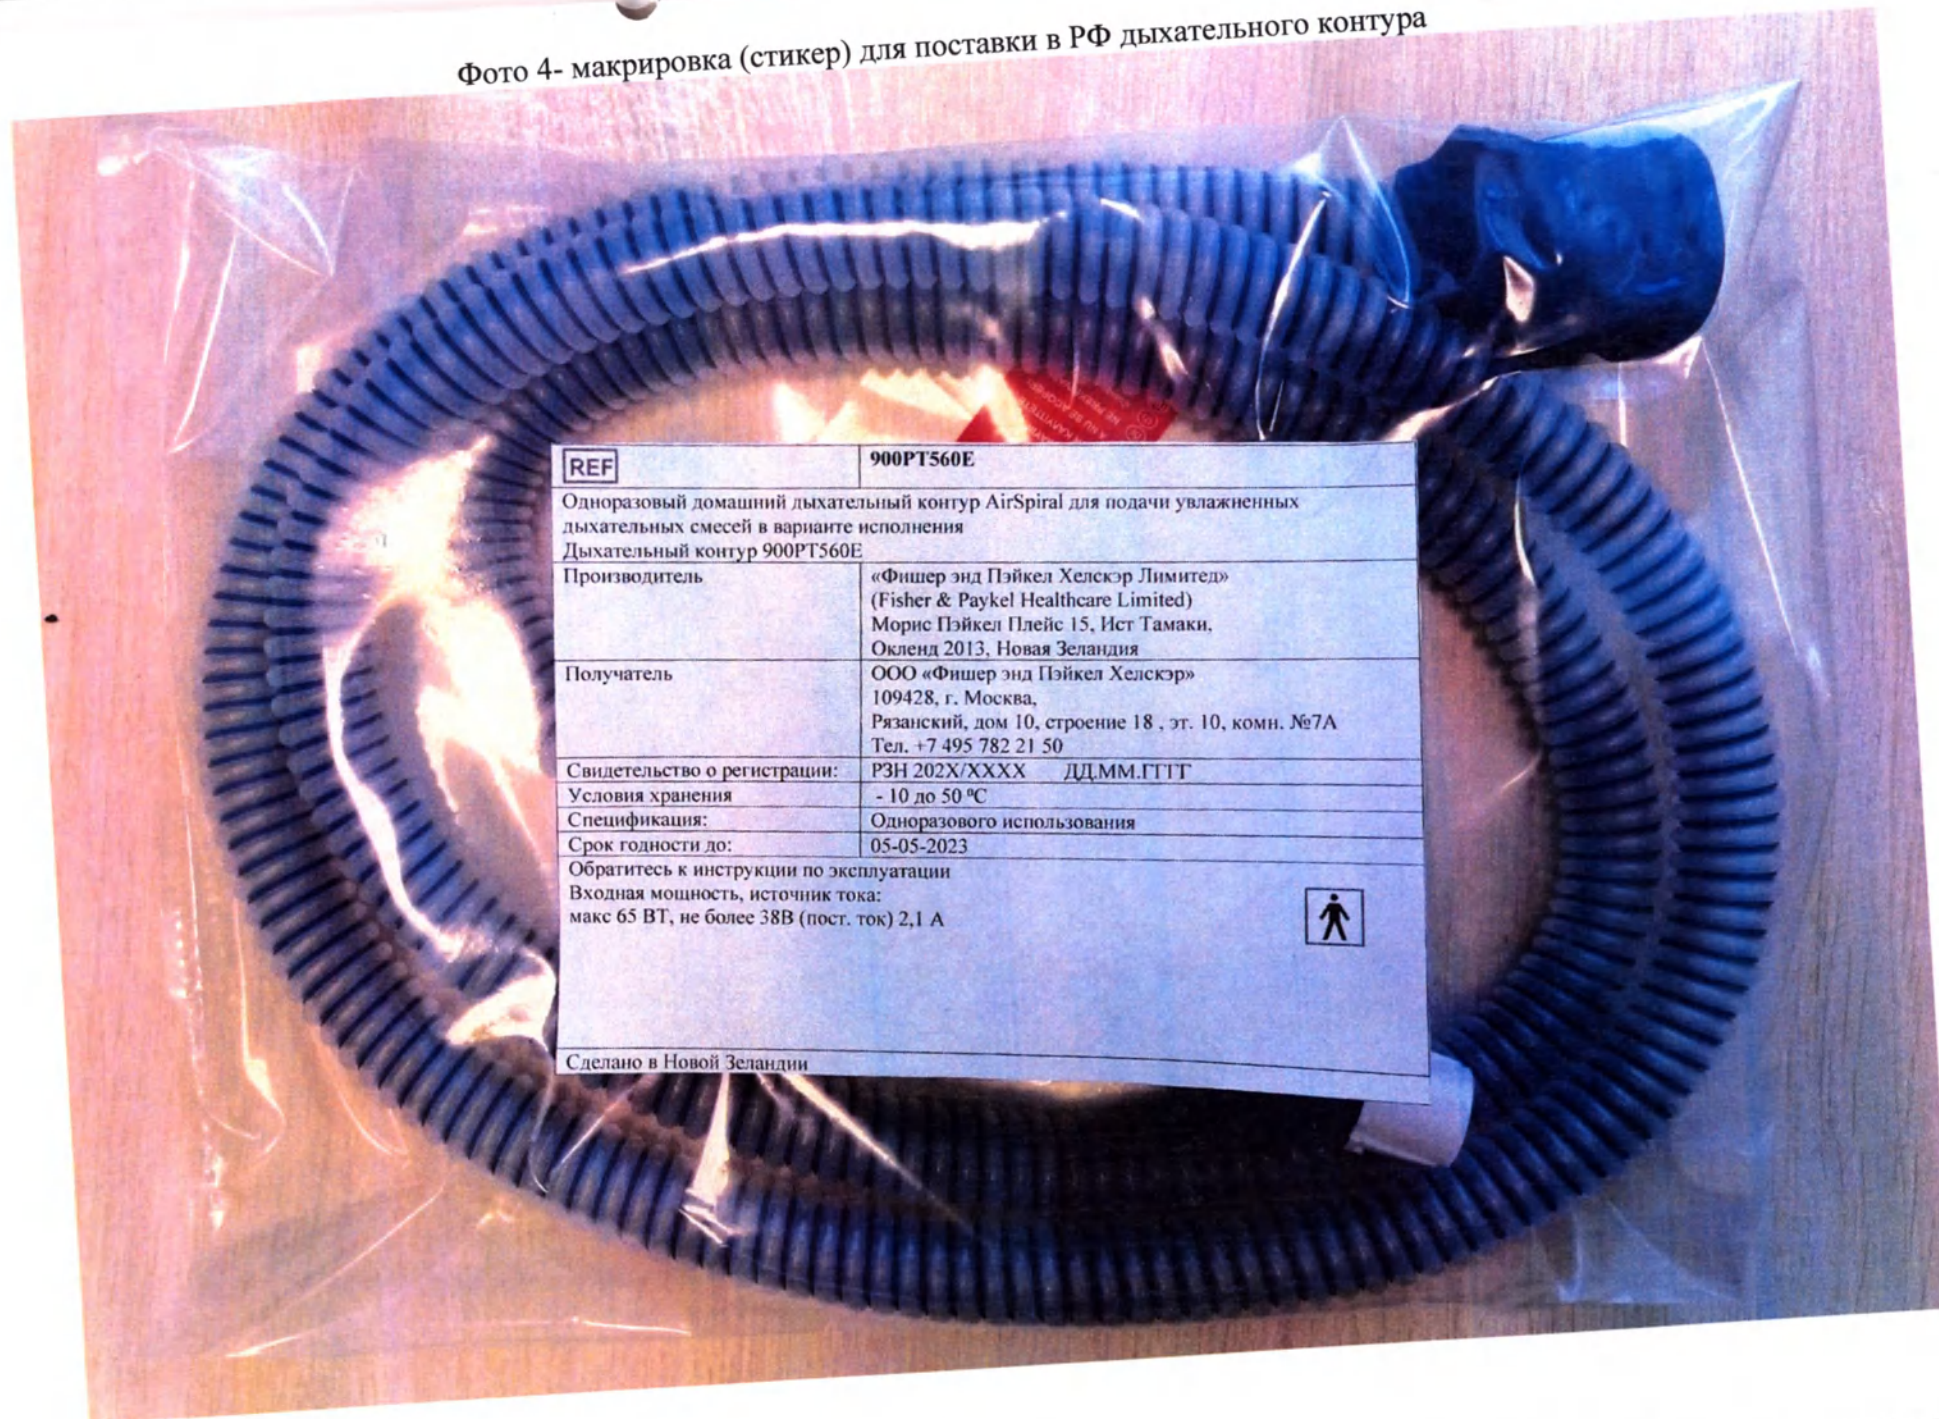

REF	900PT560E
Одноразовый домашний дыхательный контур AirSpiral для подачи увлажненных дыхательных смесей в варианте исполнения Дыхательный контур 900PT560E	
Производитель	«Фишер энд Пэйкел Хелскэр Лимитед» (Fisher & Paykel Healthcare Limited) Морис Пэйкел Плейс 15, Ист Тамаки, Окленд 2013, Новая Зеландия
Получатель	ООО «Фишер энд Пэйкел Хелскэр» 109428, г. Москва, Рязанский, дом 10, строение 18, эт. 10, комн. №7А Тел. +7 495 782 21 50
Свидетельство о регистрации:	РЗН 202Х/XXXX ДДММ.ГГГГ
Условия хранения	- 10 до 50 °С
Спецификация:	Одноразового использования
Срок годности до:	05-05-2023
Обратитесь к инструкции по эксплуатации Входная мощность, источник тока: макс 65 Вт, не более 38В (пост. ток) 2,1 А	
Сделано в Новой Зеландии	



Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 5 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Филиппов А.А.
М.П.

