

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Микрохирургические
технологии»

А.И. Галимов
« 24 » 20 22 г.



**Инструменты стоматологические микрохирургические
по ТУ 32.50.11-001-01691673-2020: распатор двусторонний
стоматологический**

Фотографические изображения и образцы маркировки

Фото 1. Распатор двусторонний стоматологический, общий вид (на примере исполнения ТС-201В).

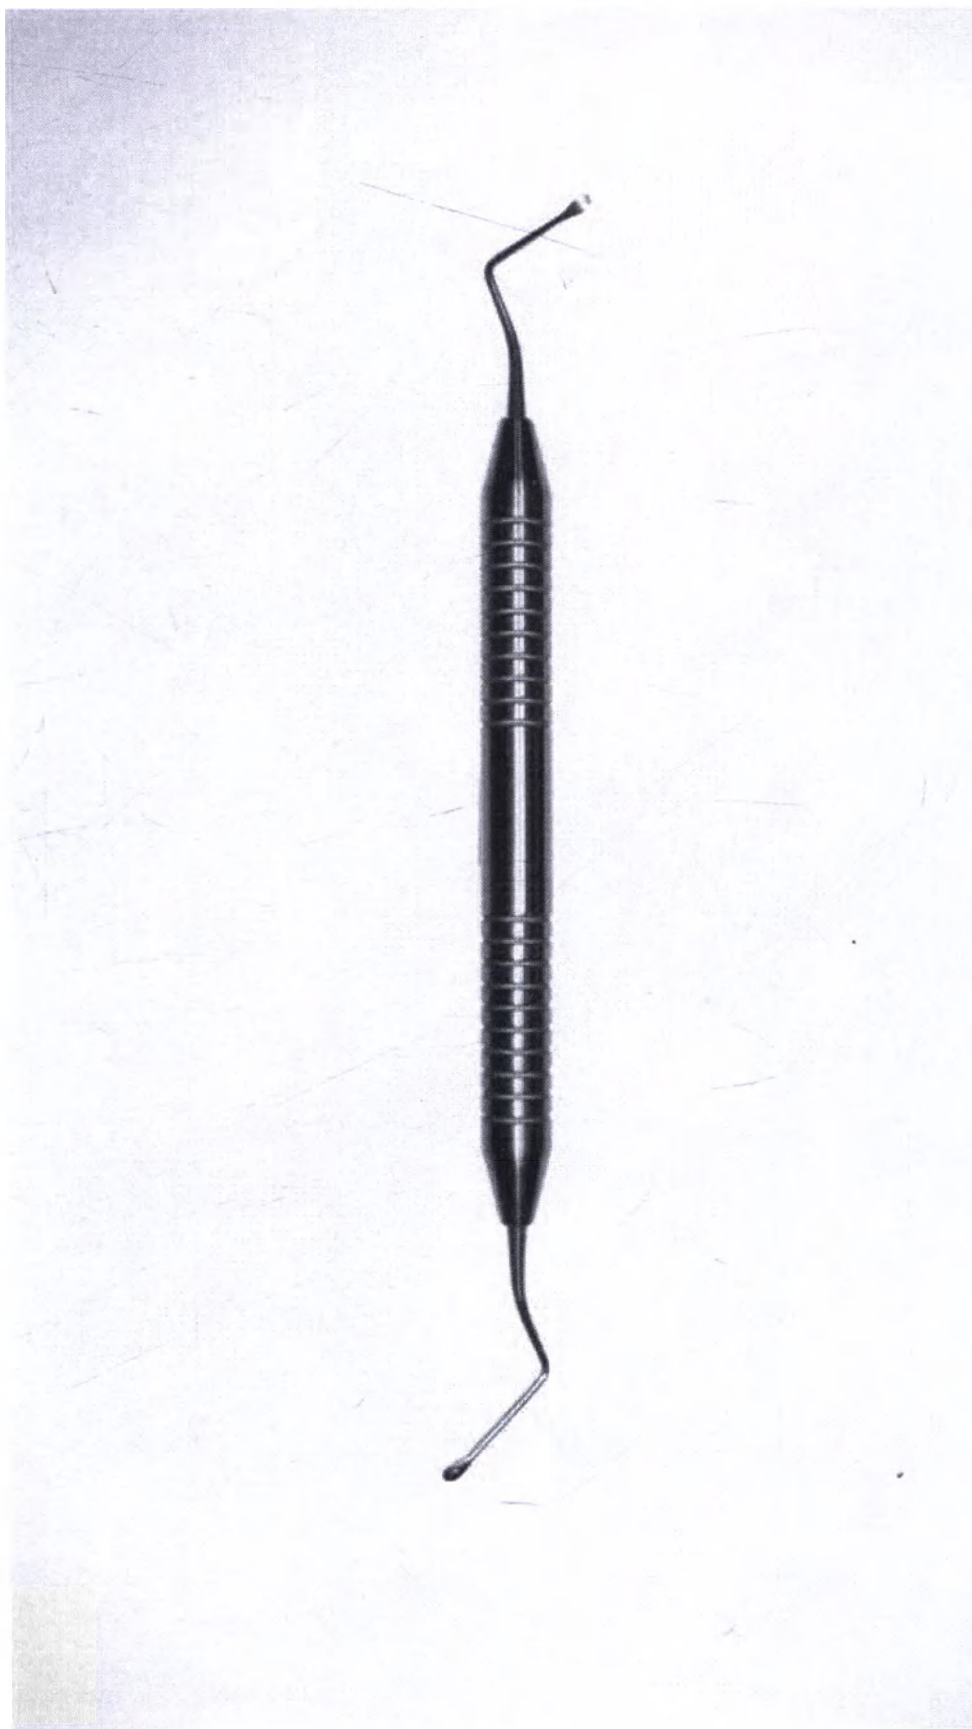


Фото 2. Распатор двусторонний стоматологический, общий вид (на примере исполнения ТС-202В).

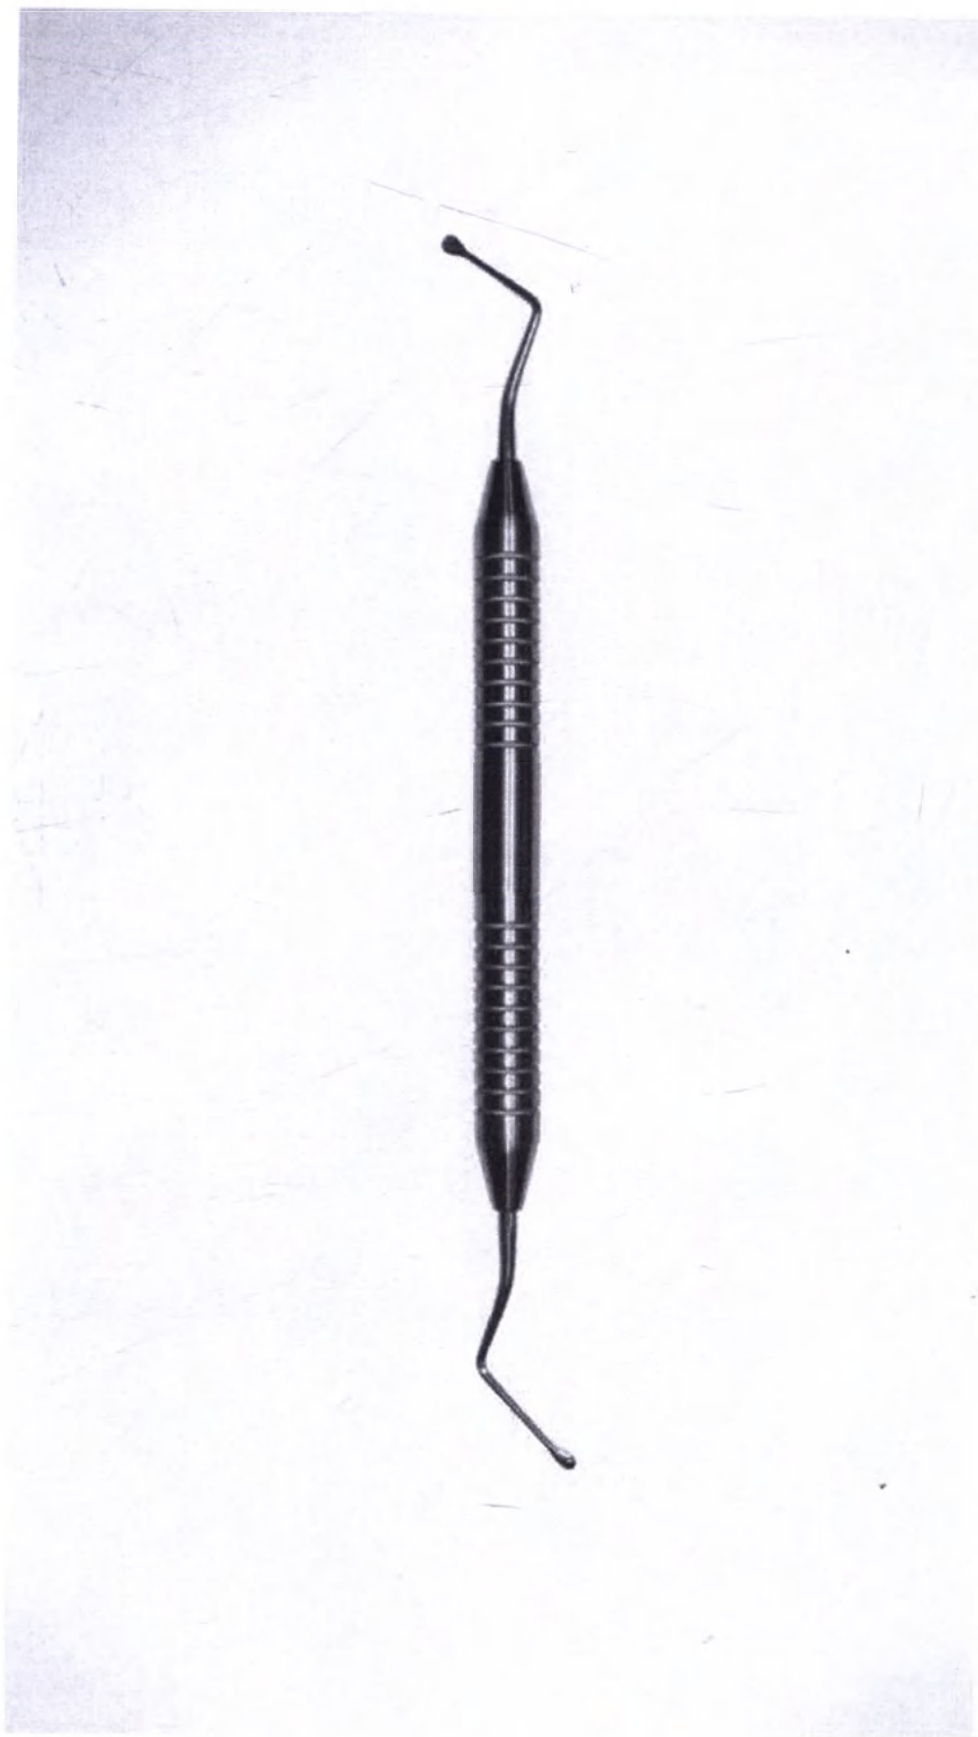


Фото 3. Распатор двусторонний стоматологический, общий вид (на примере исполнения ТС-203В).

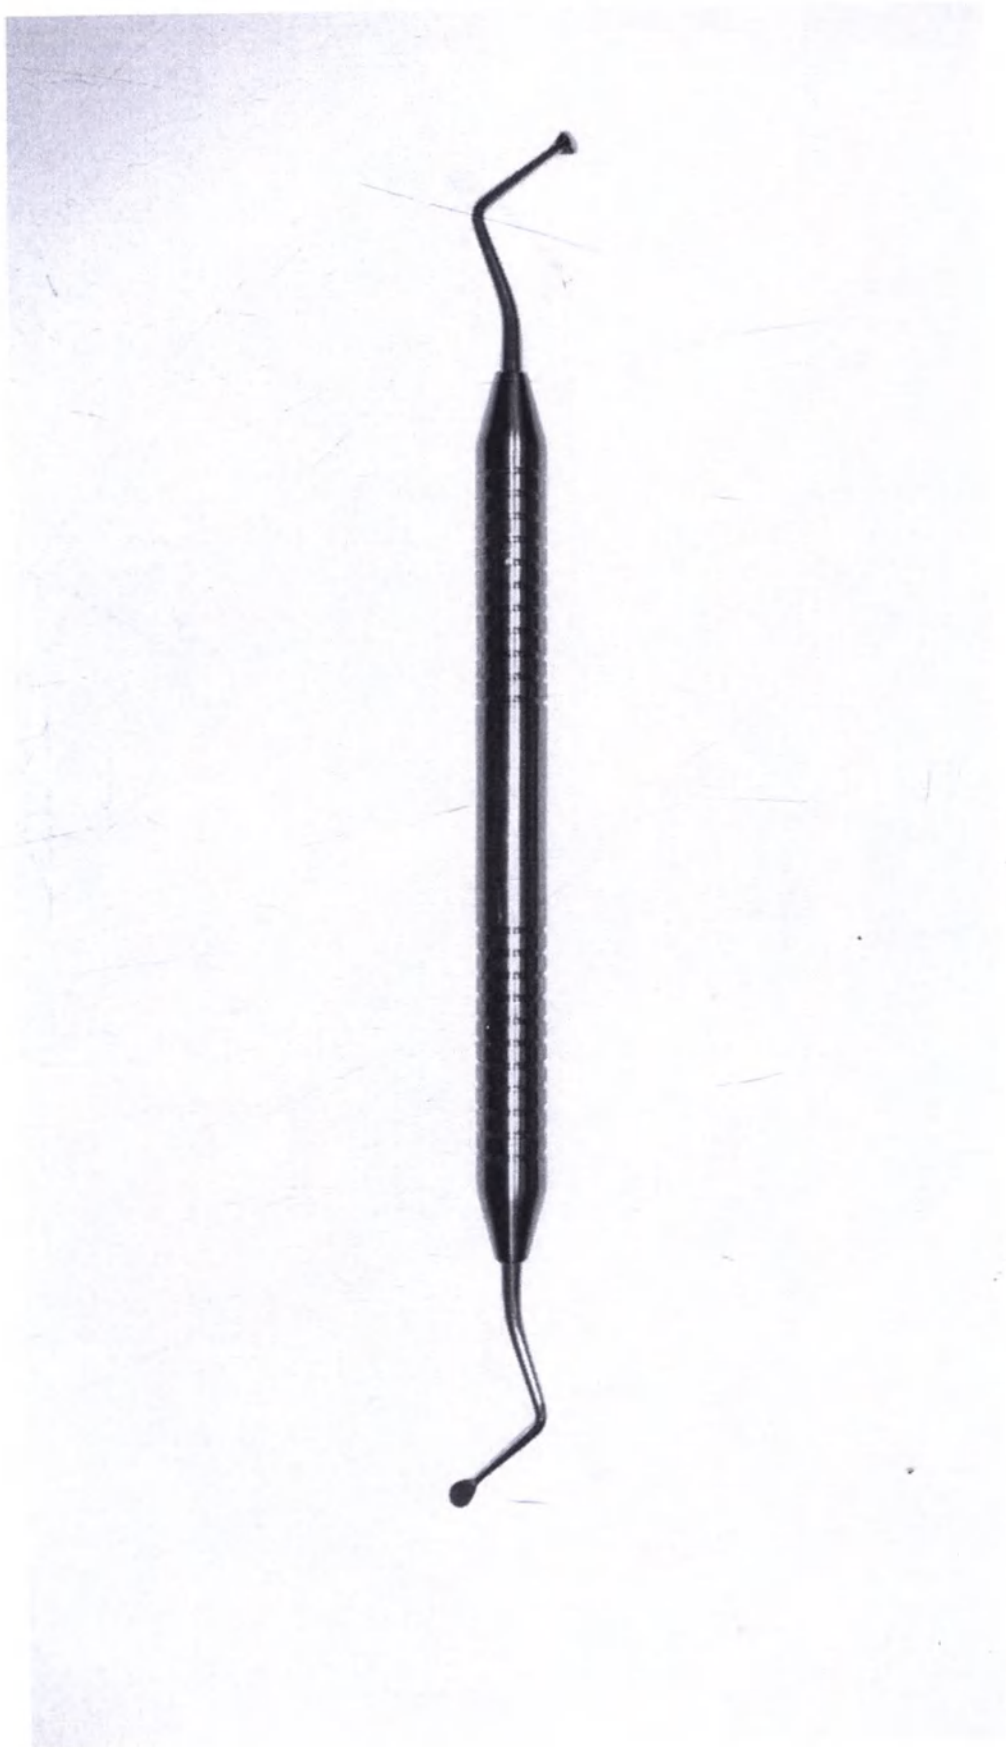


Фото 4. Распатор двусторонний стоматологический, общий вид (на примере исполнения ТС-204В).

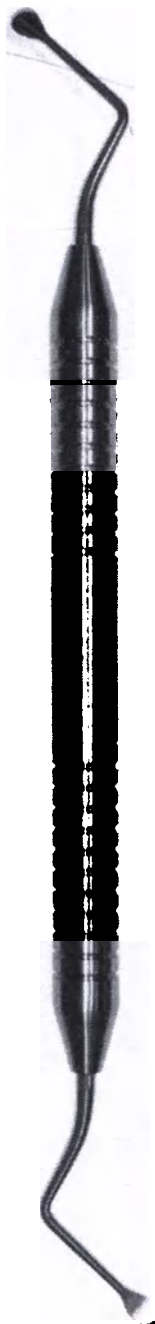


Фото 5. Распатор двусторонний стоматологический, общий вид (на примере исполнения ТС-205В).

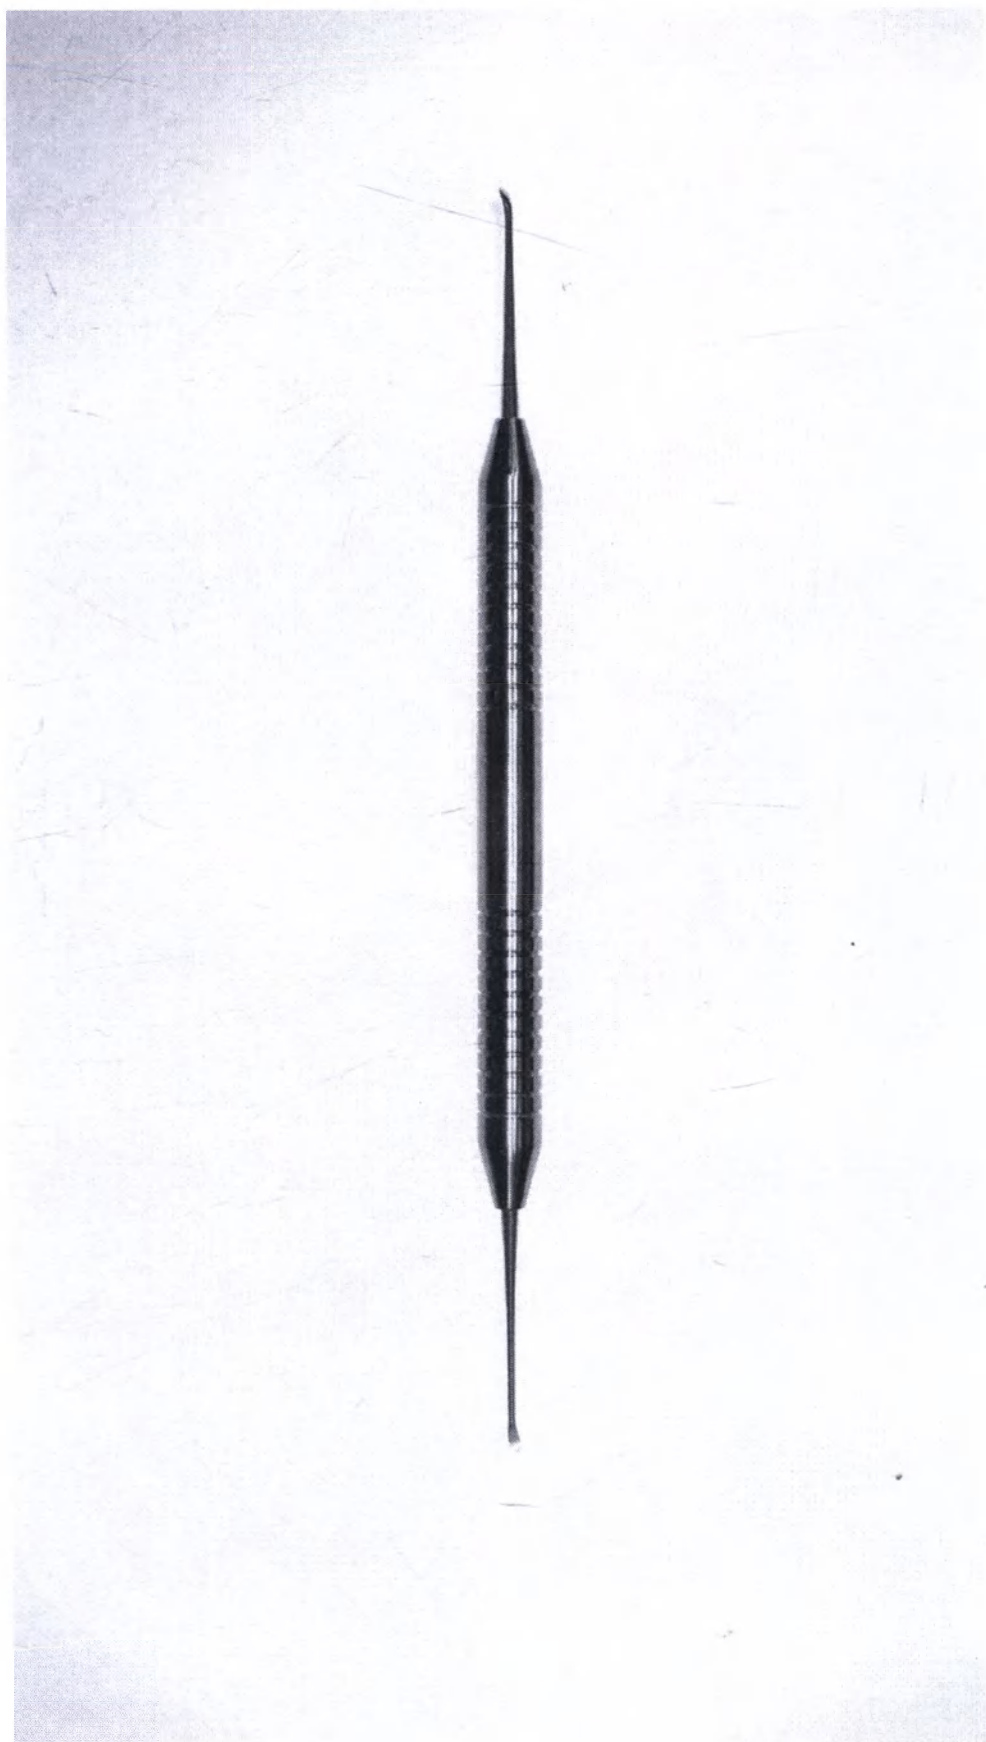


Фото 6. Распатор двусторонний стоматологический, общий вид (на примере исполнения ТС-206В).

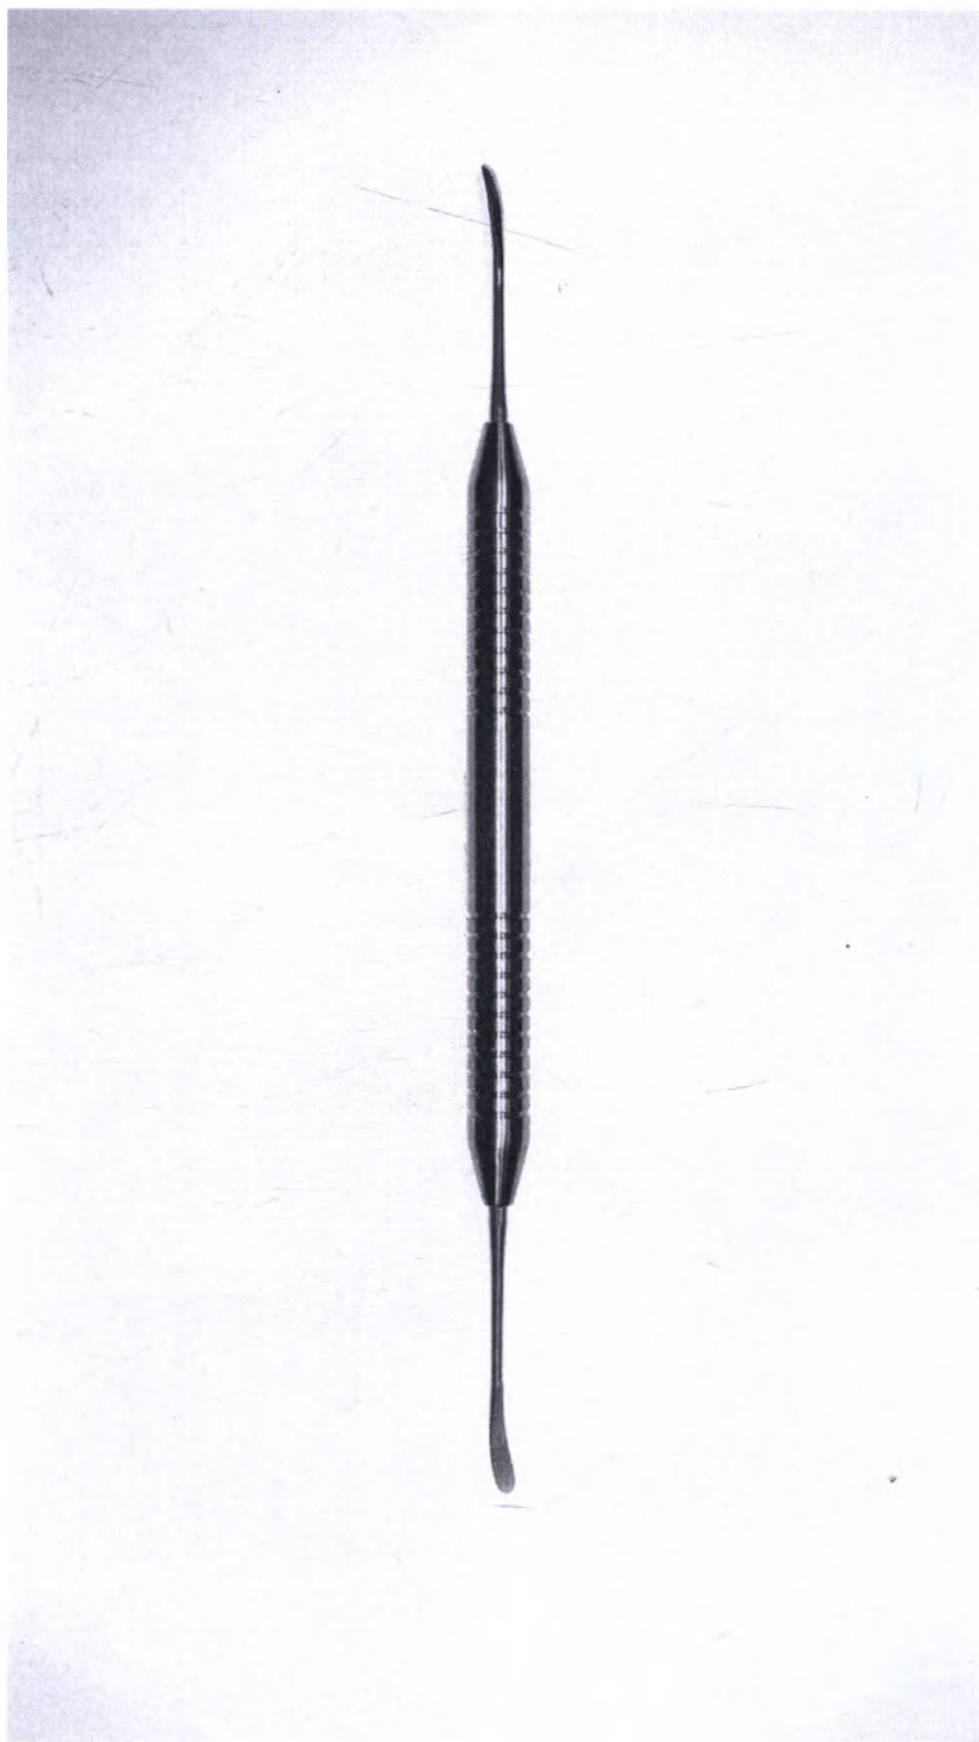


Фото 7. Распатор двусторонний стоматологический, общий вид (на примере исполнения ТС-207В).

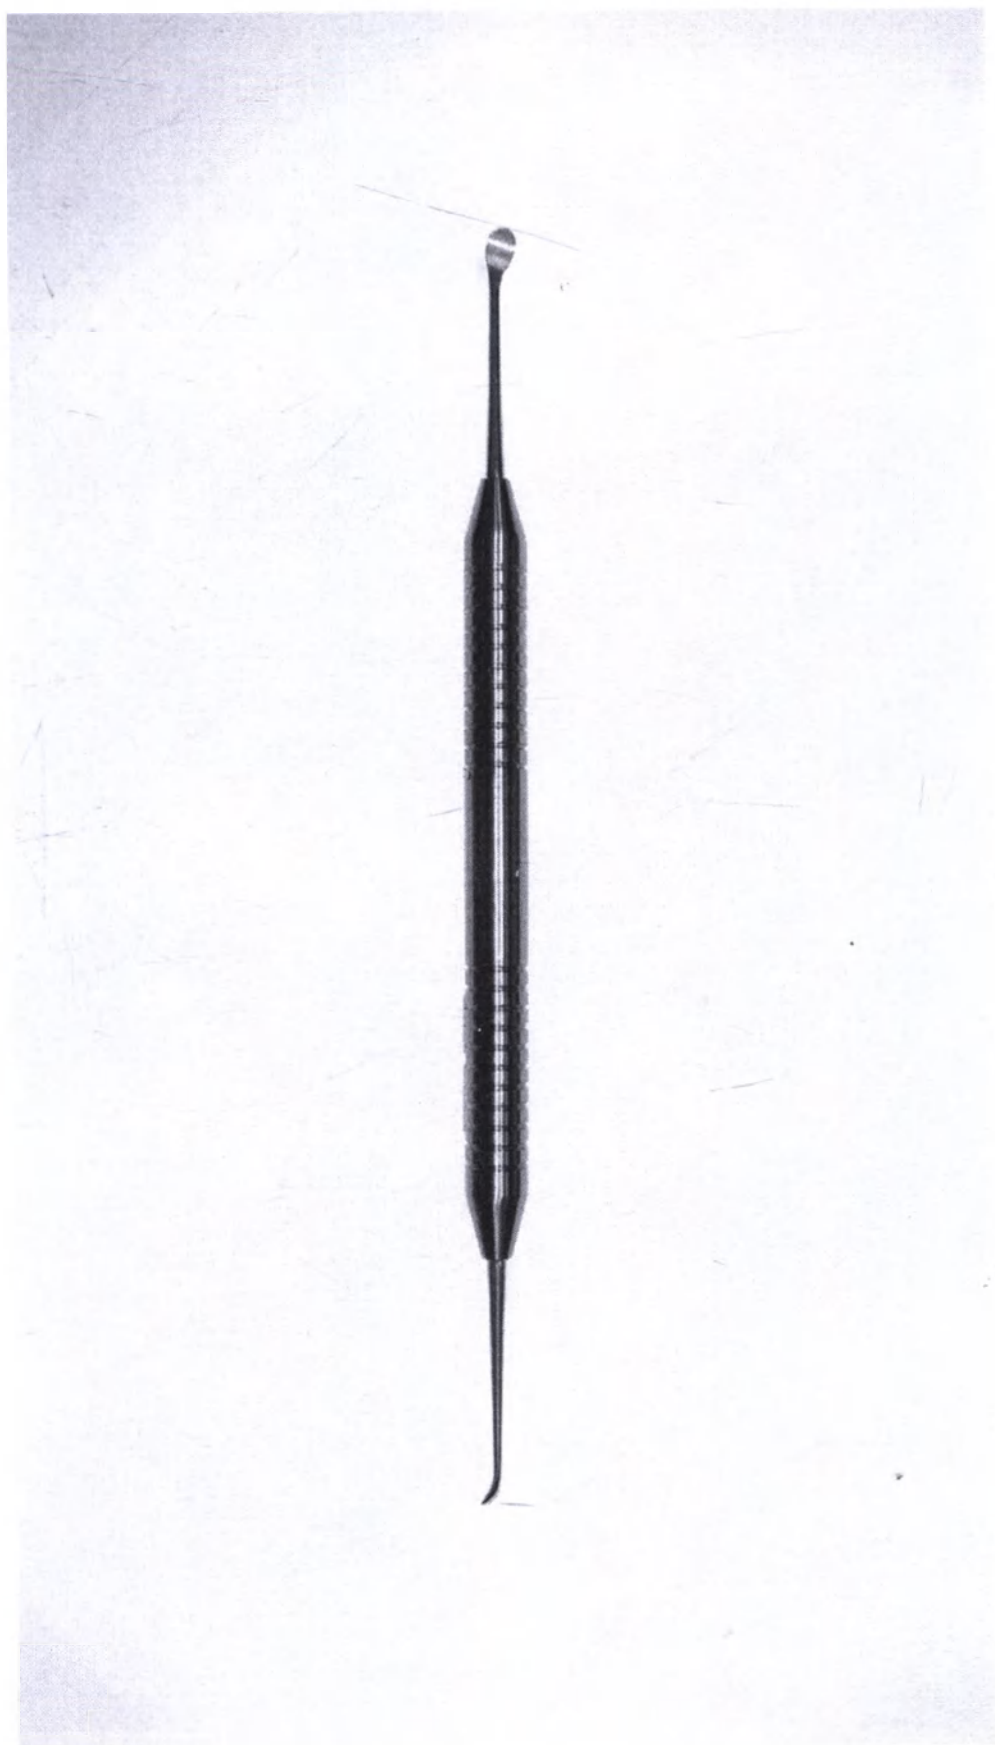


Фото 8. Распатор двусторонний стоматологический, общий вид (на примере исполнения ТС-208В).

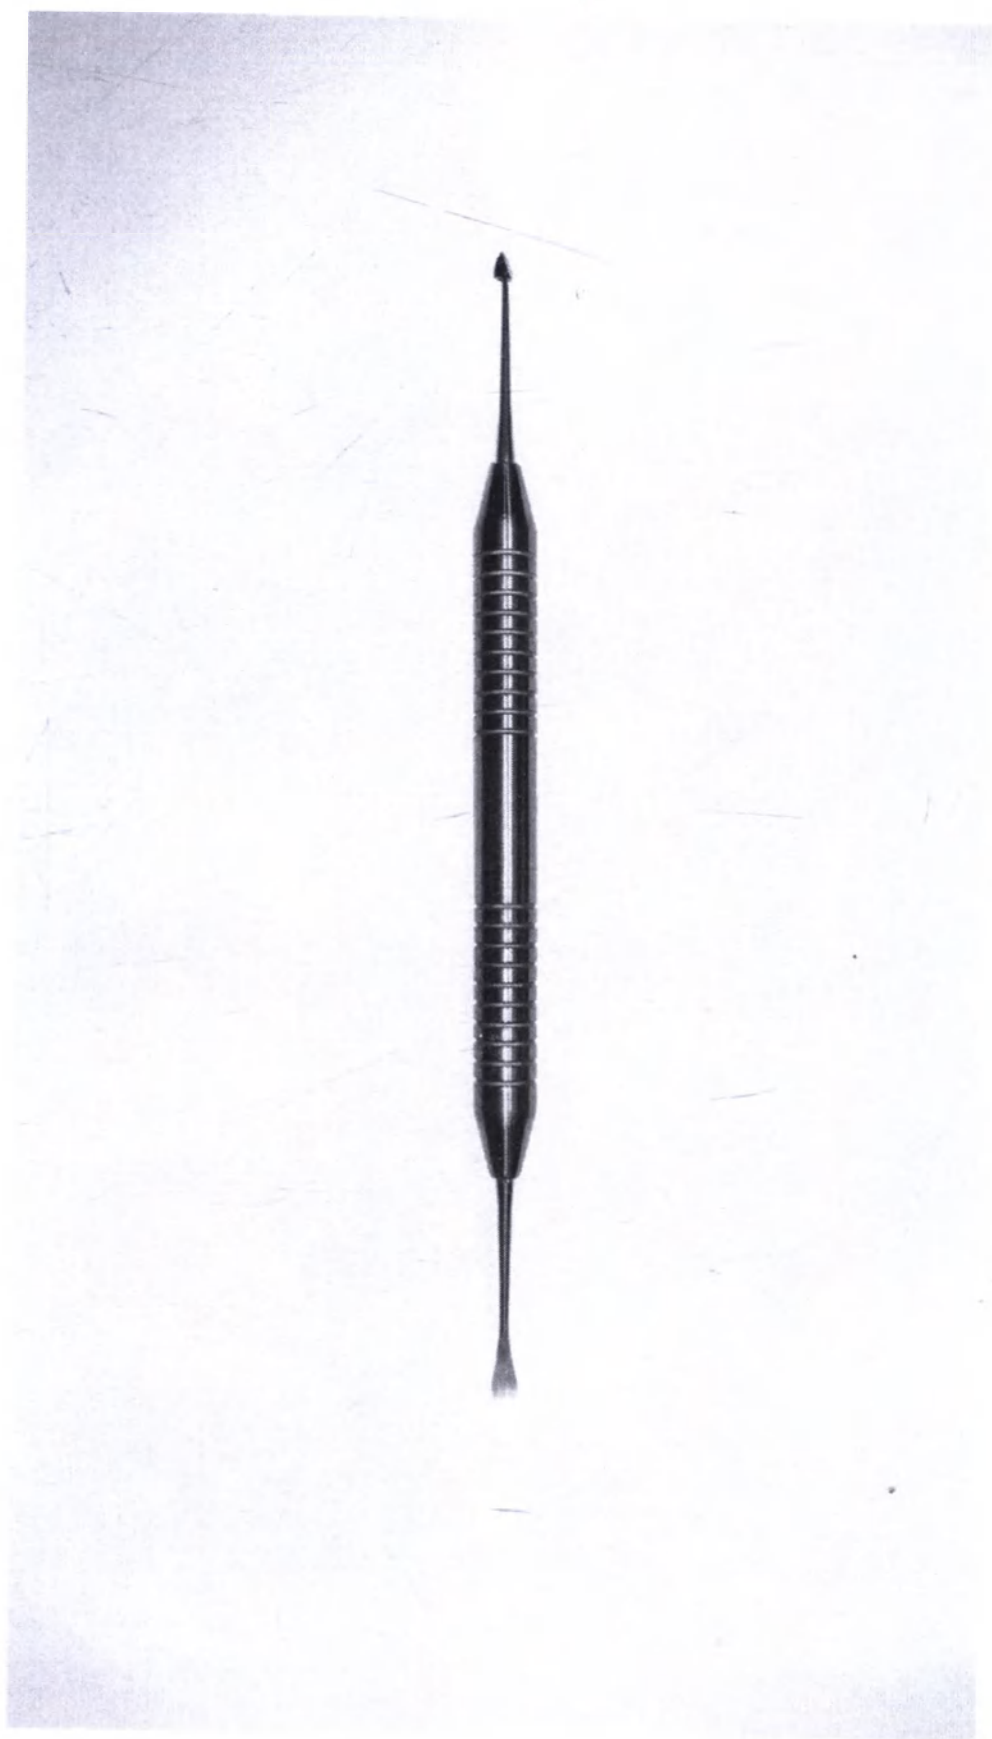


Фото 9. Распатор двусторонний стоматологический, общий вид (на примере исполнения ТС-209В).

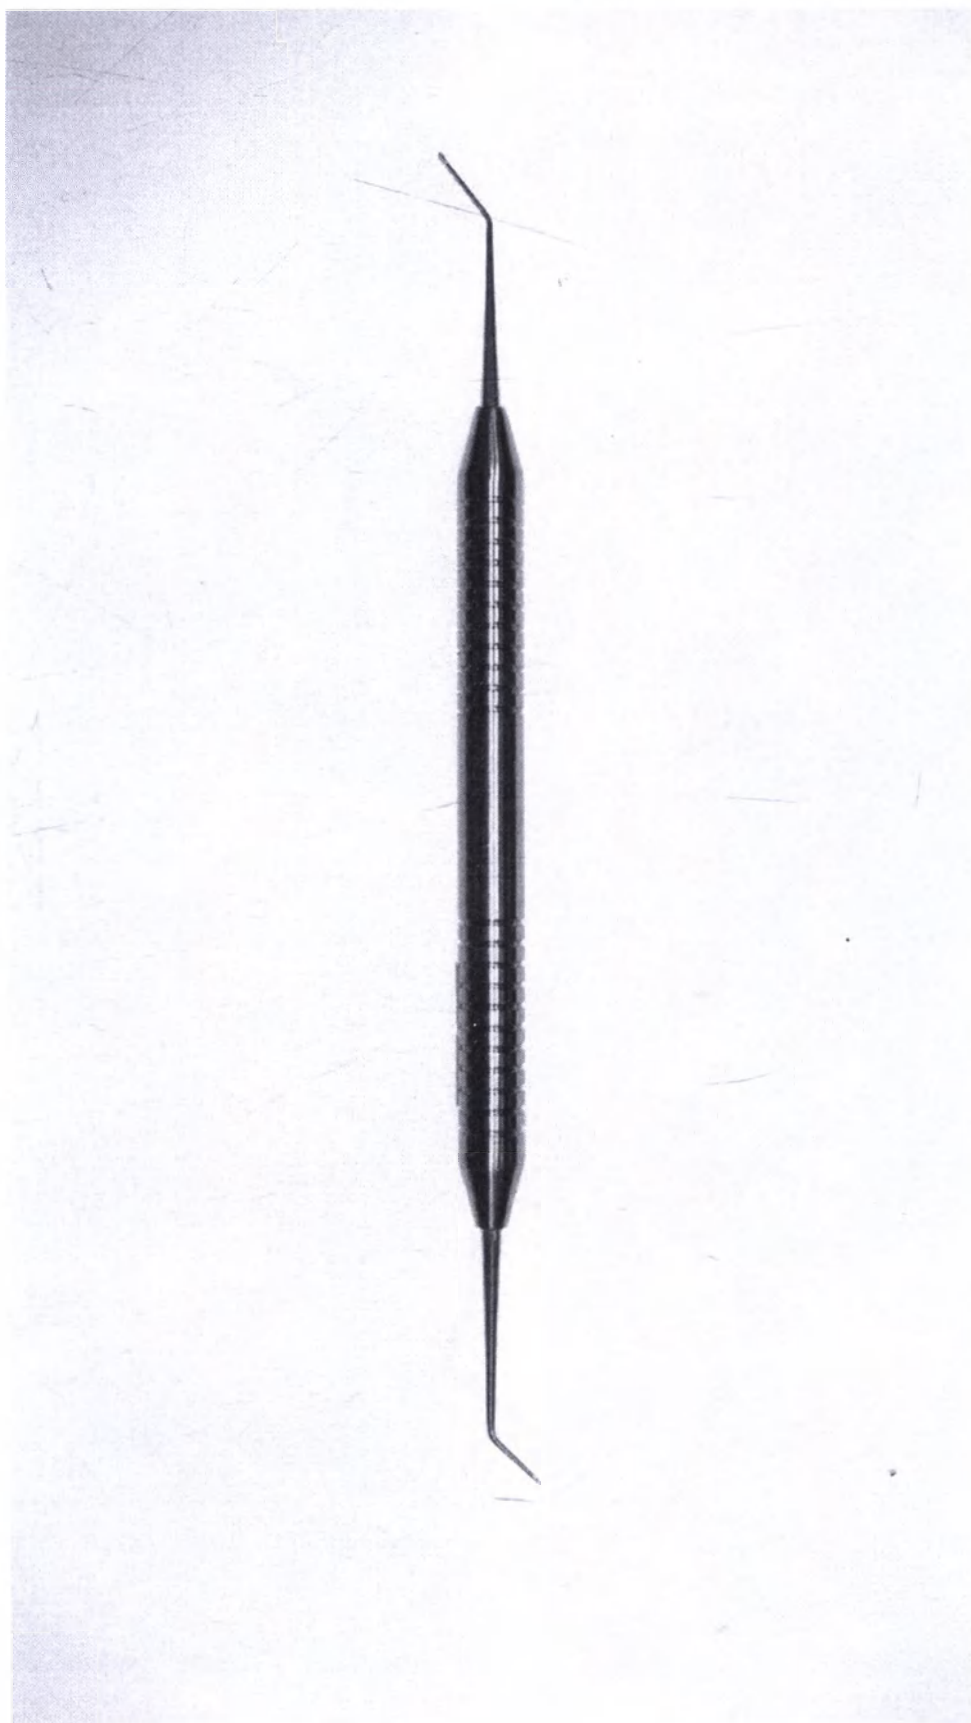


Фото 10. Распатор двусторонний стоматологический, общий вид (на примере исполнения ТС-202А).




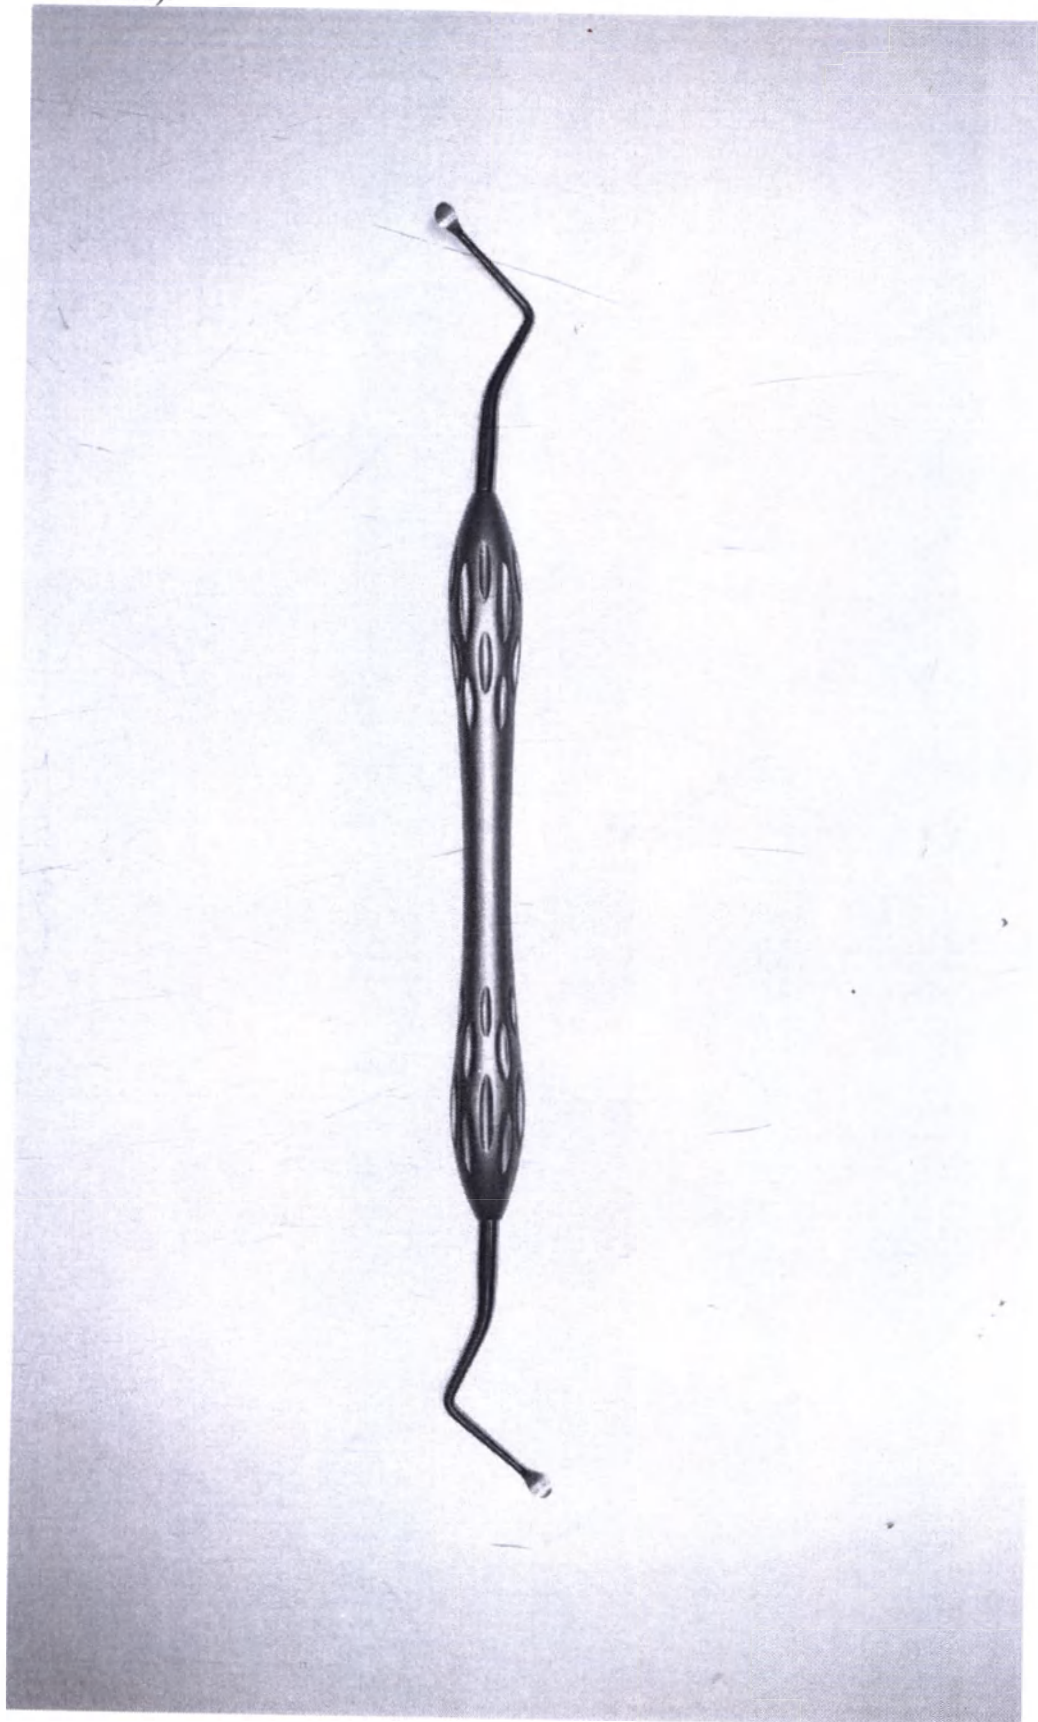


Фото 11-12. Фотографии упаковки.

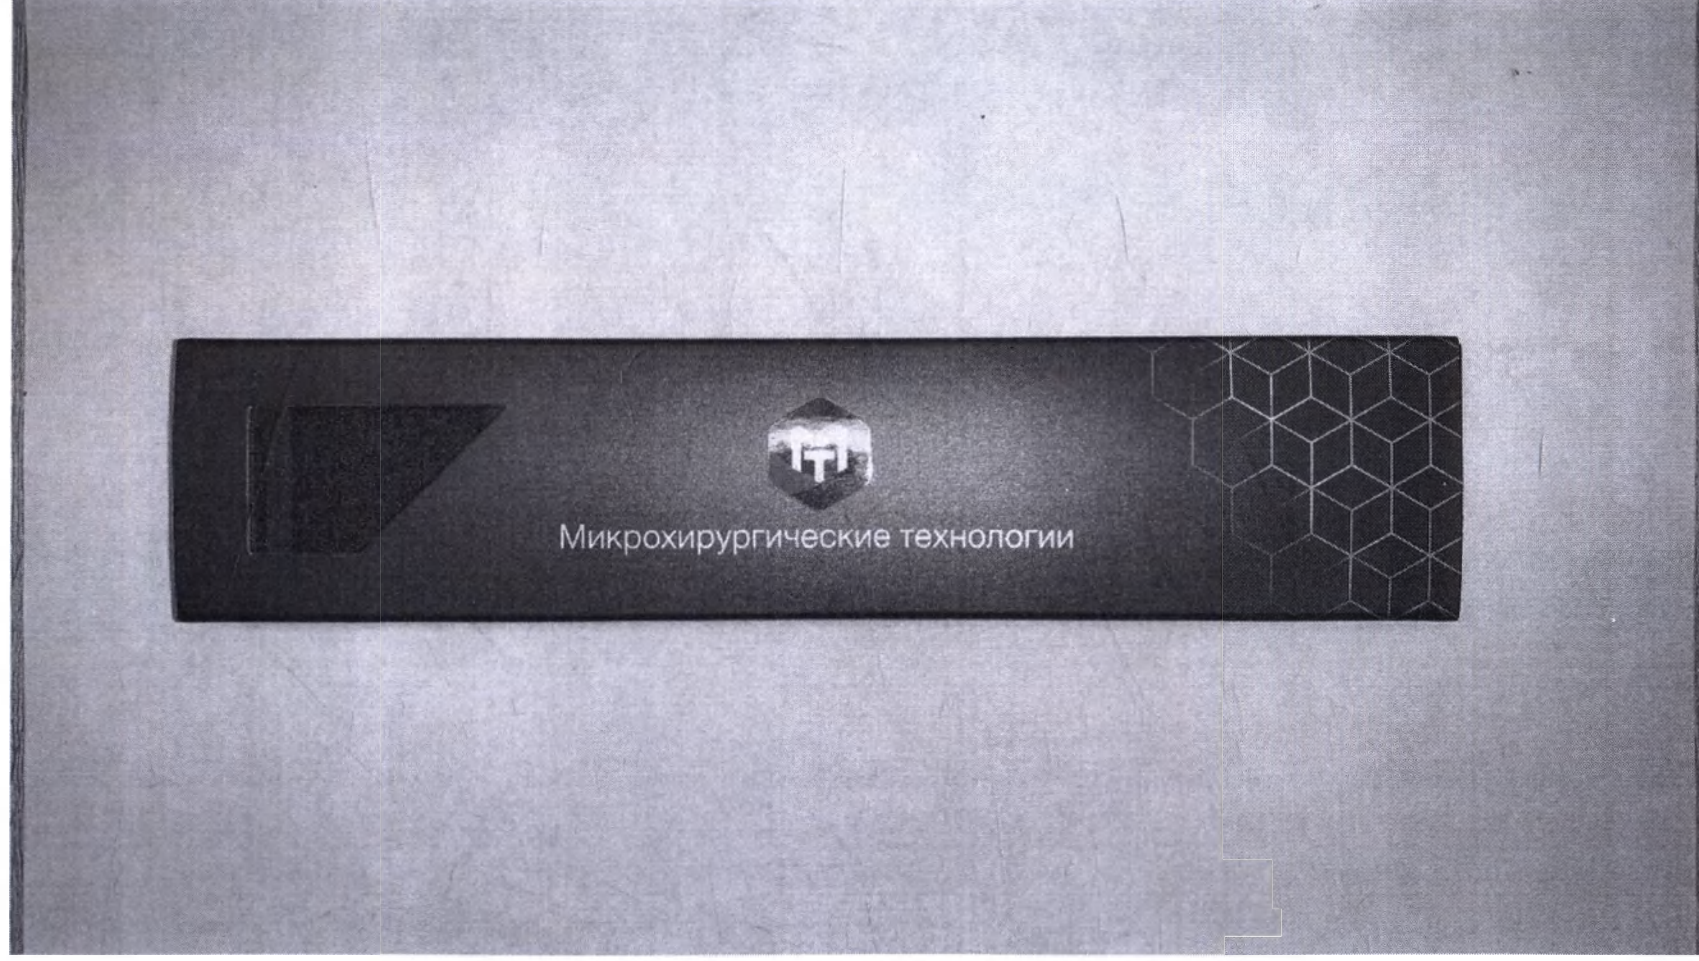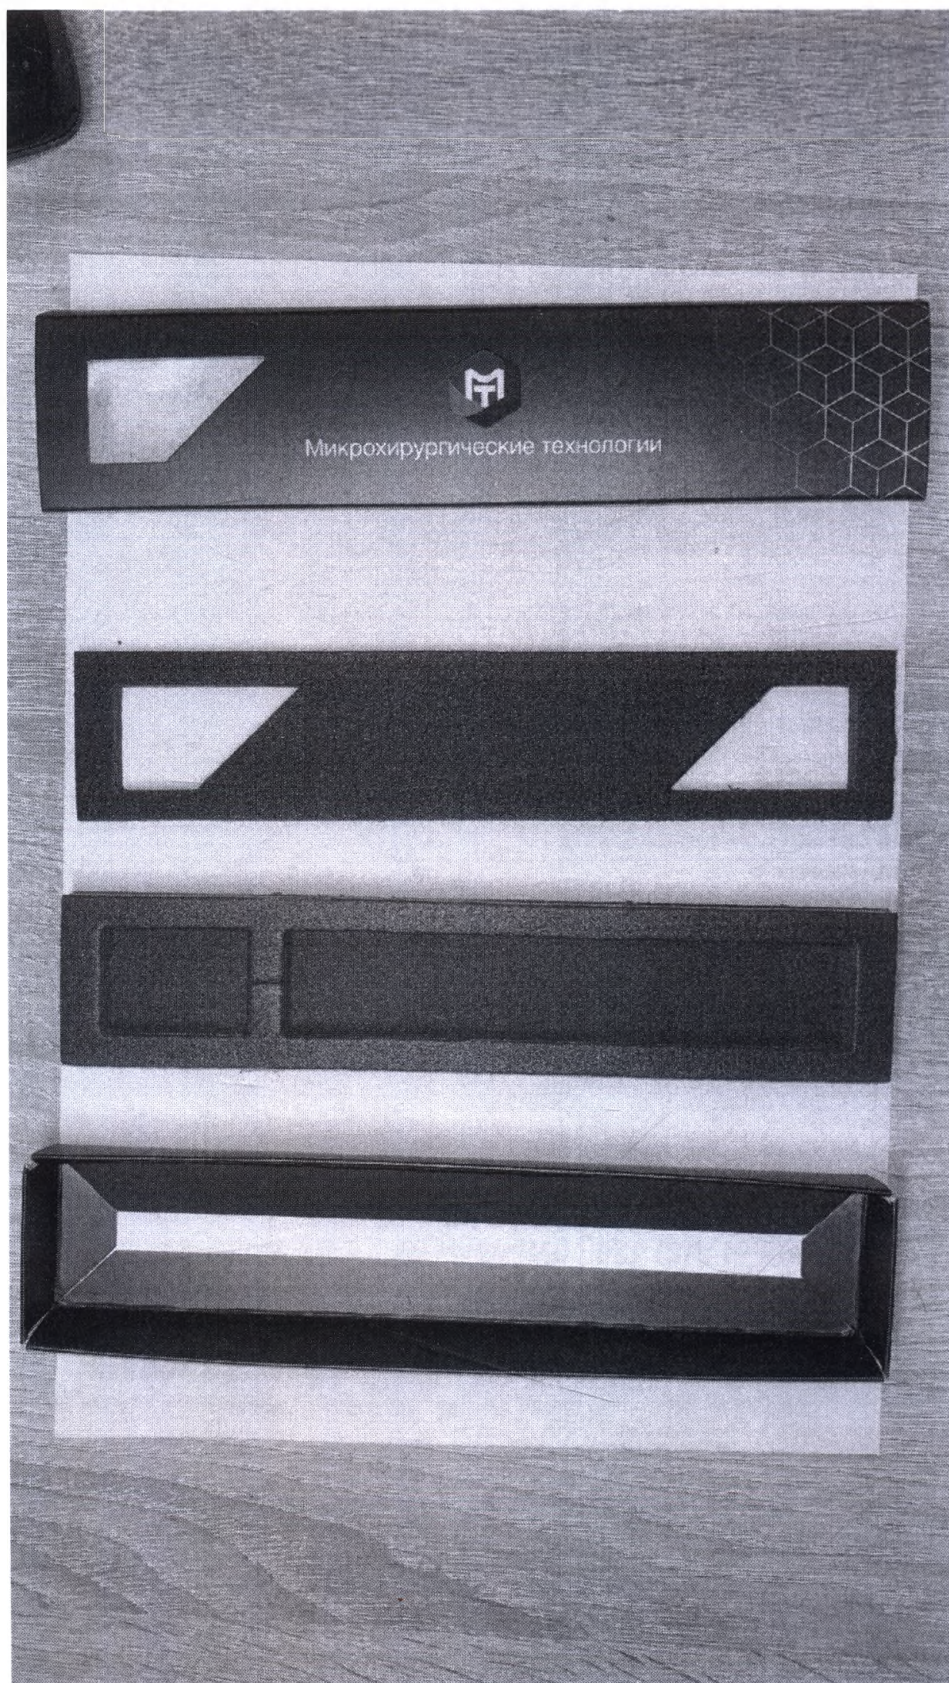



Макеты маркировки (маркировка наносится на разные стороны картонной коробки) – на примере одного исполнения каждого вида инструмента.

 ООО «Микрохирургические Технологии» Юридический адрес: 420061, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, д. 53, кв. 11 Тел.: +7(843) 206-07-15 E-mail: info@microsurgical.ru, sale@microsurgical.ru Сайт: www.microsurgical.ru Адрес производства: 420054, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Складская, д.4			
Распатор двусторонний стоматологический TC-204B ТУ 32.50.11-001-01691673-2020			
Рабочая часть Stainless Steel AISI 420		Рукоятка Titanium по ГОСТ 19807-91 ☐ BT1-0 ☐ BT6 Цвет покрытия: ☐ - синее ☐ - голубое ☐ - зеленое ☐ - желтое	
			
Серийный номер: _____ Дата изготовления: _____ Количество: 1		ОТК _____	
Срок службы: не менее 1 года			
Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г.			
Made in Russia			

Всего пронумеровано, скреплено и
заверено печатью 14 листа (-ов)

Директор

ООО «Микрохирургические
технологии»



А.И. Галимов