

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

Электрокардиограф цифровой многоканальный

(см. Приложение на 1 листе)

Wuhan Zoncare Bio-medical Electronics Co., Ltd.
(«Ухань Зонкее Био-медиал Электроникс Ко., Лтд.»), Китай



Рисунок 1 – Адаптер питания (вид сверху, провод адаптера питания и подключенный кабель питания изображены частично).

Wuhan Zoncare Bio-medical Electronics Co., Ltd.
(«Ухань Зонкаре Био-медикал Электроникс Ко., Лтд.»)

Изделие: Электрокардиограф цифровой многоканальный
Исполнение: Электрокардиограф цифровой многоканальный
iMAC12

Элемент: адаптер питания

Вх. параметры: 100-240 В, 50-60 Гц

Вых. параметры: $\sim$ 19В, 3.16А макс.

Класс электрозащиты: I

Степень защиты оболочки: IP50

SN



XH-15120144



Адрес: #380, High-tech 2nd road, Eastlake high-tech district,
Wuhan, Hubei, P. R. China

<http://www.zoncare.com>

MODEL PS157Q



XH-15120144

Рисунок 2 – Адаптер питания (вид снизу, со служебной наклейкой).



Рисунок 3 – Блок основной iMAC12 (вид спереди).



Рисунок 4 – Блок основной iMAC12 (вид сзади).

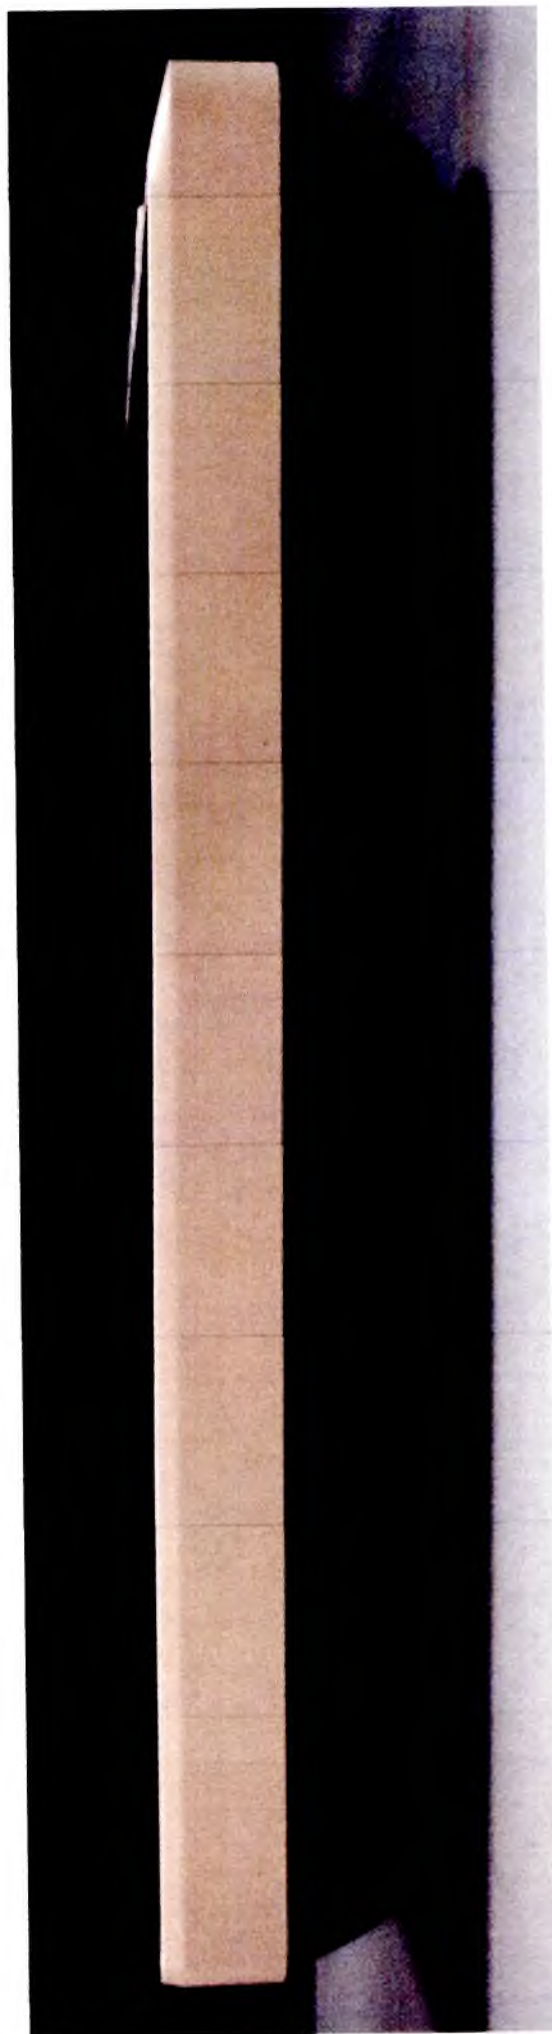


Рисунок 5 – Блок основной iMAC12 (вид сверху).

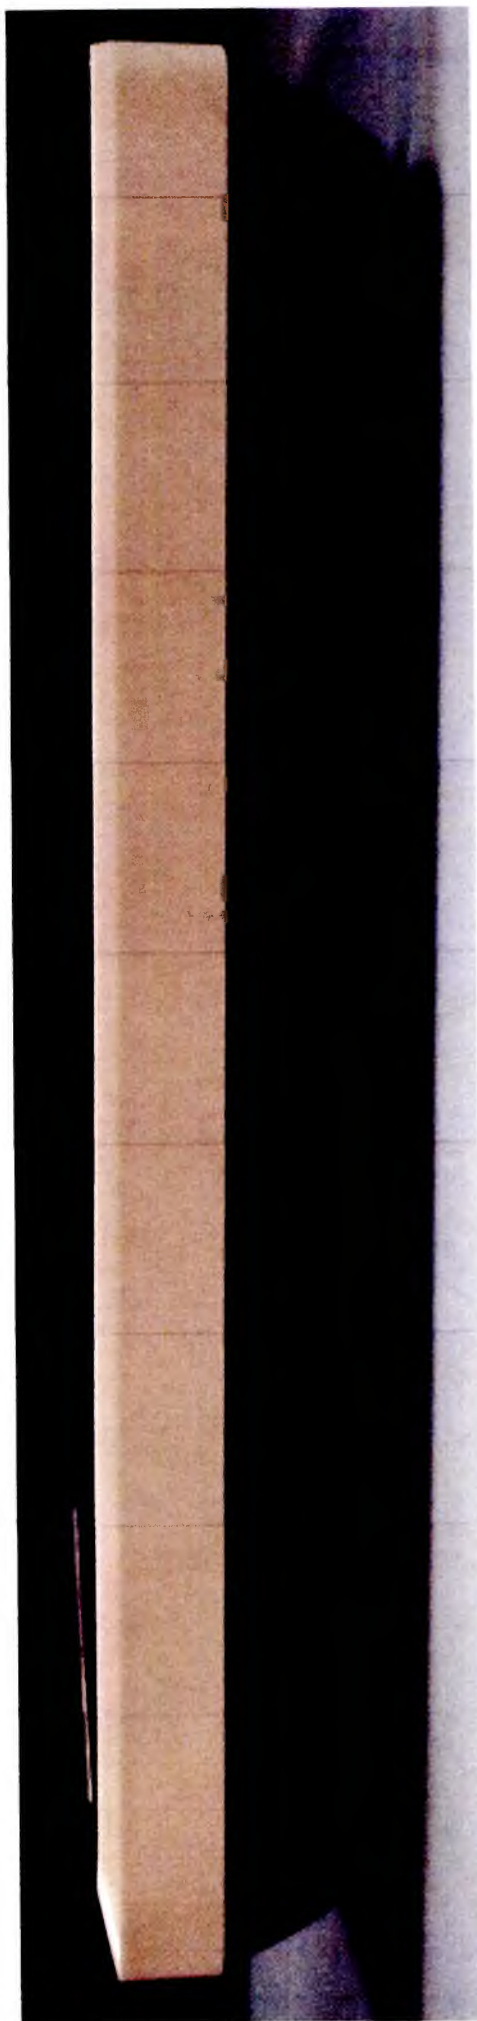


Рисунок 6 – Блок основной iMAC12 (вид снизу).

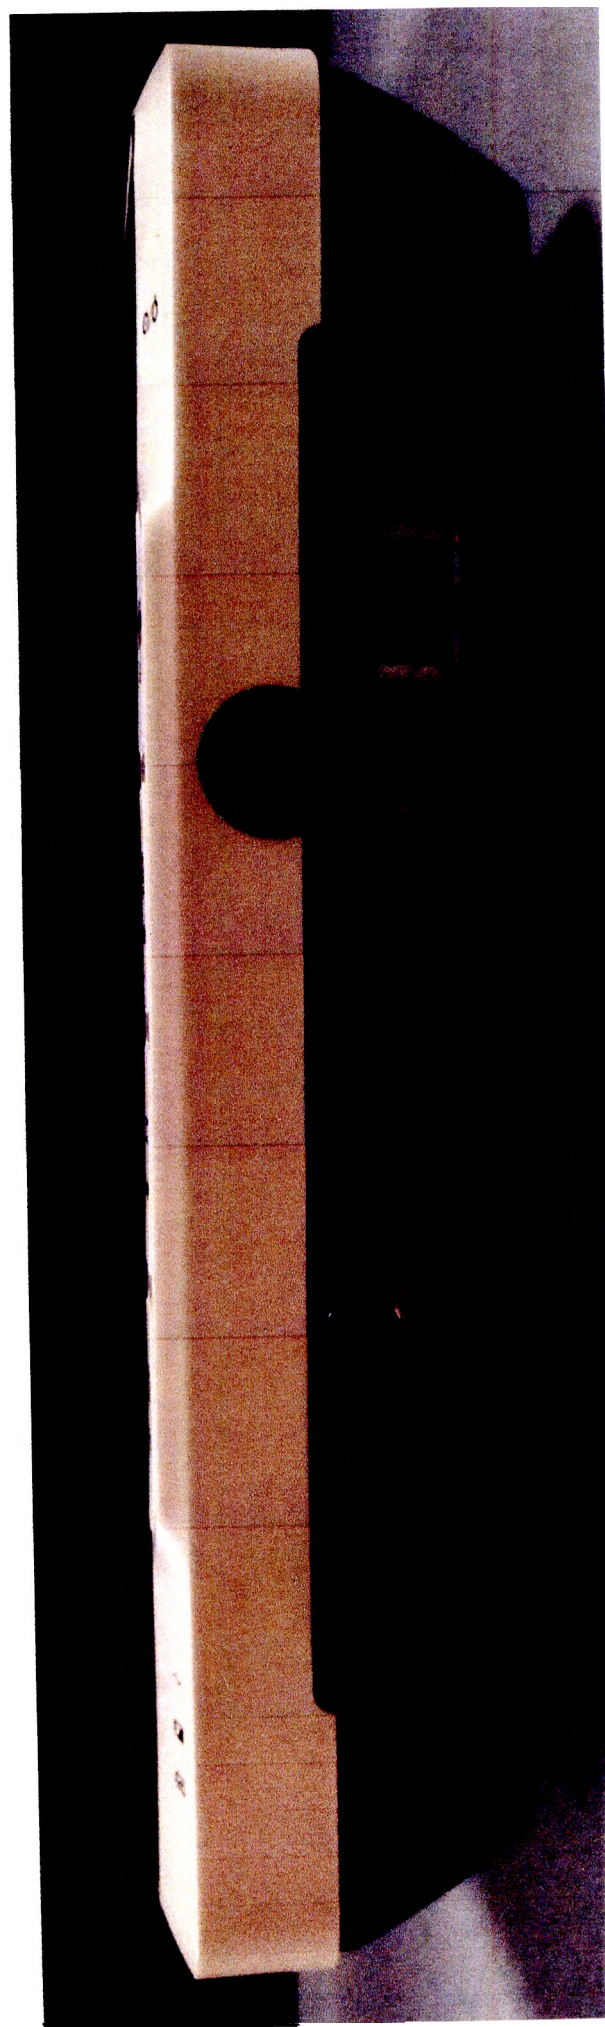


Рисунок 7 – Блок основной iMAC12 (вид справа).

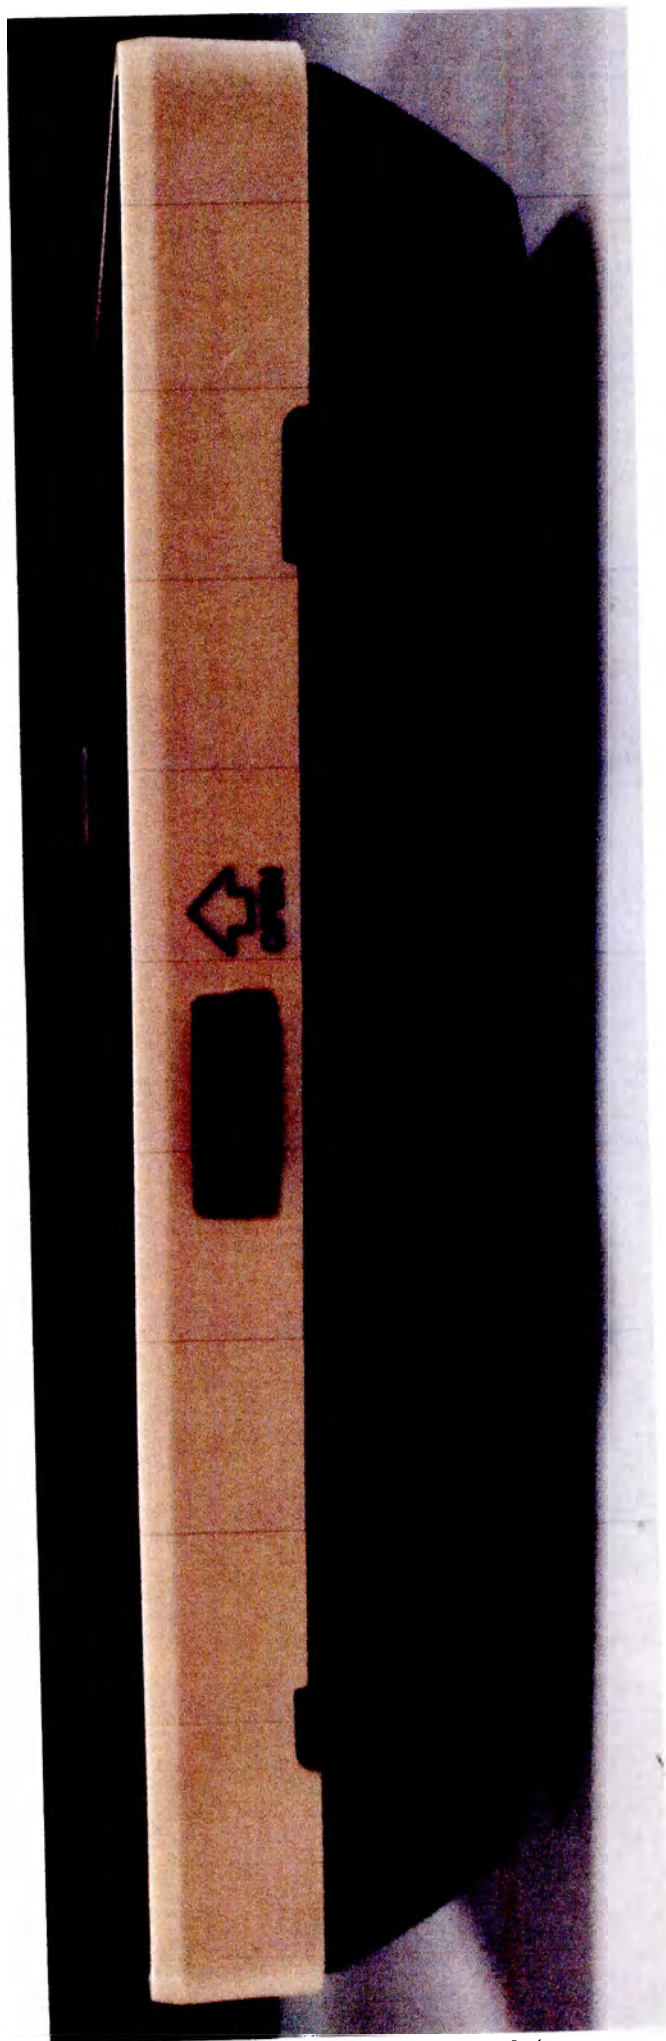


Рисунок 8 – Блок основной iMAC12 (вид слева).

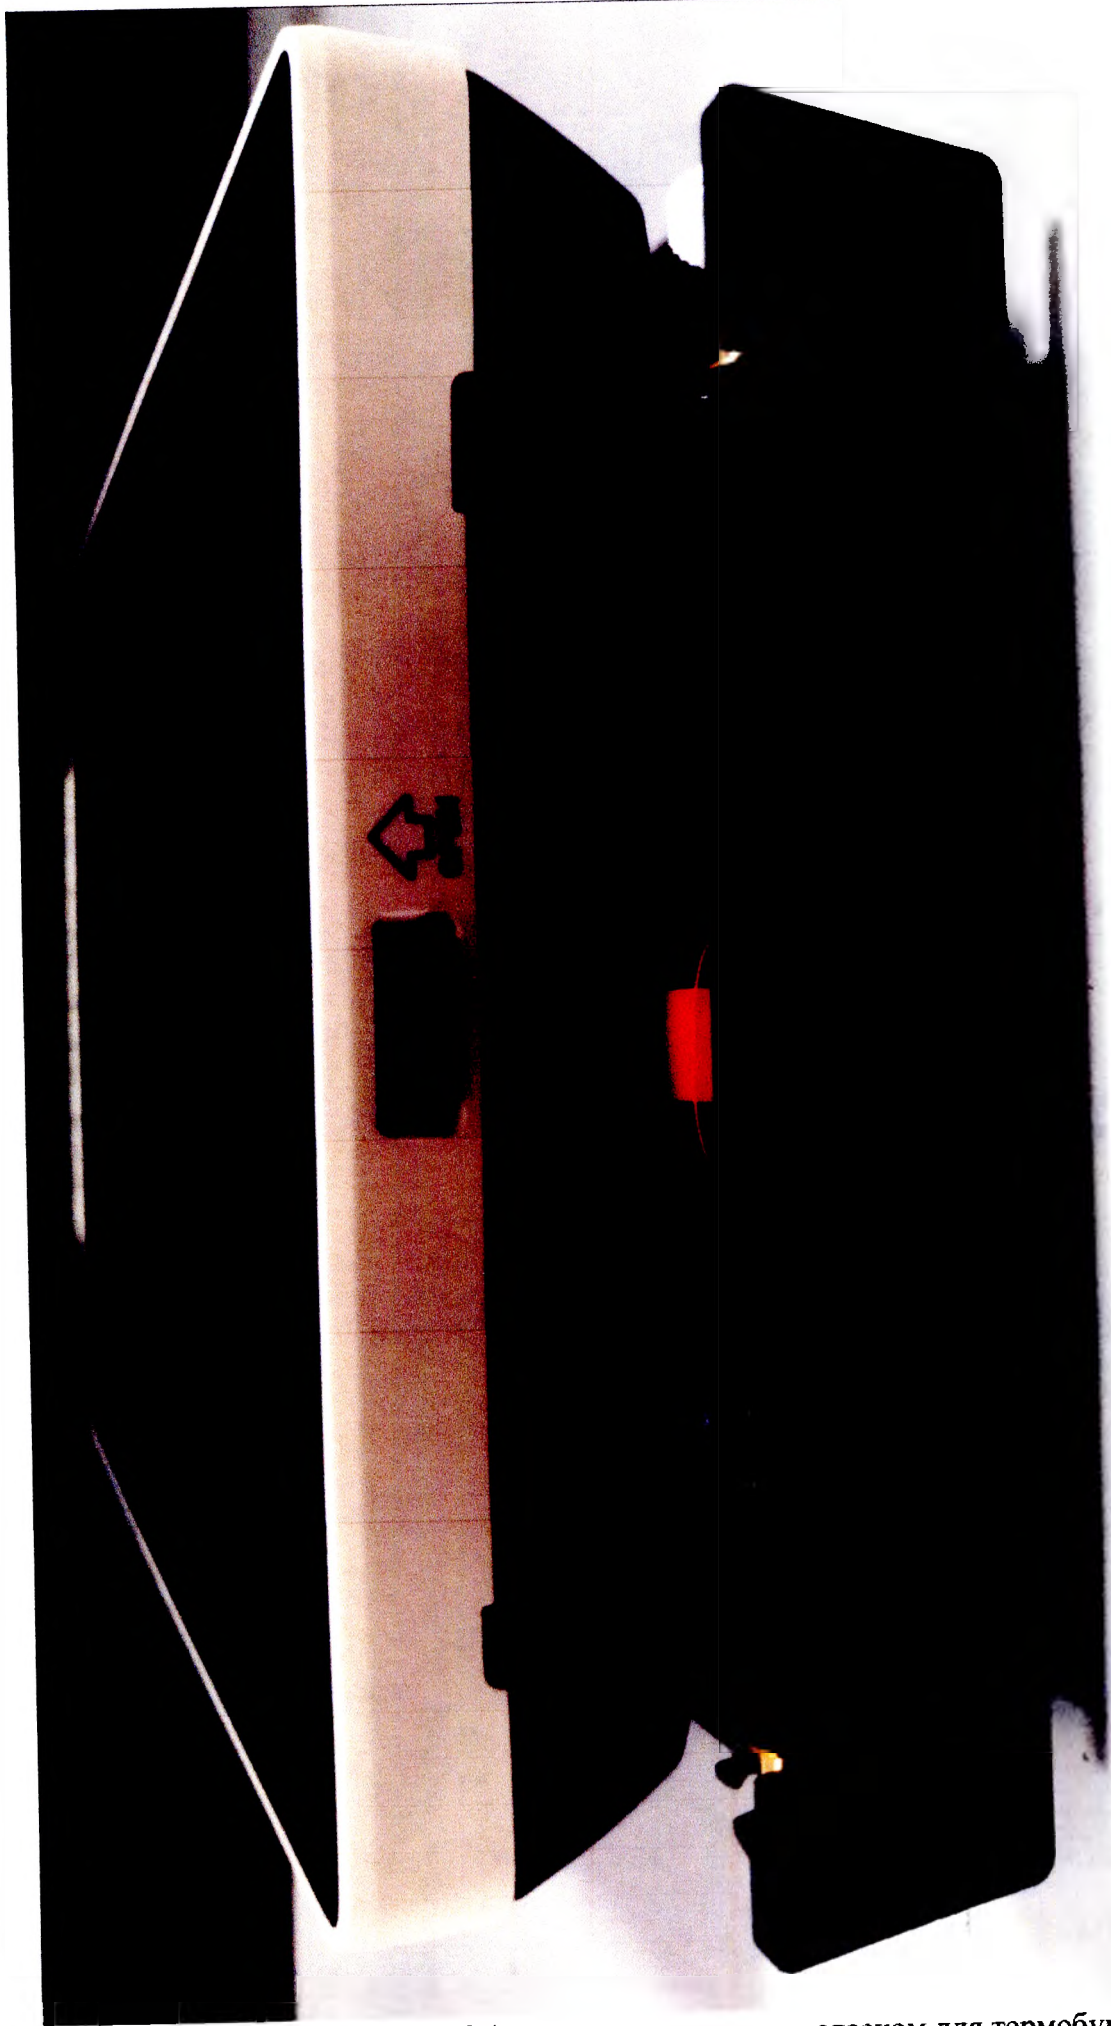


Рисунок 9 – Блок основной iMAC12 (вид слева, с открытым отсеком для термобумаги).

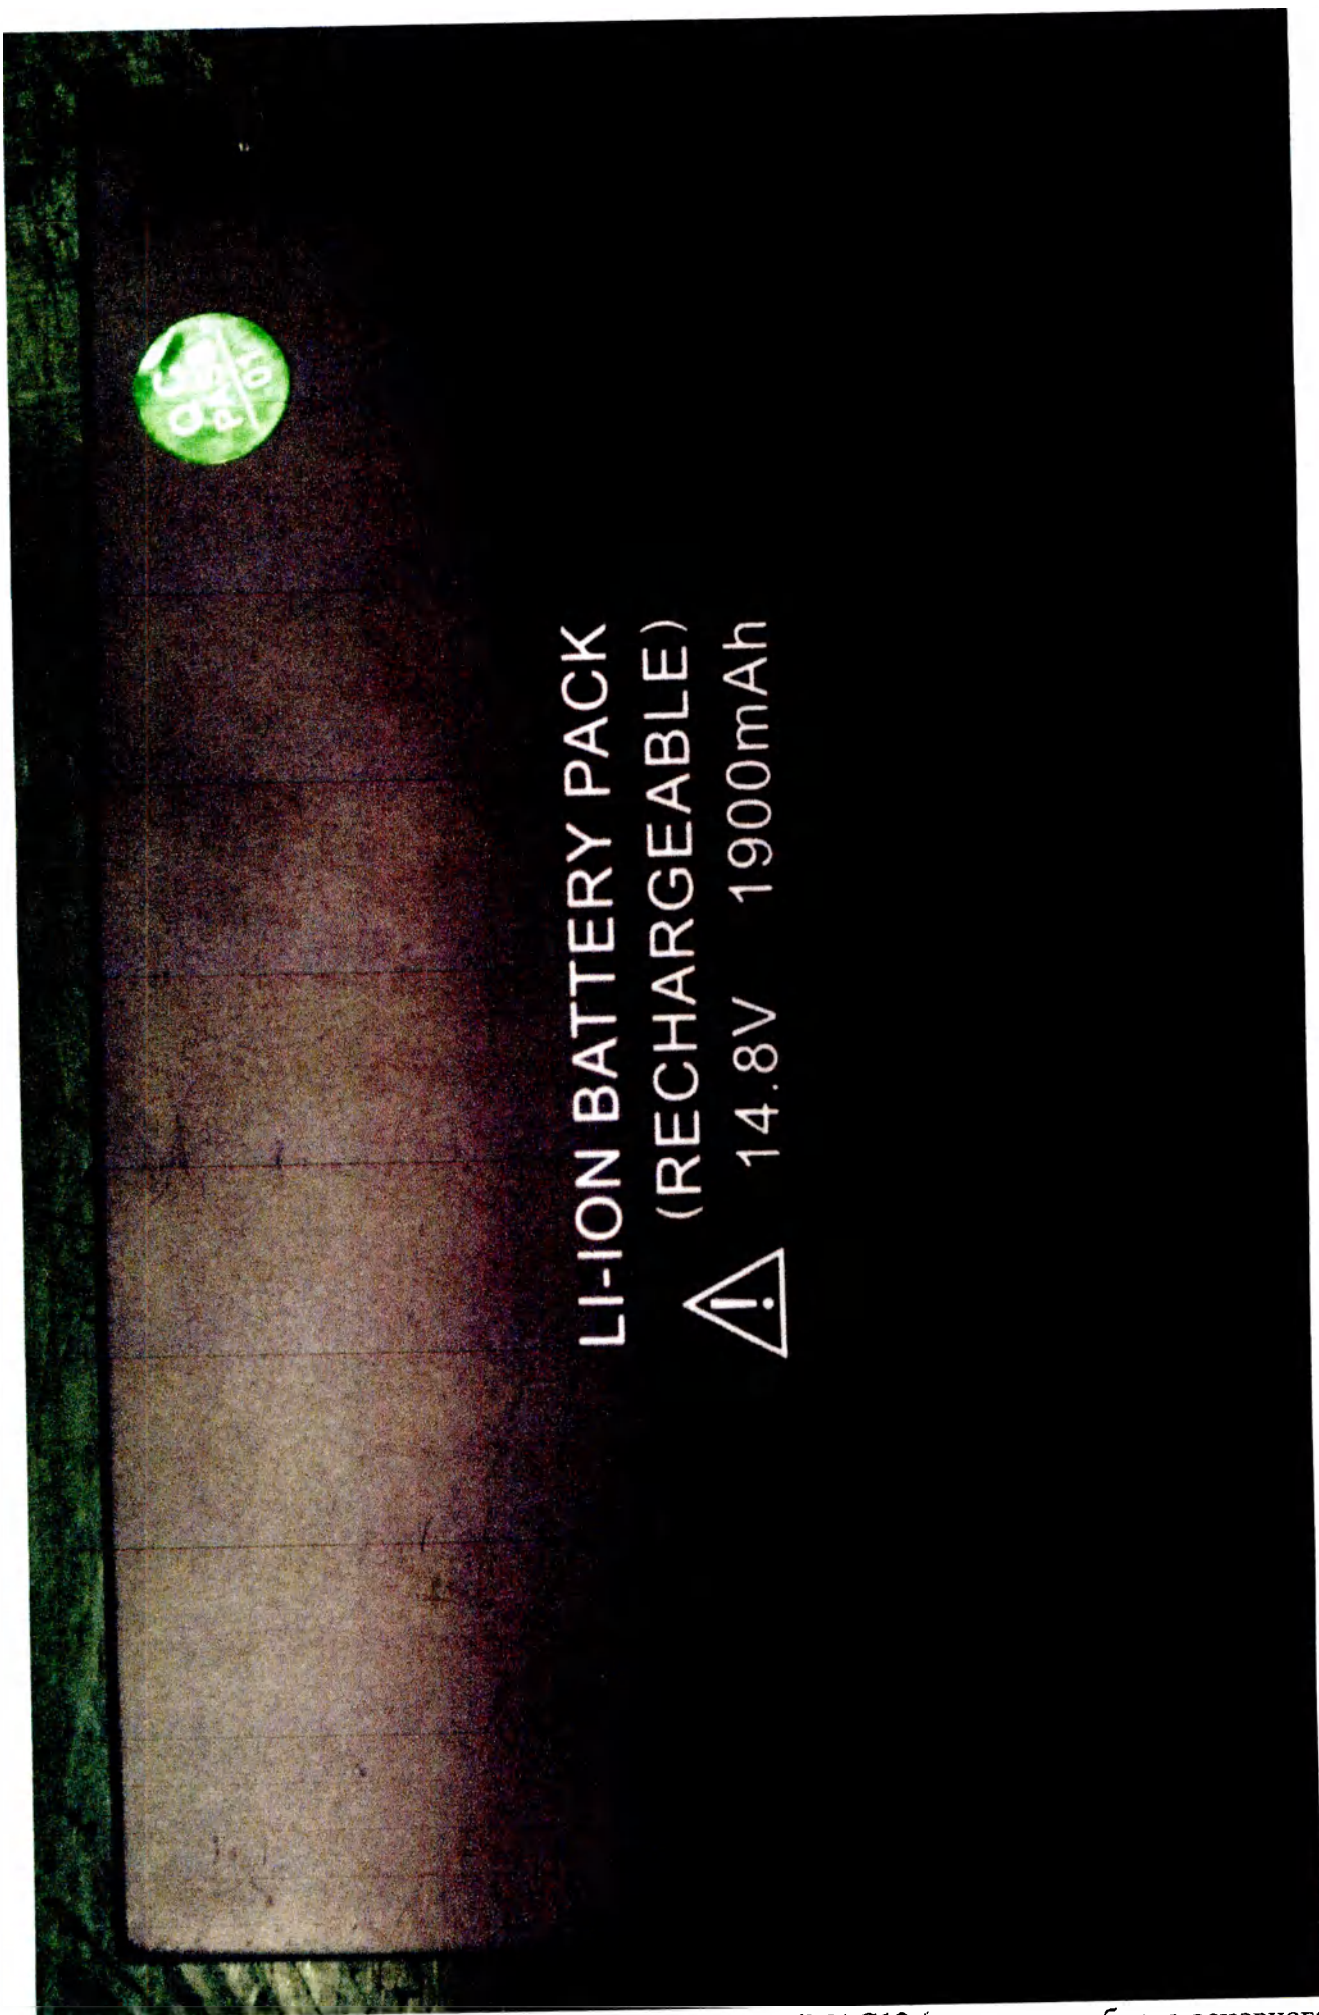


Рисунок 10 – Батарея аккумуляторная блока основного iMAC12 (отдельно от блока основного iMAC12).

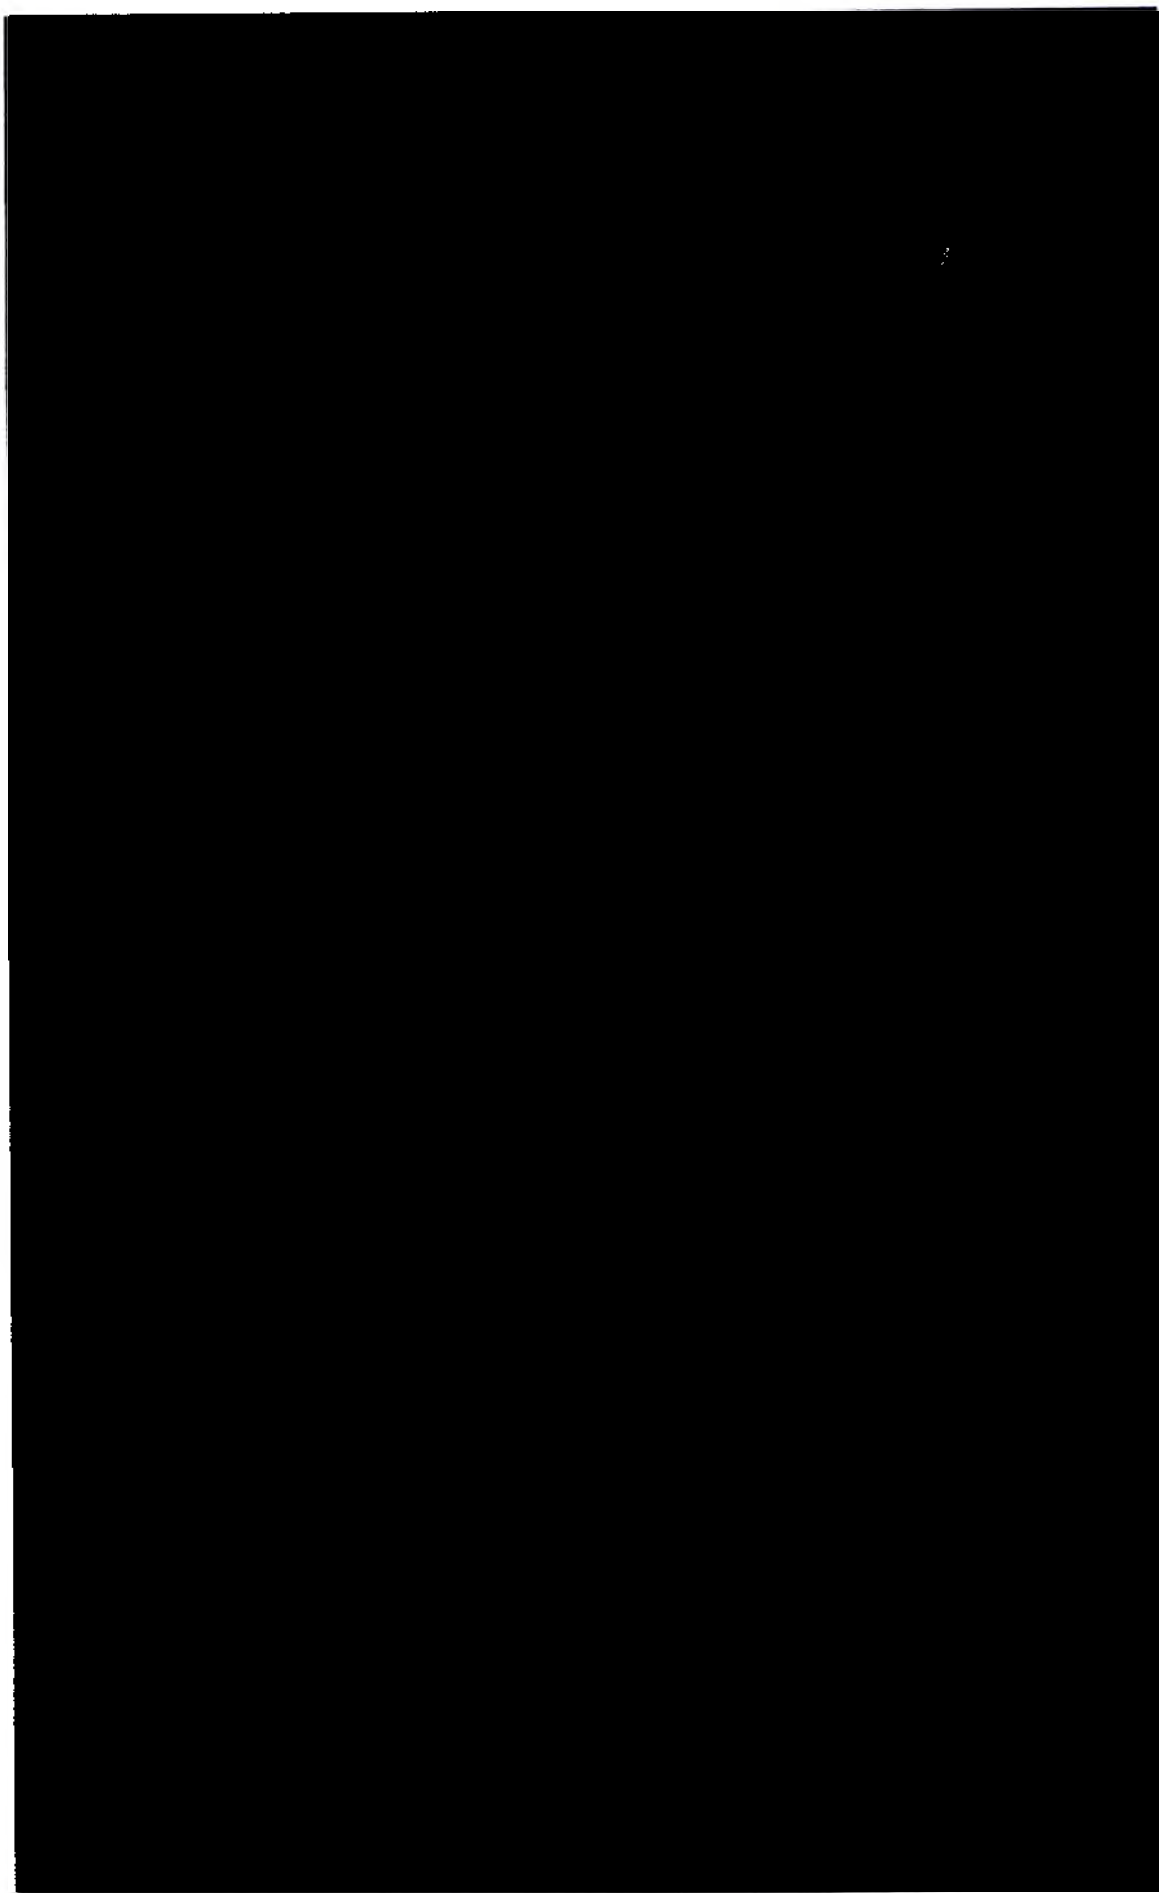


Рисунок 11 – Стилус блока основного iMAC12 (отдельно от блока основного iMAC12).

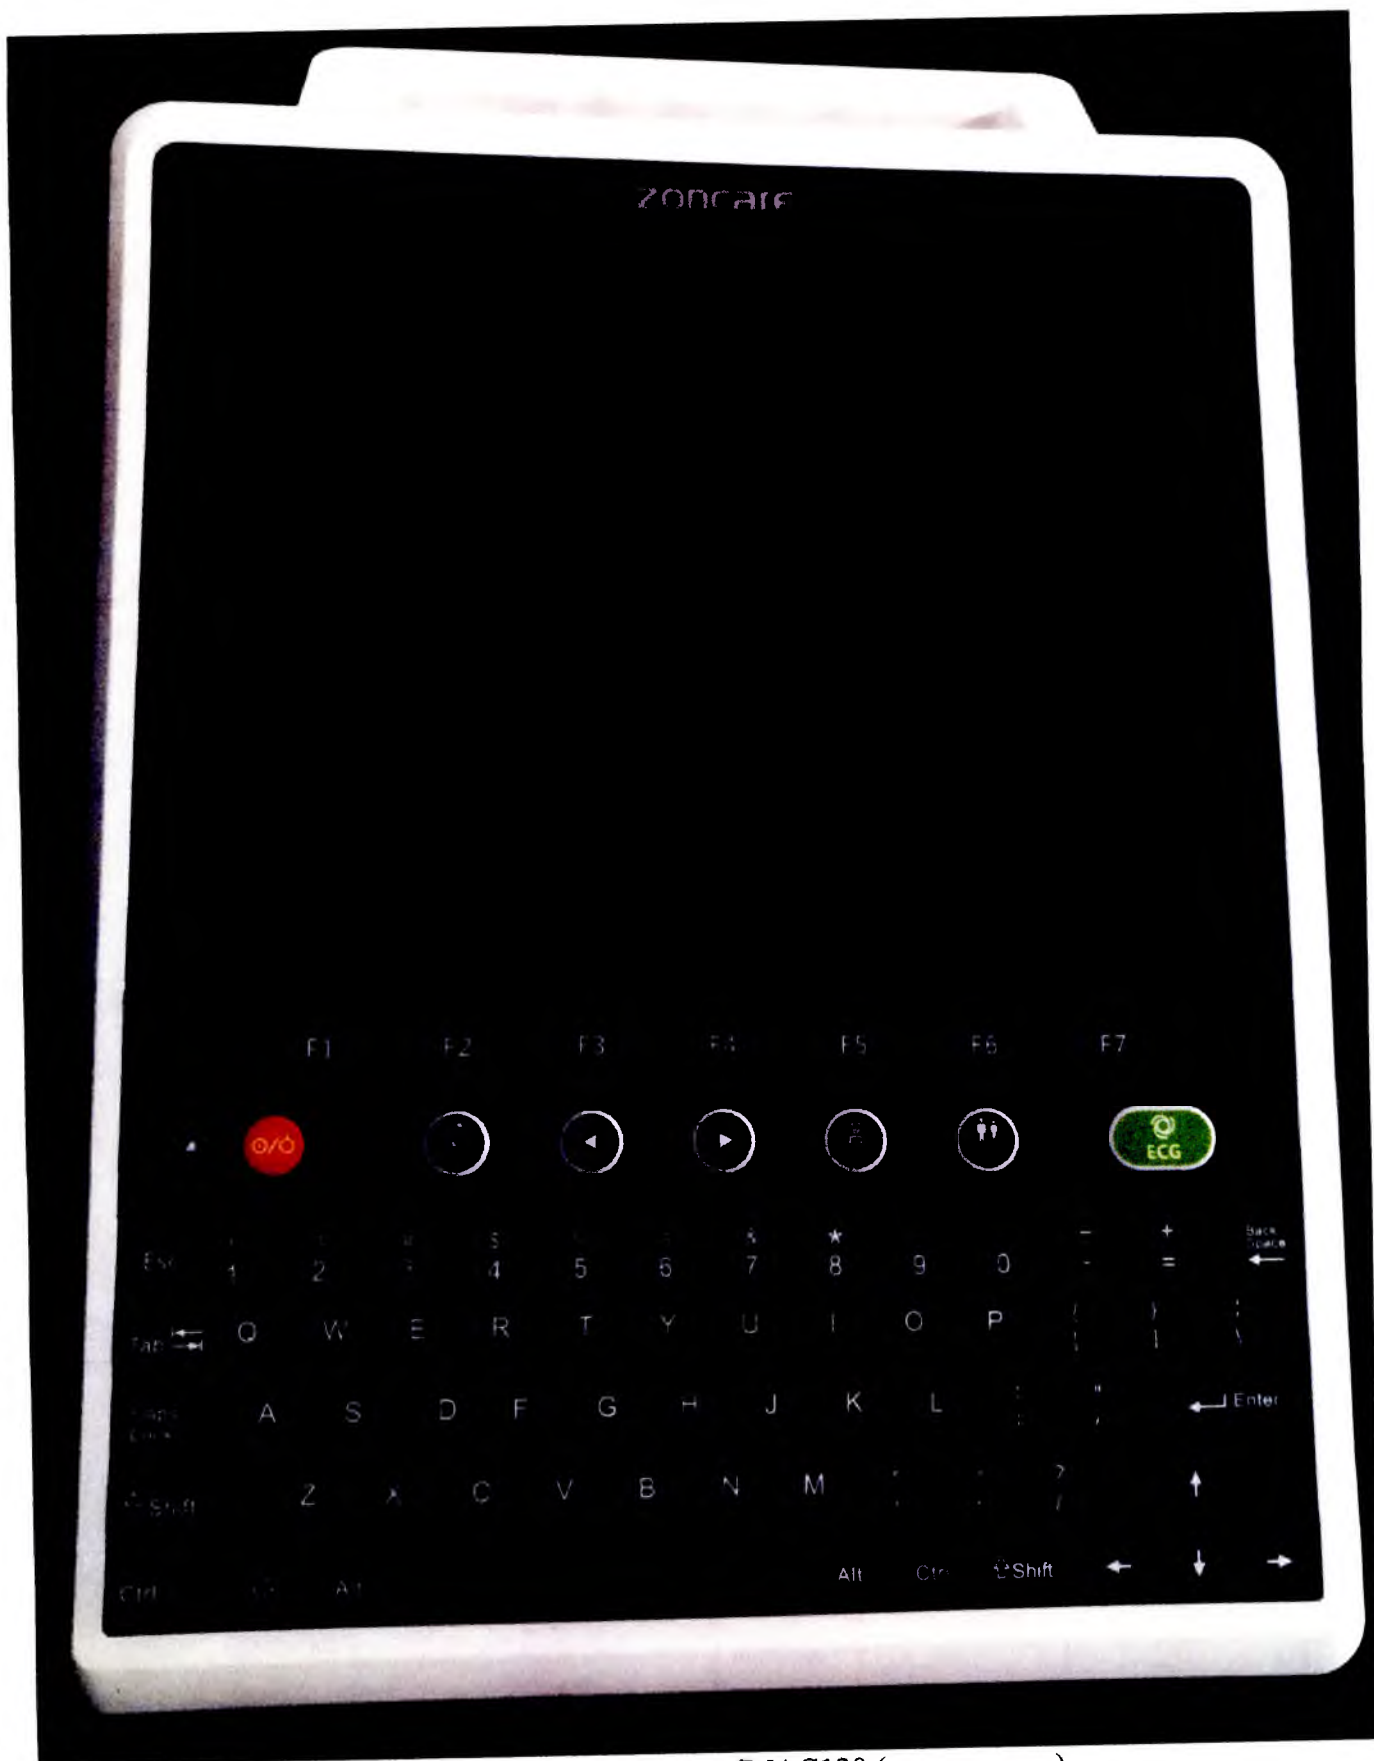


Рисунок 12 – Блок основной iMAC120 (вид спереди).

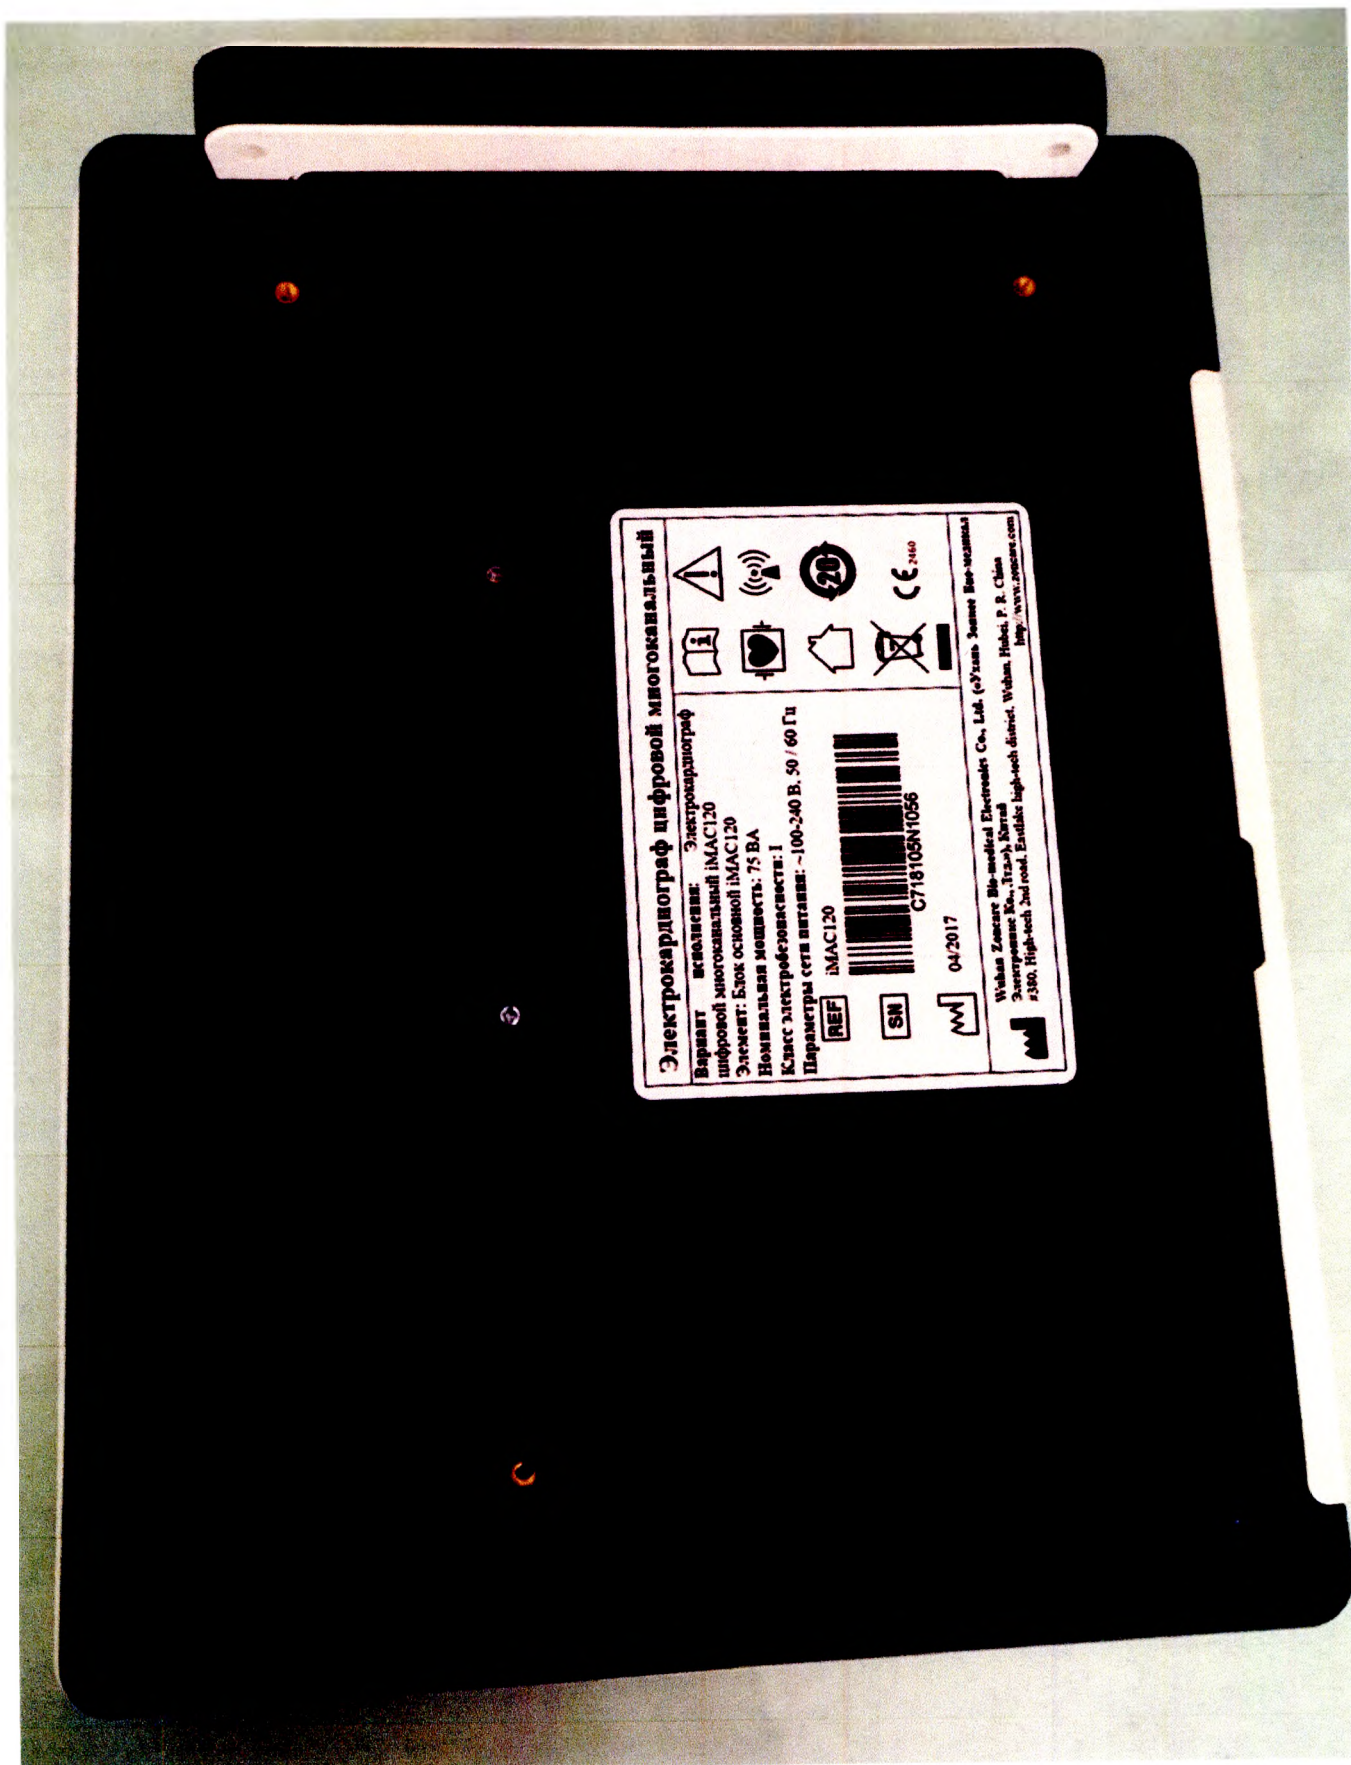


Рисунок 13 – Блок основной iMAC120 (вид сзади).

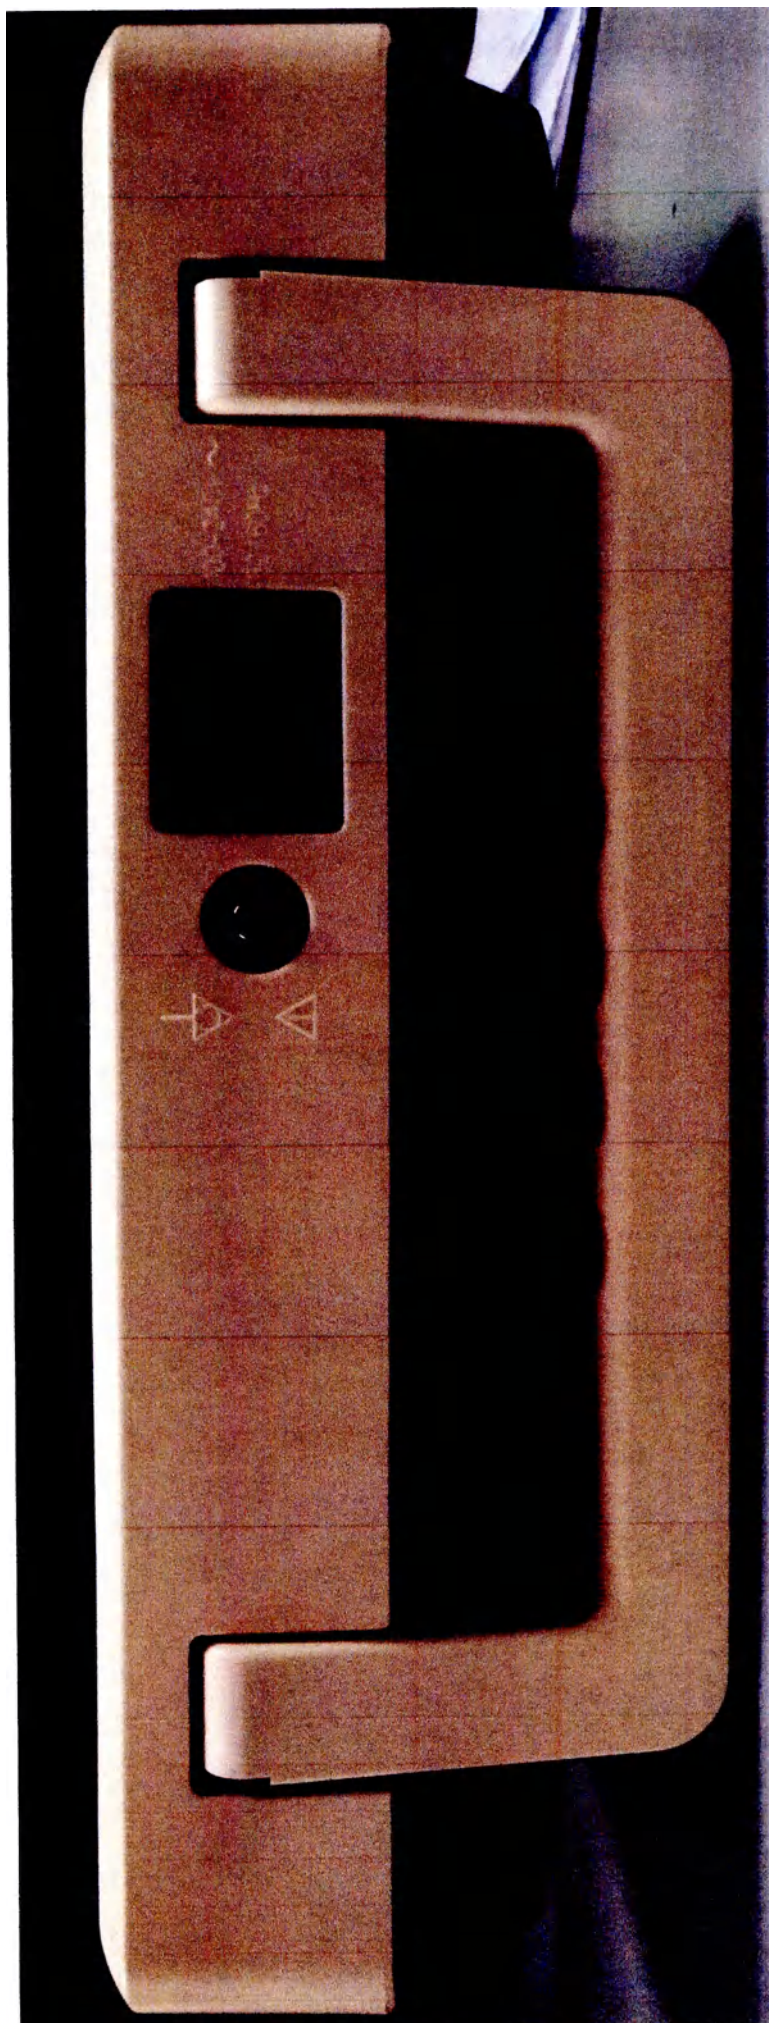


Рисунок 14 – Блок основной iMAC120 (вид сверху).

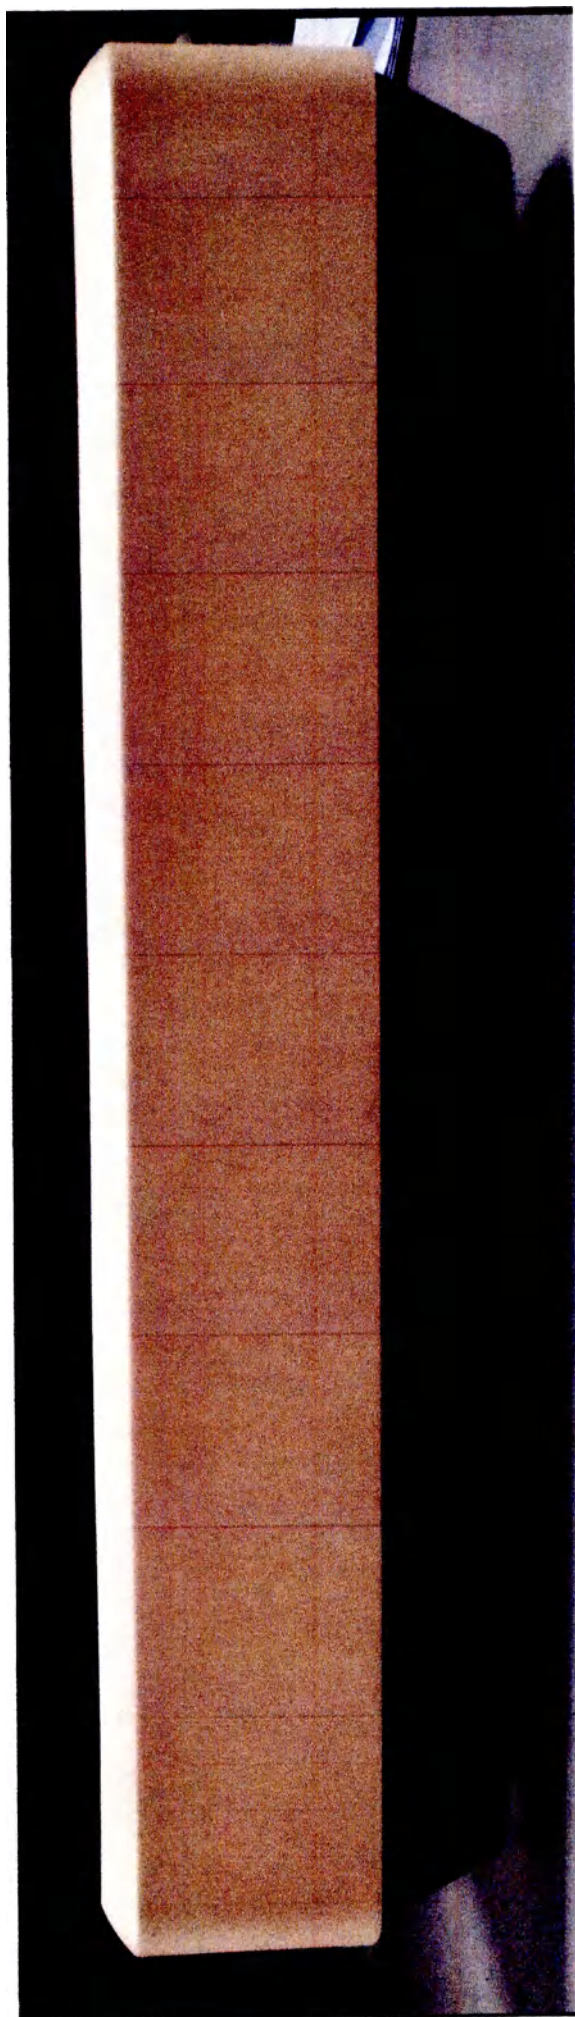


Рисунок 15 – Блок основной iMAC120 (вид слева).

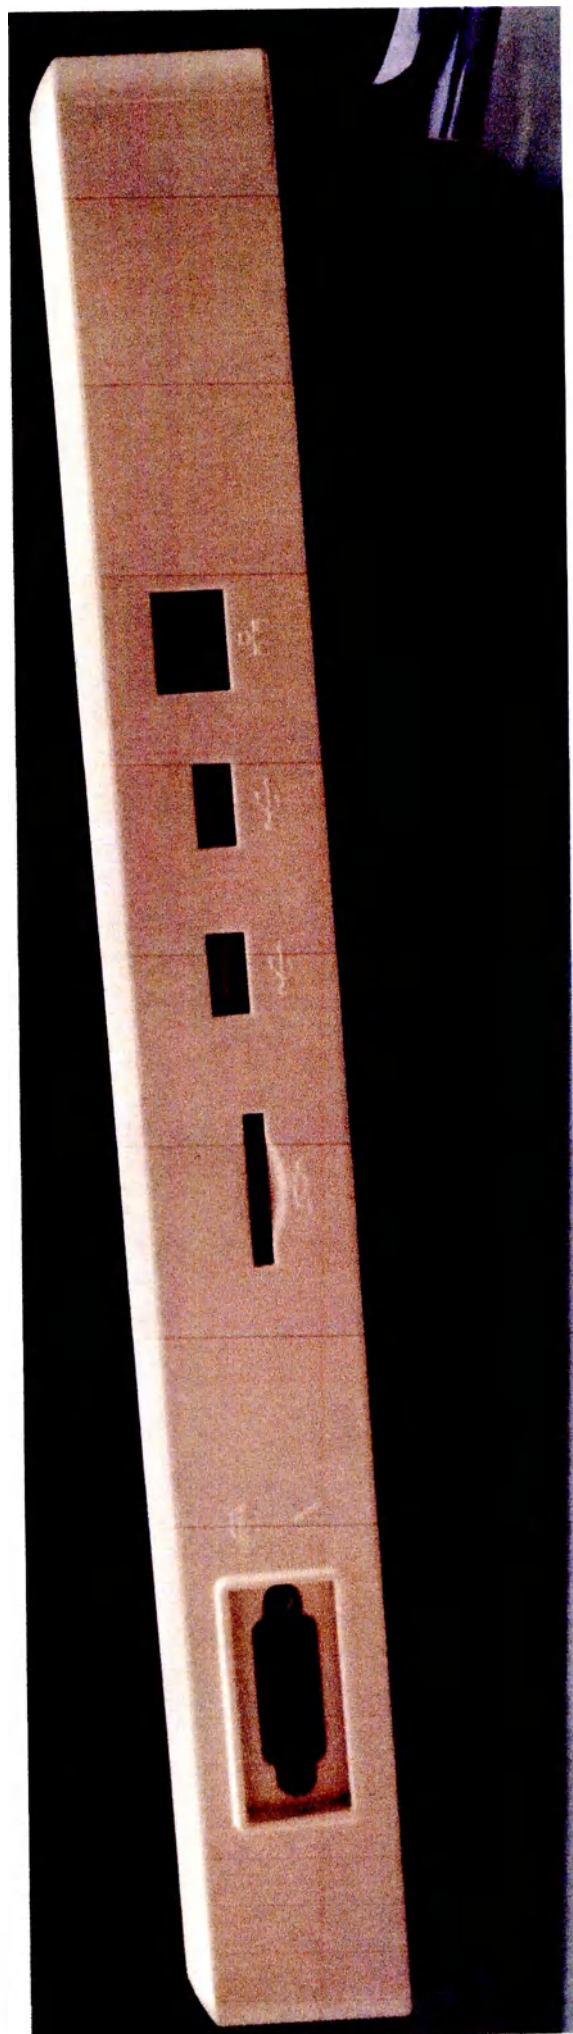


Рисунок 16 – Блок основной iMAC120 (вид слева).

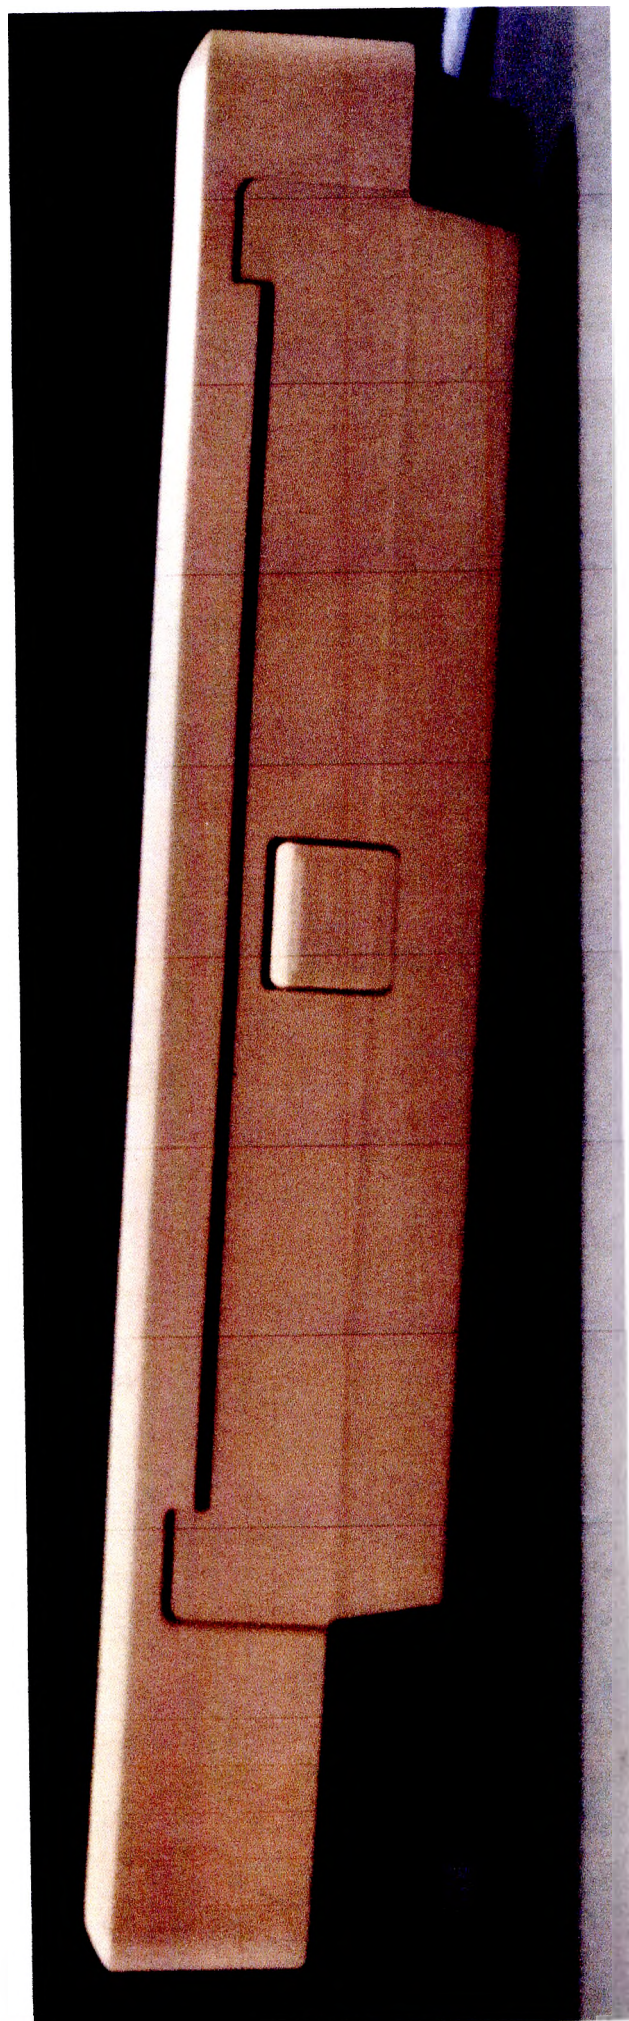


Рисунок 17 – Блок основной iMAC120 (вид слева).



Рисунок 18 – Блок основной iMAC120 (вид слева).

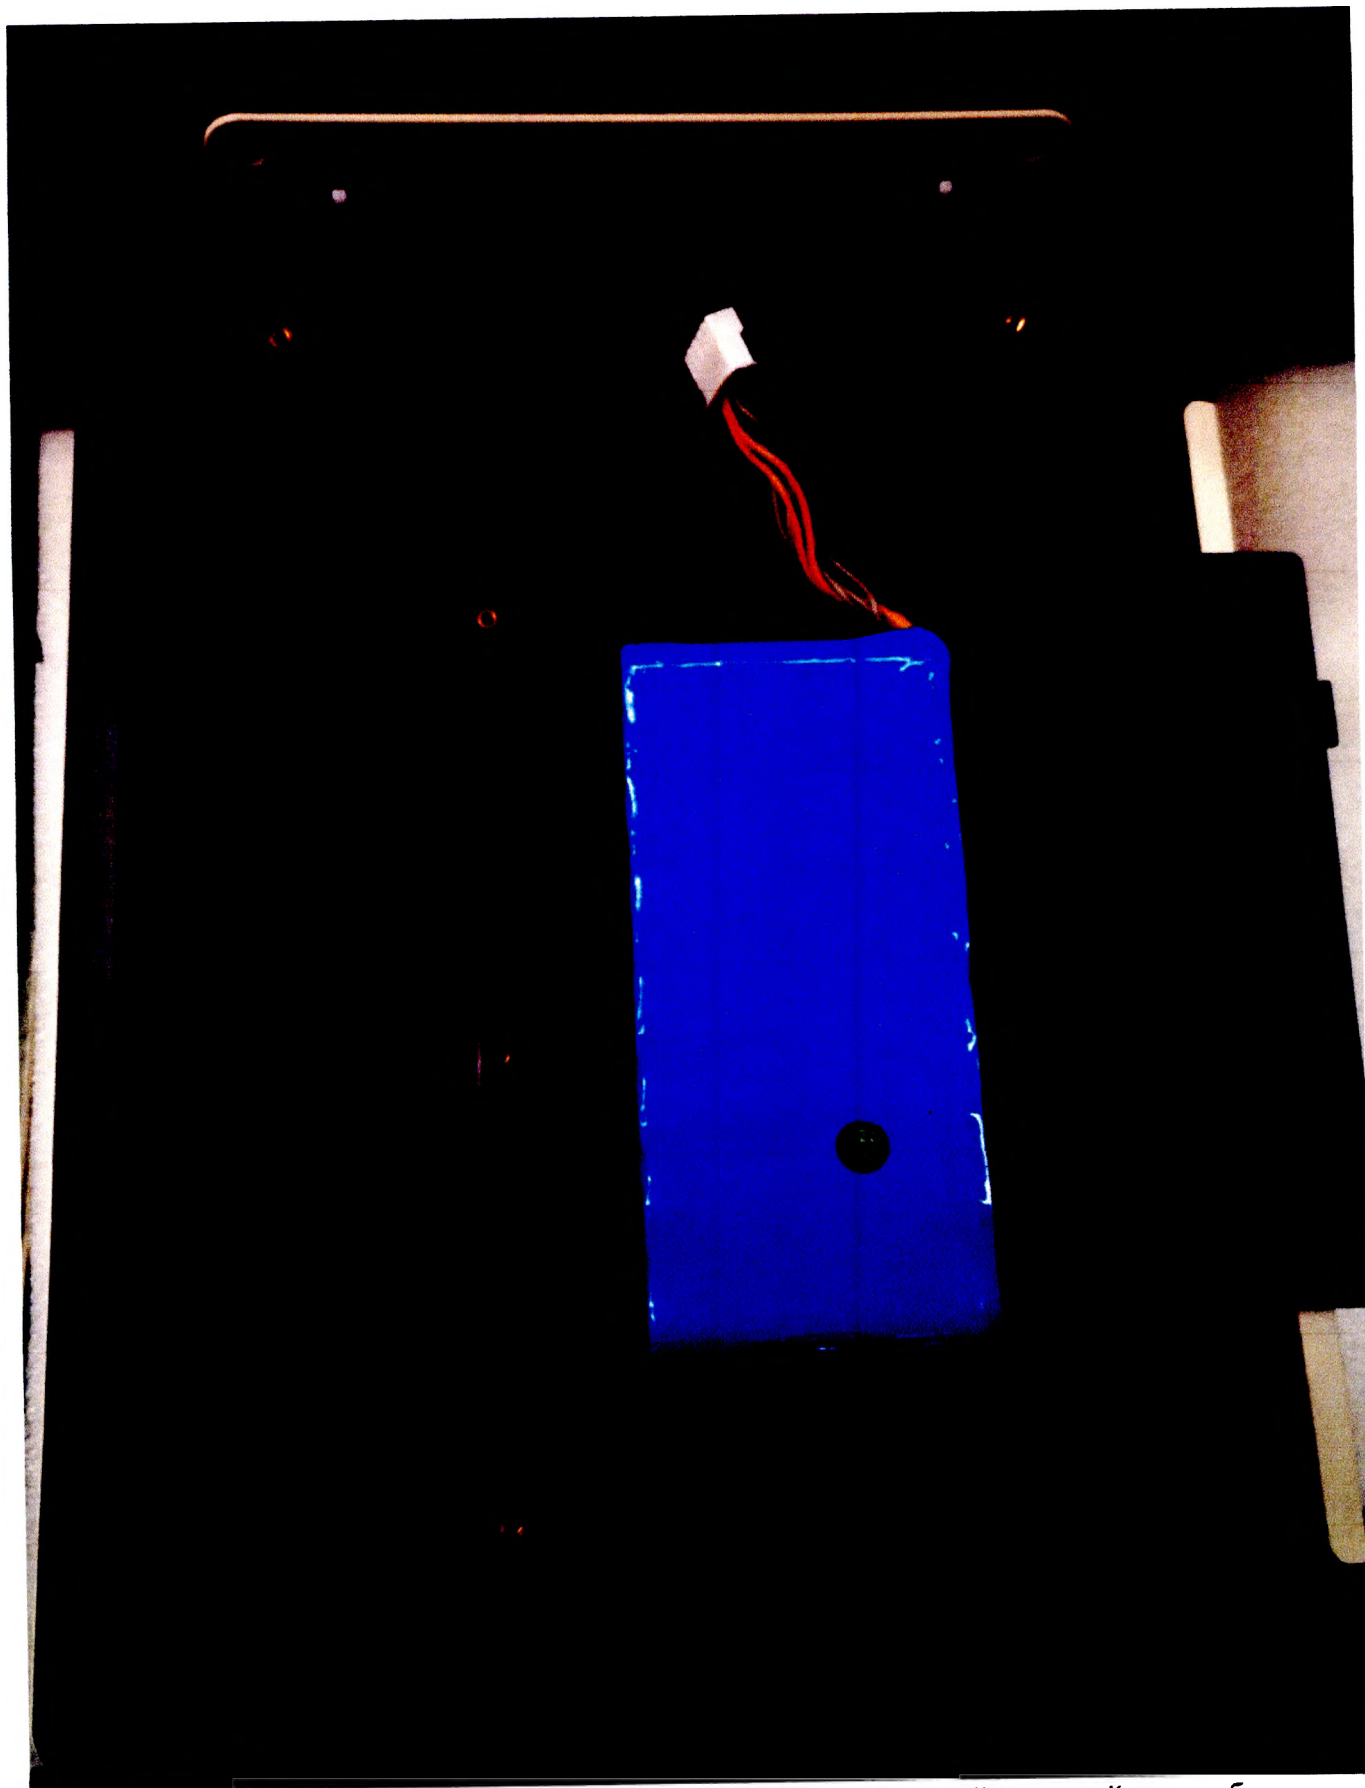
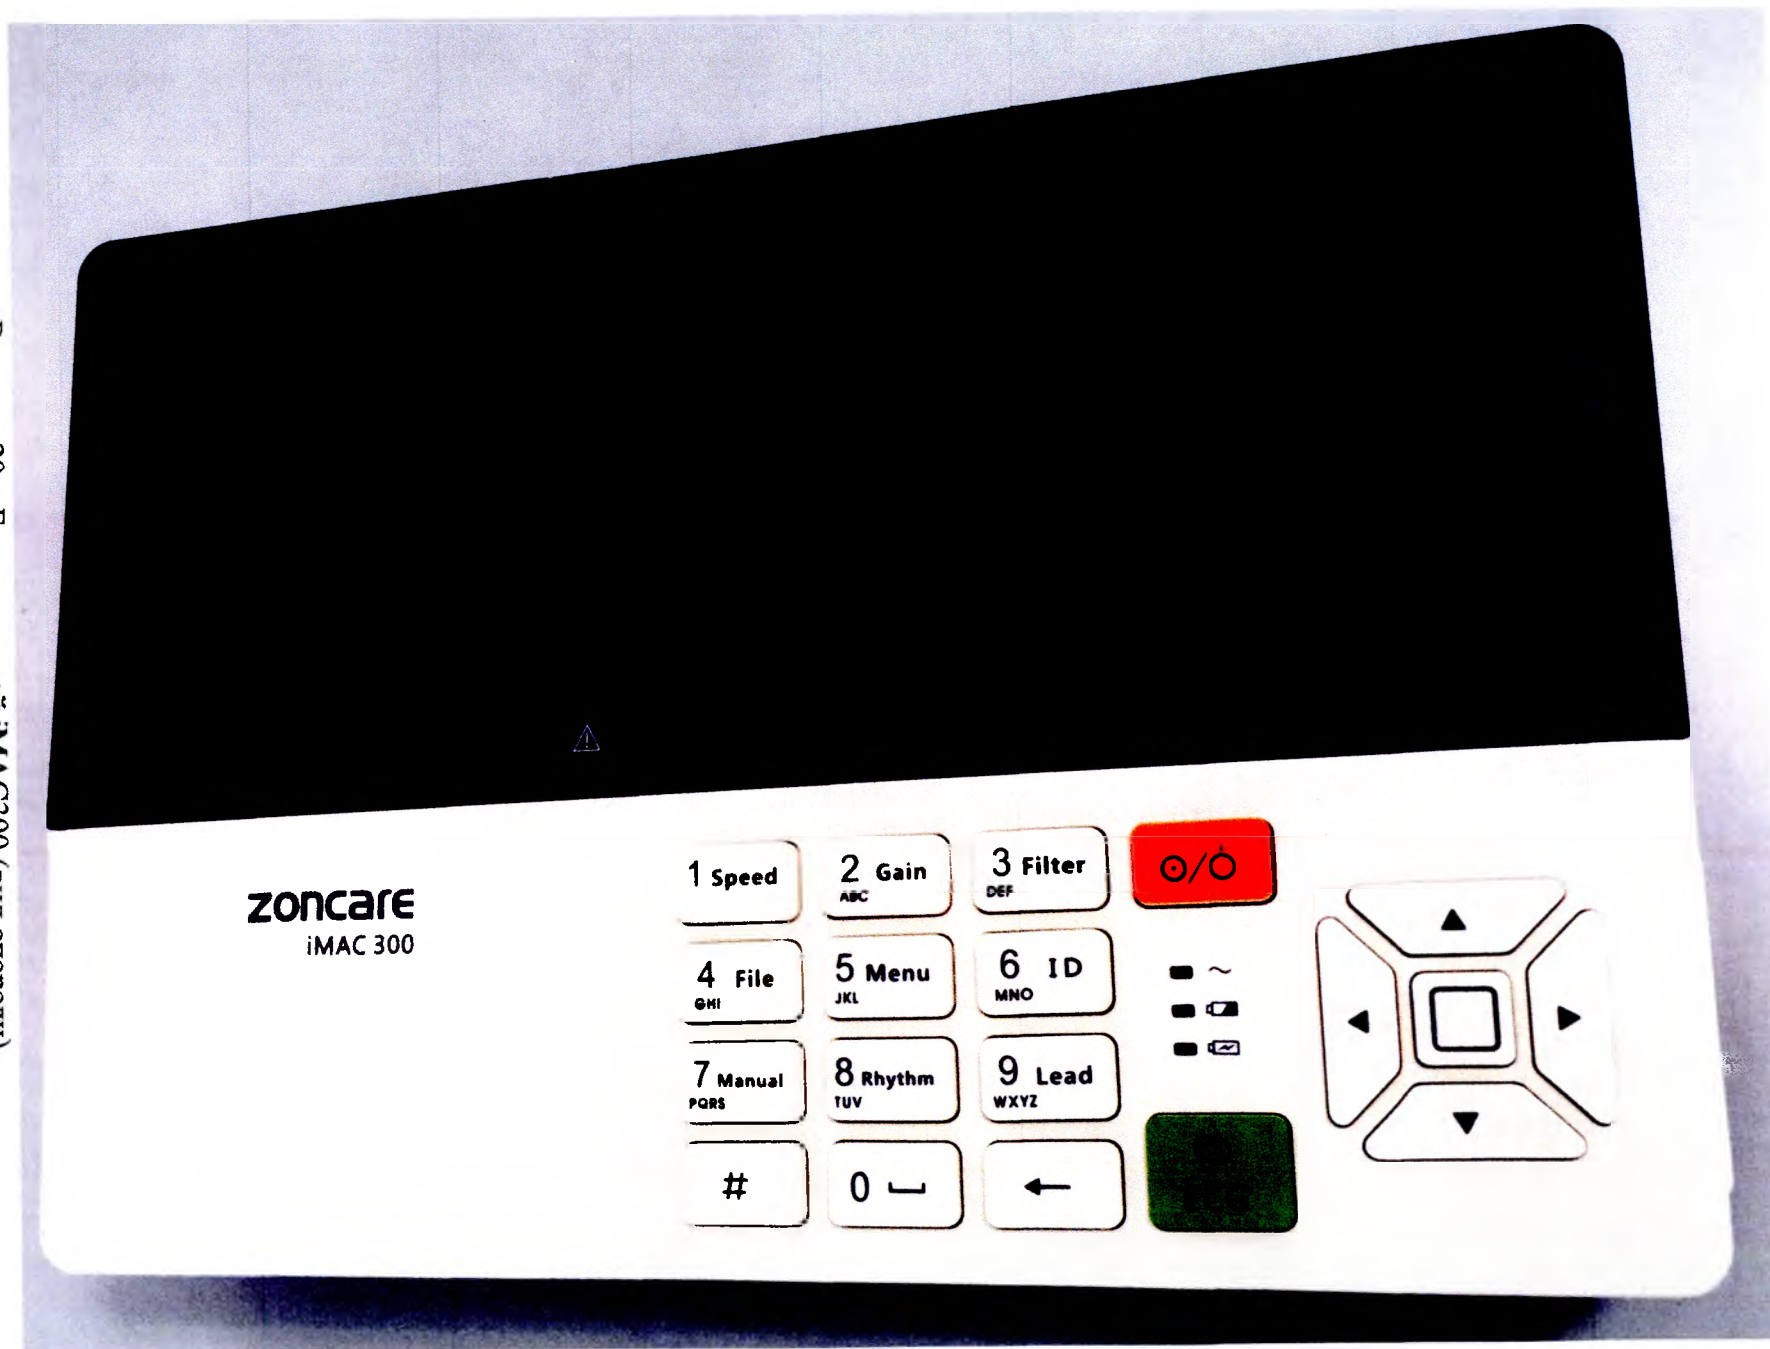


Рисунок 19 – Блок основной iMAC120 (вид сзади, с отсоединенной крышкой отсека батареи аккумуляторной, с отсоединенной батареей аккумуляторной).

Рисунок 20 – Блок основной iMAC300 (вид спереди).



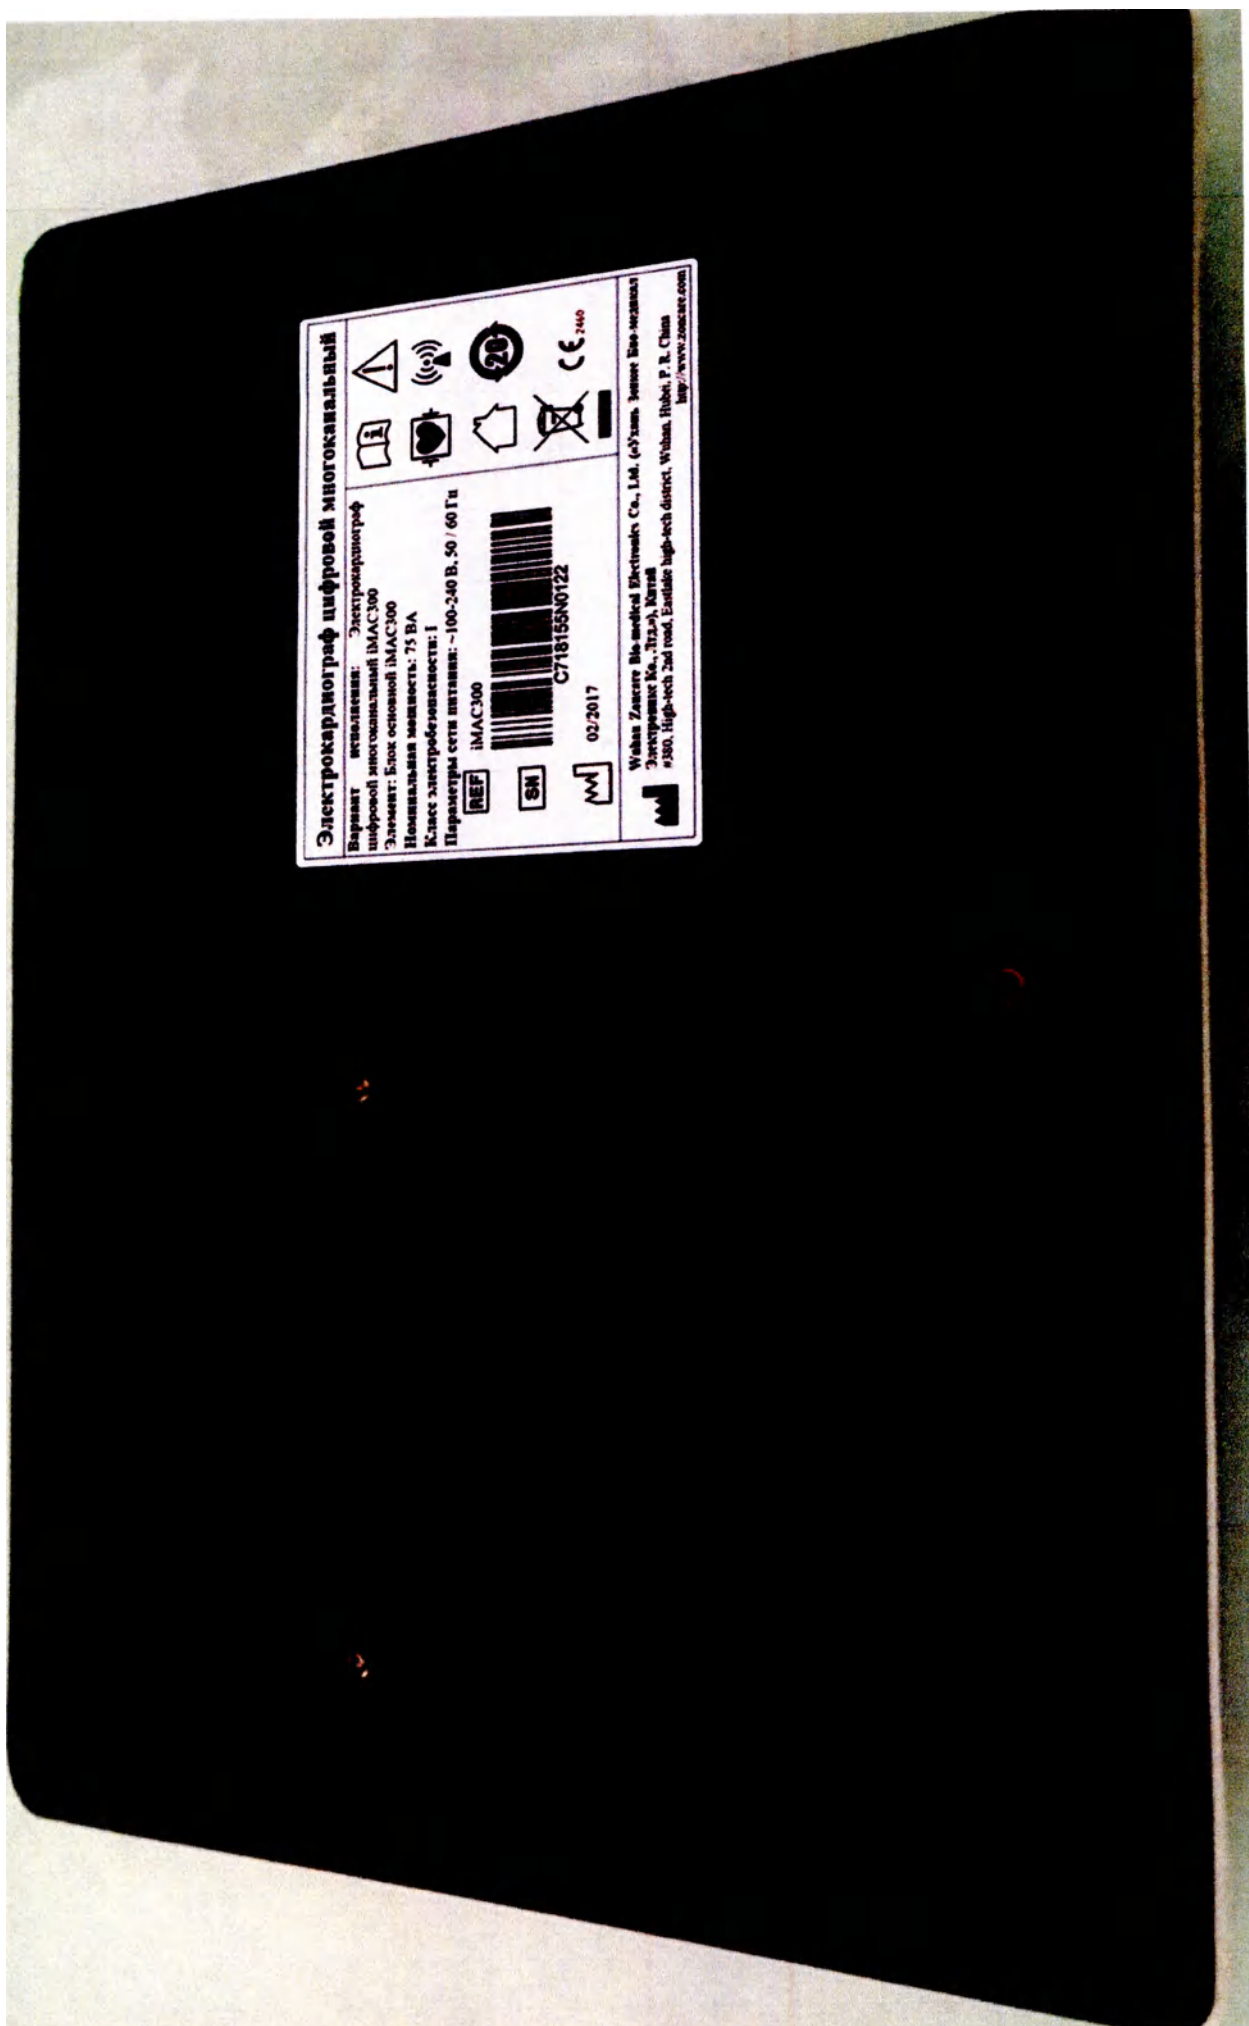


Рисунок 21 – Блок основной iMAC300 (вид сзади).

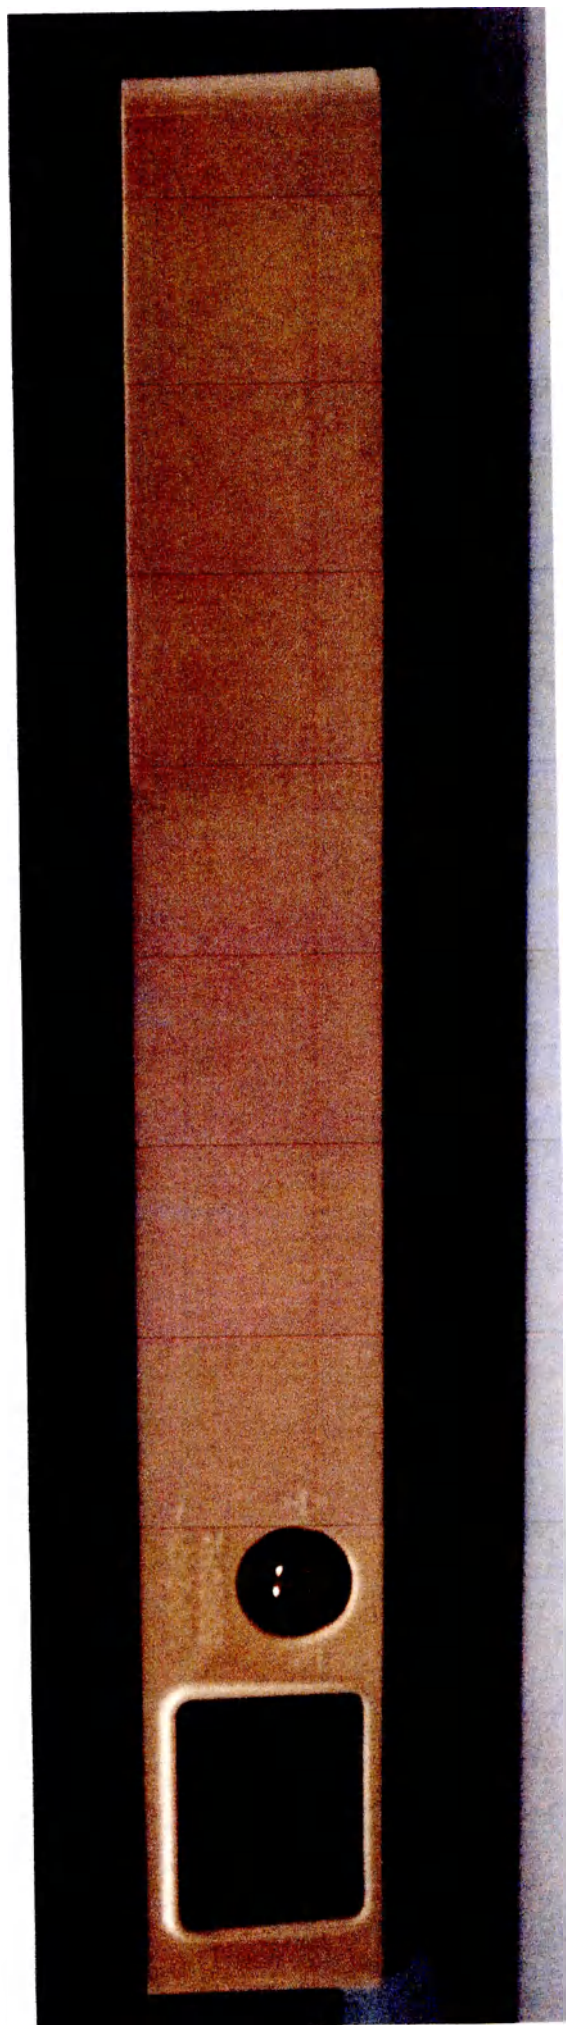


Рисунок 22 – Блок основной iMAC300 (вид сверху).

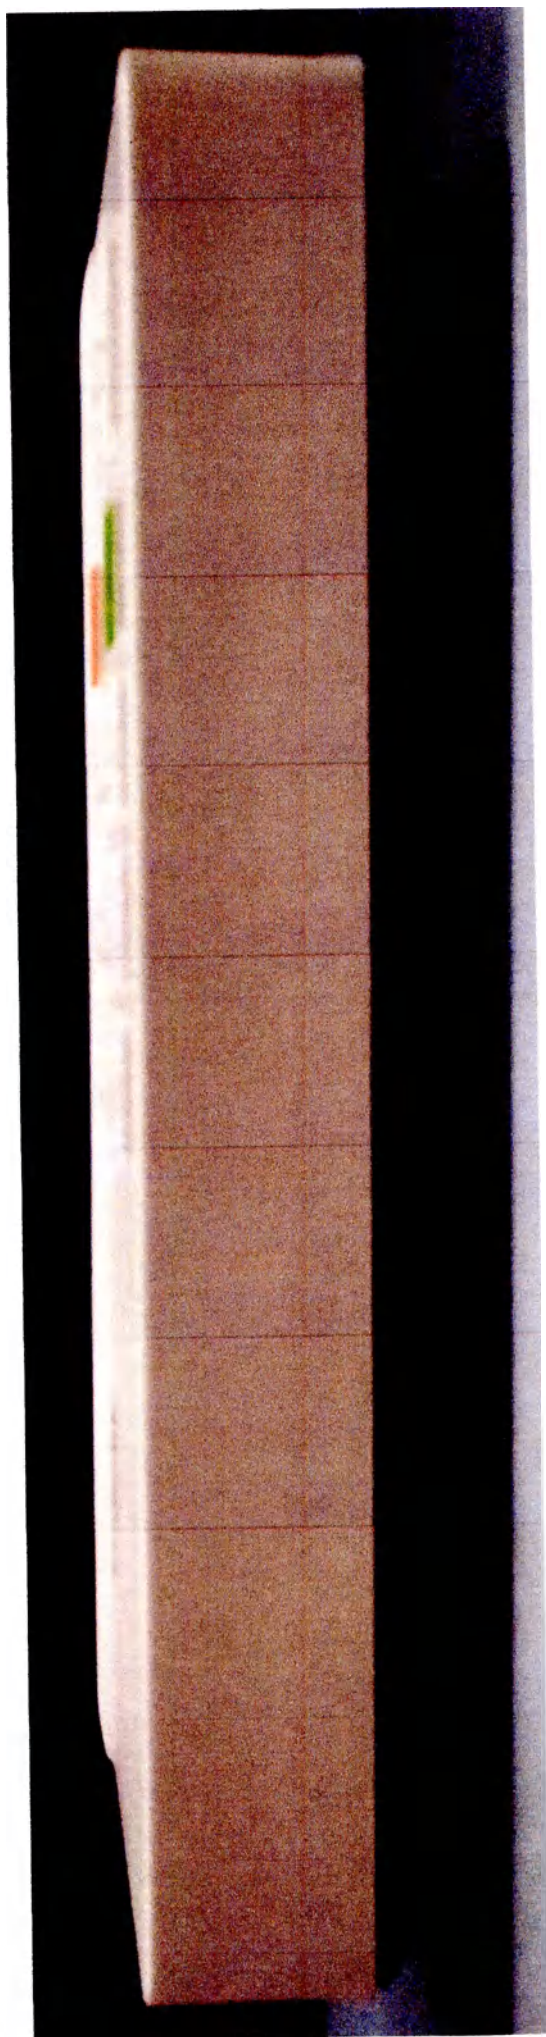


Рисунок 23 – Блок основной iMAC300 (вид снизу).

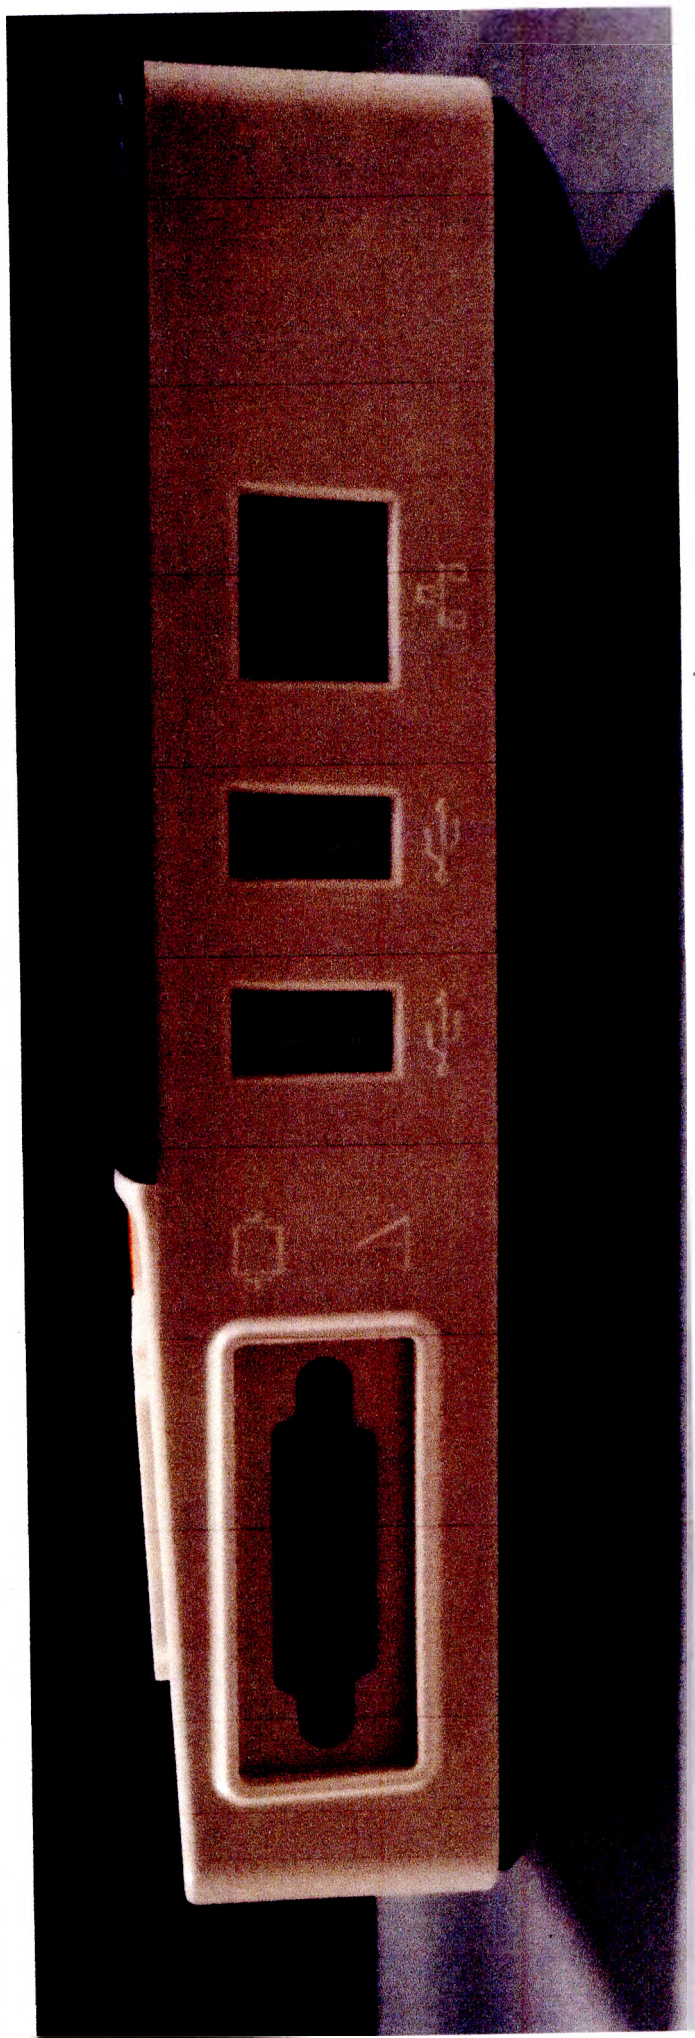


Рисунок 24 – Блок основной iMAC300 (вид справа).

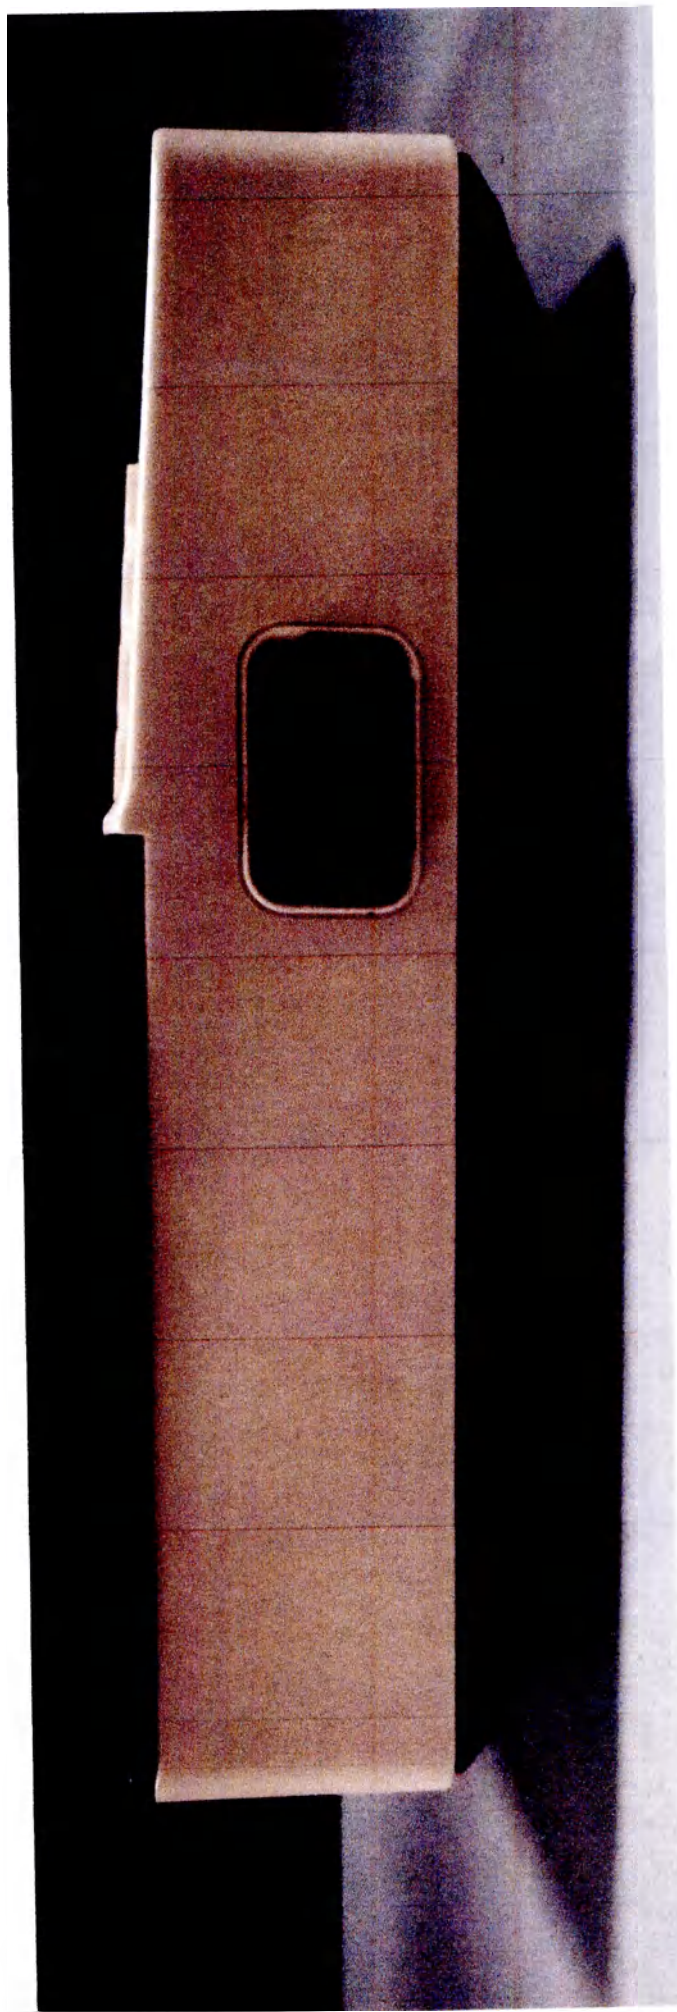


Рисунок 25 – Блок основной iMAC300 (вид слева).

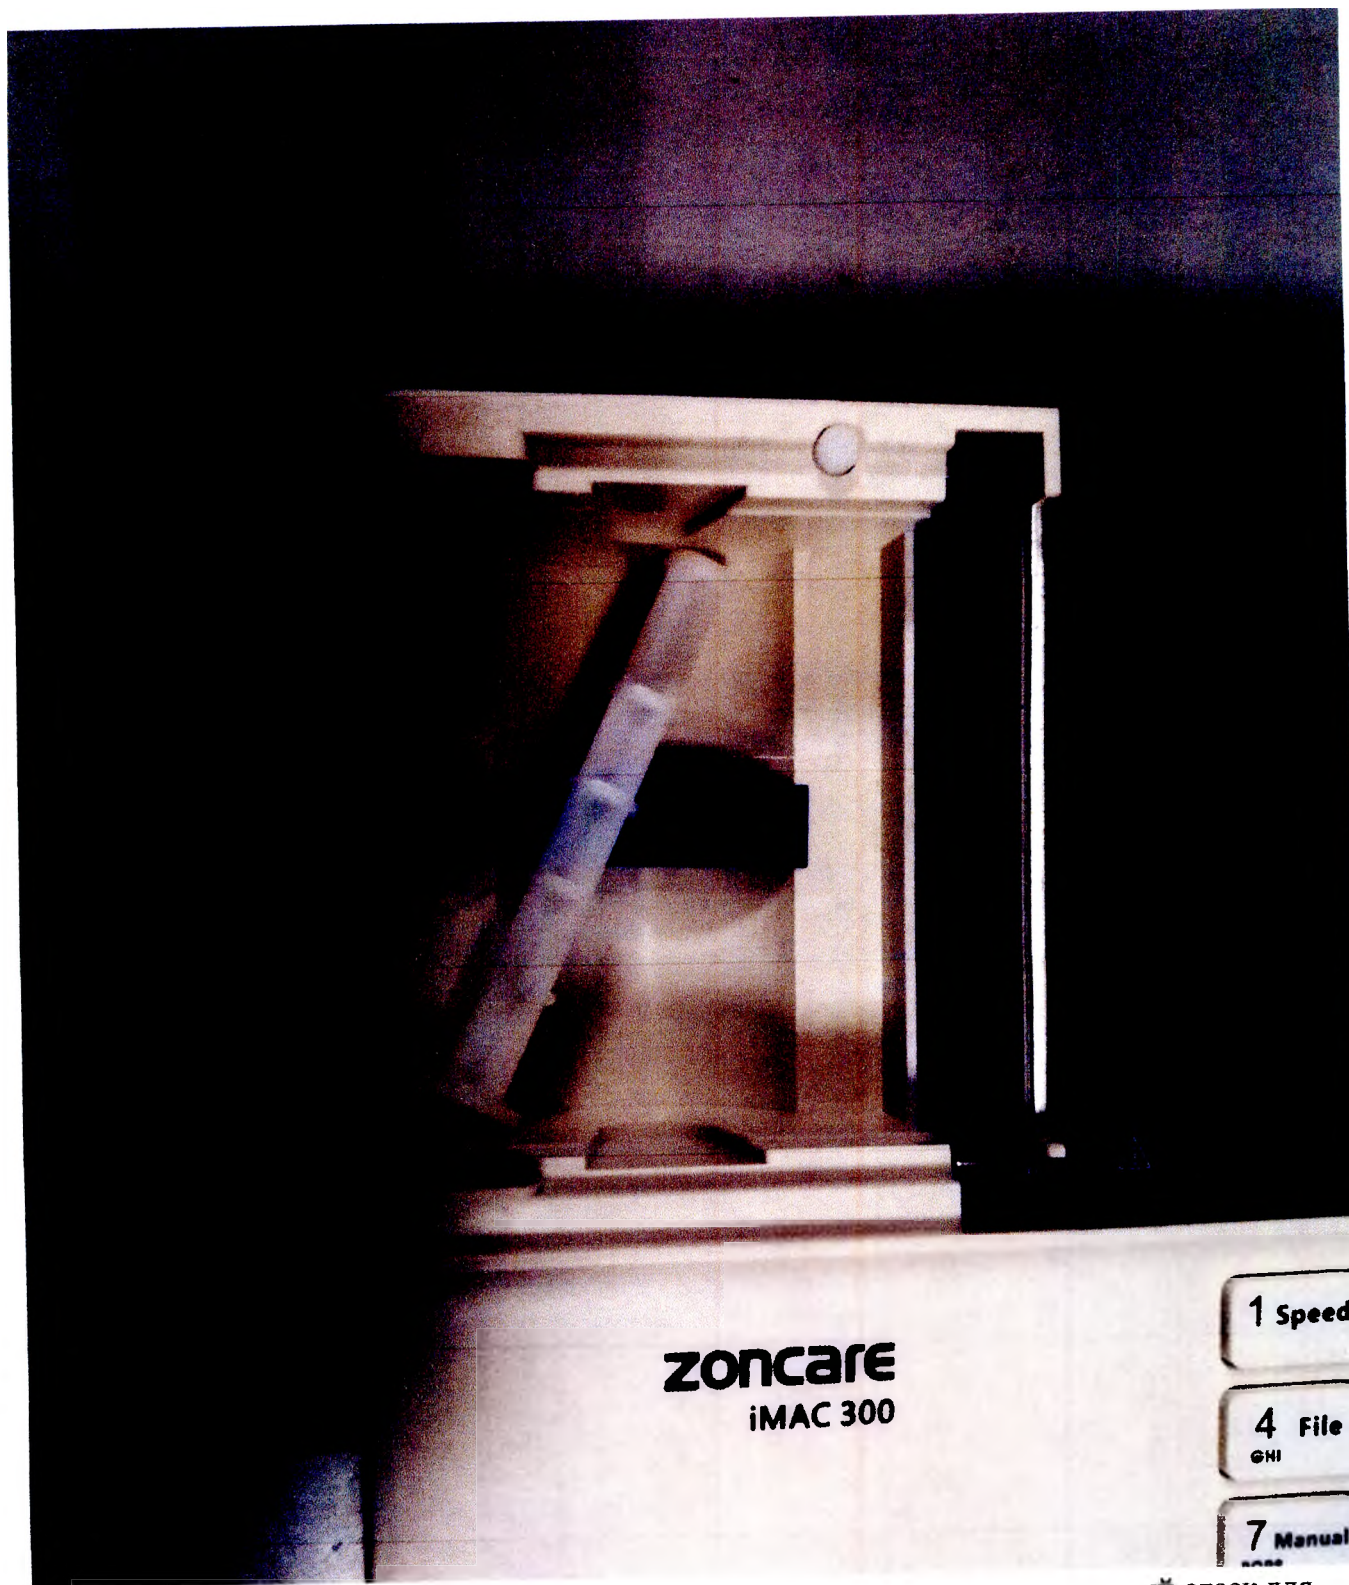


Рисунок 26 – Блок основной iMAC300 (вид сверху, крупным планом открытый отсек для термобумаги).

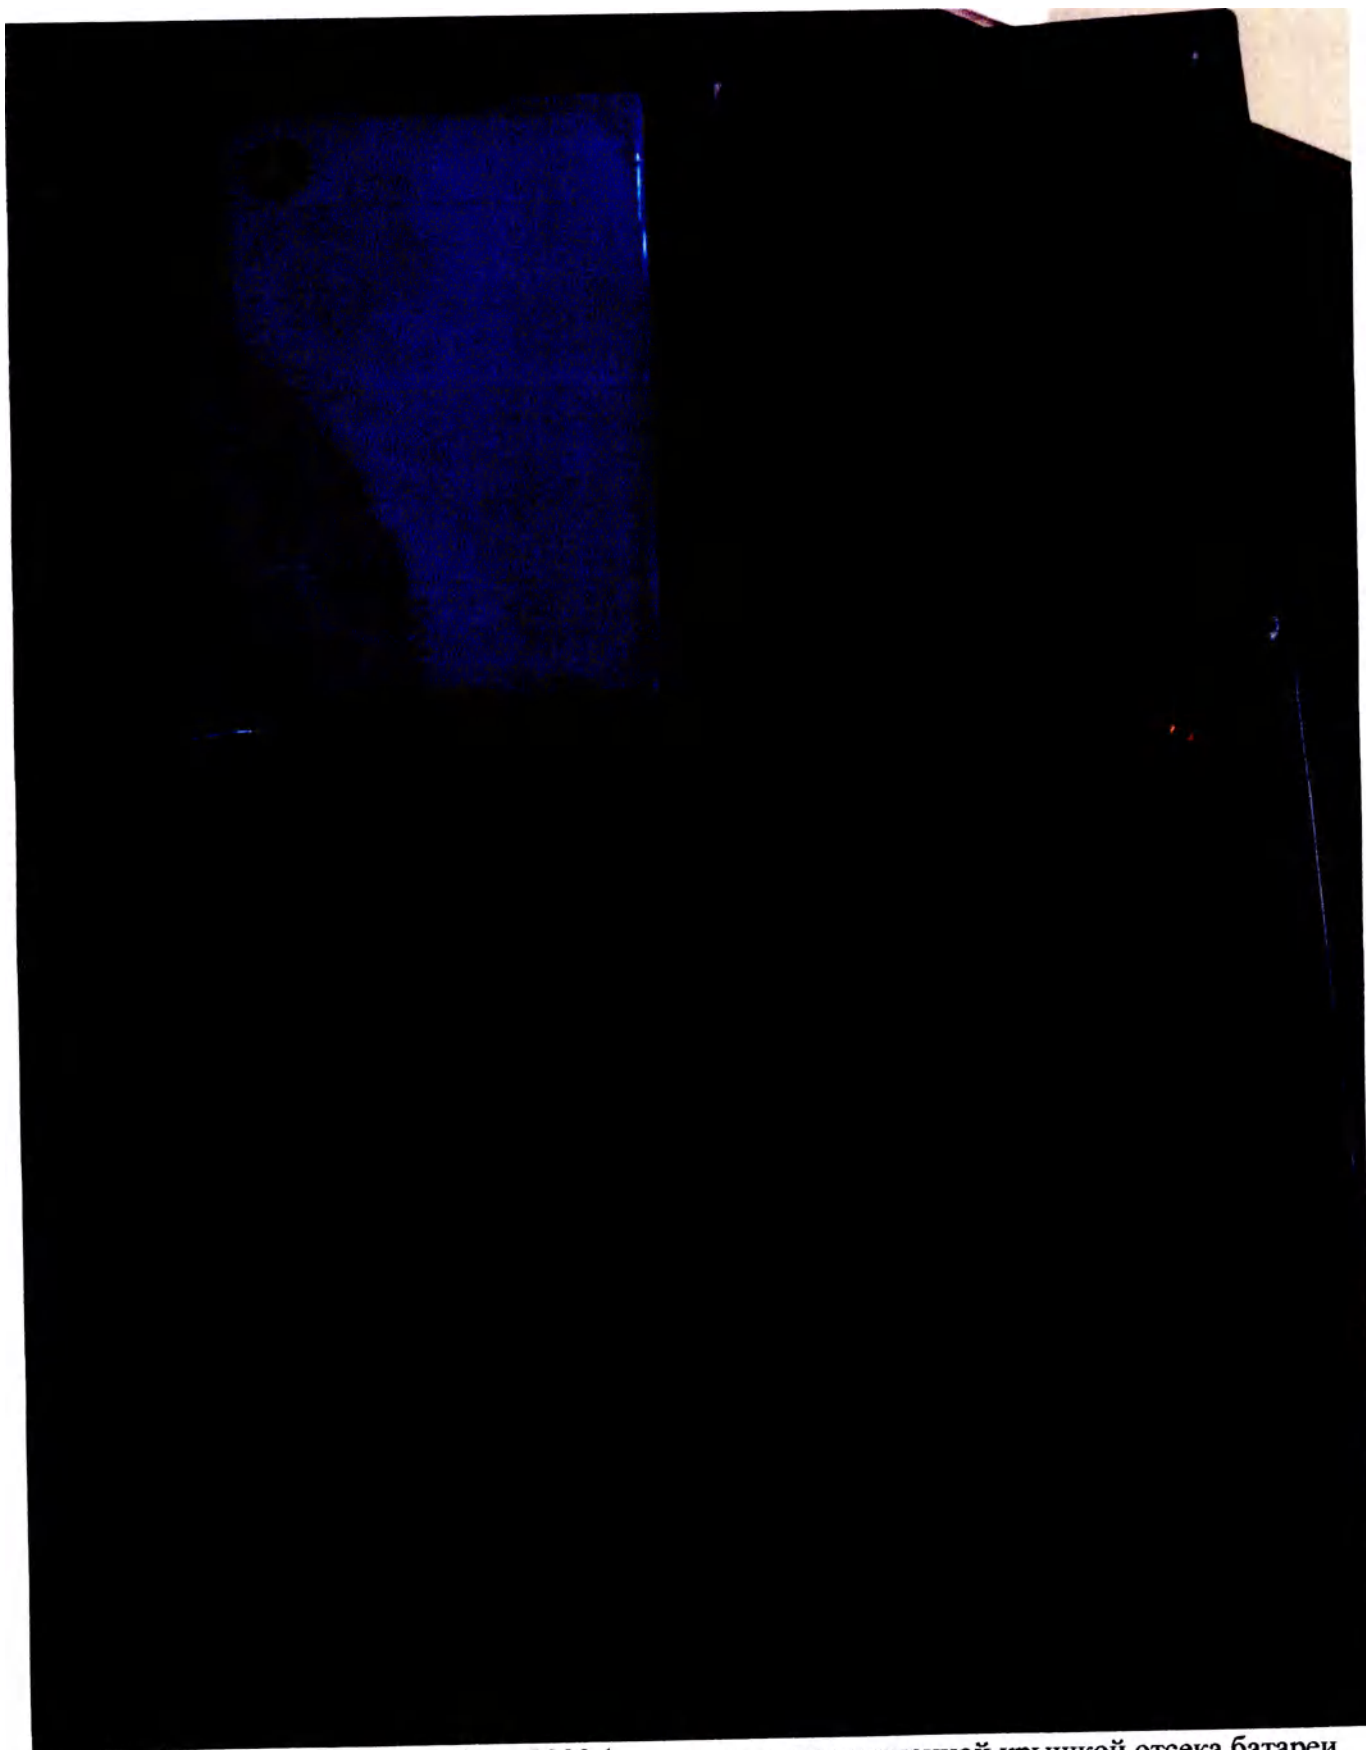


Рисунок 27 – Блок основной **iMAC300** (вид сзади, с отсоединенной крышкой отсека батареи аккумуляторной, с отсоединенной батареей аккумуляторной).



Рисунок 28 – Блок основной iMAC1200 (раскрытый).



Рисунок 29 – Блок основной iMAC1200 (вид спереди).

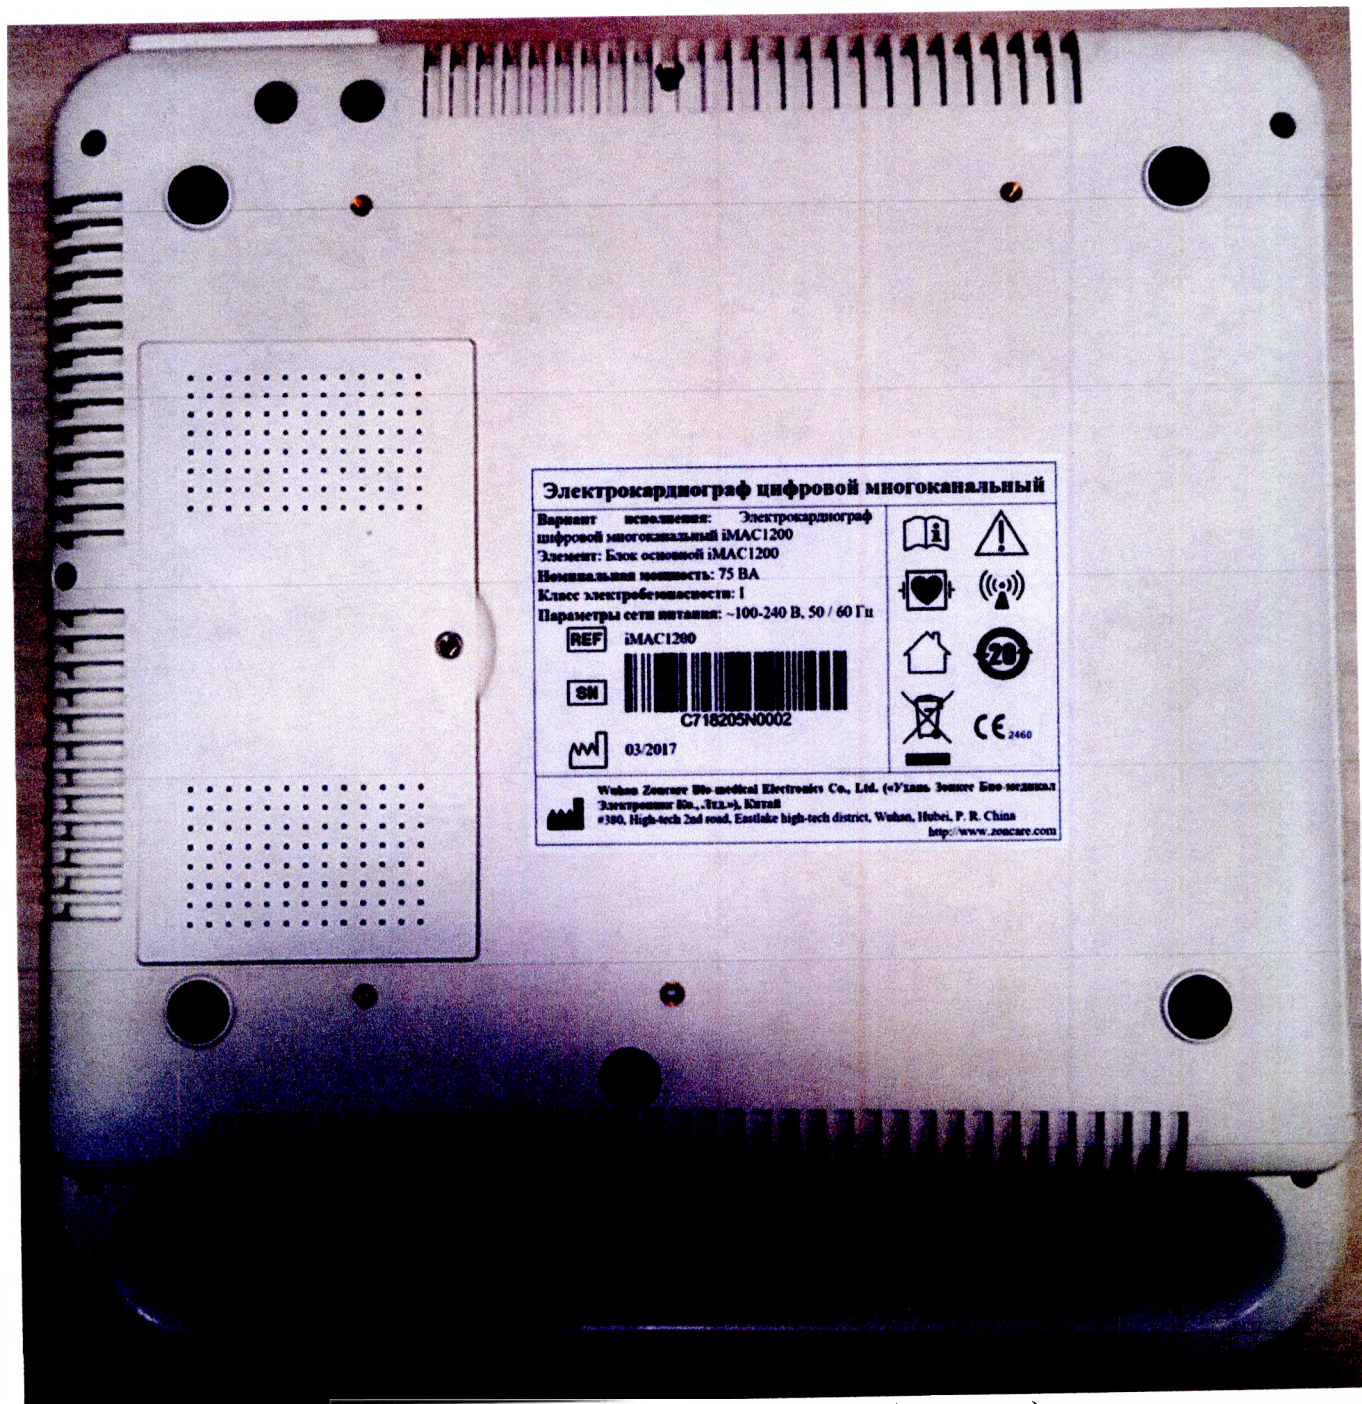


Рисунок 30 – Блок основной iMAC1200 (вид сзади).

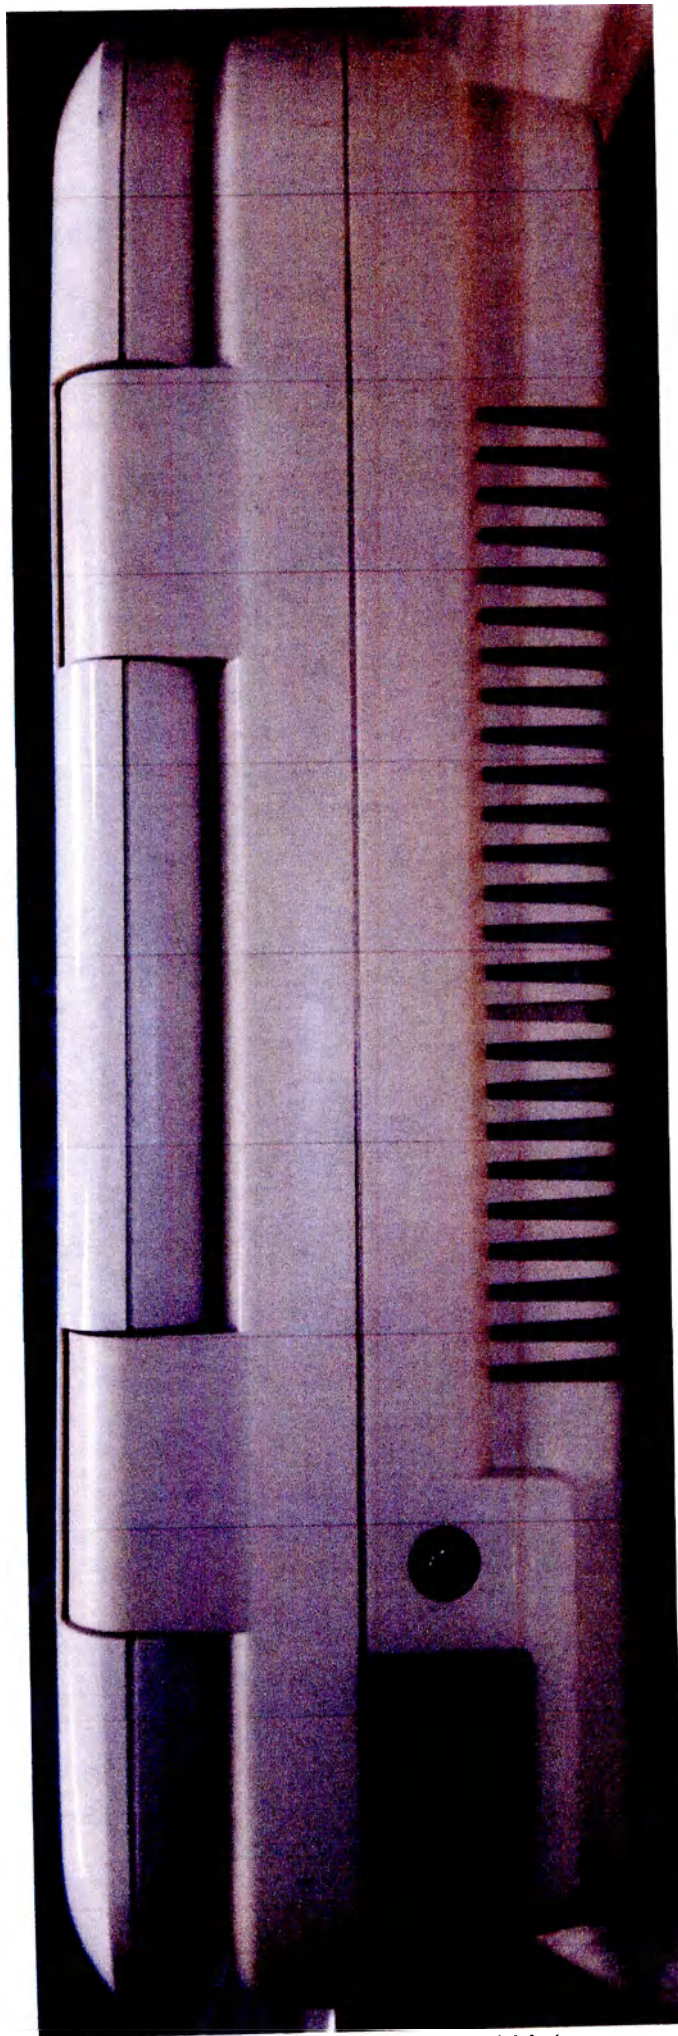


Рисунок 31 – Блок основной iMAC1200 (вид сверху).

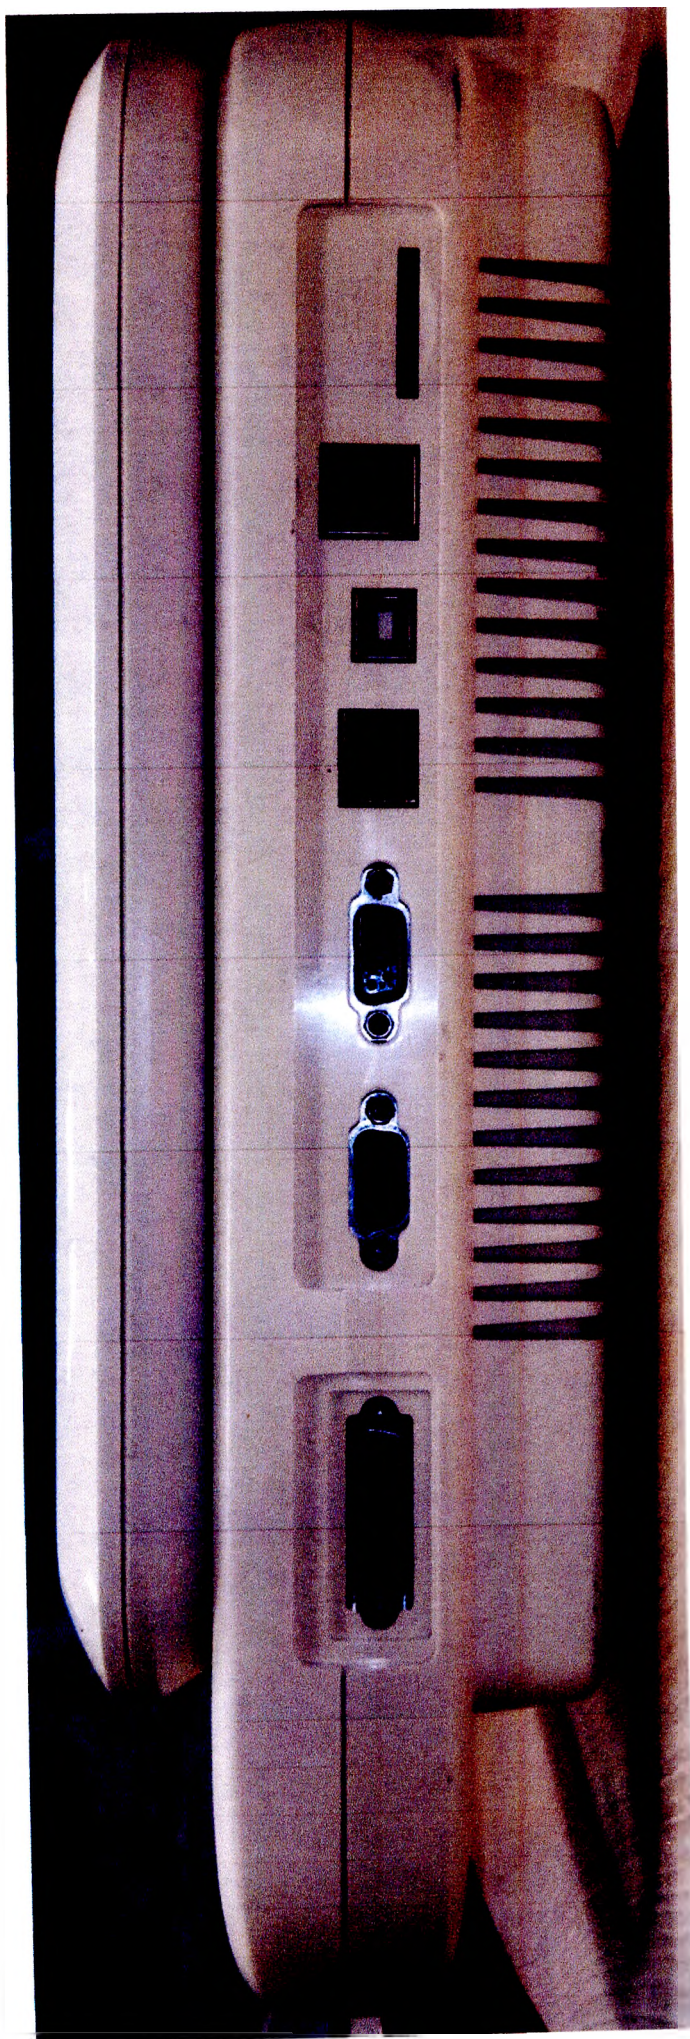


Рисунок 32 – Блок основной iMAC1200 (вид снизу).

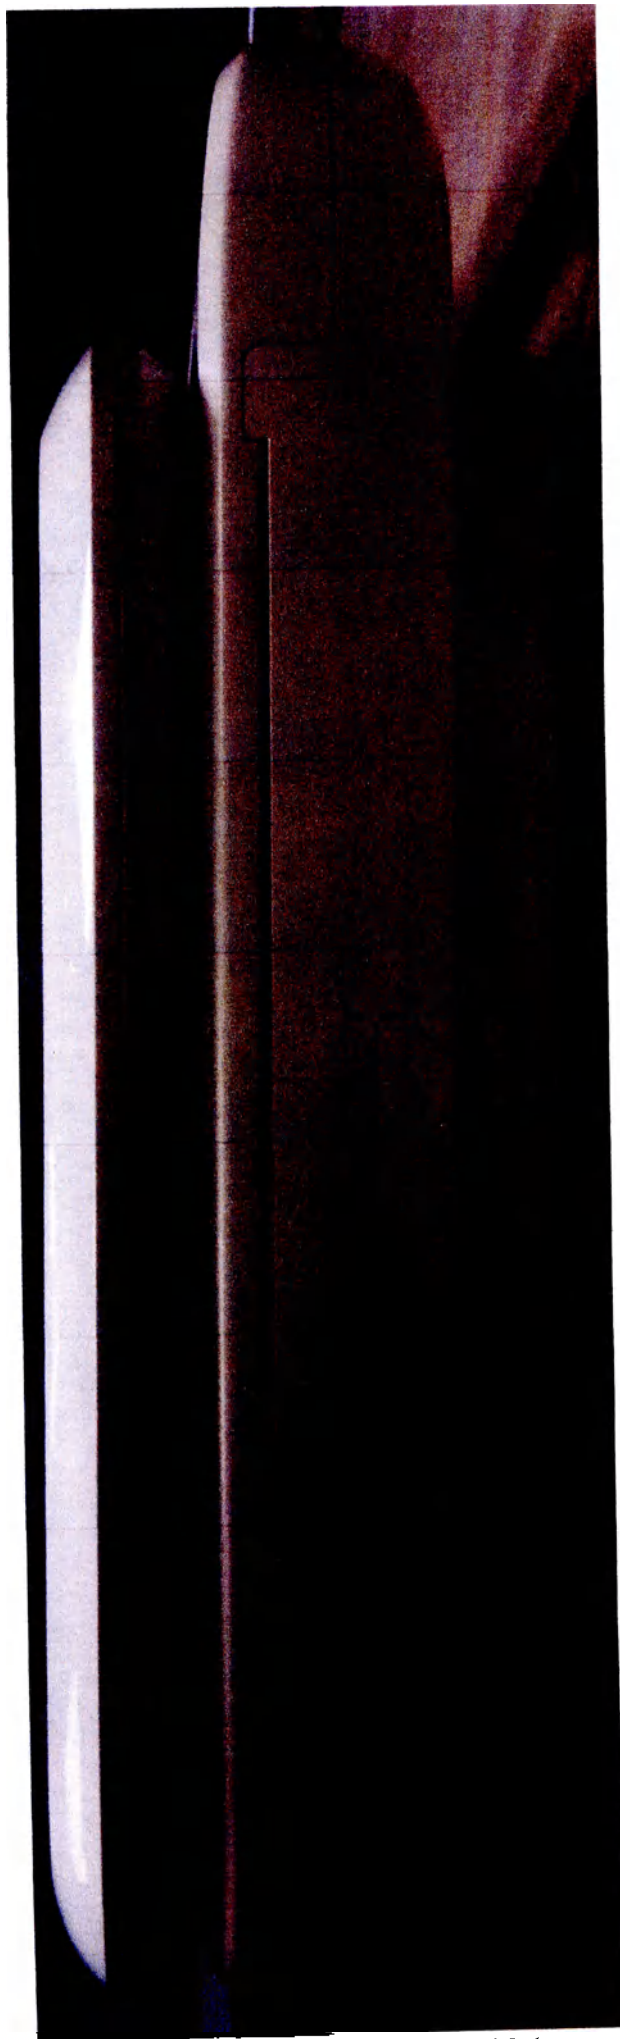


Рисунок 33 – Блок основной iMAC1200 (вид слева).



Рисунок 34 – Блок основной iMAC1200 (вид справа).

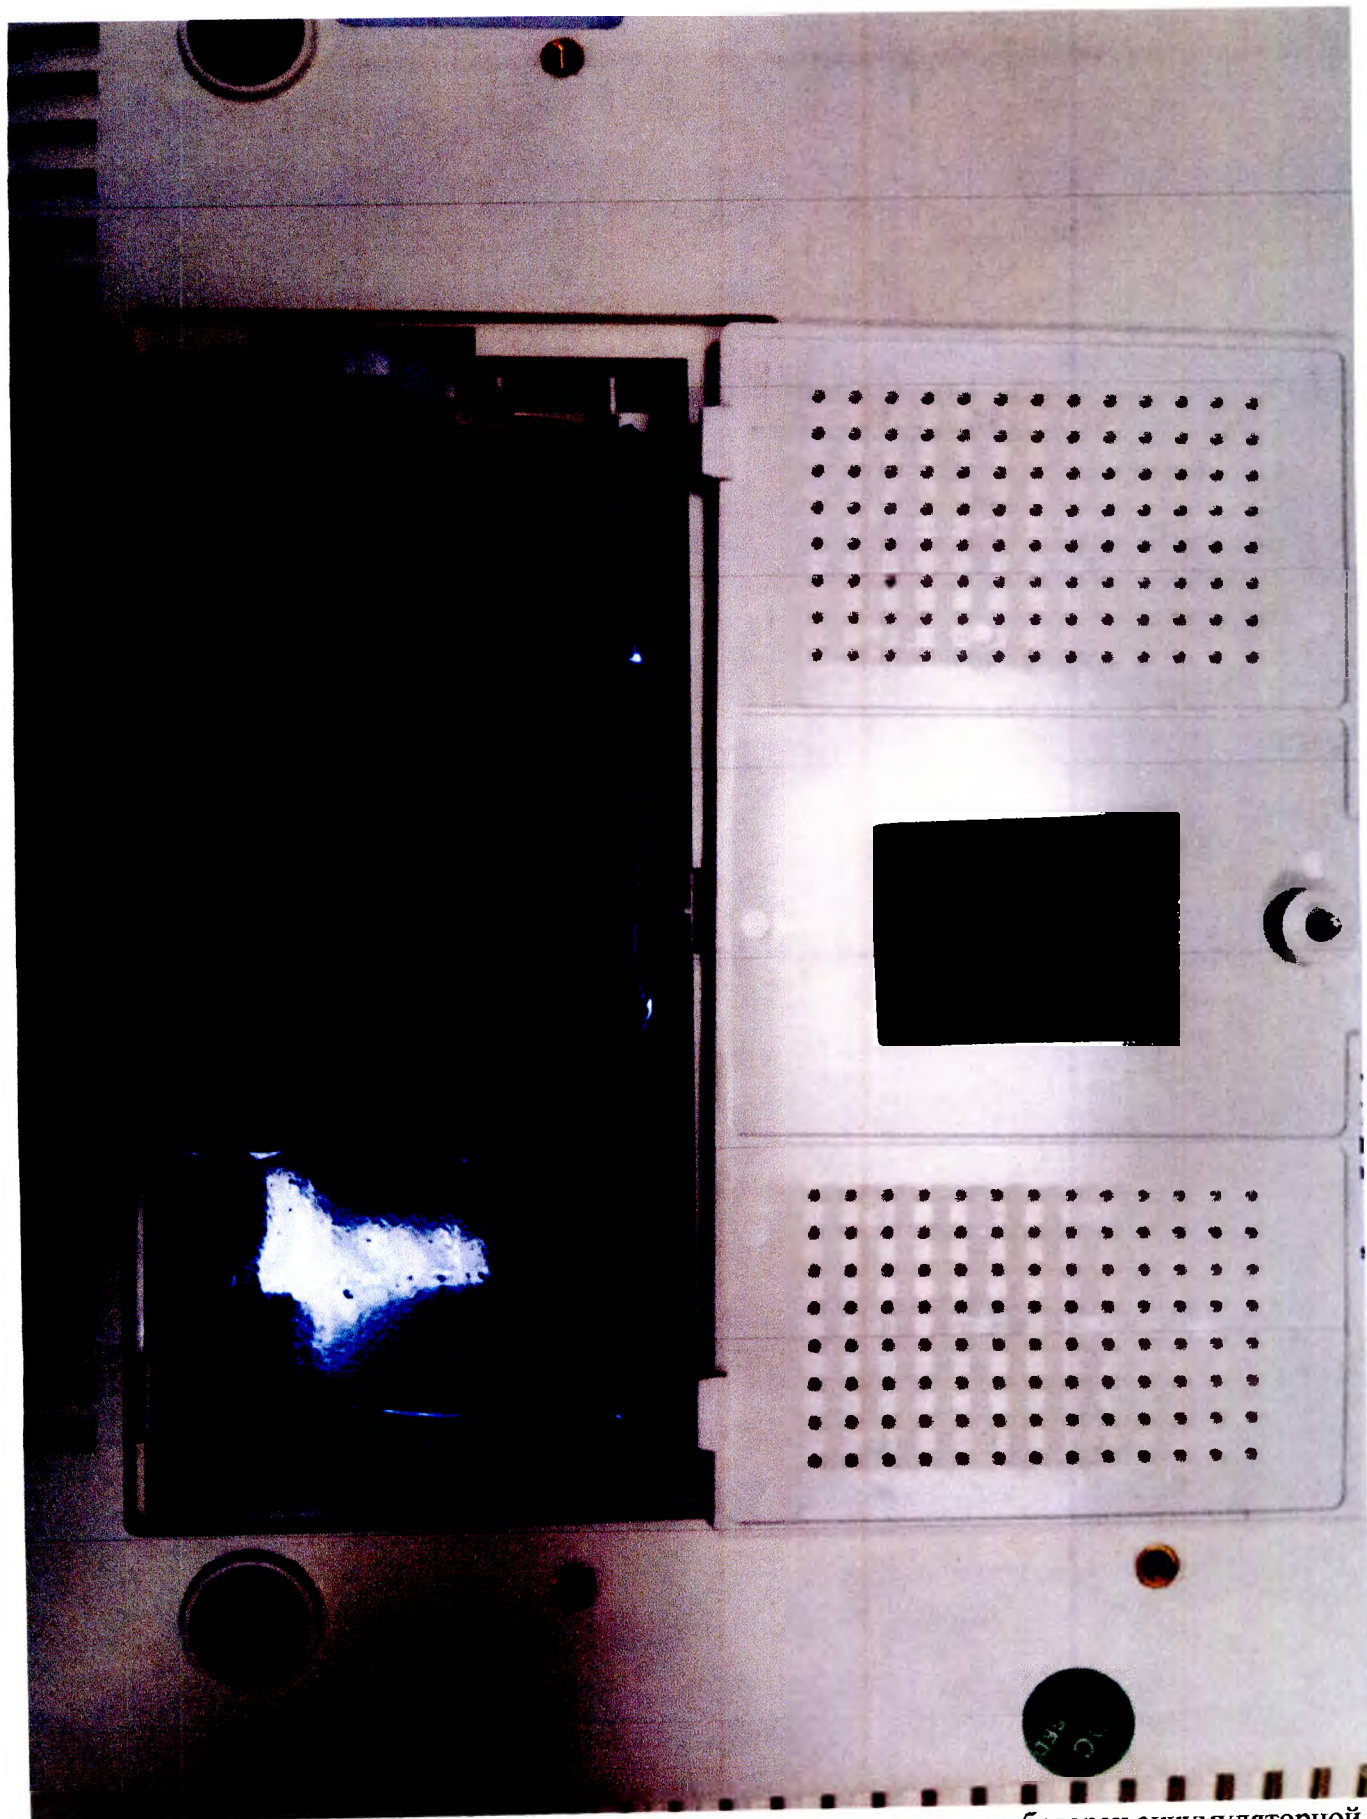


Рисунок 35 – Блок основной iMAC1200 (крупным планом вид на отсек батареи аккумуляторной (вид сзади, с отсоединенной крышкой отсека батареи аккумуляторной)).



Рисунок 36 – Кабель заземления эквипотенциальный.

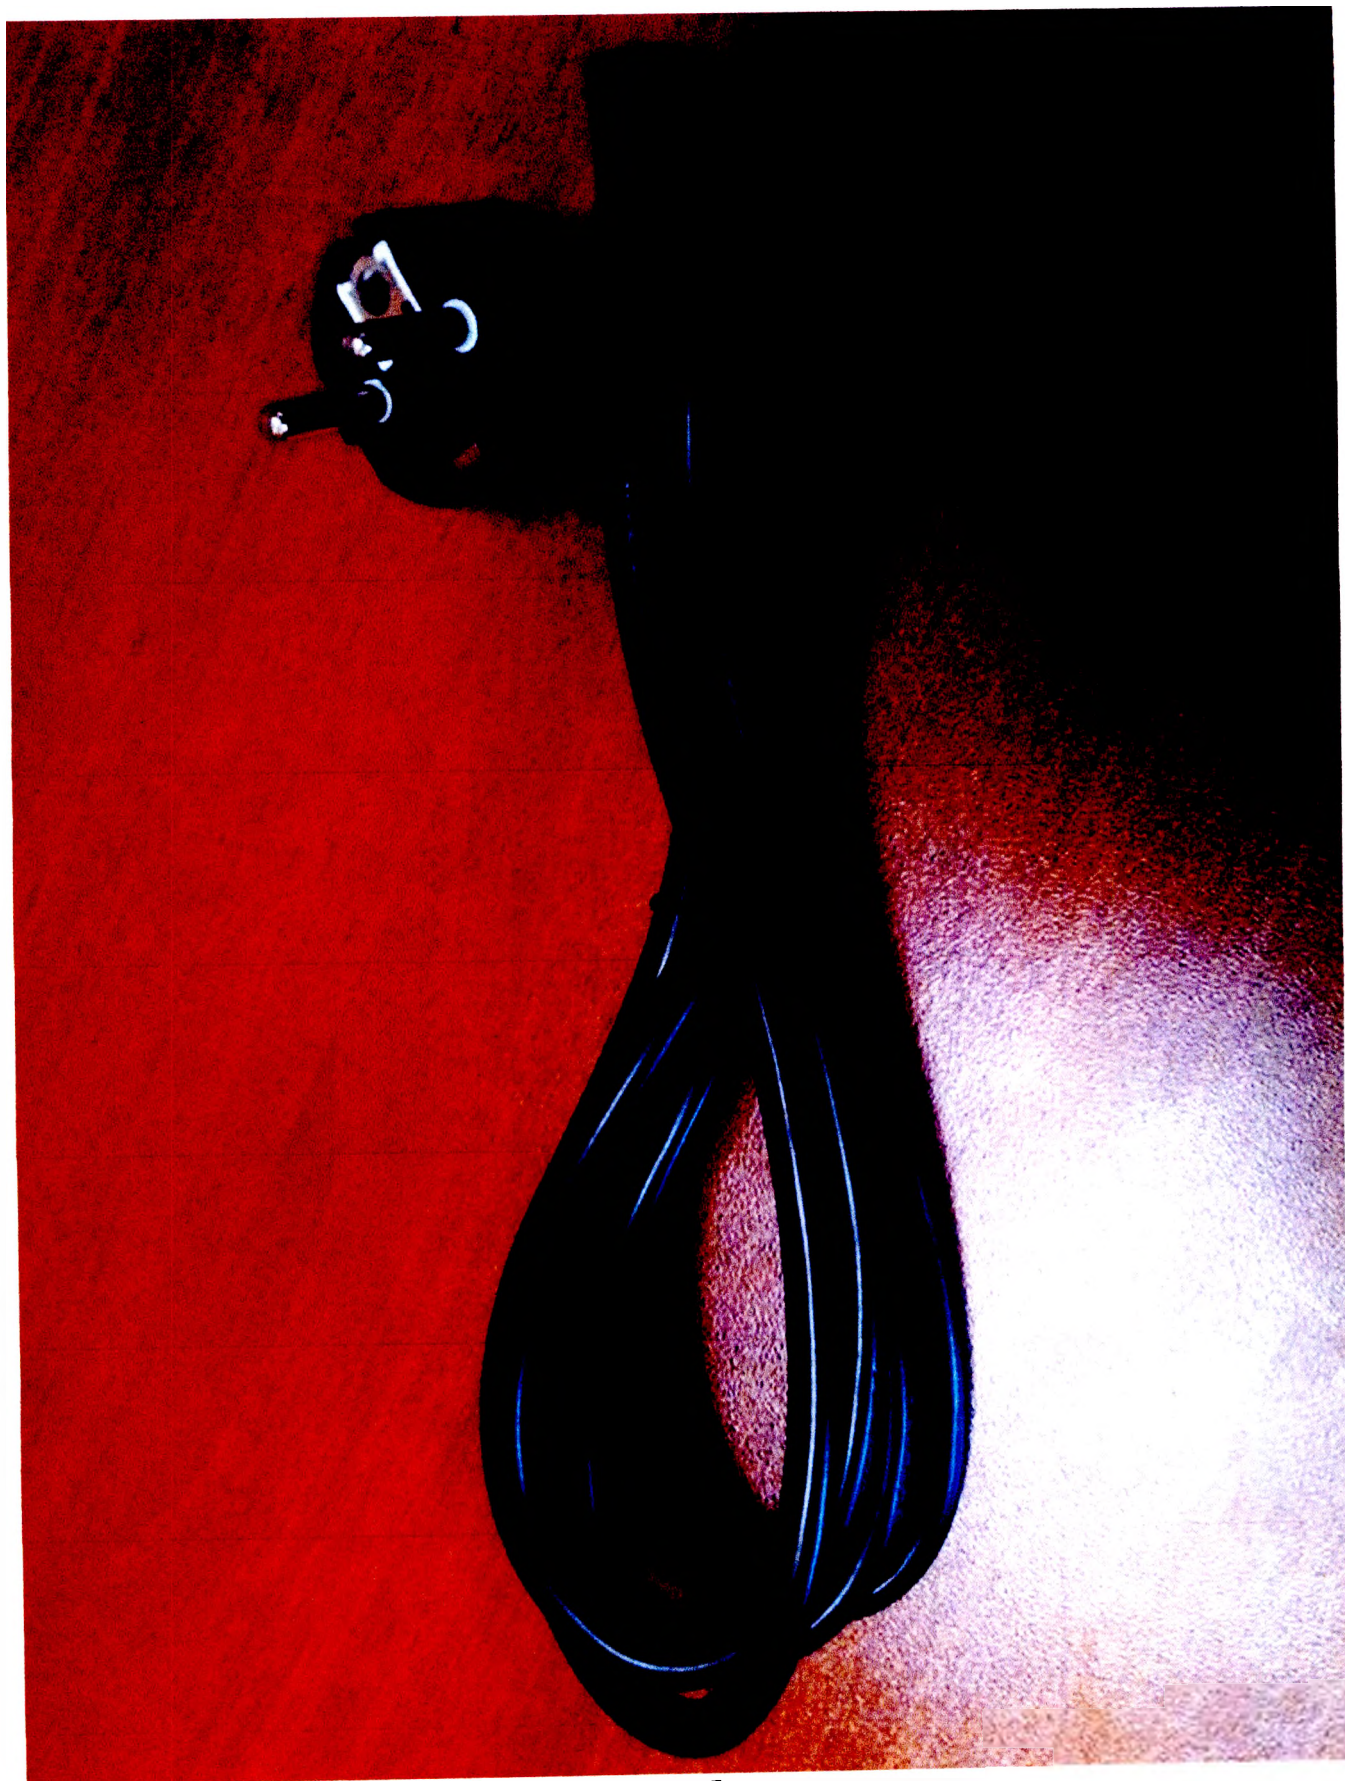


Рисунок 37 – Кабель питания.



Рисунок 38 – Кабель ЭКГ с разъемами типа Bana.

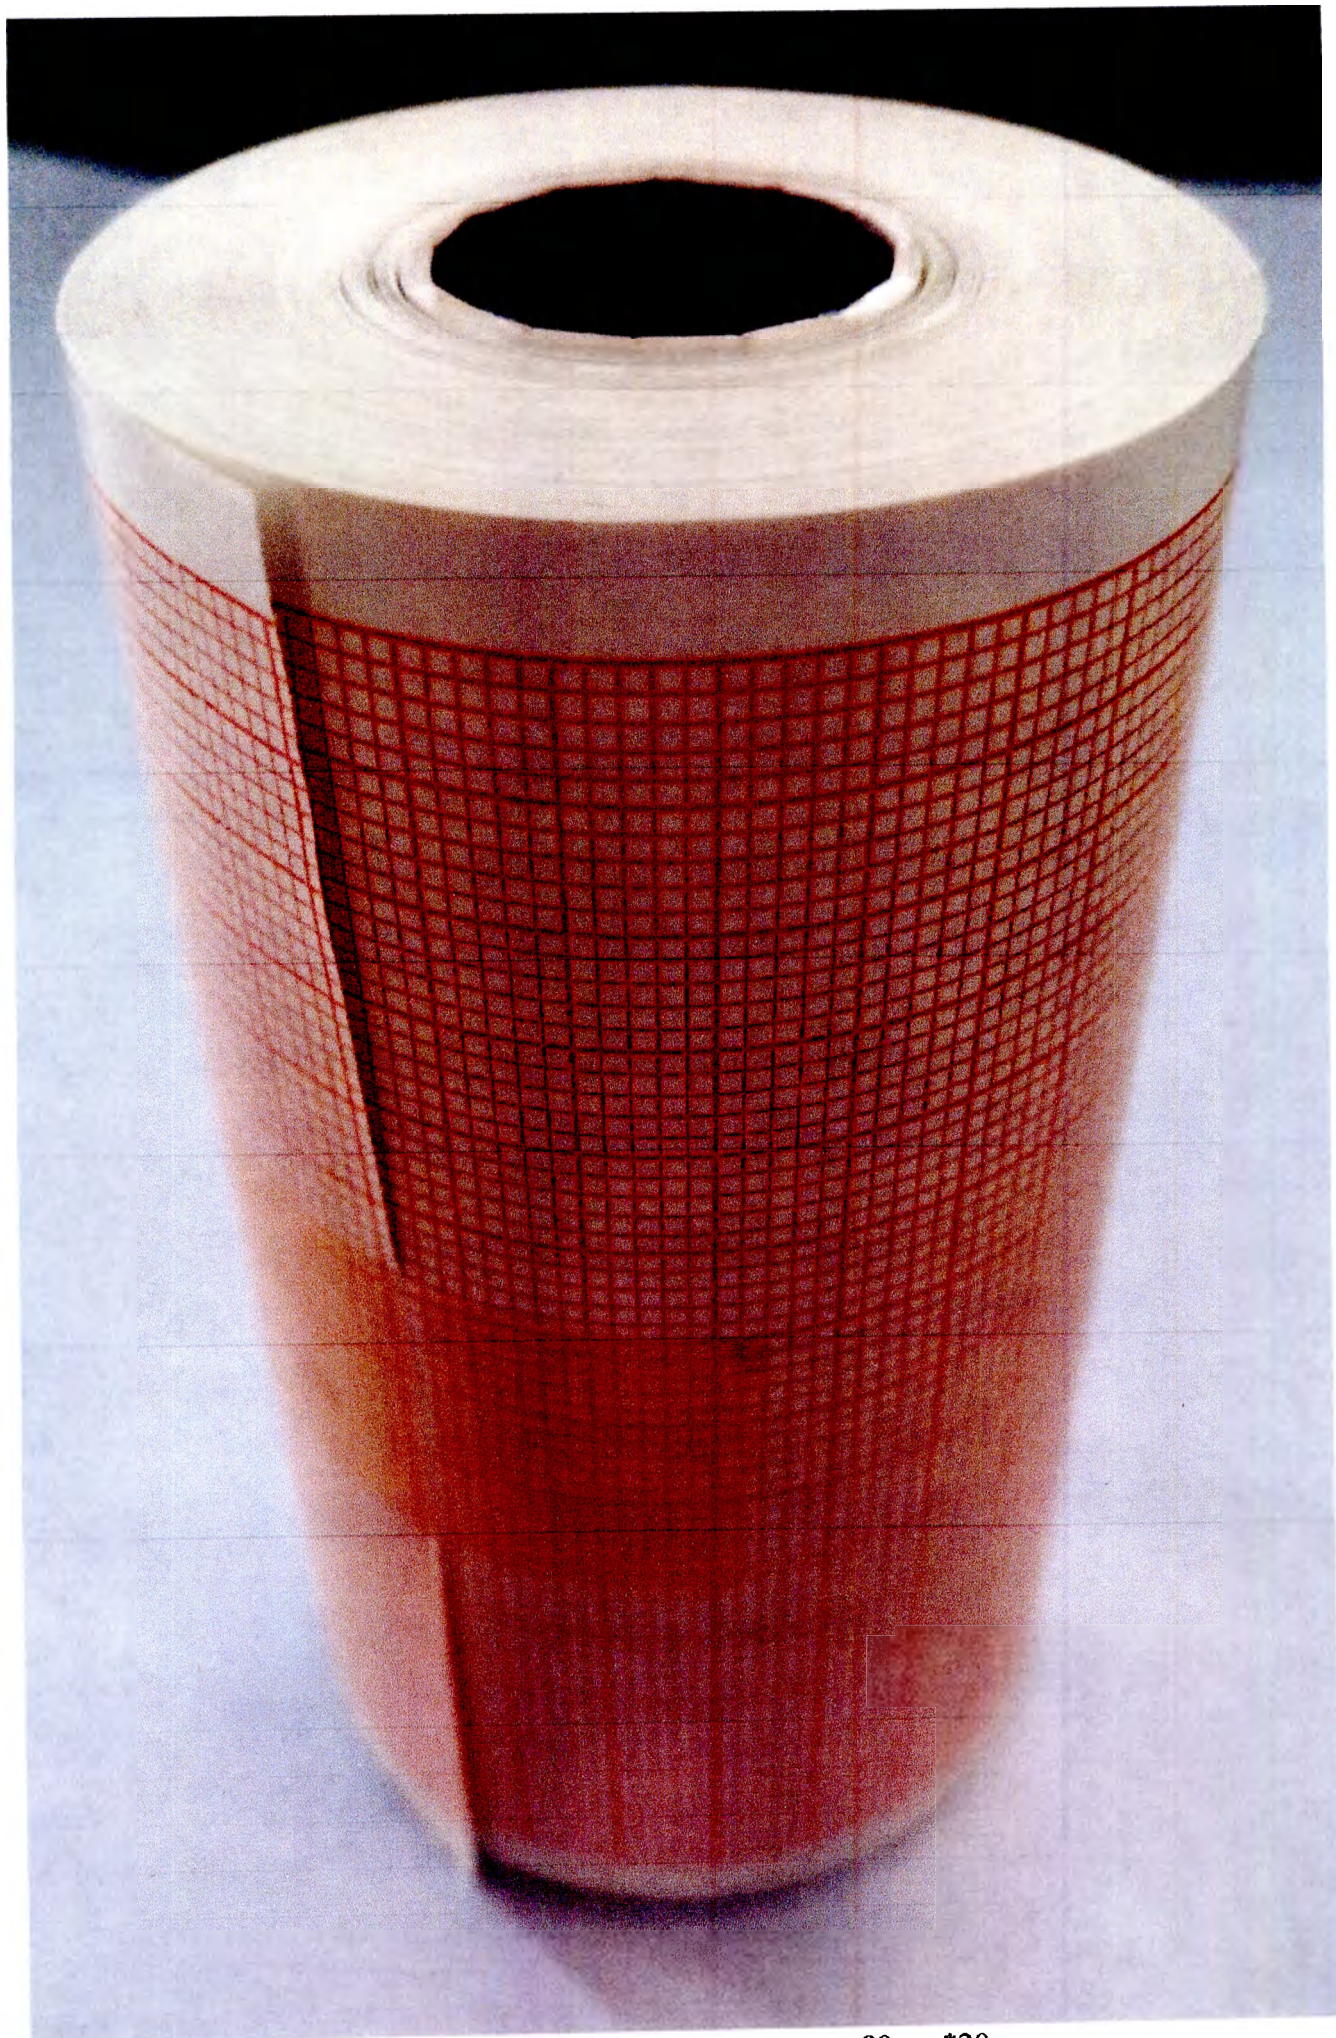


Рисунок 39 – Термобумага рулонная 80 мм*20 м.

112×100–10m

心电专用记录纸

E. C. G. SPECIAL. RECORDING. PAPER

Рисунок 40 – Термобумага Z-типа 112 мм*10 м.



Рисунок 41 – Термобумага Z-типа 210 мм*20 м.



Рисунок 42 – Предохранитель.



Рисунок 43 – Электроды грудные взрослые.



Рисунок 44 – Электроды на конечности взрослые.

Wuhan Zoncare Bio-medical Electronics Co., Ltd.
(«Ухань Зонкее Био-медиал Электроникс Ко., Лтд.»)

Изделие: Электрокардиограф цифровой многоканальный

**Исполнение: Электрокардиограф цифровой многоканальный
iMAC12**

Элемент: адаптер питания

Вх. параметры: 100-240 В, 50/60 Гц

Вых. параметры: $\overline{\text{---}}$ 19В, 3.16А макс.

Класс электрозащиты: I

Степень защиты оболочки: IP50

SN



**Адрес: #380, High-tech 2nd road, Eastlake high-tech district,
Wuhan, Hubei, P. R. China**

<http://www.zoncare.com>

Рисунок 45 – Маркировка адаптера питания.

Электрокардиограф цифровой многоканальный

Вариант исполнения: Электрокардиограф цифровой многоканальный iMAC12

Элемент: Блок основной iMAC12

Номинальная мощность: 75 ВА


Класс электробезопасности: I

Параметры сети питания: ~100-240 В, 50 / 60 Гц

REF

iMAC12

SN

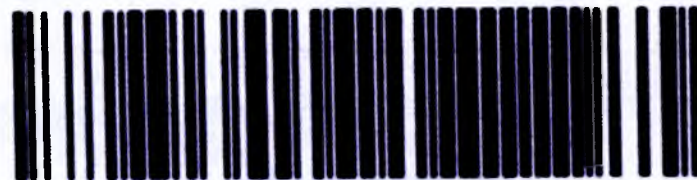


C718055N4848



12/2016



CE 2460



Wuhan Zoncare Bio-medical Electronics Co., Ltd. («Ухань Зонкее Био-медикал
Электроникс Ко., Лтд.»), Китай

#380, High-tech 2nd road, Eastlake high-tech district, Wuhan, Hubei, P. R. China

<http://www.zoncare.com>

Рисунок 46 – Маркировка блока основного iMAC12.

стр. 47 из 50

Электрокардиограф цифровой многоканальный

Вариант исполнения: Электрокардиограф цифровой многоканальный iMAC120

Элемент: Блок основной iMAC120

Номинальная мощность: 75 ВА

Класс электробезопасности: I

Параметры сети питания: ~100-240 В, 50 / 60 Гц

REF

iMAC120

SN



C718105N1056



04/2017



CE 2460



**Wuhan Zoncare Bio-medical Electronics Co., Ltd. («Ухань Зонкее Био-медикал
Электроникс Ко., Лтд.»), Китай**

#380. High-tech 2nd road. Eastlake high-tech district, Wuhan, Hubei, P. R. China

<http://www.zoncare.com>

Рисунок 47 – Маркировка блока основного iMAC120.

Электрокардиограф цифровой многоканальный

Вариант исполнения: Электрокардиограф цифровой многоканальный iMAC300

Элемент: Блок основной iMAC300

Номинальная мощность: 75 ВА


Класс электробезопасности: I

Параметры сети питания: ~100-240 В, 50 / 60 Гц

REF

iMAC300


SN

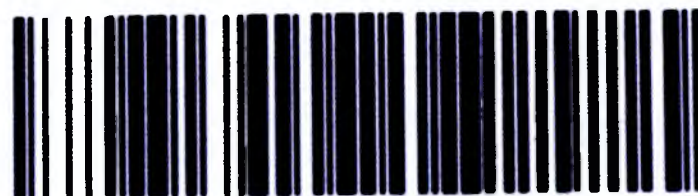

C718155N0122



02/2017



**Wuhan Zoncare Bio-medical Electronics Co., Ltd. («Ухань Зонкее Био-медикал
Электроникс Ко., Лтд.»), Китай**

#380, High-tech 2nd road, Eastlake high-tech district, Wuhan, Hubei, P. R. China

<http://www.zoncare.com>

Рисунок 48 – Маркировка блока основного iMAC300.

Электрокардиограф цифровой многоканальный

Вариант исполнения: Электрокардиограф цифровой многоканальный iMAC1200

Элемент: Блок основной iMAC1200

Номинальная мощность: 75 ВА


Класс электробезопасности: I

Параметры сети питания: ~100-240 В, 50 / 60 Гц

REF

iMAC1200

SN

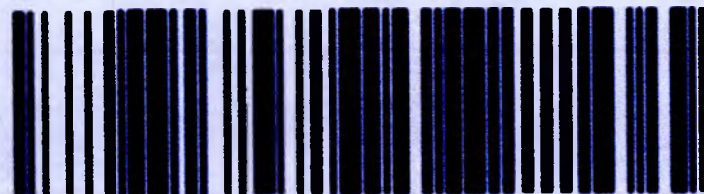

C718205N0002



03/2017



CE 2460



**Wuhan Zoncare Bio-medical Electronics Co., Ltd. («Ухань Зонкее Био-медикал
Электроникс Ко., Лтд.»), Китай**

#380, High-tech 2nd road, Eastlake high-tech district, Wuhan, Hubei, P. R. China

<http://www.zoncare.com>

Рисунок 49 – Маркировка блока основного iMAC1200.

стр. 50 из 50

ПРИЛОЖЕНИЕ

Электрокардиограф цифровой многоканальный

В вариантах исполнения:

1. Электрокардиограф цифровой многоканальный iMAC12, в составе:

- Адаптер питания – 1 шт.;
- Батарея аккумуляторная (REF 103450) (при необходимости) – 1 шт.;
- Блок основной iMAC12 – 1 шт.;
- Кабель питания – 1 шт.;
- Кабель ЭКГ с разъемами типа Banana – не более 2 шт.;
- Руководство по эксплуатации iMAC12 – 1 шт.;
- Термобумага Z-типа 112 мм*10 м (при необходимости) – не более 10 шт.;
- Электроды грудные взрослые – не более 12 шт.;
- Электроды на конечности взрослые – не более 8 шт.

2. Электрокардиограф цифровой многоканальный iMAC120, в составе:

- Батарея аккумуляторная (REF INR18650) (при необходимости) – 1 шт.;
- Блок основной iMAC120 – 1 шт.;
- Кабель заземления эквипотенциальный – 1 шт.;
- Кабель питания – 1 шт.;
- Кабель ЭКГ с разъемами типа Banana – не более 2 шт.;
- Руководство по эксплуатации iMAC120 – 1 шт.;
- Термобумага Z-типа 210 мм*20 м (при необходимости) – не более 10 шт.;
- Электроды грудные взрослые – не более 12 шт.;
- Электроды на конечности взрослые – не более 8 шт.

3. Электрокардиограф цифровой многоканальный iMAC300, в составе:

- Батарея аккумуляторная (REF BAK103450AR) (при необходимости) – 1 шт.;
- Блок основной iMAC300 – 1 шт.;
- Кабель заземления эквипотенциальный – 1 шт.;
- Кабель питания – 1 шт.;
- Кабель ЭКГ с разъемами типа Banana – не более 2 шт.;
- Руководство по эксплуатации iMAC300 – 1 шт.;
- Термобумага рулонная 80 мм*20 м (при необходимости) – не более 10 шт.;
- Электроды грудные взрослые – не более 12 шт.;
- Электроды на конечности взрослые – не более 8 шт.

4. Электрокардиограф цифровой многоканальный iMAC1200, в составе:

- Батарея аккумуляторная (REF INR18650) (при необходимости) – 1 шт.;
- Блок основной iMAC1200 – 1 шт.;
- Кабель заземления эквипотенциальный – 1 шт.;
- Кабель питания – 1 шт.;
- Кабель ЭКГ с разъемами типа Banana – не более 2 шт.;
- Предохранитель (при необходимости) – не более 4 шт.;
- Руководство по эксплуатации iMAC1200 – 1 шт.;
- Термобумага Z-типа 210 мм*20 м (при необходимости) – не более 10 шт.;
- Электроды грудные взрослые – не более 12 шт.;
- Электроды на конечности взрослые – не более 8 шт.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 51 листа (-ов)

Генеральный Директор Носова Т.А. / Носова Т.А.
М.П.

